

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2018 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
«Клапан гемостатический ОКАУП»
(Goodman Co., Ltd. («Гудман Ко., Лтд»), Япония)**



Рисунок 1- Клапан гемостатический

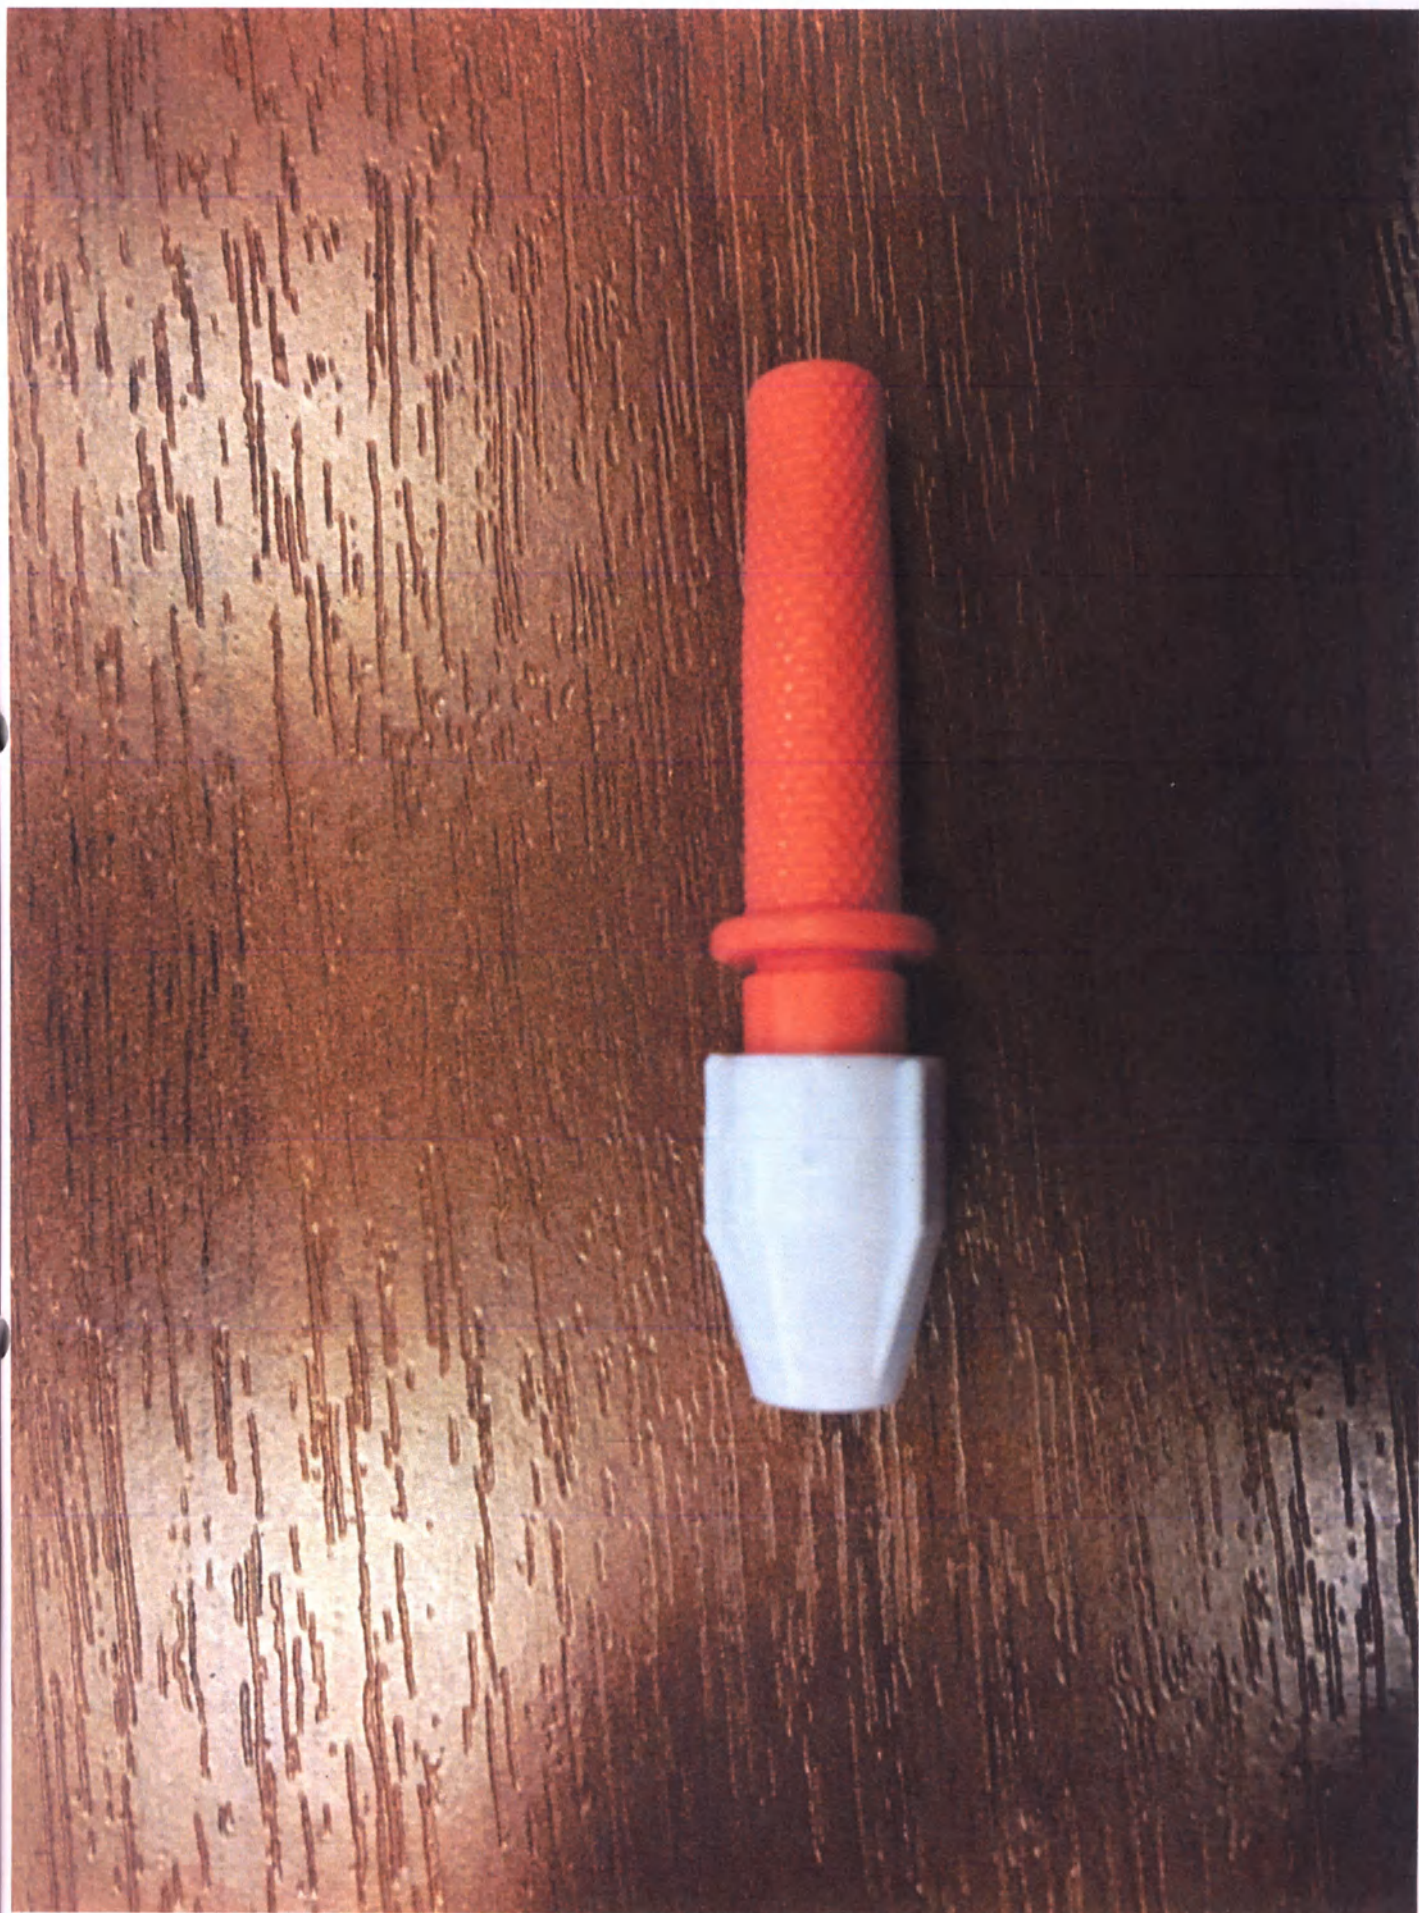


Рисунок 2- Толкатель проводника



Рисунок 3 - Игла-нитродерм

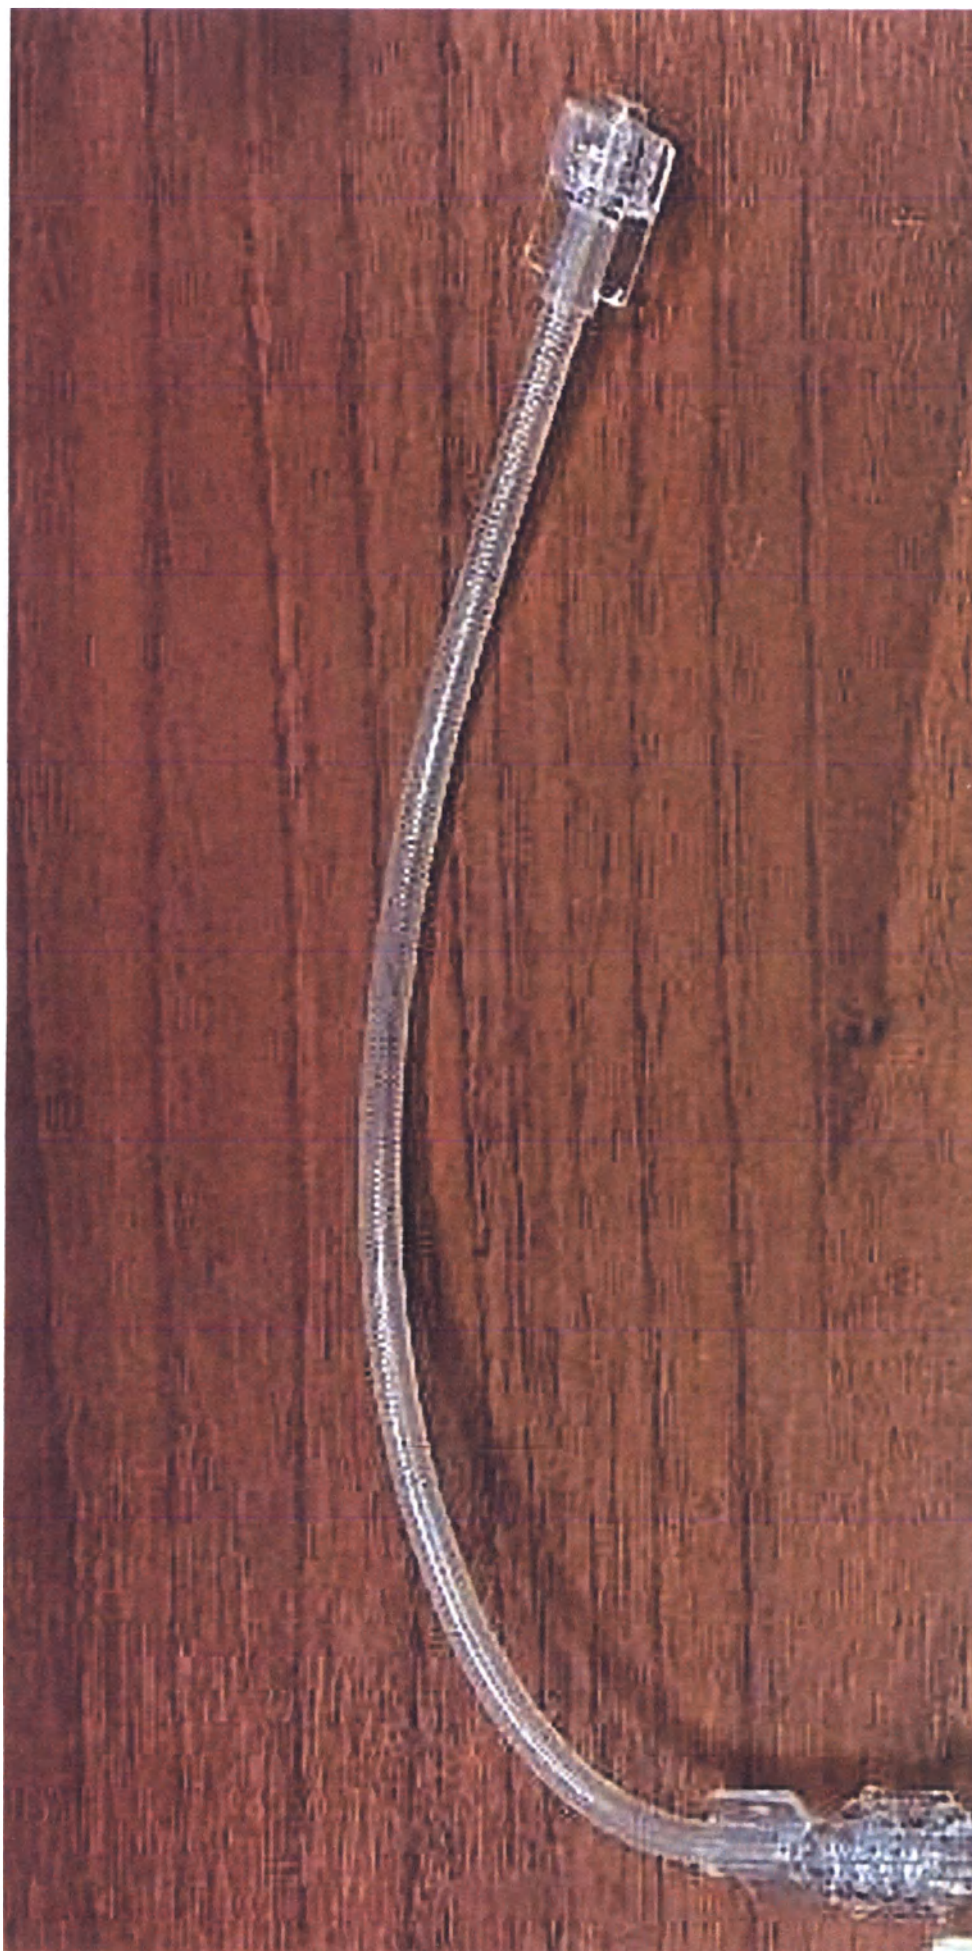


Рисунок 4 - Трубка удлинительная

ОКАУ П

Клапан гемостатический

REF **YOKOE**
LOT **YA160912W**

Дата стерилизации **2016-09**
Дата истечения срока годности **2019-08**

STERILE EO



Содержит:
- Клапан гемостатический.
- Трубка удлинительная.
- Игла-интродьюсер.
- Токарь проводника.
НЕТОКСИЧНО

Стерильно, стерилизация этиленоксидом



Внимание, обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при поврежденной упаковке



Не использовать повторно

CE
0086



(01)04543660004248(17)190831(30)01(10)YA160912W

Производитель:

Goodman Co., Ltd. («Гудман Ко., Лтд»), Япония.
5F KDX Nagoya Sakae Building, 4-5-3 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0008 Japan.
Тел.: 81-52-269-5300.

Место производства: Goodman Co., Ltd. Goodman Research Center.
(«Гудман Ко., Лтд. Гудман Ресерч Центр.»), Япония.
276-1 Idongane-cho, Seto, Aichi 489-0976 Japan.
Тел.: 81-561-85-6821, факс: 81-561-85-6831

Уполномоченный представитель на территории ЕС:

Goodman Medical Ireland Limited
David Mackie

Mervue Business Park Galway
Ireland

Rev:YLC2G

Рисунок 5 - Маркировка упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 6 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

