






Кровать медицинская функциональная Total-Lift Bed, с
вытяжными механизмами: V6-TLB425 V/T, V6-TLB425 T

1. Форма крепления

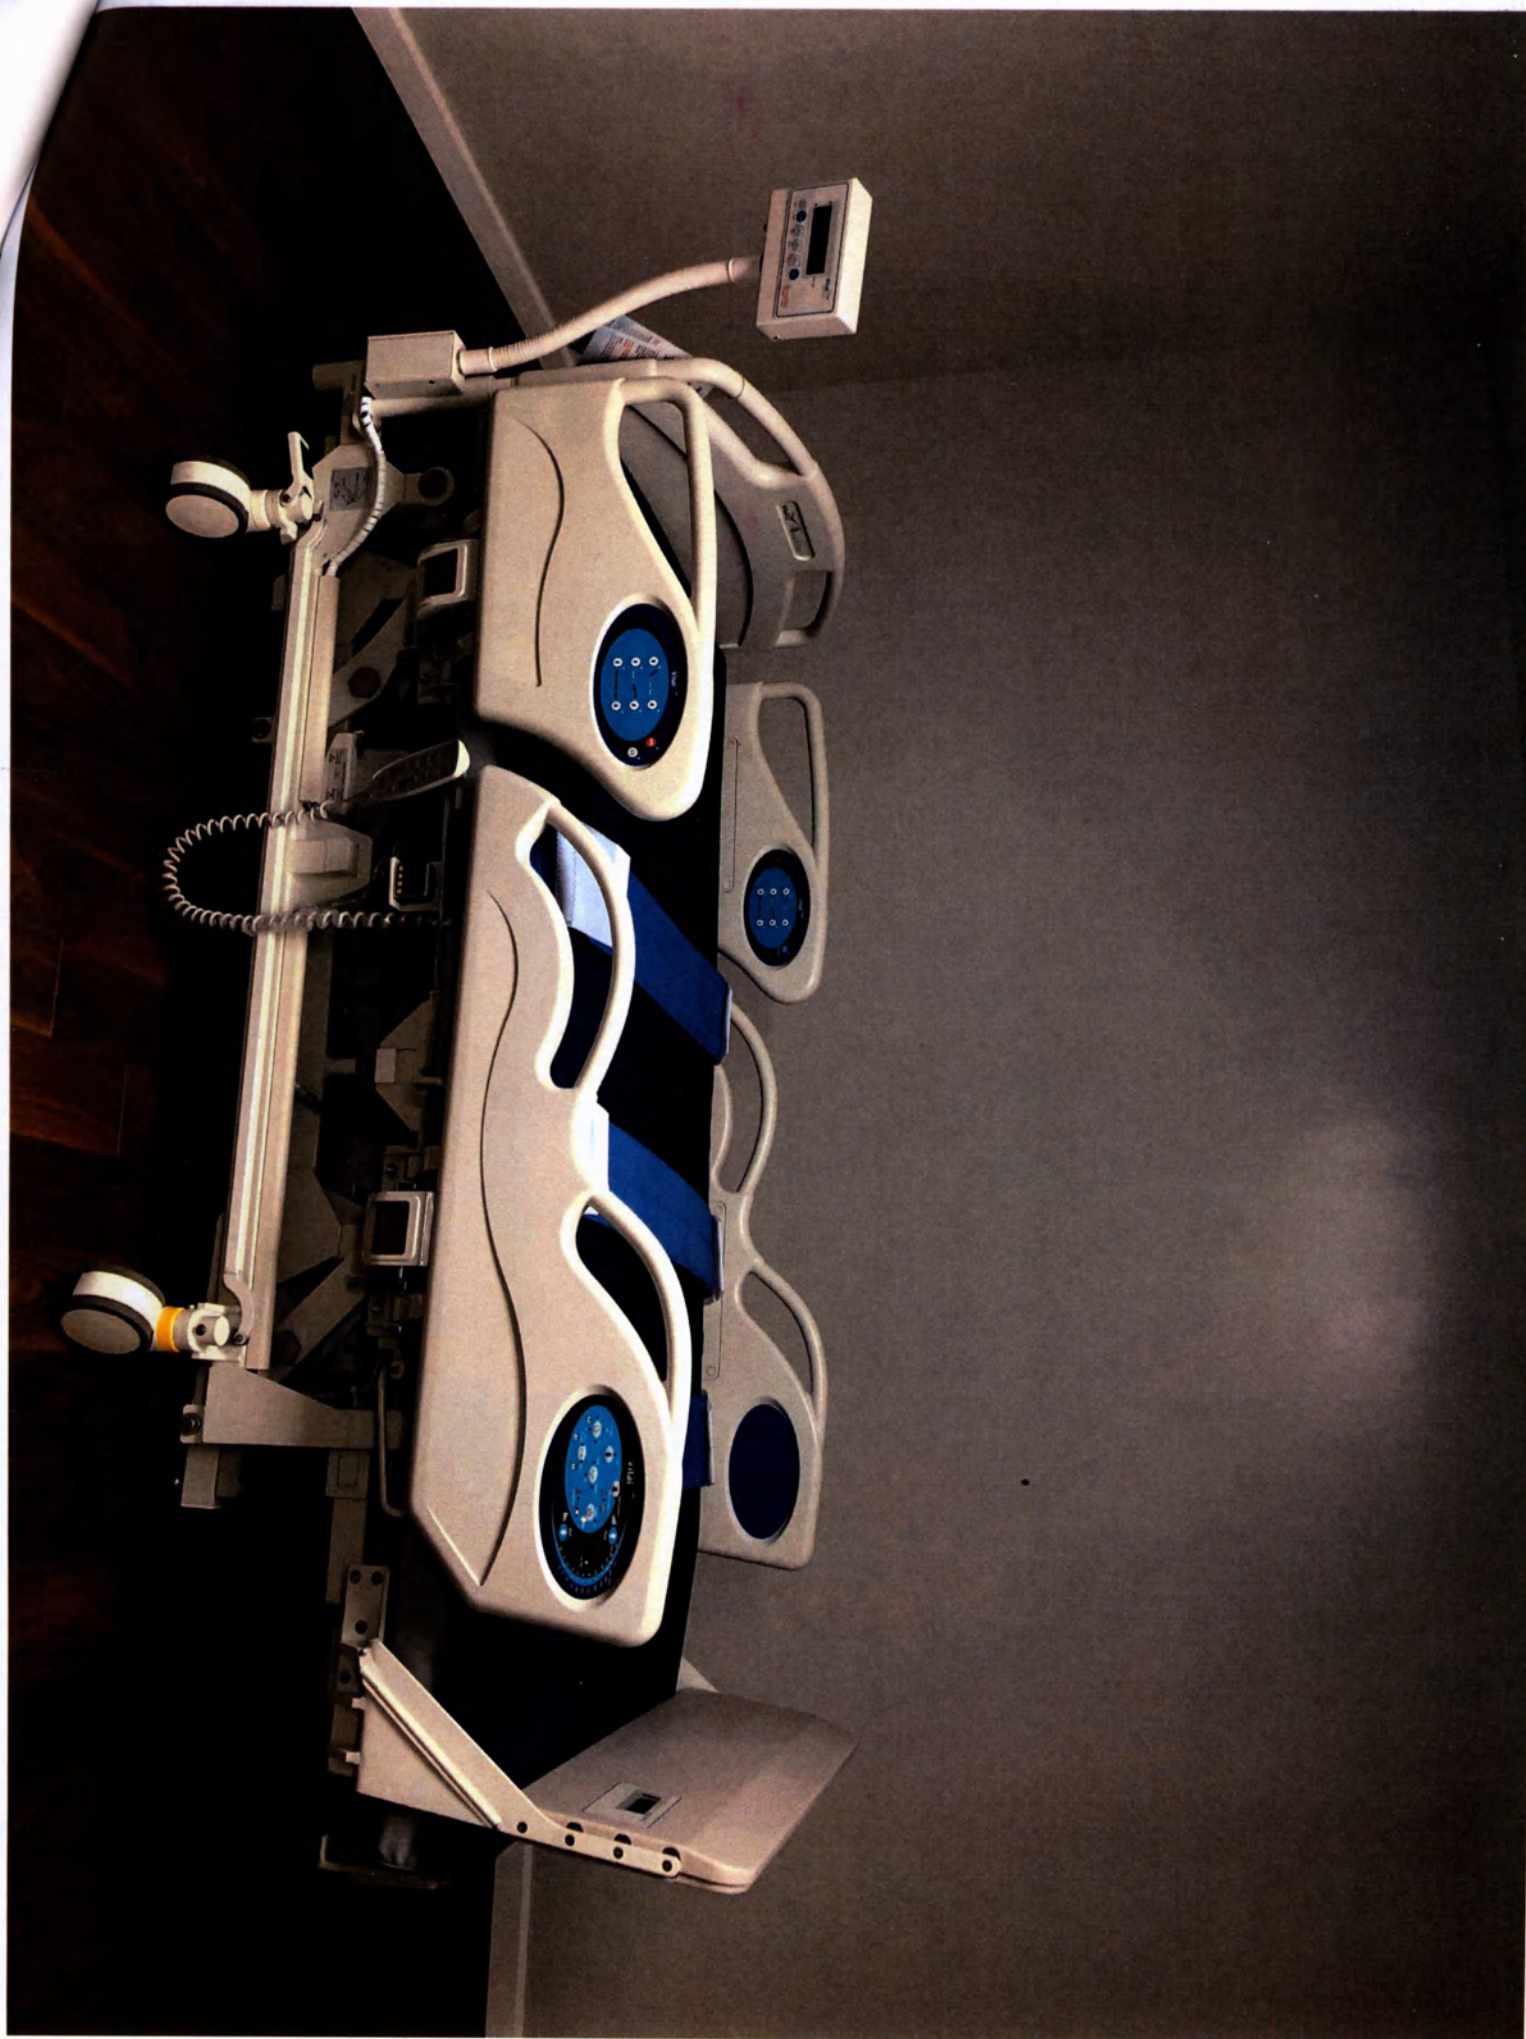

2. Проверка кровли на предмет коррозии

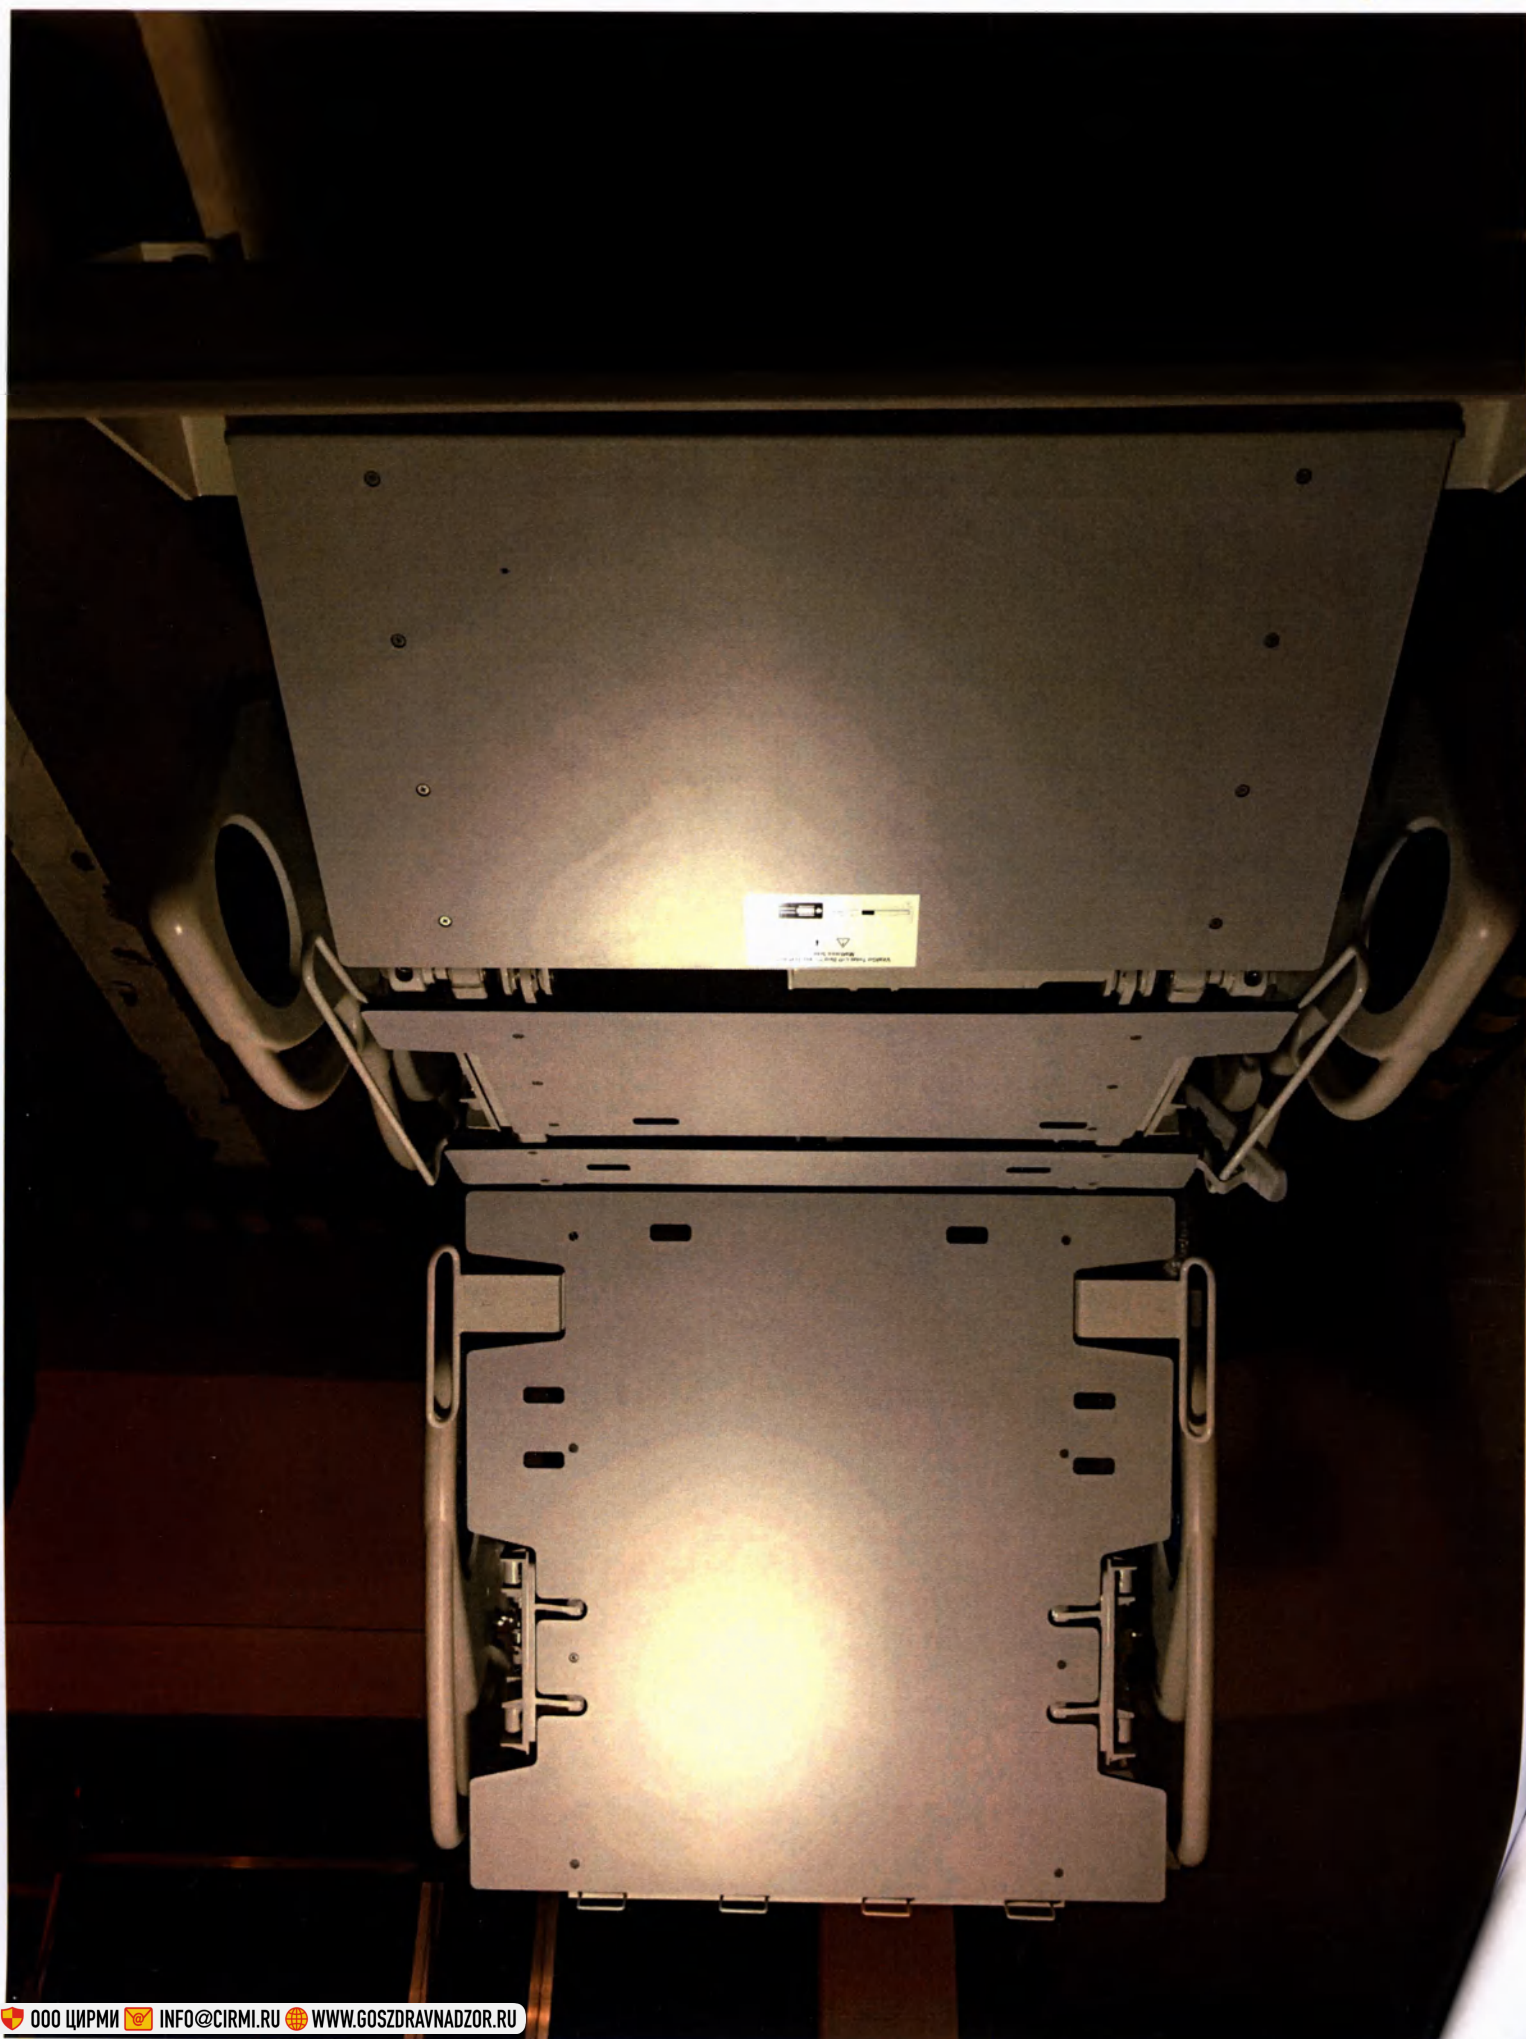


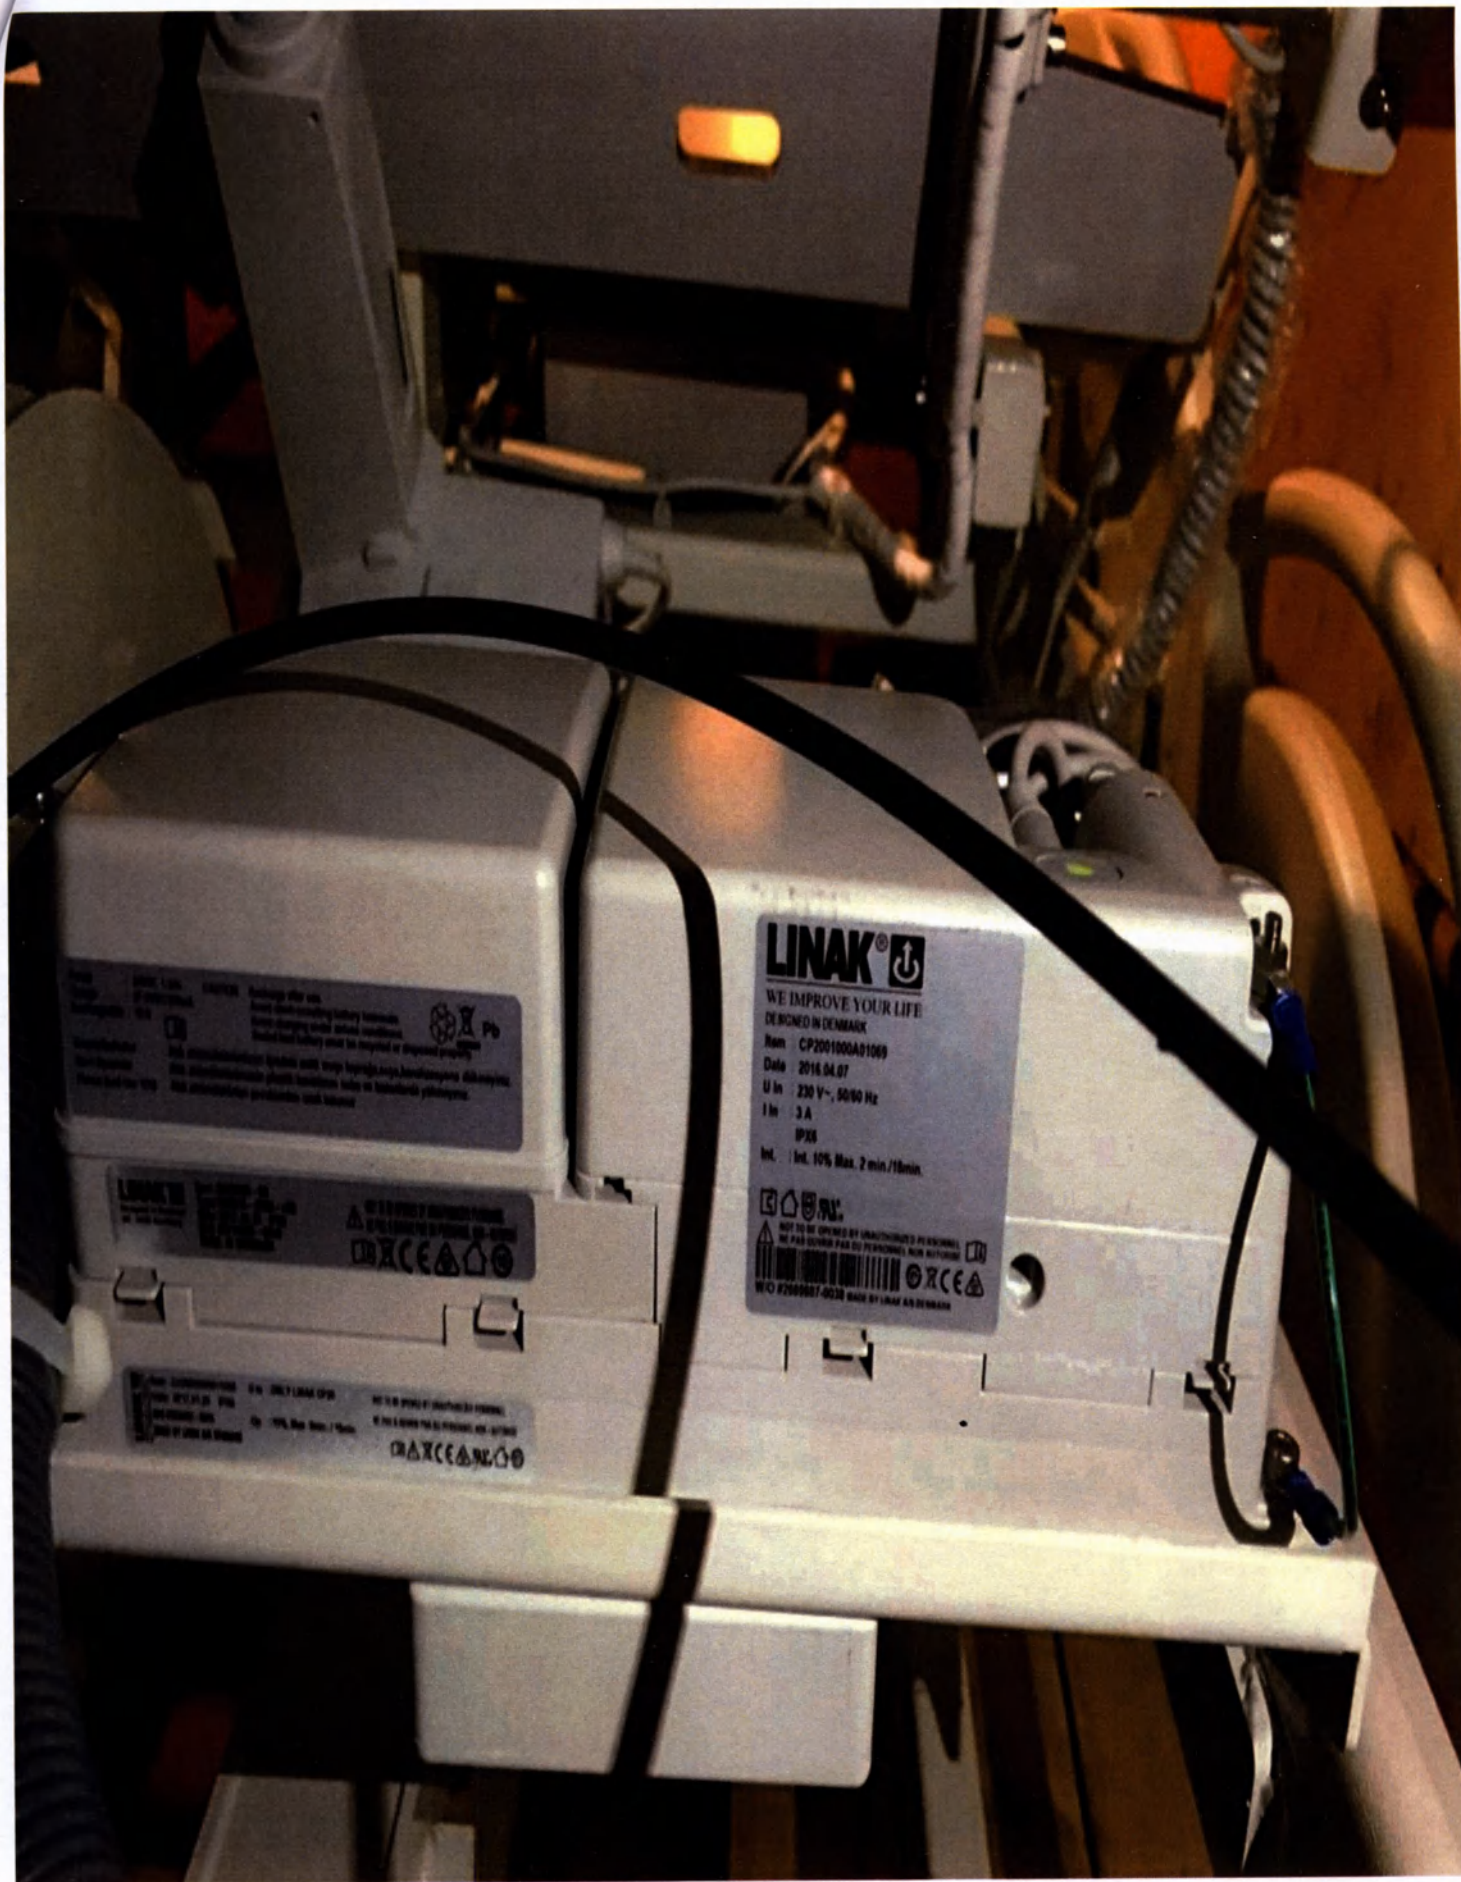


3. Блок управления

4. Индикатор угла наклона ложа кровати



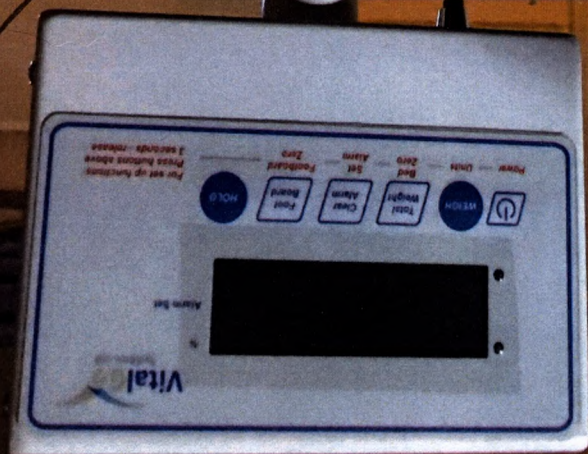

6. Доработка ортопедического аппарата

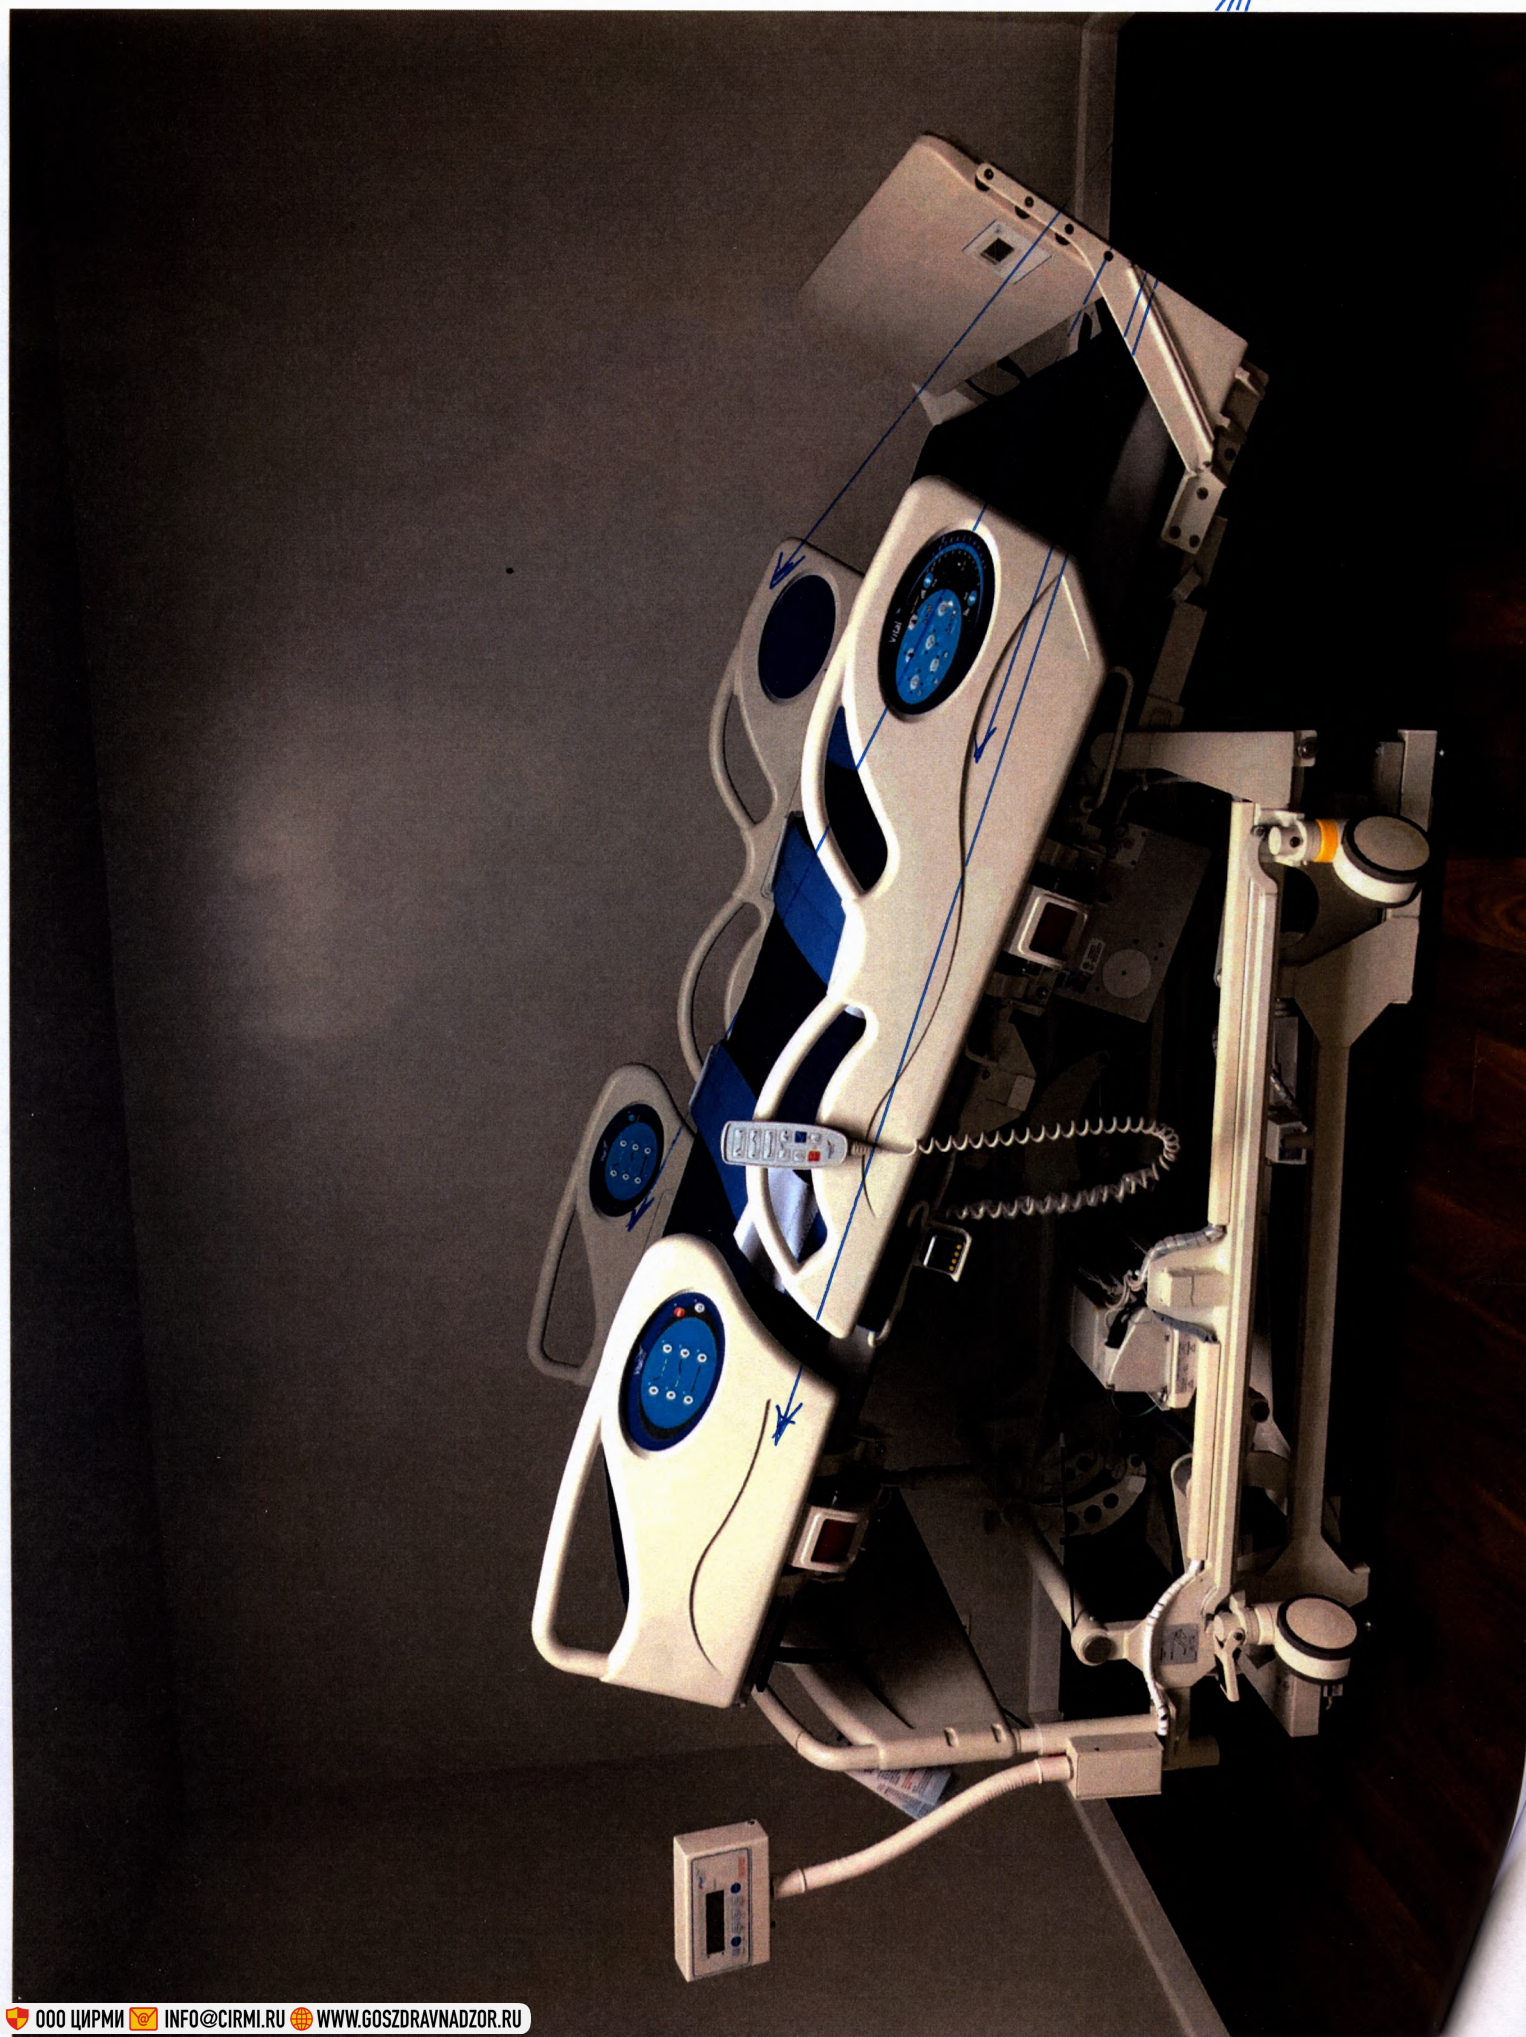

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ КРОВАТИ ВСТРОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАЖАЮЩИХСЯ



8. Матрас неомолихуегадоблеї, нефекачнеперевірається годівенне



Матрас терапевтический переменного давления с технологией воздушных микро-потерь с воздушным компрессором






10 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ АСИНХРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ



Н. Спичка сдвинута головным концом.


A detailed view of a medical bed, likely a gynecological examination table. The bed has a white frame and blue padding. A control panel with a coiled cable is attached to the side. The bed is positioned on a metal stand with wheels. The background is dark and out of focus.

13. Вещи безвредные по своему составу

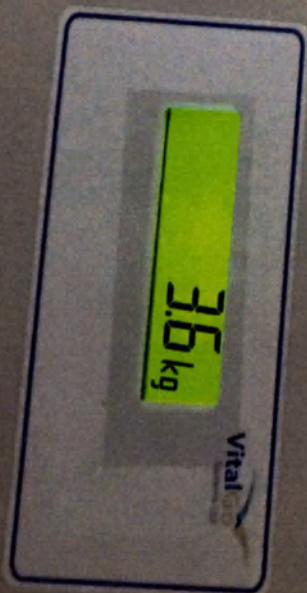

16. 11.2017
4. 11.2017
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБНОЕ



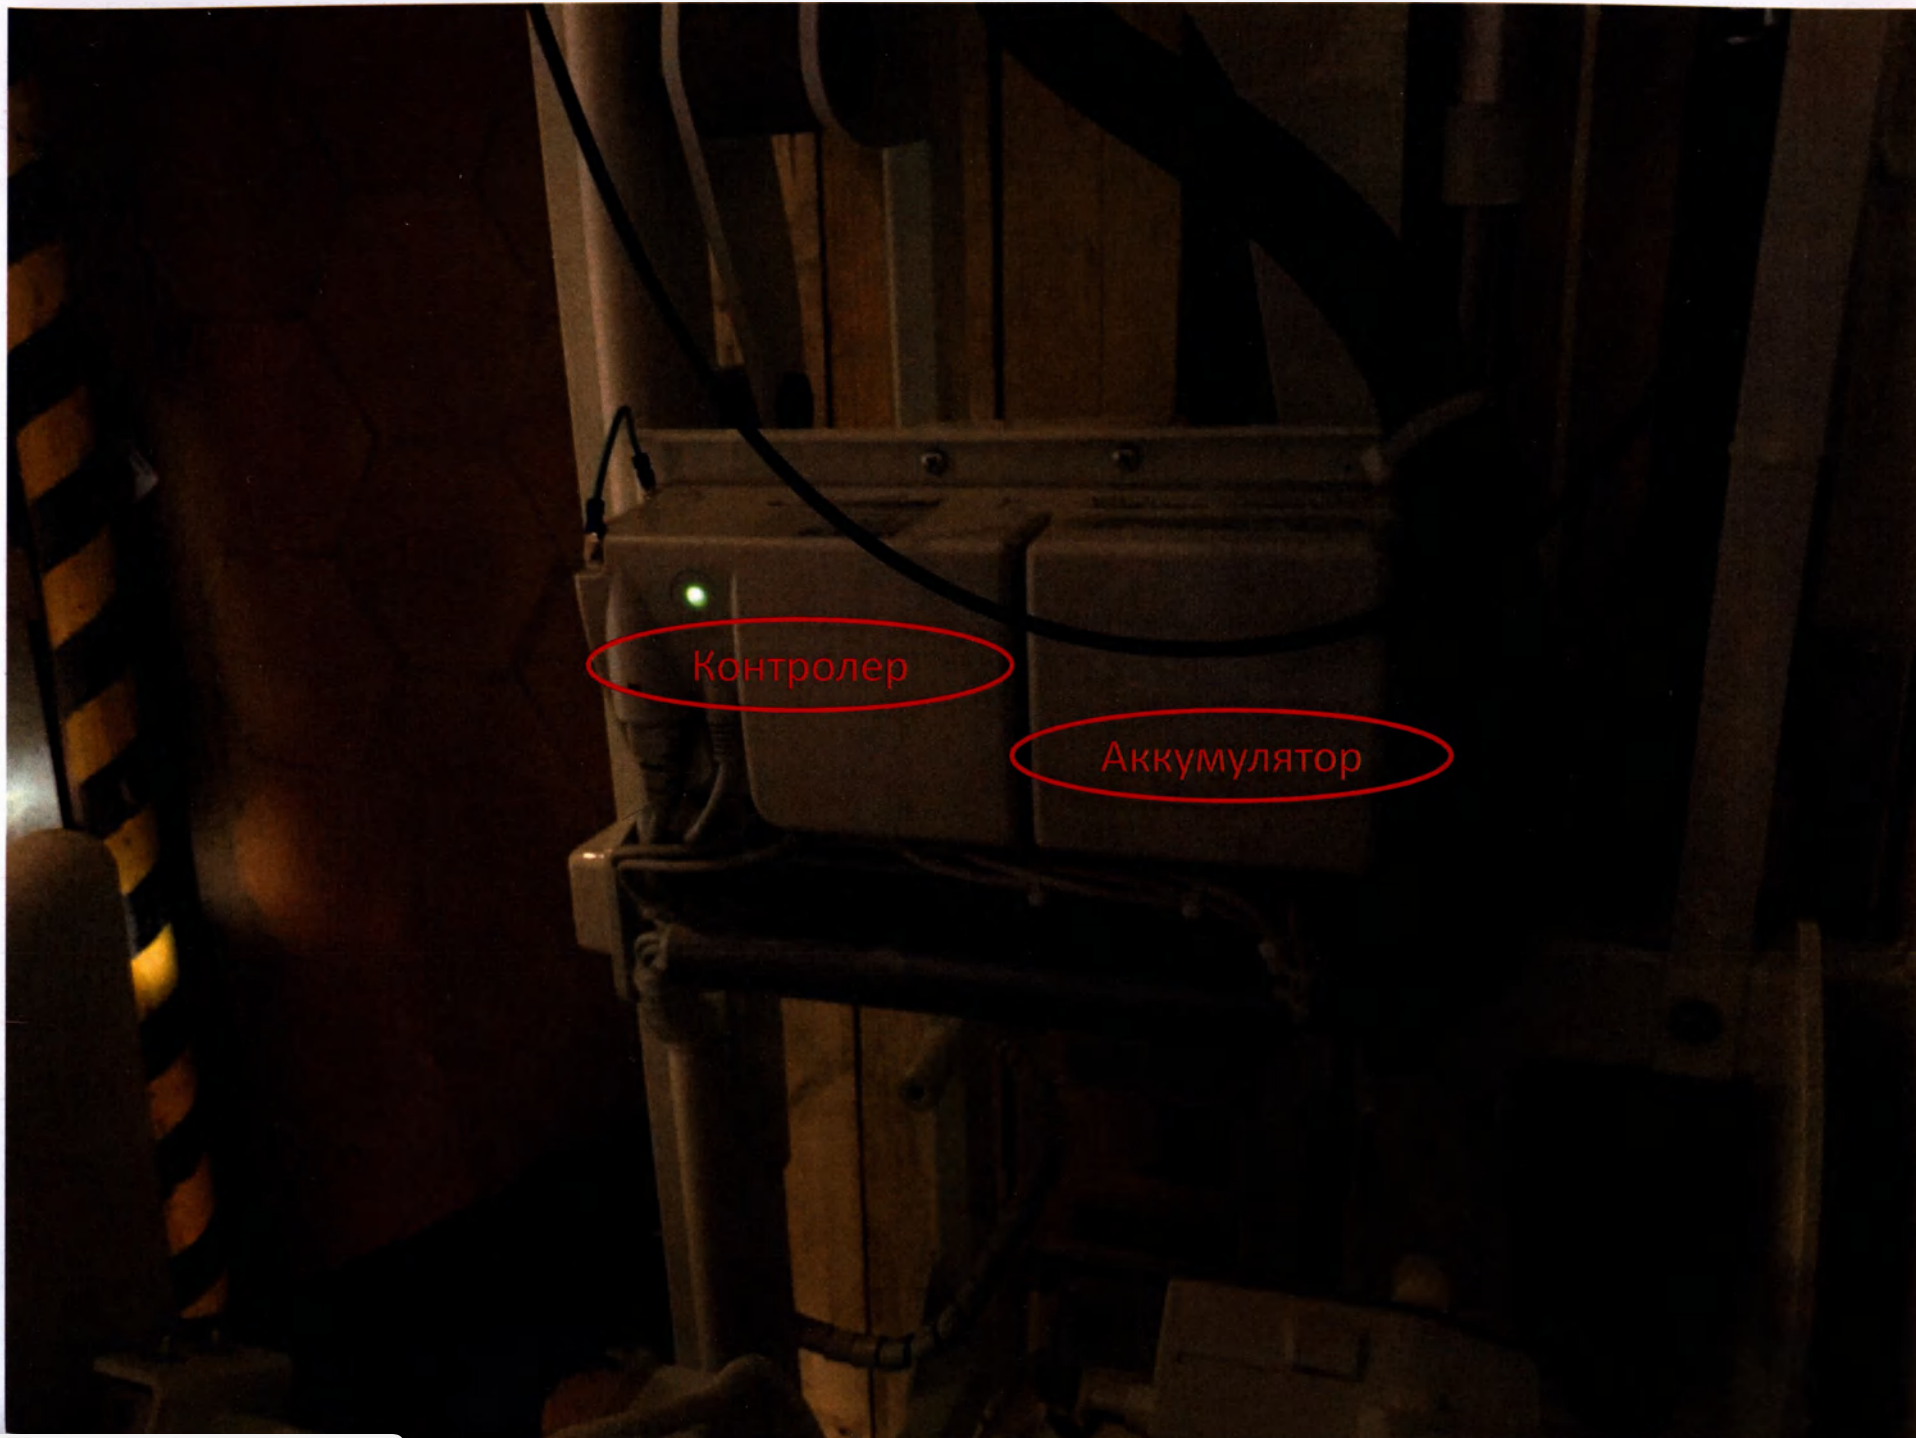

15. Аккумулятор резервного питания

16. Korea




17. Стенд тортика/онора




18. Устранили топнос блок и добили конец




19. Кабель питания

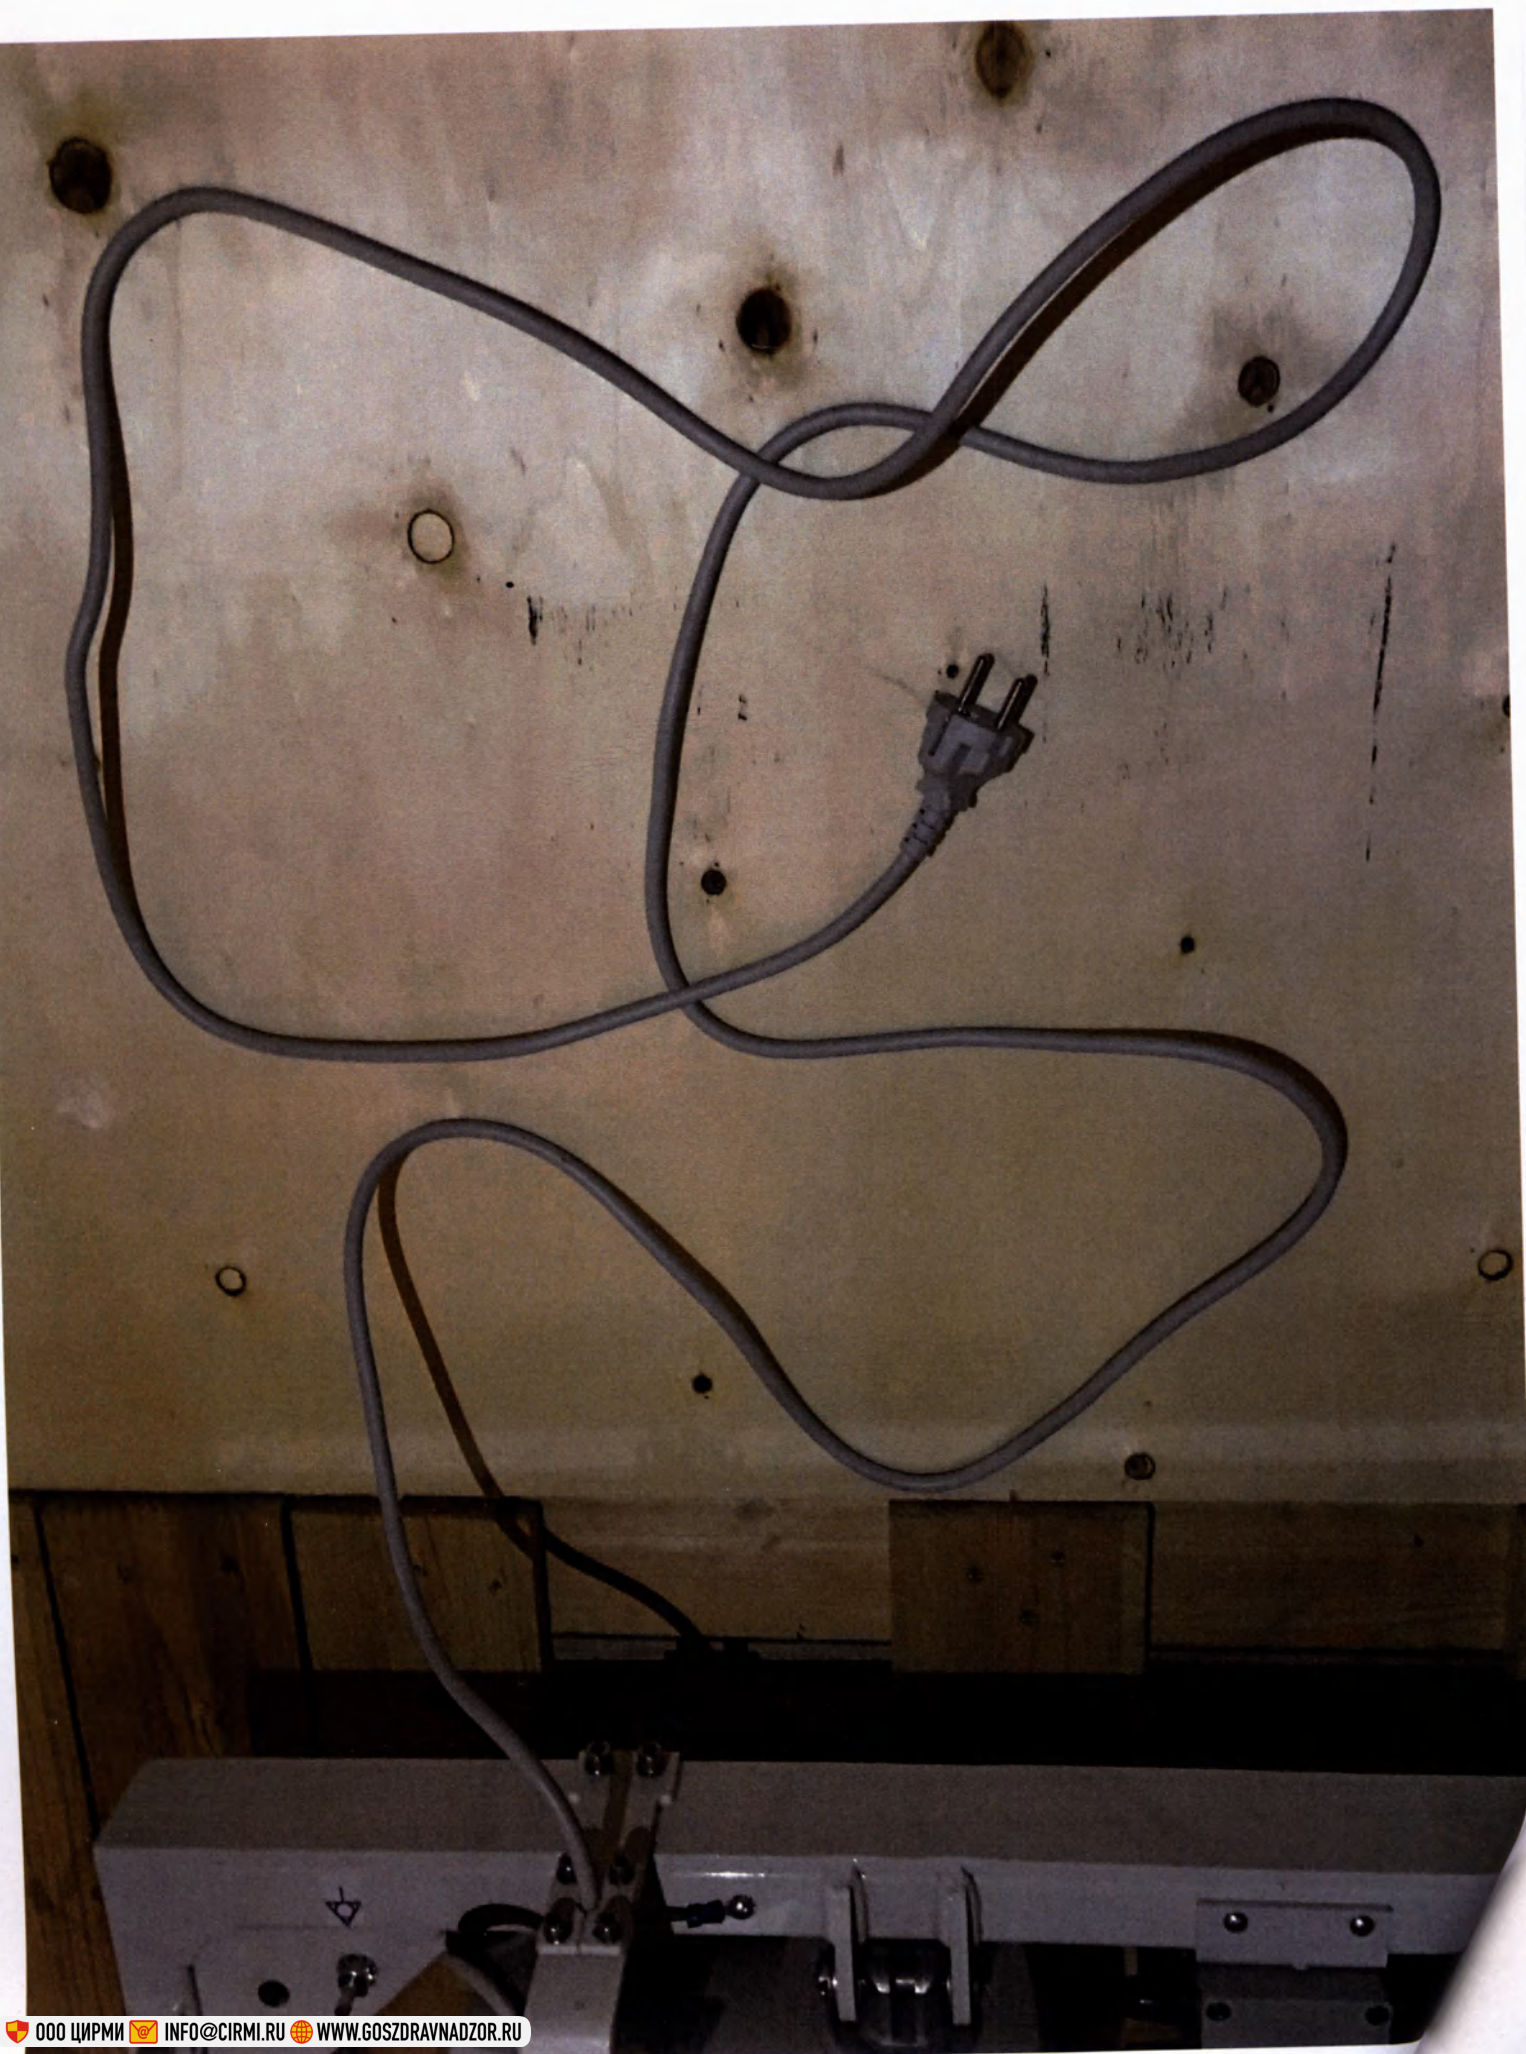


22
до деформации сжатия газ поперек
и сжатия газ вглубинных вмятинах

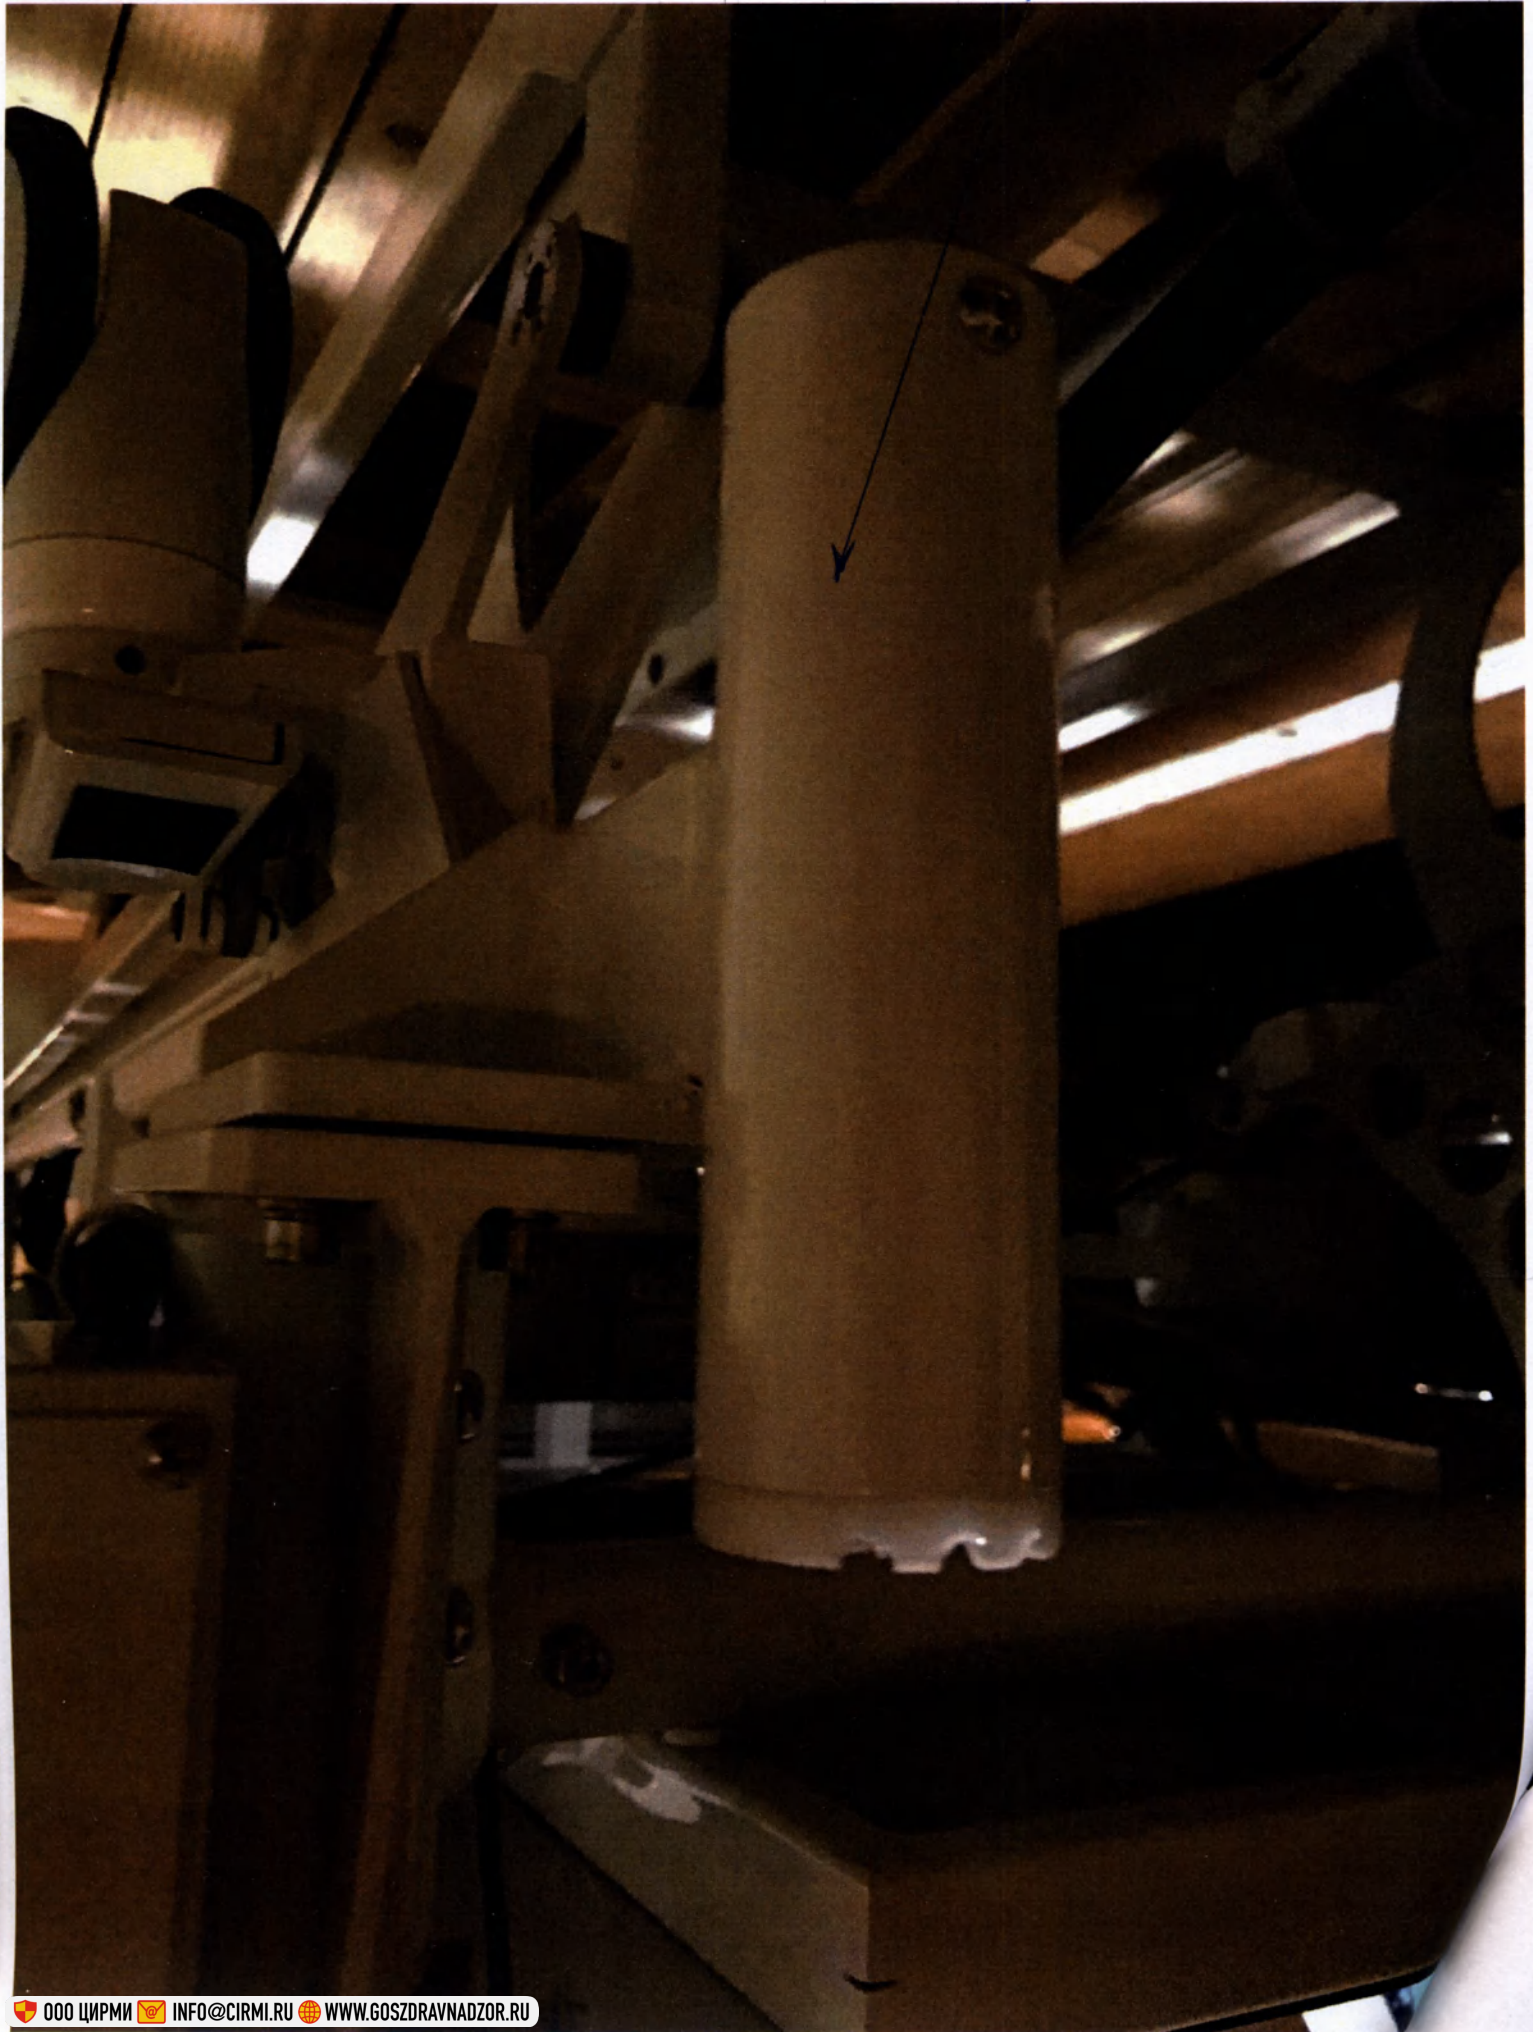

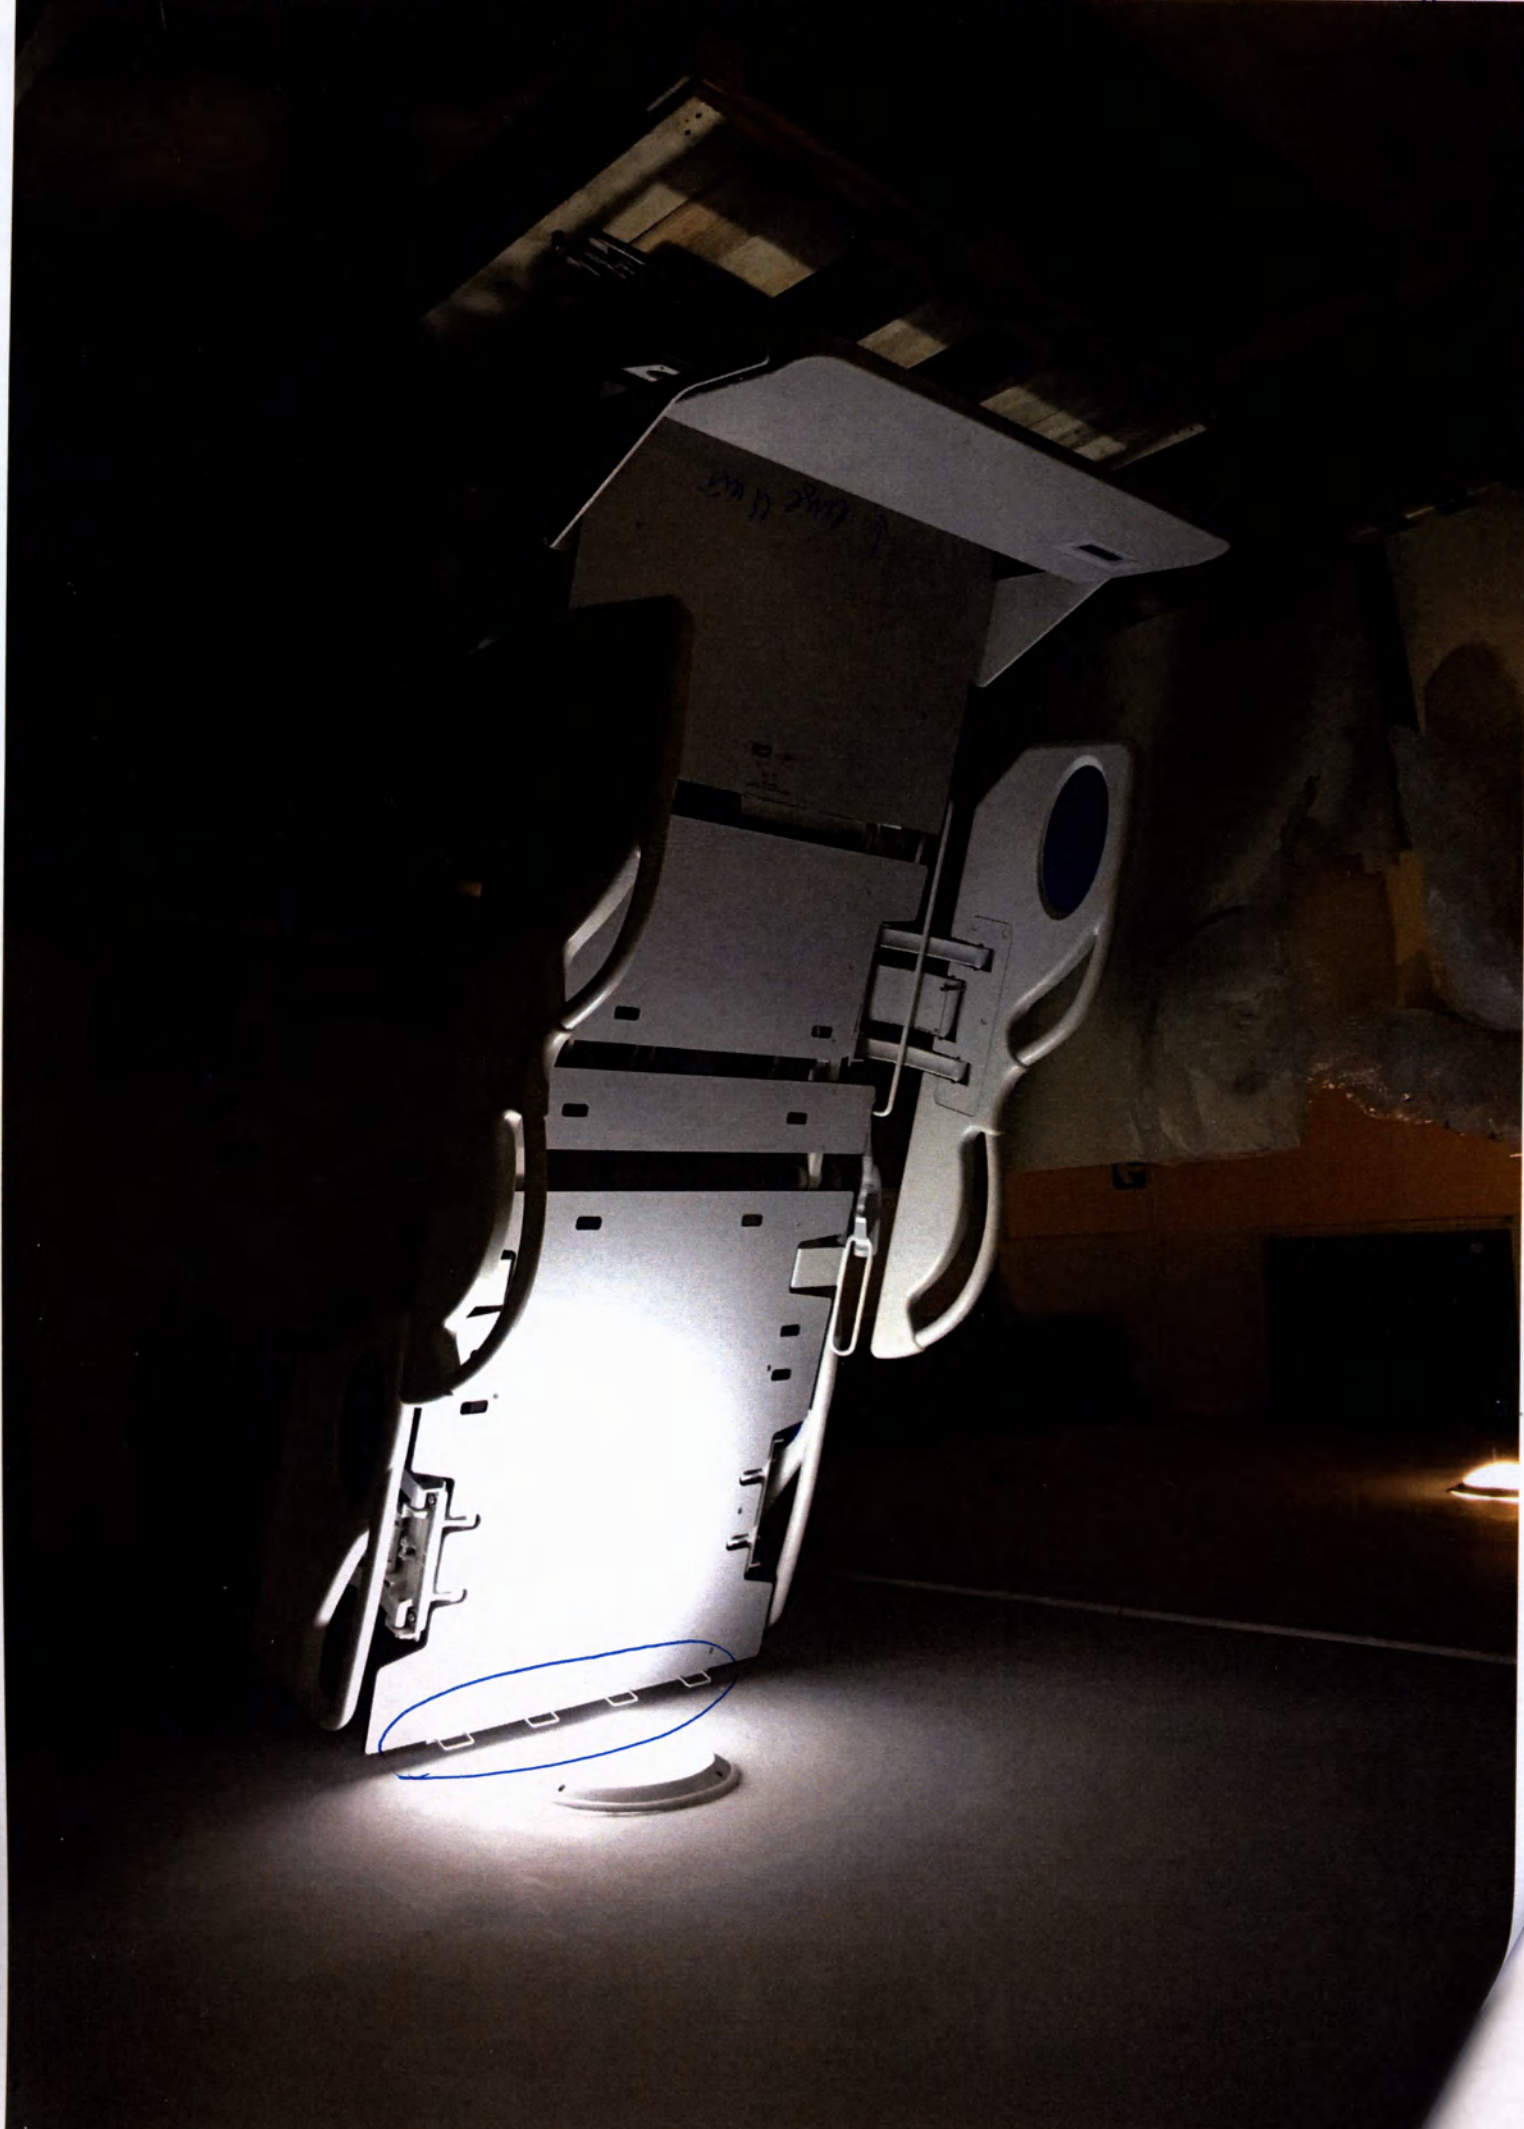

28
22. Кременские ЭВЕНТЫ БЕЖИТЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ

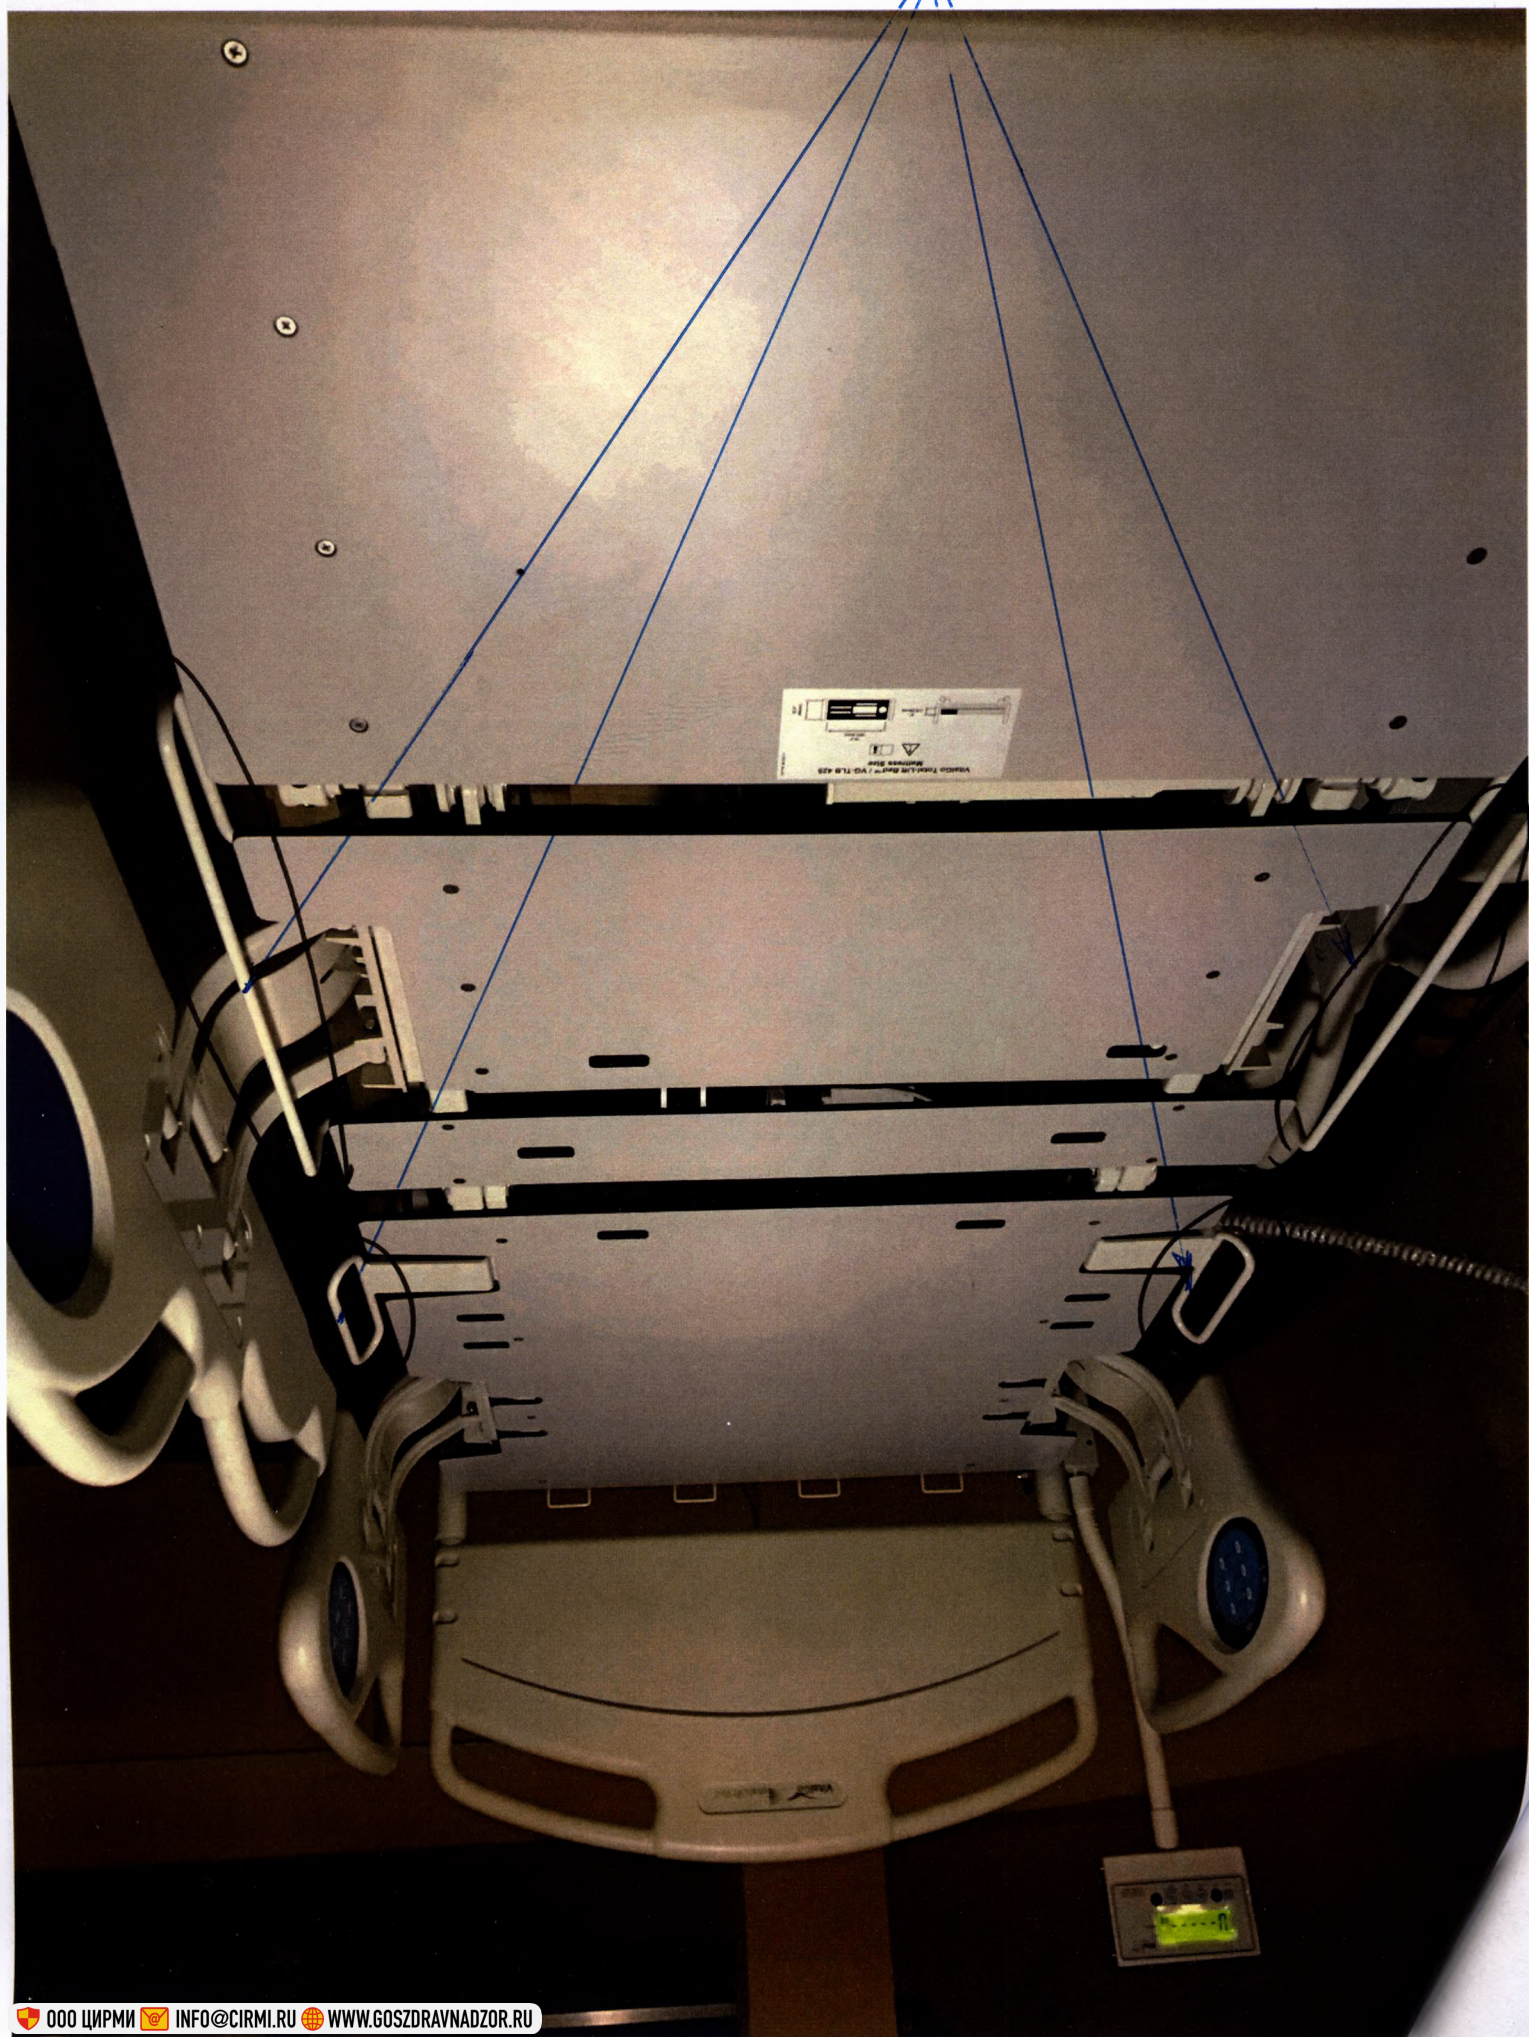

Rev. 6/2016

Rev. 01

Rev. 01/10/2014

VitalGo
Systems Ltd.

Total-Lift Bed™

Elevating Patient Care & Mobility

ASSEMBLY, OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

Before opening, please verify proper size was ordered.

Once opened, this product is not eligible for return for credit or exchange.

Before opening, please verify proper size was ordered.

Once opened, this product is not eligible for return for credit or exchange.

Before opening, please verify proper size was ordered.

Once opened, this product is not eligible for return for credit or exchange.



24. Ручка для механического (экстренного) перевода кровати в положение для проведения сердечно-легочной реанимации (CPR)

Форма А-755-6
Форма А-755-6 –РФ

Ред.: 5.0
Ред.: 6.0

Дата ред.: 10 сентября 2016 г.
Дата ред.: 04 августа 2018 г.



Total-Lift Bed

Кровать медицинская функциональная Total-Lift Bed, в вариантах исполнения: VG-TLB425V/T, VG-TLB425T в составе с принадлежностями

Повышение качества медицинского обслуживания пациентов и мобильности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель кровати:
VG-TLB 425 V/T и VG-TLB425T


ДИЛЕРУ: Настоящее руководство предоставляется пользователю продукции.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Прежде чем приступить к эксплуатации продукции, необходимо изучить настоящее руководство и хранить его для дальнейшего пользования.

ВиталГо Инк, США
VitalGo Inc, USA

3520 NW 56th St. Fort Lauderdale, Florida 33309, USA

Для получения более детальной информации
по продукции, изделиям и услугам VitalGo
посетите наш сайт www.vitalgosys.com



25. Инструкция по эксплуатации

