

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов

« 03 » февраля 2023 г.

МАРКИРОВКА Макет упаковки

**Презерватив латексный для УЗИ
по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018**

**производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru,
www.bergus24.ru**

Макеты первичной (индивидуальной) упаковки медицинского изделия, ТЗ «АРМА®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. **II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе:** 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. **III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе:** 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



Макеты вторичной (потребительской) упаковки медицинского изделия, ТЗ «АРМА®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:


I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

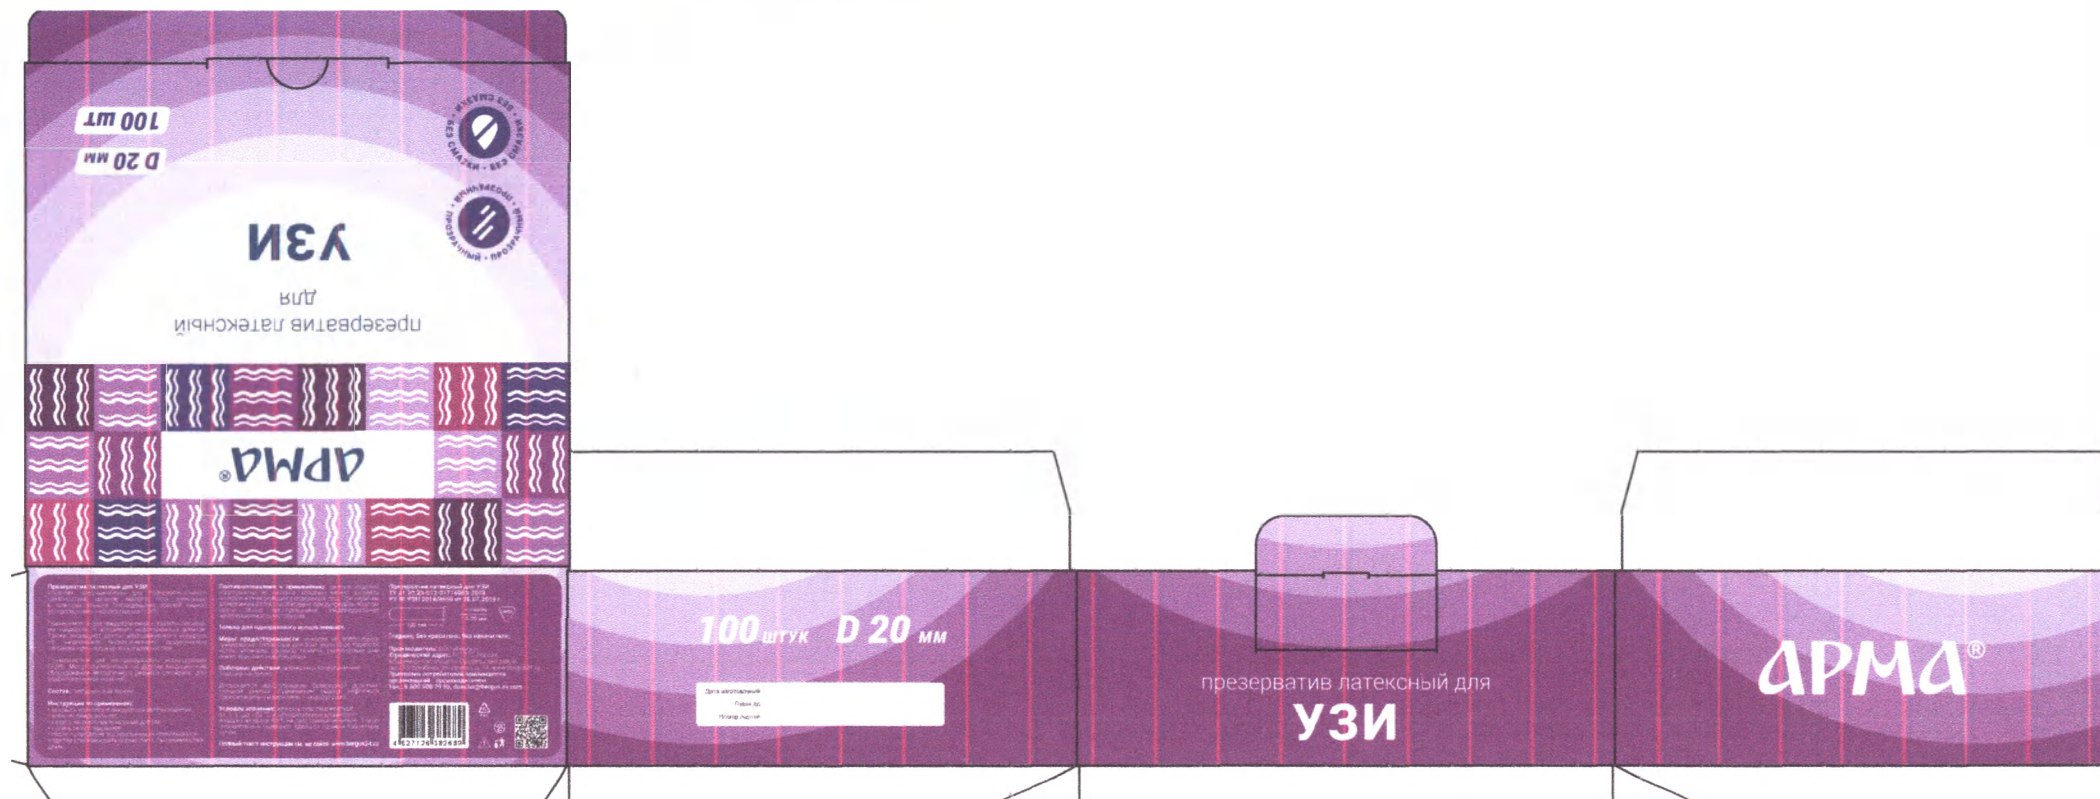

В увеличении:

Презерватив латексный для УЗИ

Изделия предназначены для трансвагинального (диагностика органов малого таза женщины) и трансректального (исследование прямой кишки) ультразвукового исследования (УЗИ).

Применяются для предохранения и защиты организма пациента от вторжения инфекционных агентов. Также защищают датчик ультразвукового аппарата от загрязнения биологическими выделениями человека при ультразвуковой диагностике.

Применяются для ультразвукового исследования (УЗИ). Могут применяться на другом медицинском оборудовании аналогичного размера (аппараты для ударно-волновой терапии).

Состав: натуральный латекс.

Инструкция по применению:

- вскрыть упаковку и аккуратно извлечь изделие, чтобы не повредить его
- надеть на ректо-вагинальный датчик
- провести исследование
- после проведения исследования использованное изделие утилизировать совместно с бытовыми отходами

Противопоказания к применению: данные изделия изготовлены из латекса, который может вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии аллергии на латекс необходимо предупредить об этом врача перед исследованием. Индивидуальная непереносимость материала.

Только для одноразового использования.

Меры предосторожности: никогда не используйте презерватив латексный для УЗИ, если срок годности истек, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.


Побочные действия: возможны аллергические реакции на латекс.

Допускается использование безвредной дополнительной смазки. Применение смазок нефтяного происхождения и вазелина – недопустимо.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

Полный текст инструкции см. на сайте www.bergus24.ru

Презерватив латексный для УЗИ
ТУ 21.20.23-012-01716953-2018
ПУ № РЗН 2019/8659 от 26.07.2019 г.



толщина
0,09 мм



Гладкие, без красителя, без накопителя.


Производитель: ООО «Бергус».
Юридический адрес: 601270, Россия,
Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, www.bergus24.ru
Петензии потребителей принимаются
организацией - производителем.
Тел.: 8 800 500 79 85, director@bergus.ru




Макеты первичной (потребительской) упаковки медицинского изделия, **ТЗ «АРМА®»**

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018


I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, мер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

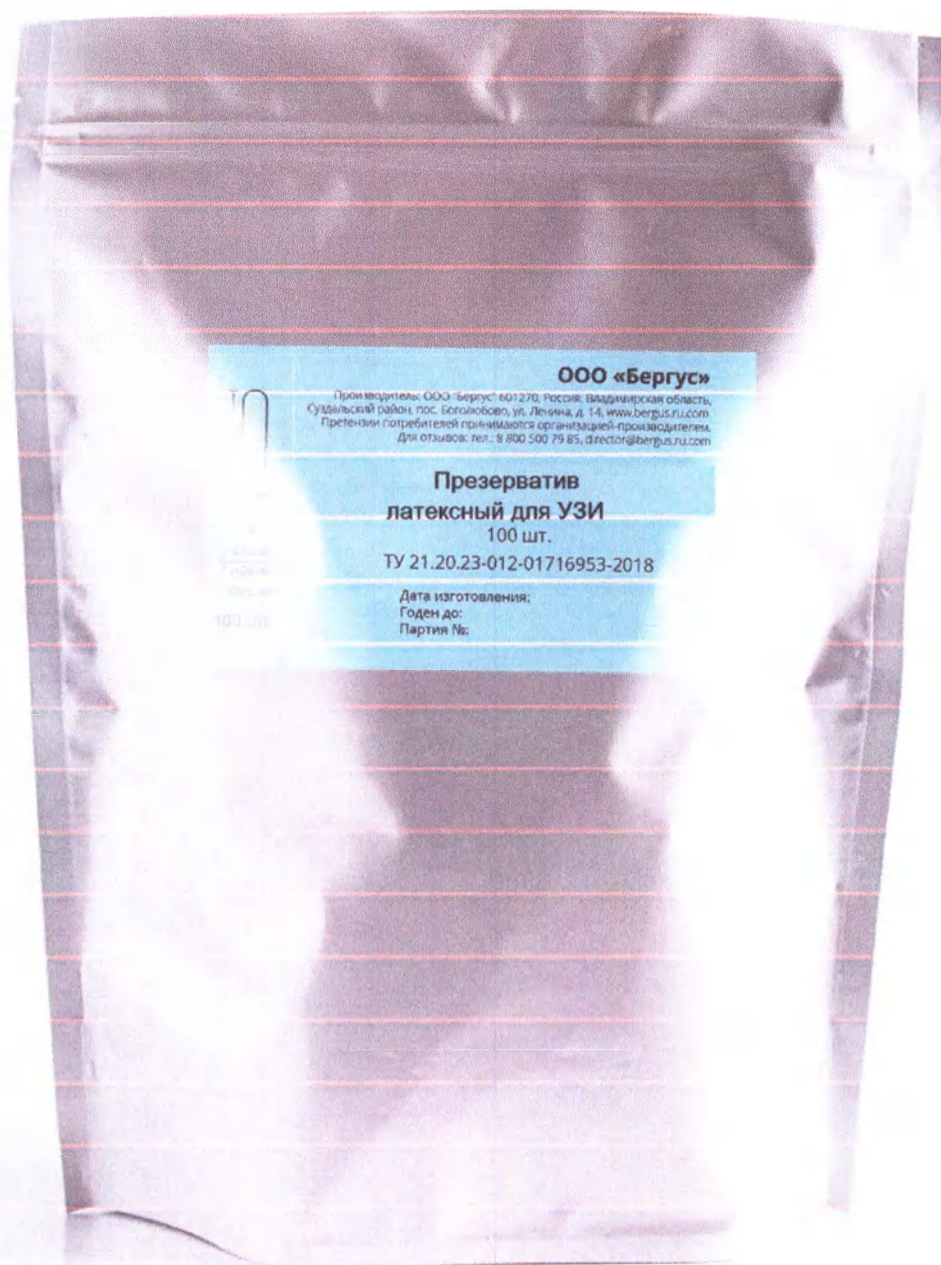

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

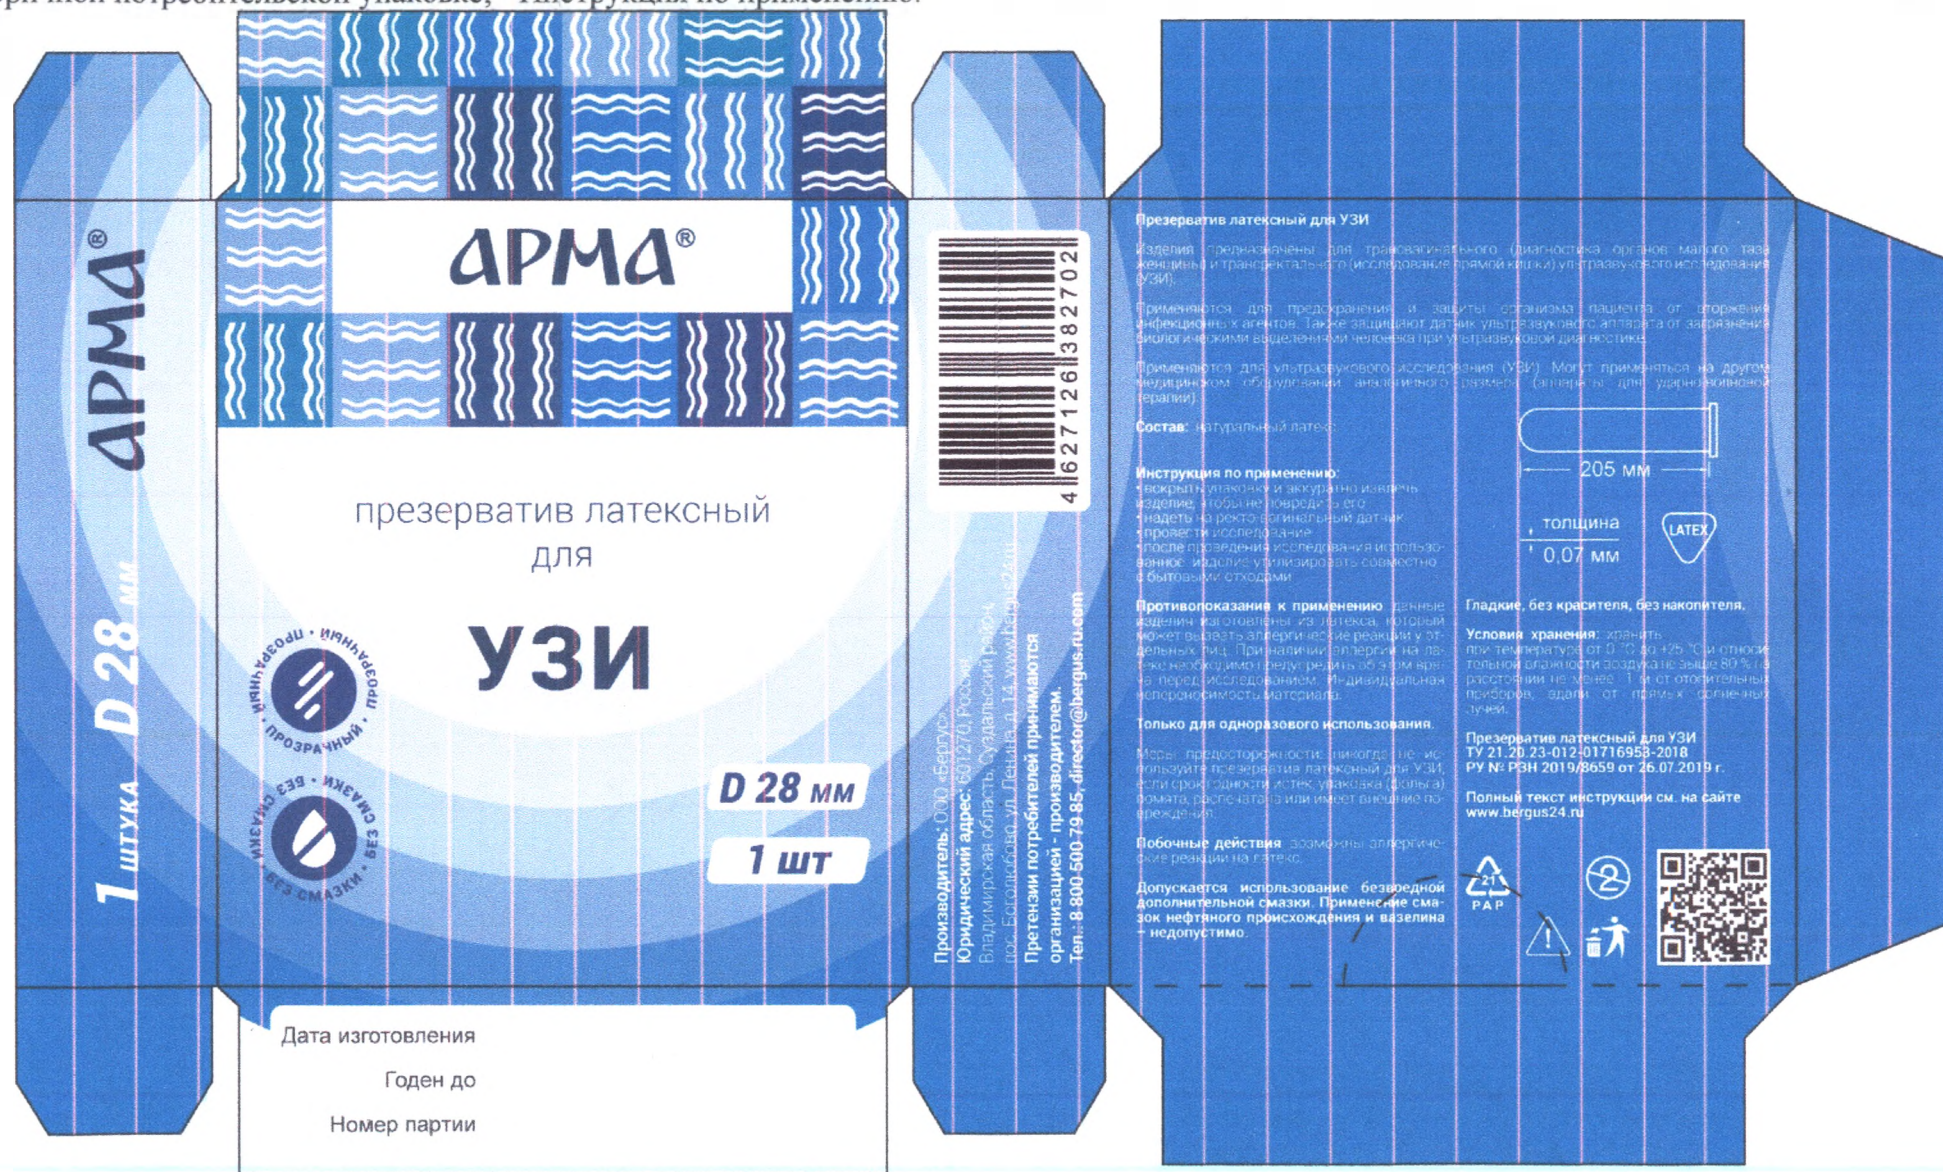

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

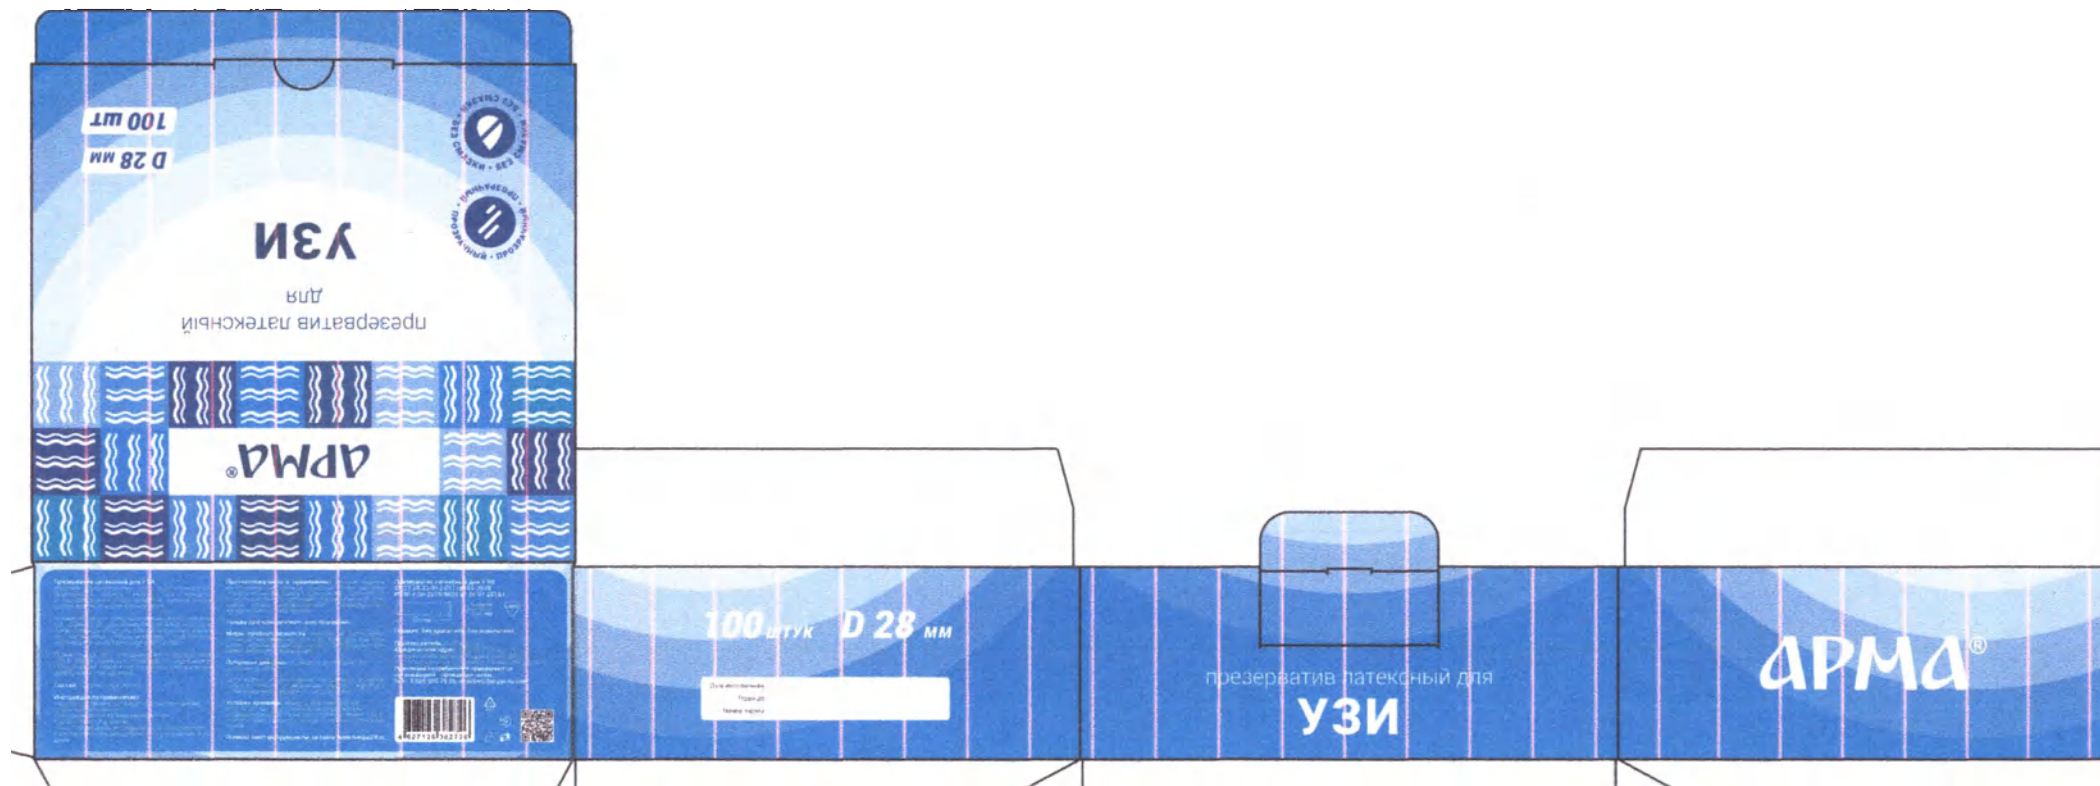

В увеличении:

Презерватив латексный для УЗИ

Изделия предназначены для трансагинального (диагностика органов малого таза женщины) и трансректального (исследование прямой кишки) ультразвукового исследования (УЗИ).

Применяются для предохранения и защиты организма пациента от вторжения инфекционных агентов. Также защищают датчик ультразвукового аппарата от загрязнения биологическими выделениями человека при ультразвуковой диагностике.

Применяются для ультразвукового исследования (УЗИ). Могут применяться на другом медицинском оборудовании аналогичного размера (аппараты для ударно-волновой терапии).

Состав: натуральный латекс

Инструкция по применению:

- вскрыть упаковку и аккуратно извлечь изделие, чтобы не повредить его;
- надеть на ректо-вагинальный датчик;
- провести исследование;
- после проведения исследования использованное изделие утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Противопоказания к применению: данные изделия изготовлены из латекса, который может вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии аллергии на латекс необходимо предупредить об этом врача перед исследованием. Индивидуальная непереносимость материала.

Только для одноразового использования.

Меры предосторожности: никогда не используйте презерватив латексный для УЗИ, если срок годности истек, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на латекс.

Допускается использование безвредной дополнительной смазки. Применение смазок нефтяного происхождения и вазелина – недопустимо.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

Полный текст инструкции см. на сайте www.bergus24.ru

Презерватив латексный для УЗИ

ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

РУ № РЗН 2019/8659 от 26.07.2019 г.



толщина
0,07 мм



Гладкие, без красителя, без накопителя.

Производитель: ООО «Бергус»

Юридический адрес: 601270, Россия, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Лесина, д. 14, www.bergus24.ru

Претензии потребителей принимаются организацией - производителем.


Тел.: 8 800 500 79 85, director@bergus.ru



Макеты первичной (потребительской) упаковки медицинского изделия, ТЗ «АРМА ®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018


II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

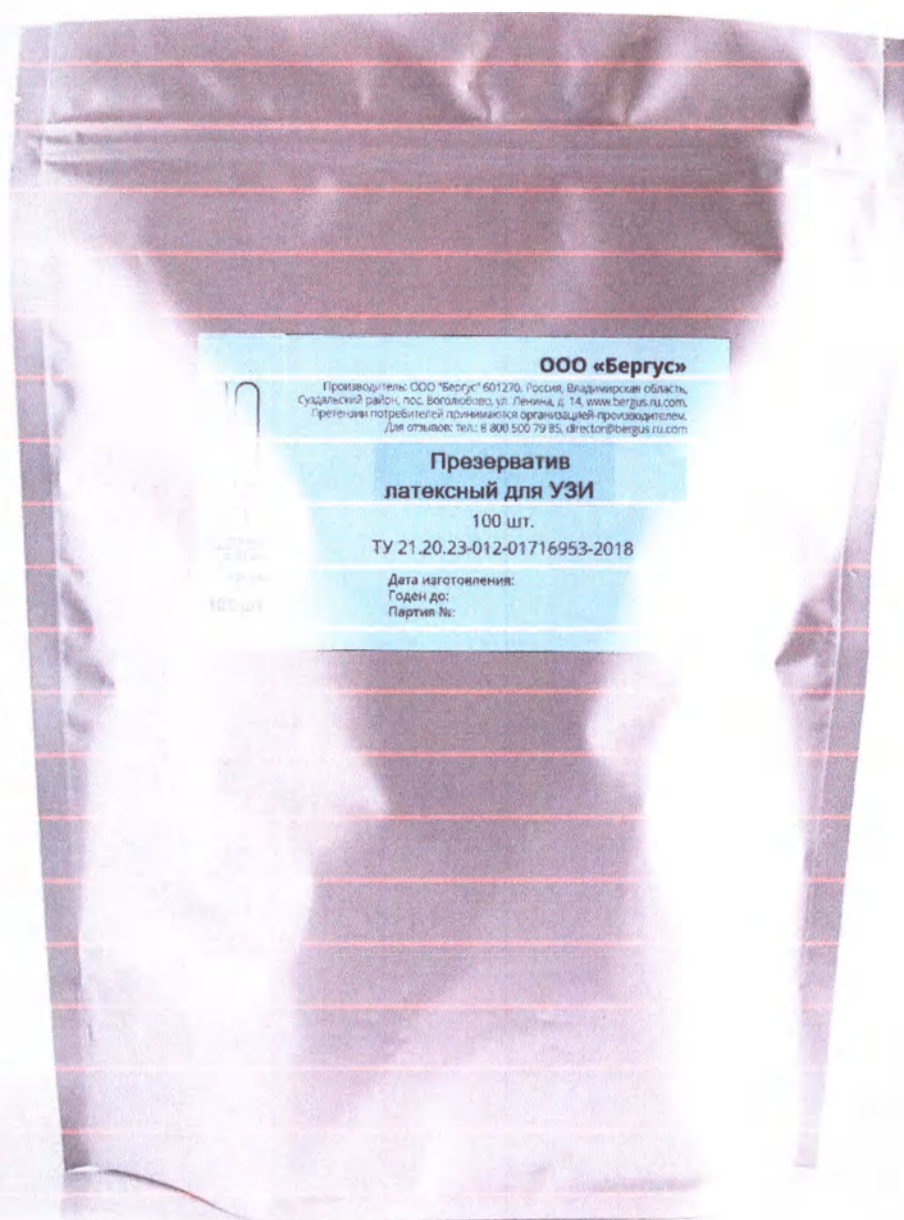

III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

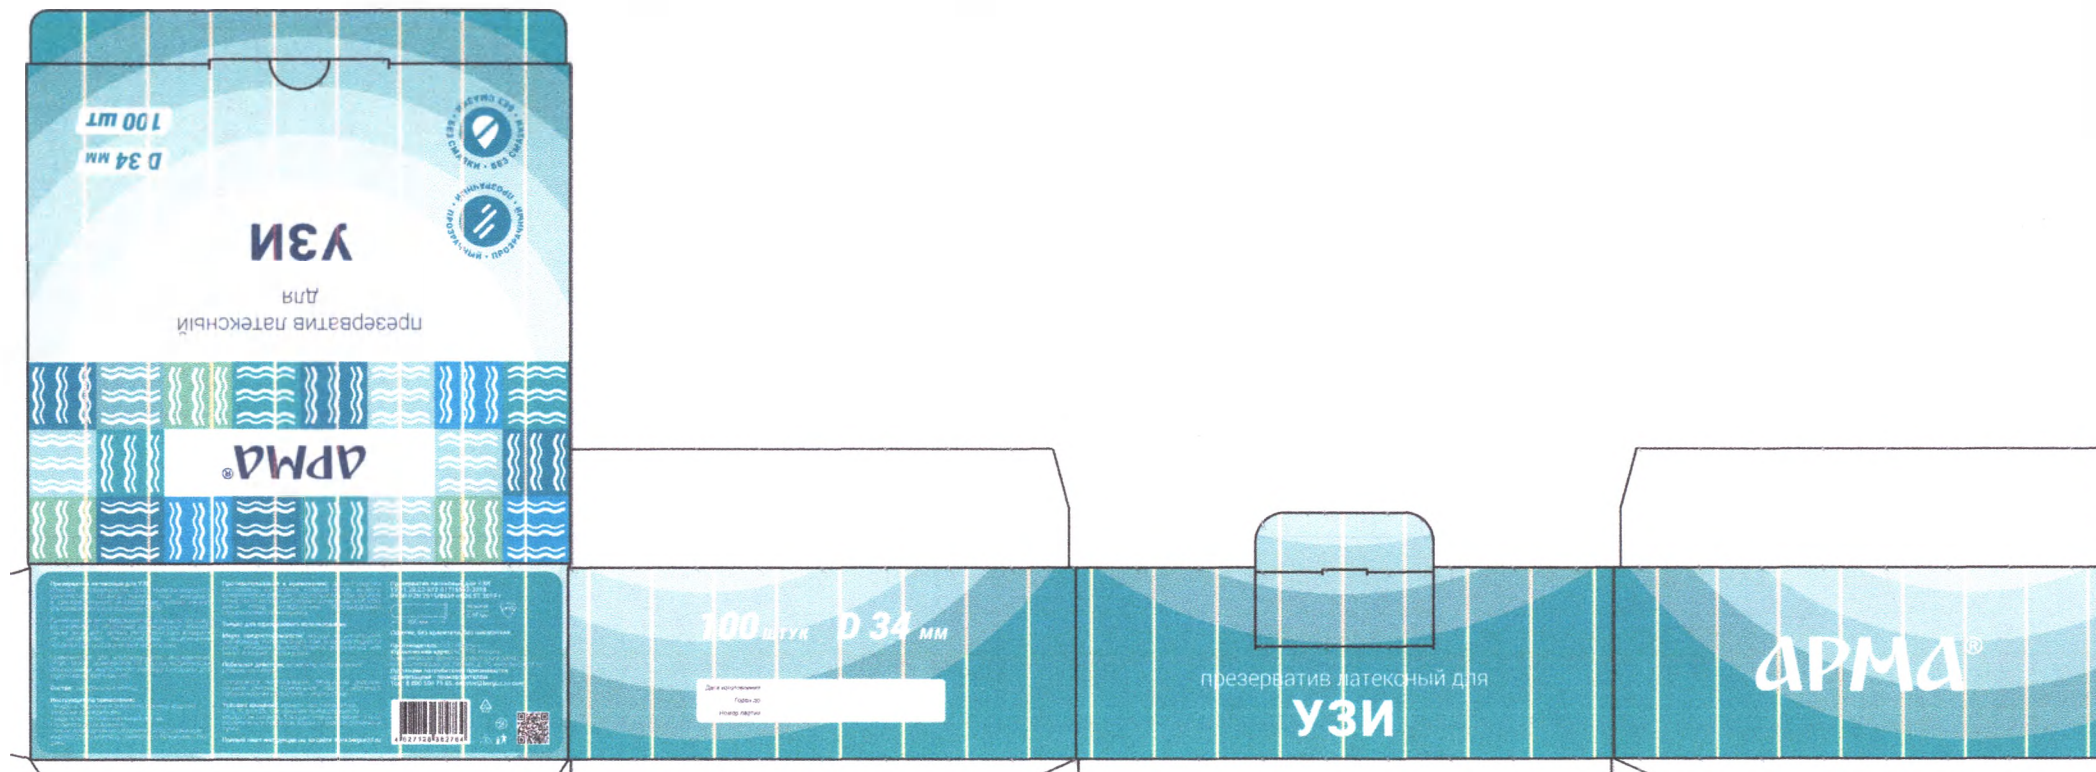

В увеличении:

Презерватив латексный для УЗИ

Изделия предназначены для трансвагинального (диагностика органов малого таза женщины) и трансректального (исследование прямой кишки) ультразвукового исследования (УЗИ).

Применяются для предохранения и защиты организма пациента от вторжения инфекционных агентов. Также защищают датчик ультразвукового аппарата от загрязнения биологическими выделениями человека при ультразвуковой диагностике.

Применяются для ультразвукового исследования (УЗИ). Могут применяться на другом медицинском оборудовании аналогичного размера (аппараты для ударно-волновой терапии).

Состав: натуральный латекс.

Инструкция по применению:

- вскрыть упаковку и аккуратно извлечь изделие, чтобы не повредить его;
- надеть на ректо-вагинальный датчик;
- провести исследование;
- после проведения исследования использованное изделие утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Противопоказания к применению: данные изделия изготовлены из латекса, который может вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии аллергии на латекс необходимо предупредить об этом врача перед исследованием. Индивидуальная непереносимость материала.

Только для одноразового использования.

Меры предосторожности: никогда не используйте презерватив латексный для УЗИ, если срок годности истек, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на латекс.

Допускается использование безвредной дополнительной смазки. Применение смазок нефтяного происхождения и вазелина – недопустимо.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

Полный текст инструкции см. на сайте www.bergus24.ru

Презерватив латексный для УЗИ

ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

РУ № РЗН 2019/8659 от 26.07.2019 г.



Гладкие, без красителя, без накопителя.

Производитель: ООО «Бергус».

Юридический адрес: 601270, Россия, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, www.bergus24.ru

Петензии потребителей принимаются организацией - производителем.


Тел.: 8 800 500 79 85, director@bergus.ru



Макеты первичной (потребительской) упаковки медицинского изделия, ТЗ «АРМА ®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

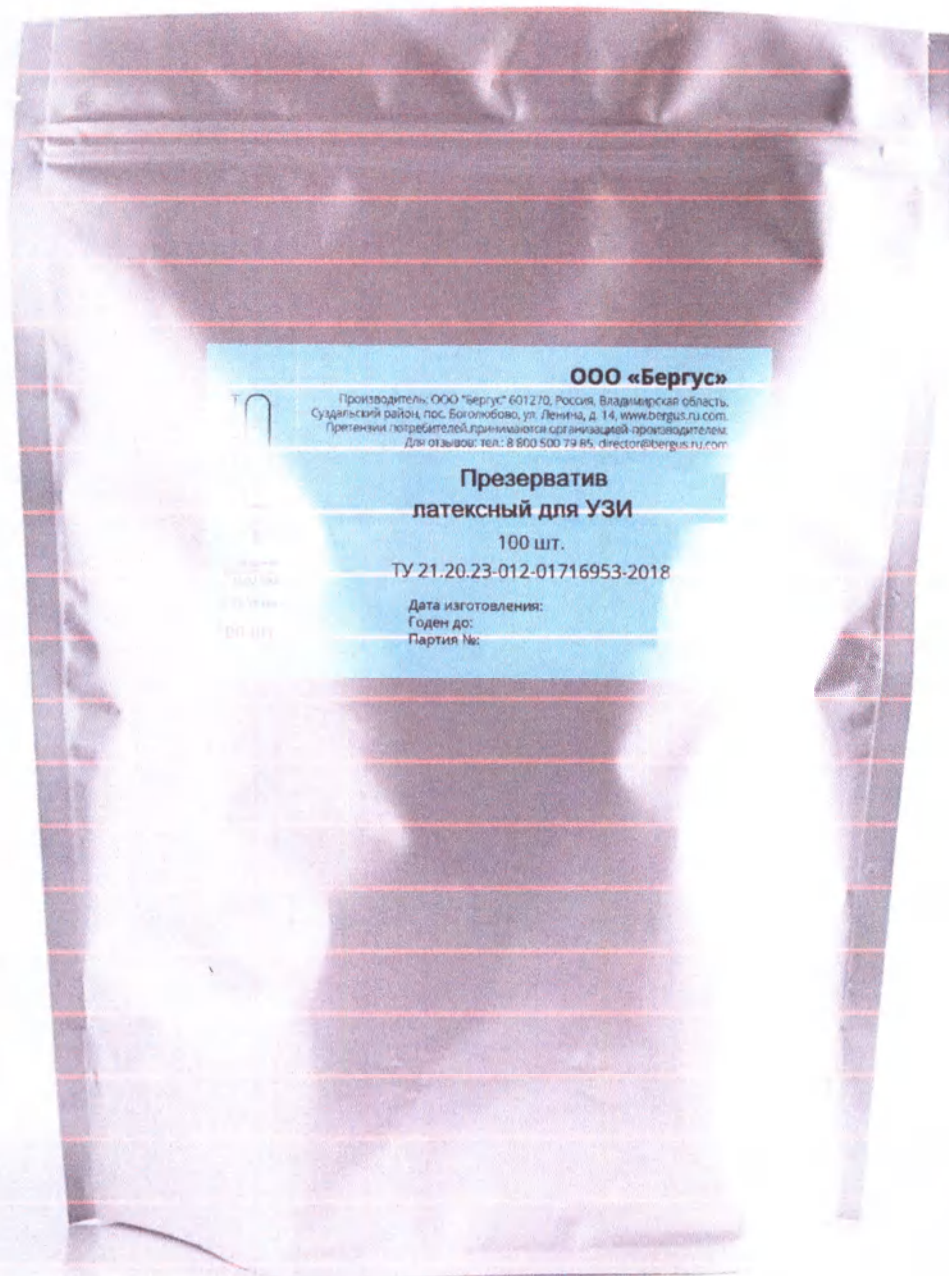

Макеты первичной (индивидуальной) упаковки медицинского изделия, ТЗ «ARLETTE®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



Макеты вторичной (потребительской) упаковки изделия, ТЗ «ARLETTE®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



В увеличении:

Презерватив латексный для УЗИ

Изделия предназначены для трансвагинального (диагностика органов малого таза женщины) и трансректального (исследование прямой кишки) ультразвукового исследования (УЗИ). Гладкие, без красителя, без накопителя. Применяются для предохранения и защиты организма пациента от вторжения инфекционных агентов. Также защищают датчик ультразвукового аппарата от загрязнения биологическими выделениями человека при ультразвуковой диагностике. Применяются для ультразвукового исследования (УЗИ). Могут применяться на другом медицинском оборудовании аналогичного размера (аппараты для ударно-волновой терапии). Допускается применение безвредной дополнительной смазки. Применение смазок нефтяного происхождения и вазелина – недопустимо.

Состав:

натуральный латекс.

Инструкция по применению:

• Вскрыть упаковку и аккуратно извлечь изделие, что бы не повредить его.

• Надеть на ректо-вагинальный датчик

• Провести исследование

• После проведения исследования использованное изделие утилизировать совместно с бытовыми отходами

Полный текст инструкции см. на сайте www.bergus24.ru


Противопоказания к применению: Данные изделия изготовлены из латекса, которые может вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии аллергии на латекс необходимо предупредить об этом врача перед исследованием. Индивидуальная непереносимость материала.

Условия хранения: хранить при температуре от 0 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

Только для однократного использования.

Меры предосторожности: никогда не используйте презерватив латексный для УЗИ, если срок годности истёк, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на латекс.



толщина
0,07 мм



Производитель: ООО «Бергус».

Юридический адрес: Россия, 601270, Владимирская обл., Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, дом 14

Изготовлено по заказу: ООО «БТК», Россия 194156,

г. Санкт-Петербург, пр. Зингелса, дом. 34, лит. В.

Претензии потребителей принимает организация-заказчик b-t-k@bk.ru

Презерватив латексный для УЗИ

ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

РУ № РЗН 2019/8659 от 26.07.2019 г.

www.arlette-condoms.ru



btk-med.ru

ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2119840484 листа (ов)

Генеральный директор  Гурбанов Р.М.



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов

03 февраля 2023 г.

ФОТО ИЗДЕЛИЯ

Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018


производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com,
www.bergus24.ru

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:


1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 4. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 – по 100 шт/уп в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

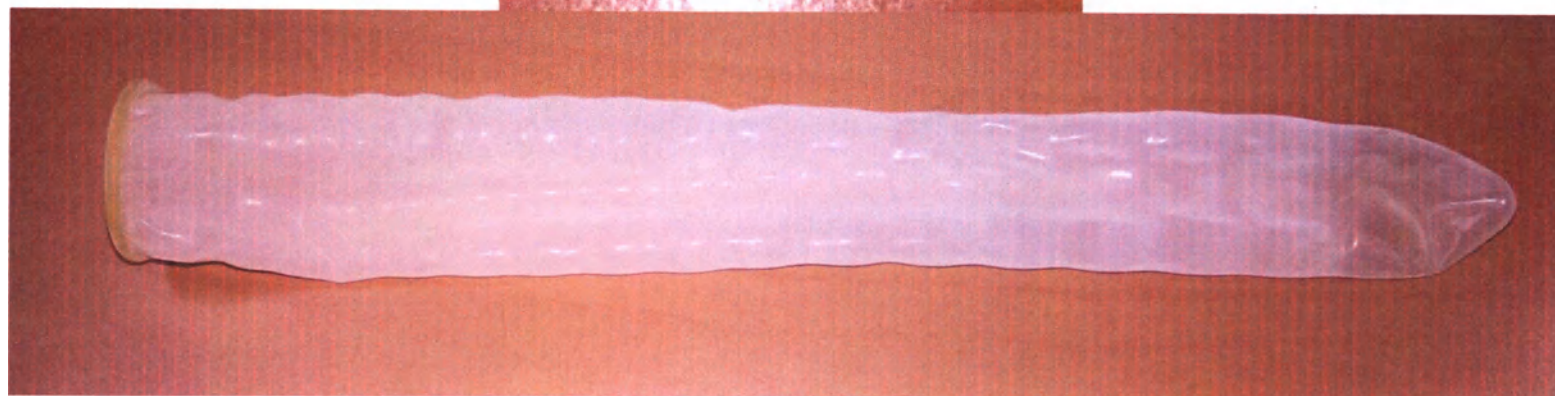

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 4. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 – по 100 шт/уп в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

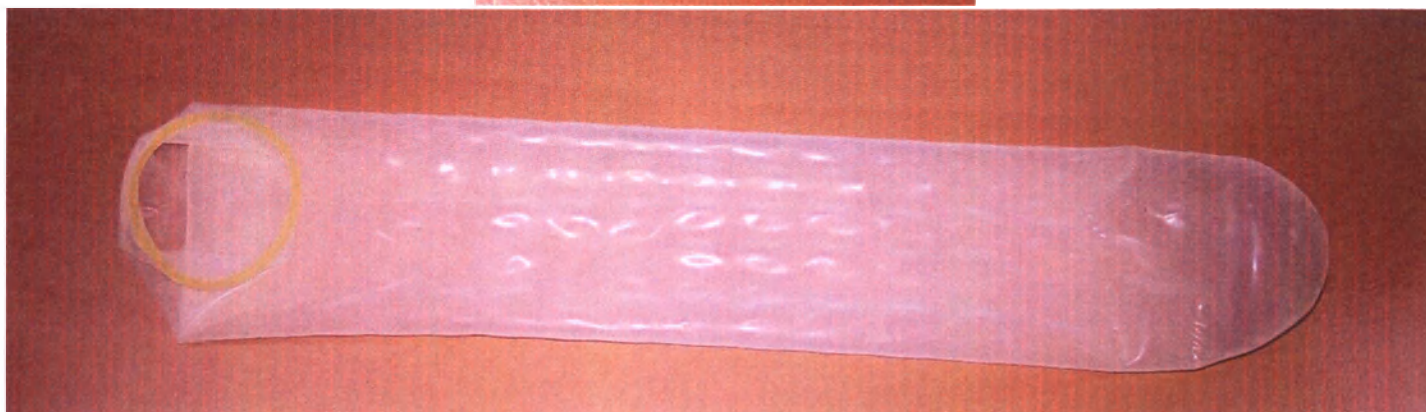

III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 4. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 – по 100 шт/уп в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.

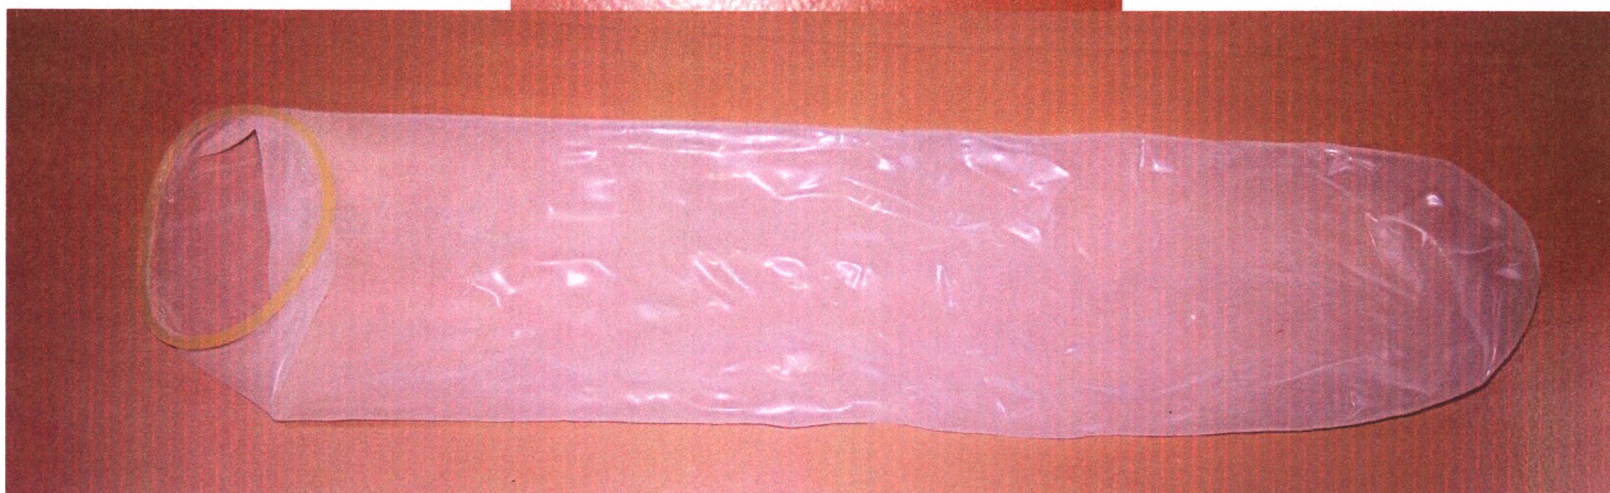

Фотографические изображения изделия в первичной (индивидуальной) упаковке, ТЗ «АРМА»®

Варианты исполнения:

- I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе:** 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.





Фотографические изображения изделия во вторичной (потребительской) упаковке, ТЗ «АРМА»®
Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. **II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе:** 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. **III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе:** 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



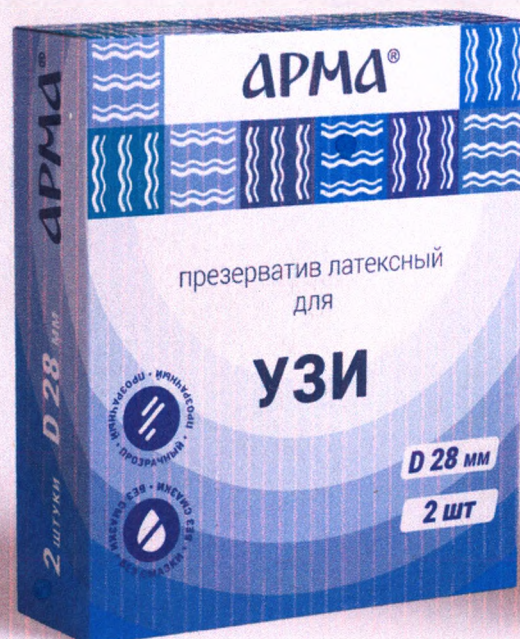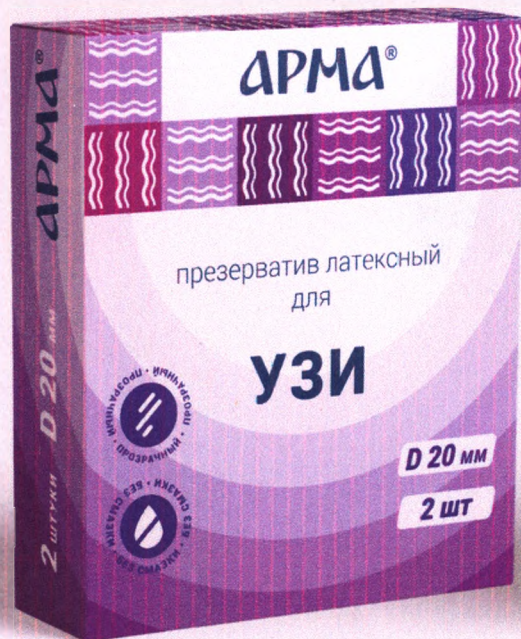







Фотографические изображения изделия в первичной (потребительской) упаковке, ТЗ «АРМА»®

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

I. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 20 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



III. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 34 - по 100 шт/уп. в первичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



Фотографические изображения изделия в первичной (индивидуальной) упаковке, ТЗ «ARLETTE®».

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28- по 2 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 3. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.



Фотографические изображения изделия во вторичной (потребительской) упаковке, ТЗ «ARLETTE®»

Наименование медицинского изделия: Презерватив латексный для УЗИ по ТУ 21.20.23-012-01716953-2018

Варианты исполнения:

II. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 в составе: 1. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 1 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению. 2. Презерватив латексный для УЗИ, размер, мм: D 28 - по 100 шт/уп. во вторичной потребительской упаковке; - Инструкция по применению.





ООО «Бергус»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
181 листов (ов)
Генеральный директор *С.М. Курбанов* Р.М.



..)