


**Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных
имплантатов, с принадлежностями:
фотографические изображения**

2018

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:
Речевой процессор Naida CI Q70




Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

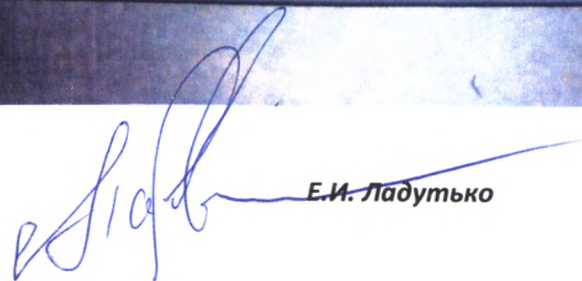

Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Заушный крючок T-mic 2

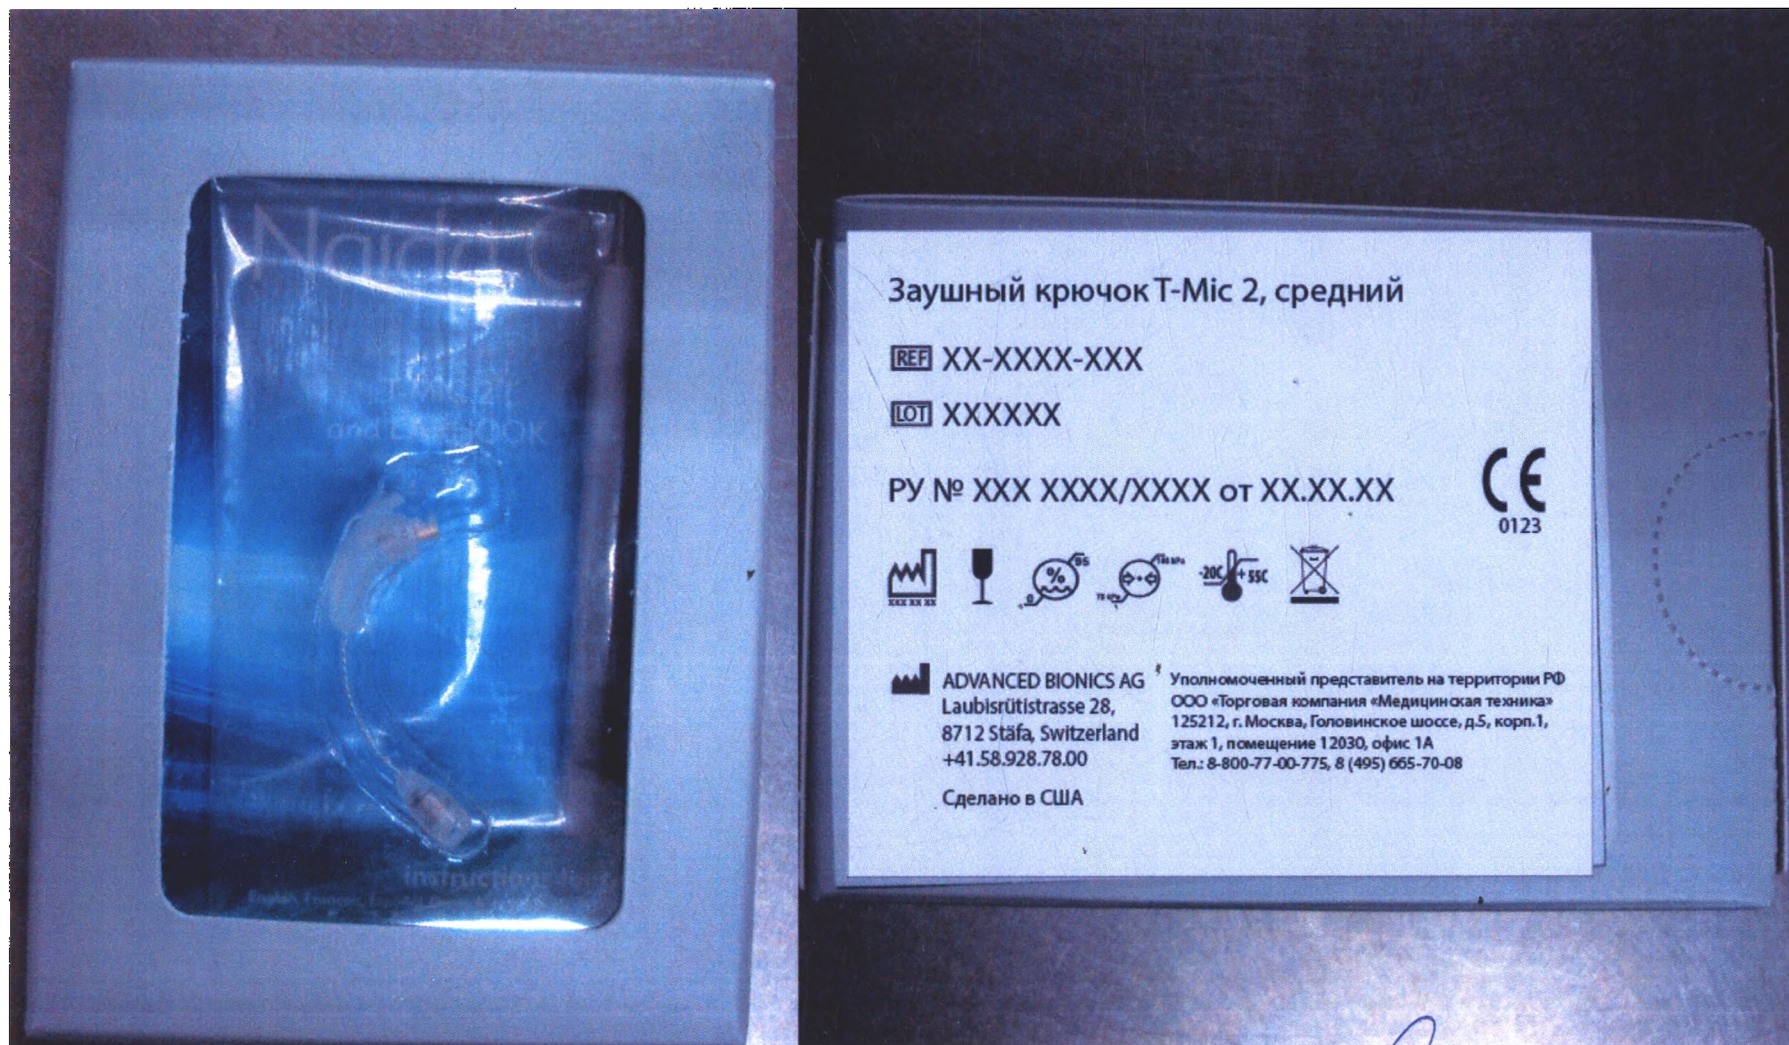


Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

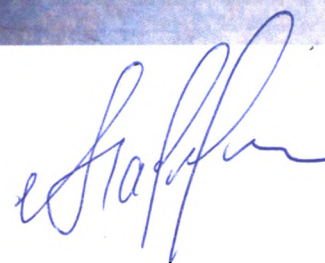 **Е.И. Ладутько**

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Устройство зарядное для Naida CI

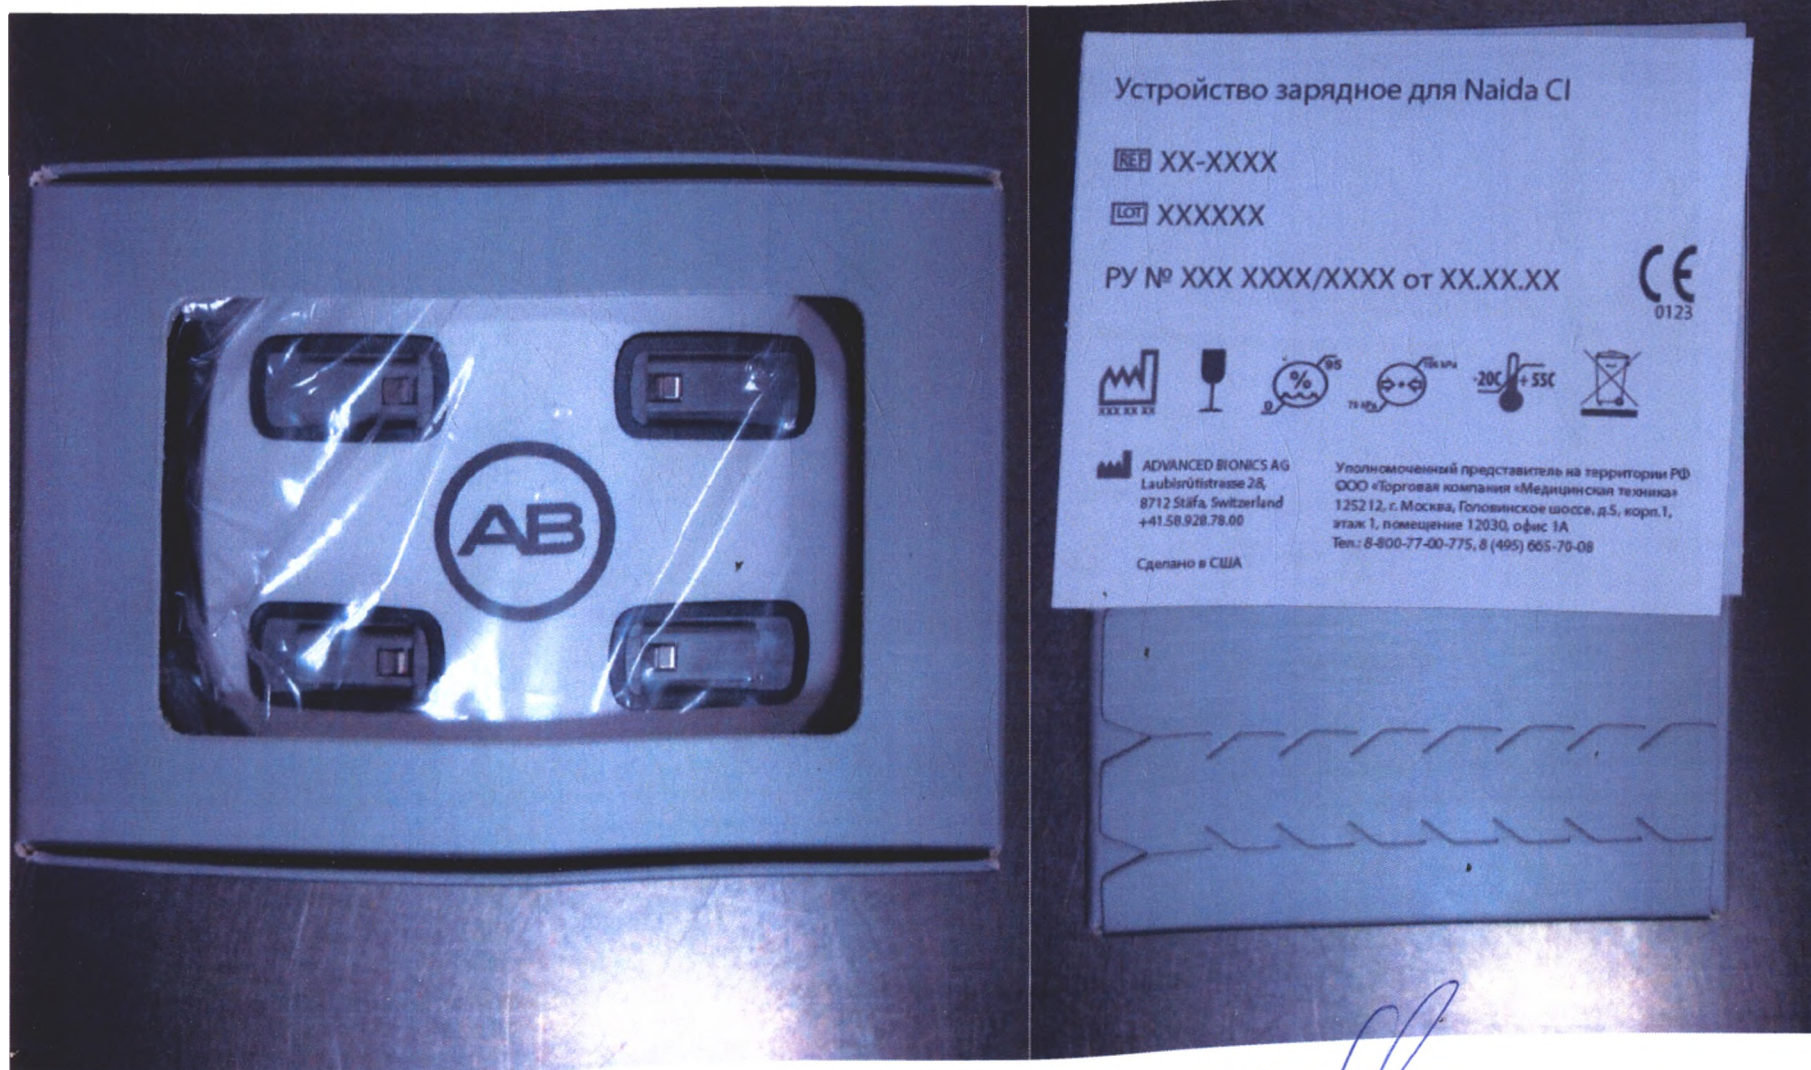

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Блок питания для зарядного устройства к Naida CI




Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»


Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Головной передатчик универсальный

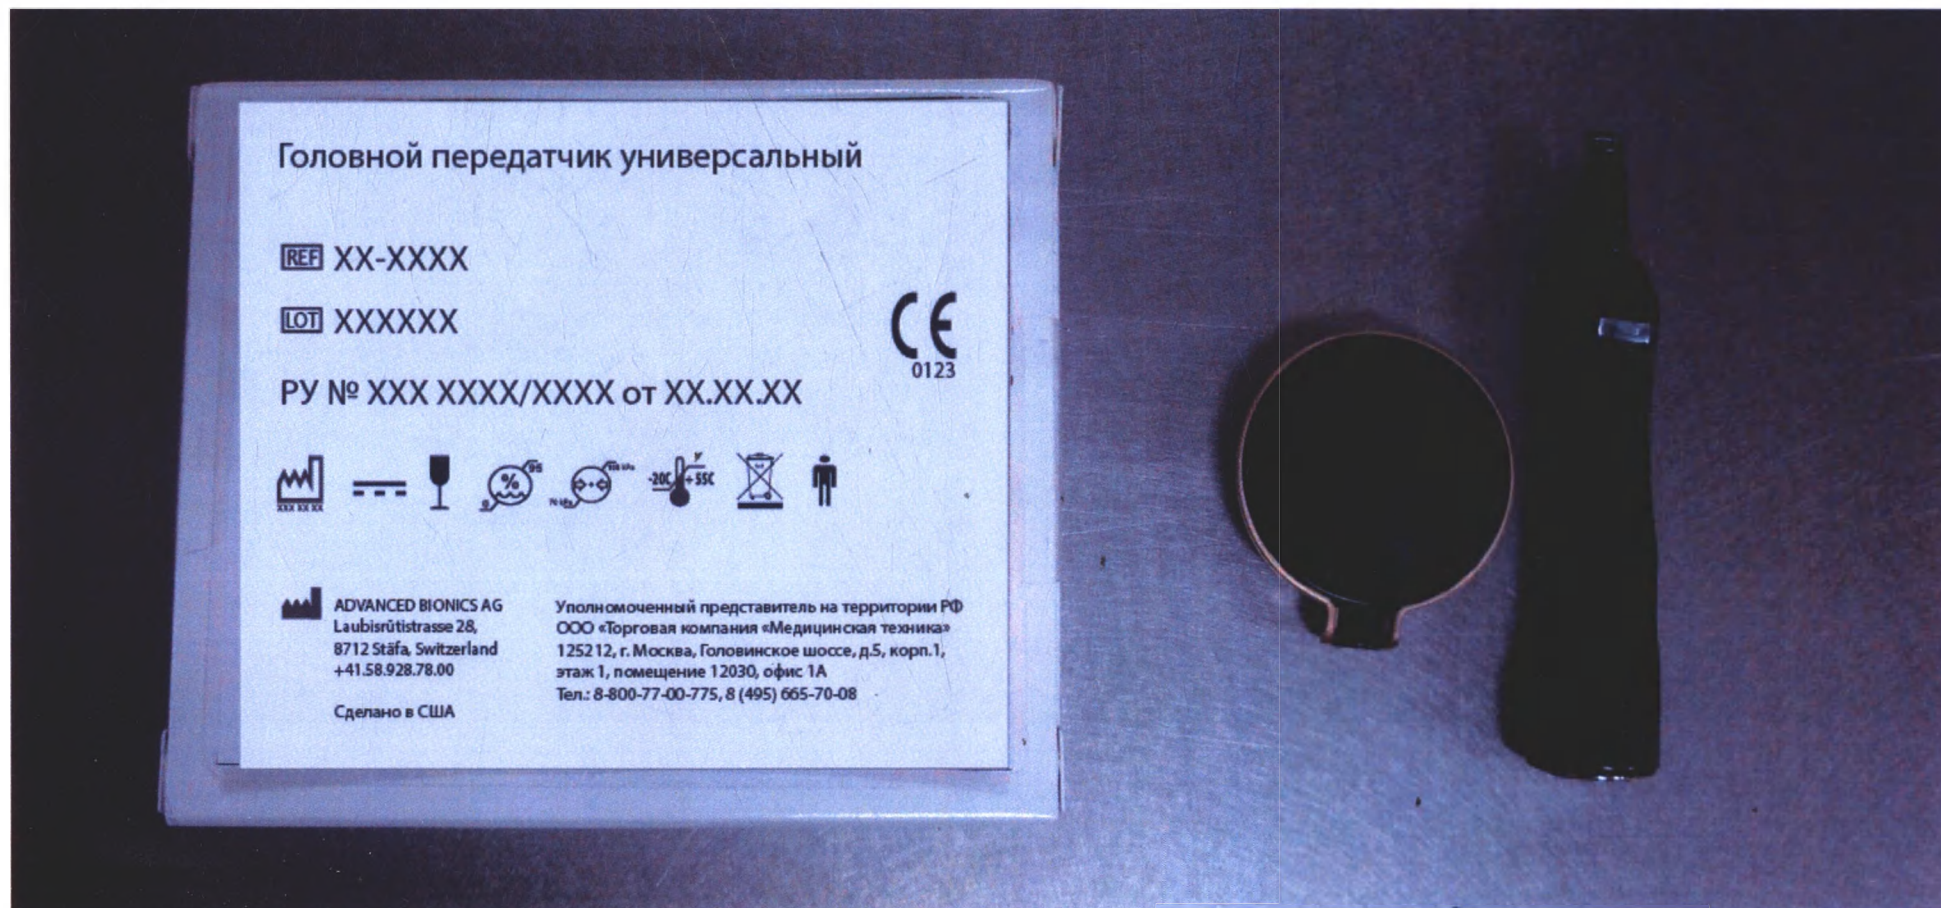

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

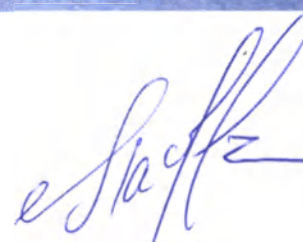
 Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Кабель головного передатчика



Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

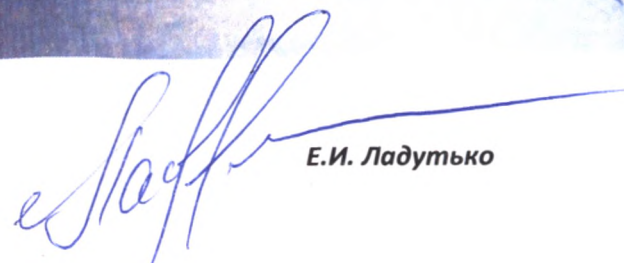
Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Накладки цветные для универсальных головных передатчиков




Накладки цветные
для универсальных головных передатчиков

REF XX-XXXX-XXX

LOT XXXXXX

РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XX


CE
0123



ADVANCED BIONICS AG
Laubisrütistrasse 28,
8712 Stäfa, Switzerland
+41.58.928.78.00
Сделано в США


Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Торговая компания «Медицинская техника»
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5, корп.1,
этаж 1, помещение 12030, офис 1А
Тел.: 8-800-77-00-775, 8 (495) 665-70-08

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»


Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Аккумуляторы PowerCel 170

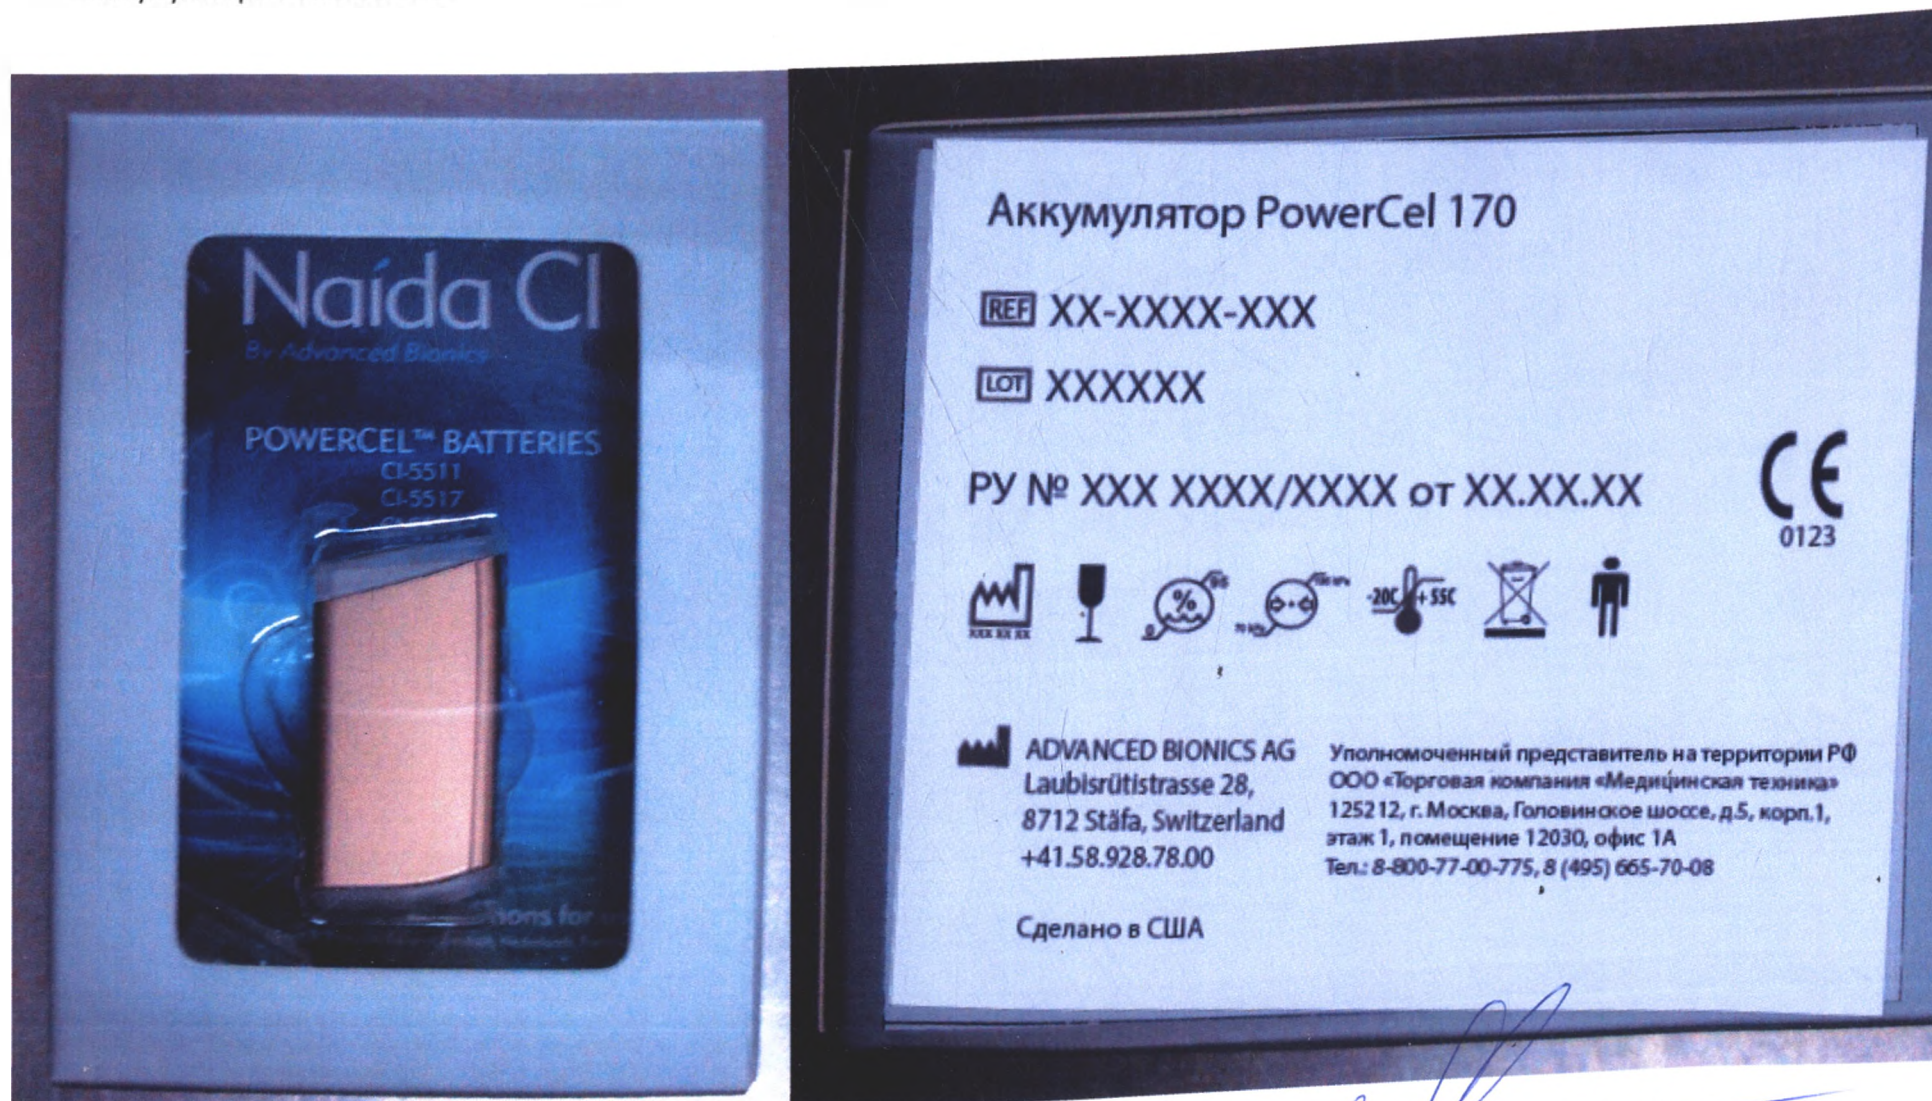


Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

E.I. Ladutsky
Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Аккумуляторы PowerCel 110

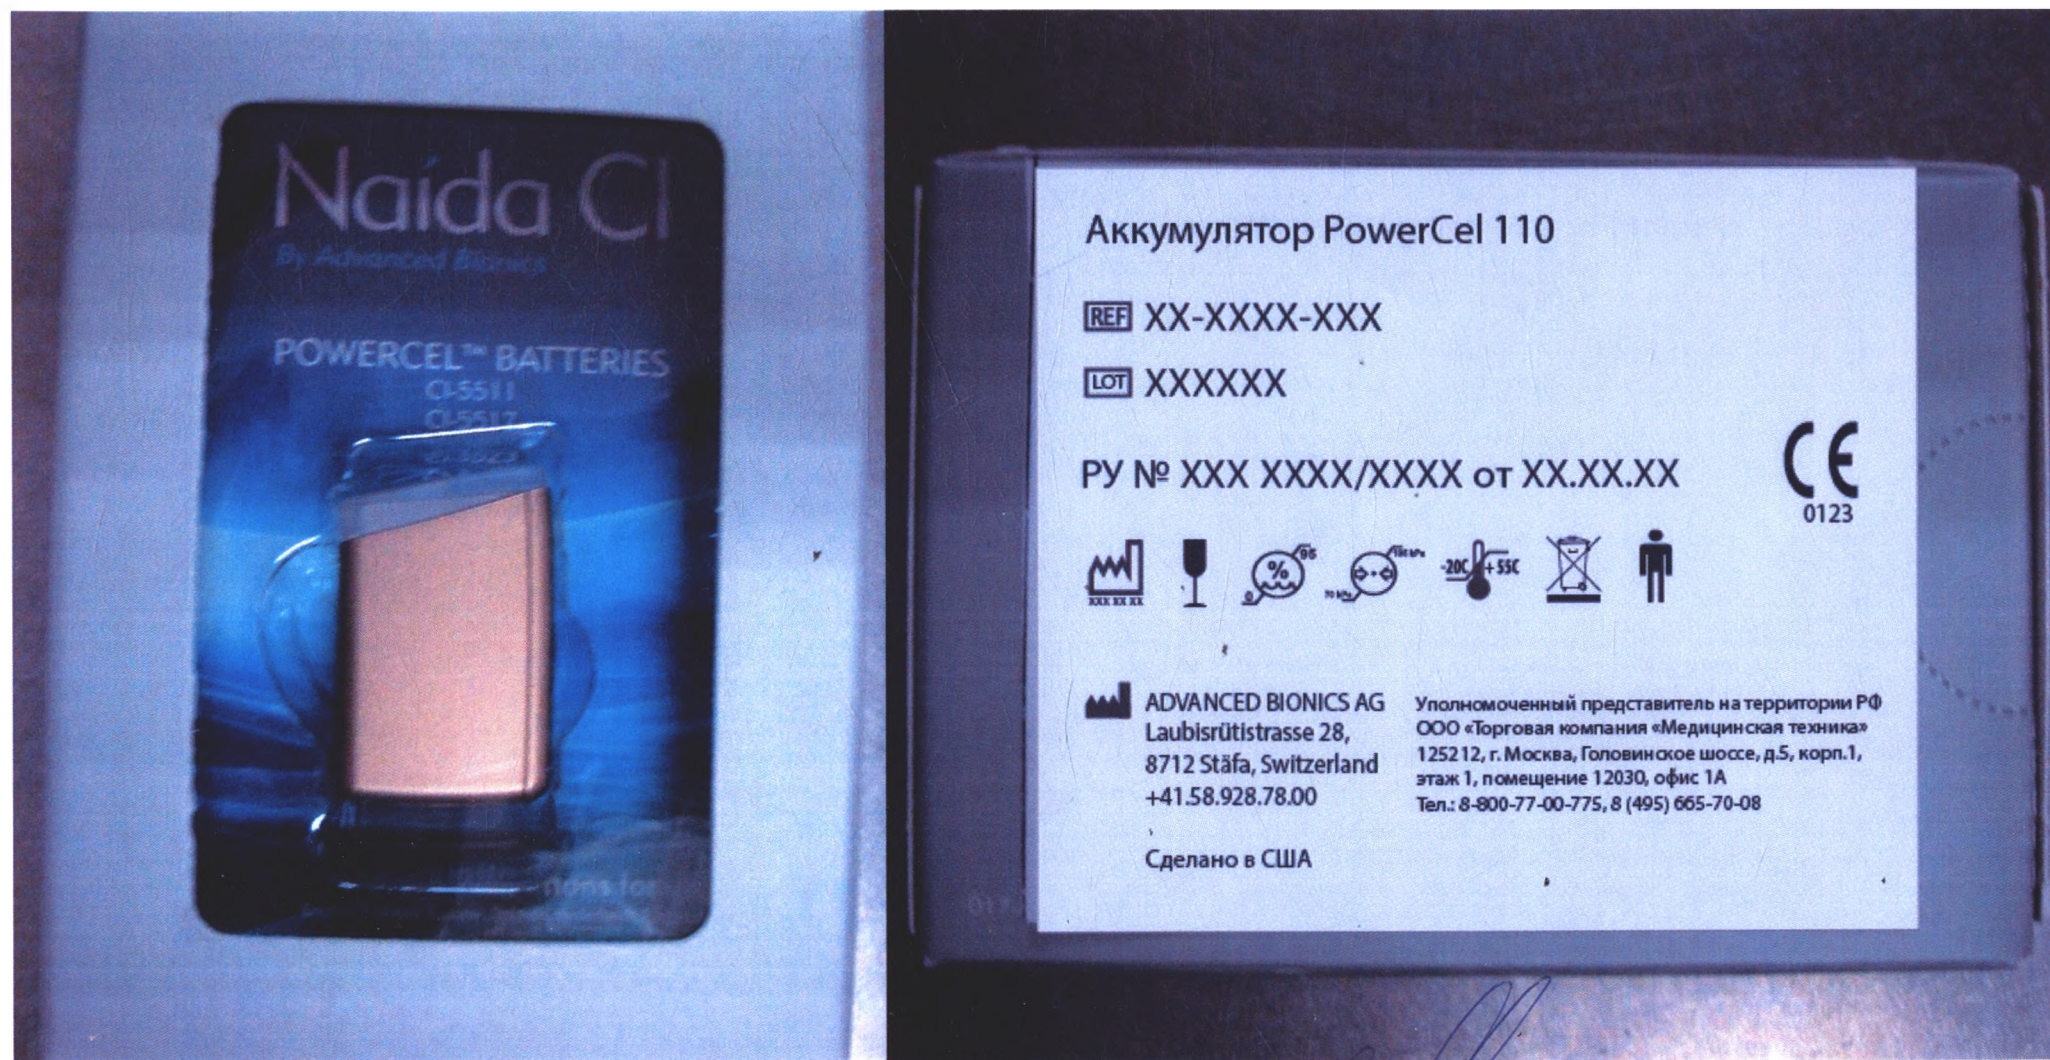


Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»


Е.И. Ладутько

Процессор Naída CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Отсек для воздушно-цинковых батареек

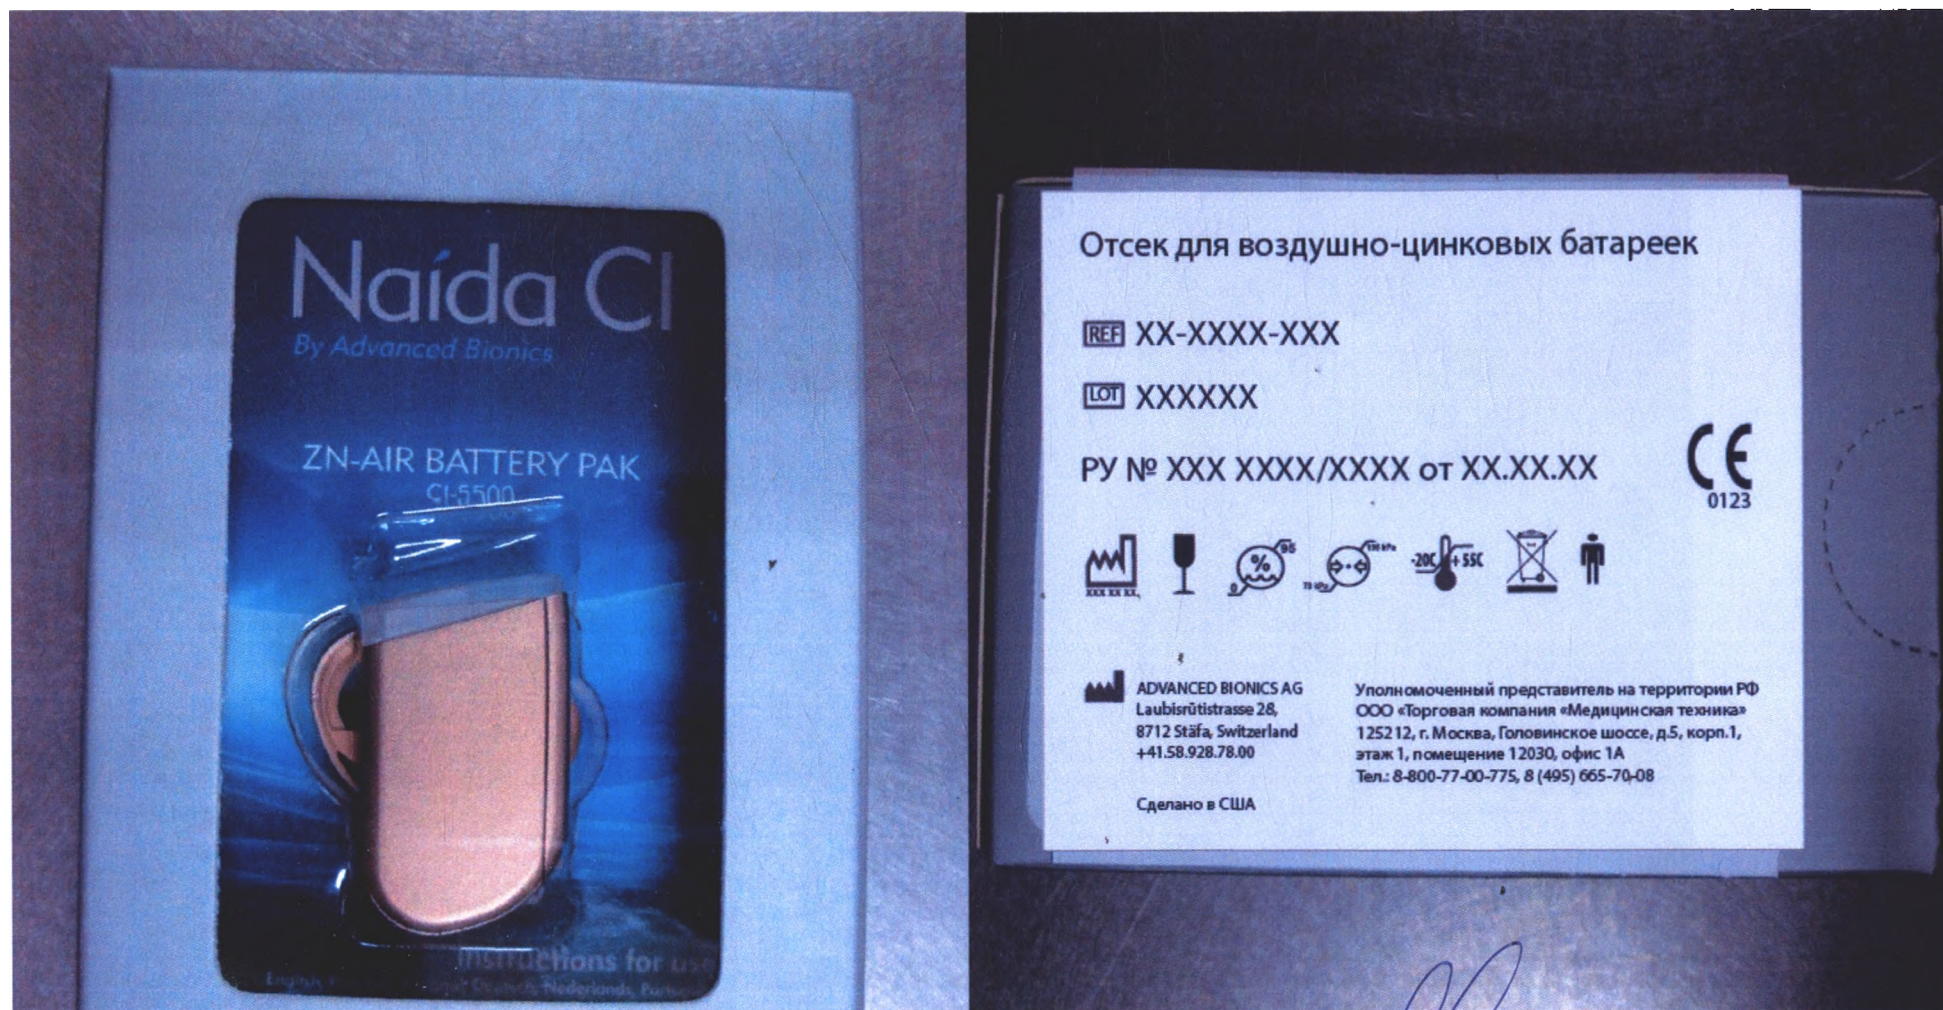

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

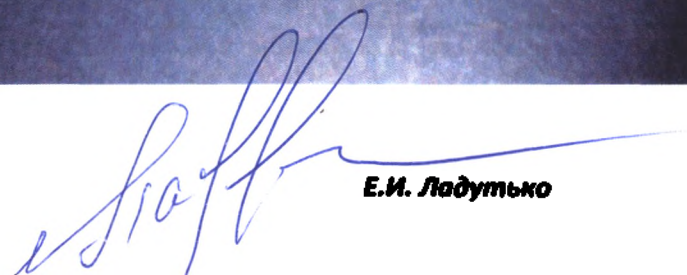
Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Блистер с 6-ю воздушно-цинковыми батарейками 675



Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Чехол для переноски Naida CI



Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Осушающее устройство



Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Е.И. Ладутько', is written over the printed name.

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Осушающий материал




Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Руководство пользователя Naida CI Q70

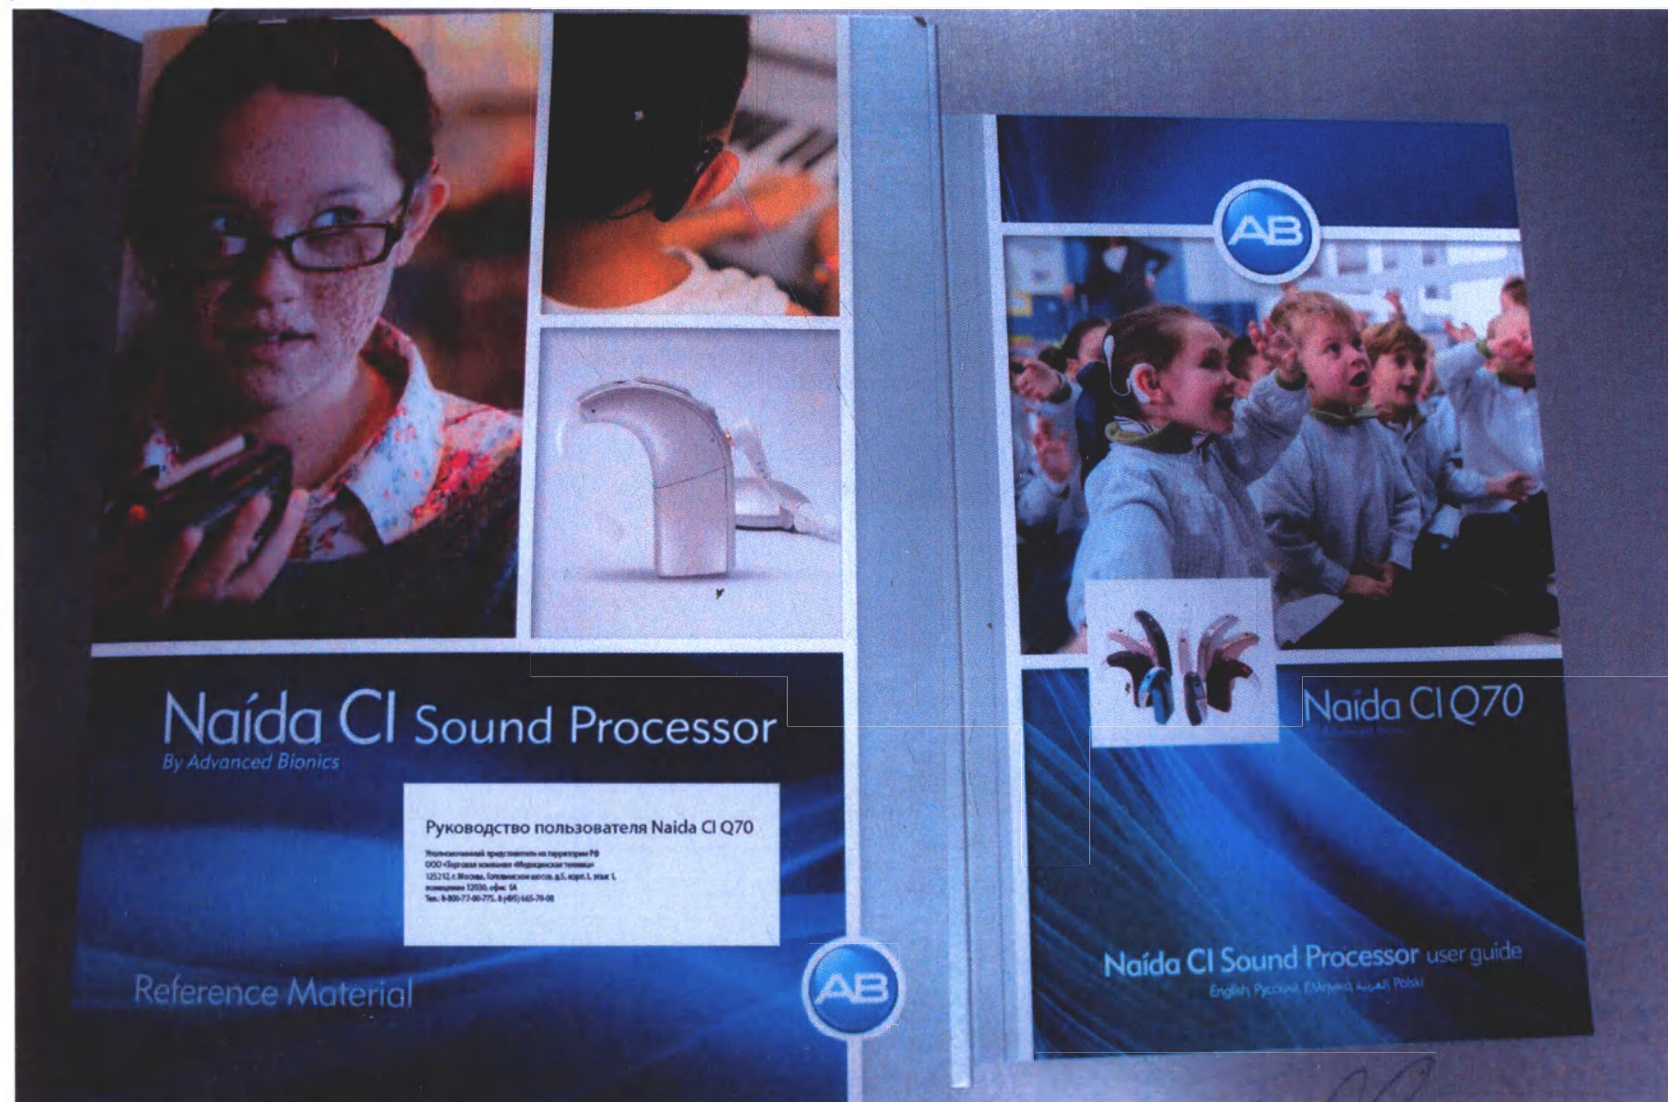

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Аудиоадаптер ComPilot (с руководством по эксплуатации)

Phonak ComPilot



PHONAK
life is on

A Sonova brand

017-0984/V3.00/2016-07/na

Аудиоадаптер ComPilot
(с Руководством по эксплуатации)

REF XX-XXXX-XXX

SN


ПУ № РЗН 2016/4399 от 05.07.16



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28,
CH-8712 Stäfa, Switzerland
+41.58.928.78.00
Сделано во Вьетнаме

Импортер
ООО «Сонова РУС»
125009, г.Москва, ул.Тверская,
д.12, стр.9, офис 98.
т. 8(495)788 02 01

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

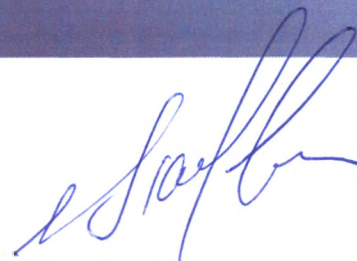 **Е.И. Ладутский**

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Устройство для проверки микрофонов в Naida CI




Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Наушники для прослушивания микрофона

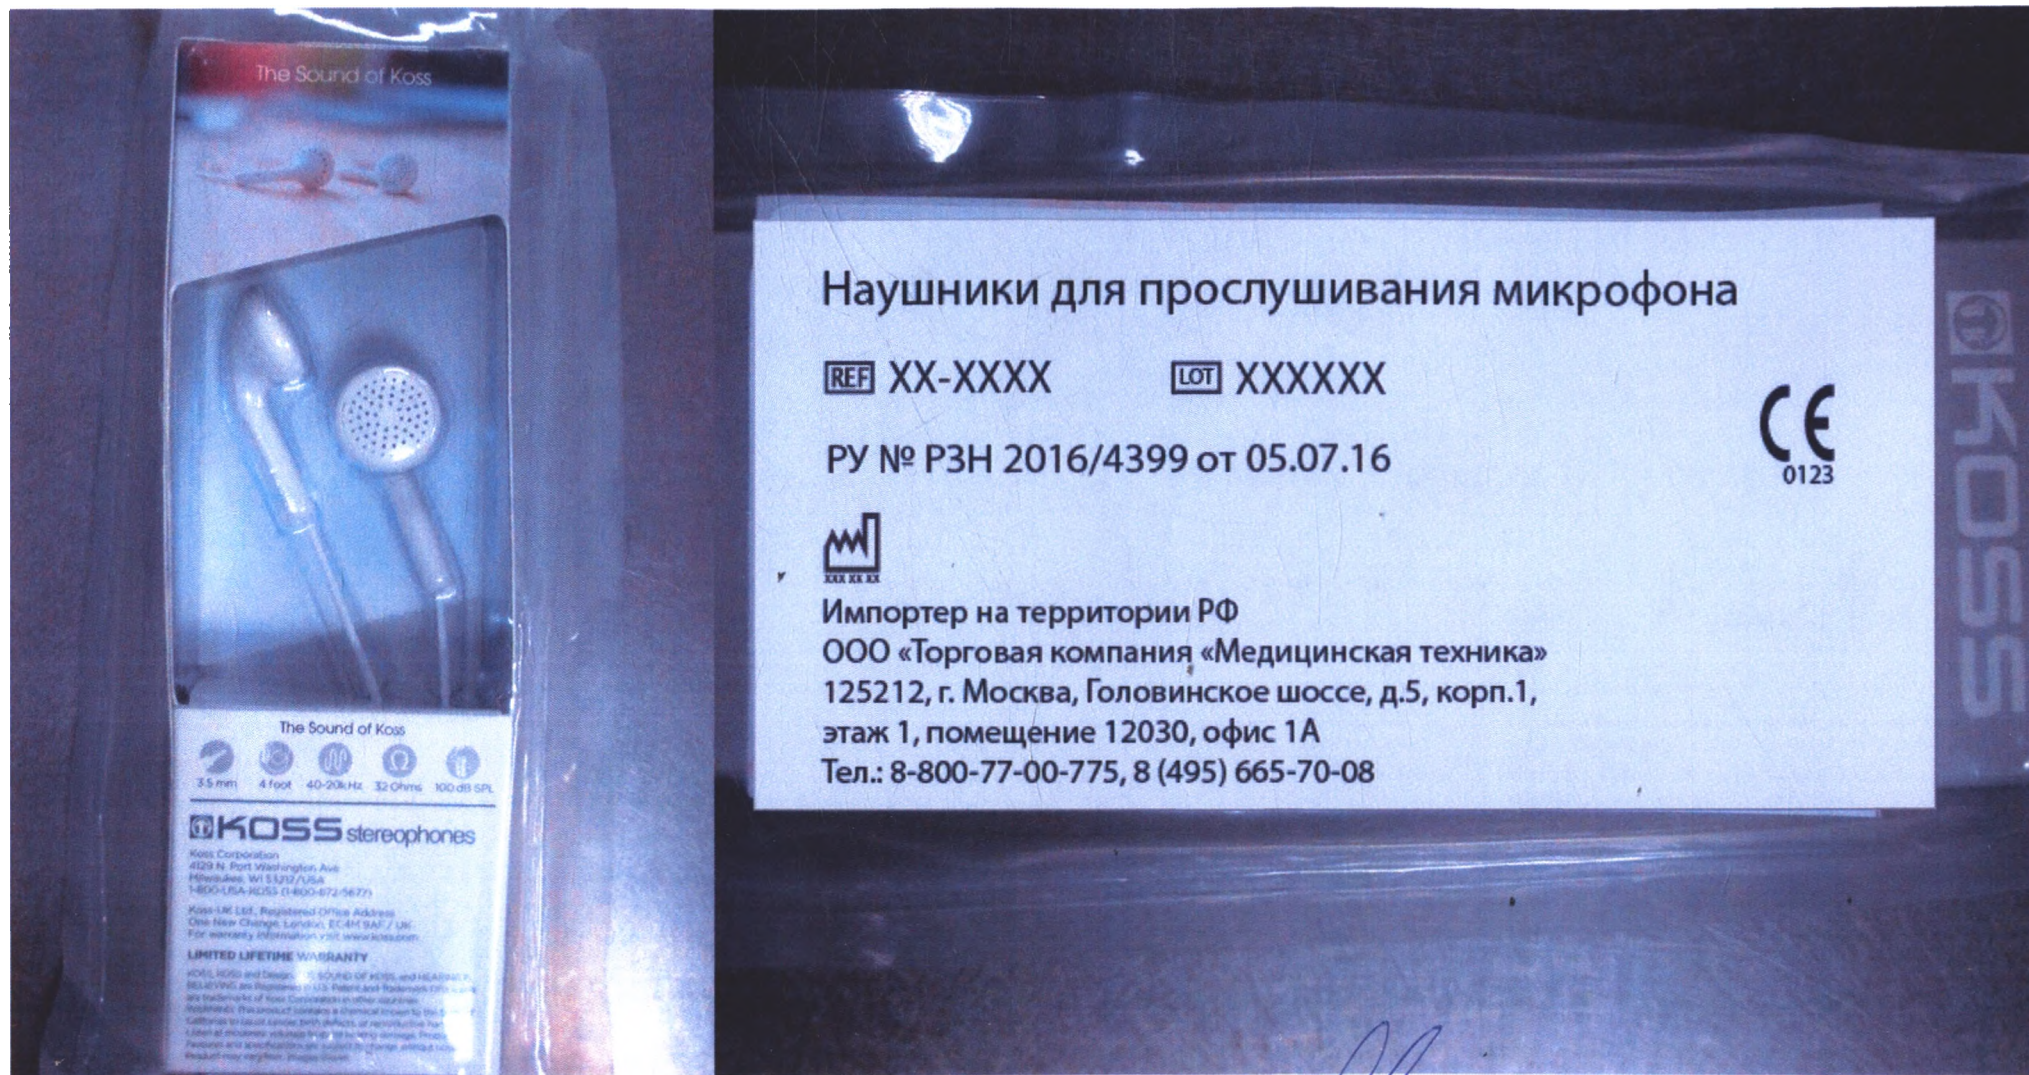

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Программатор CPI-3 (CPI-3 Clinical Programming Interface)



Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»


Е.И. Ладутко

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Кабель для программатора CPI-3 для Naida CI (Naida CI Programming Cable)




Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько

Процессор Naida CI Q70 для системы кохлеарных имплантатов, с принадлежностями:

Программное обеспечение Soundwave версия 2.2

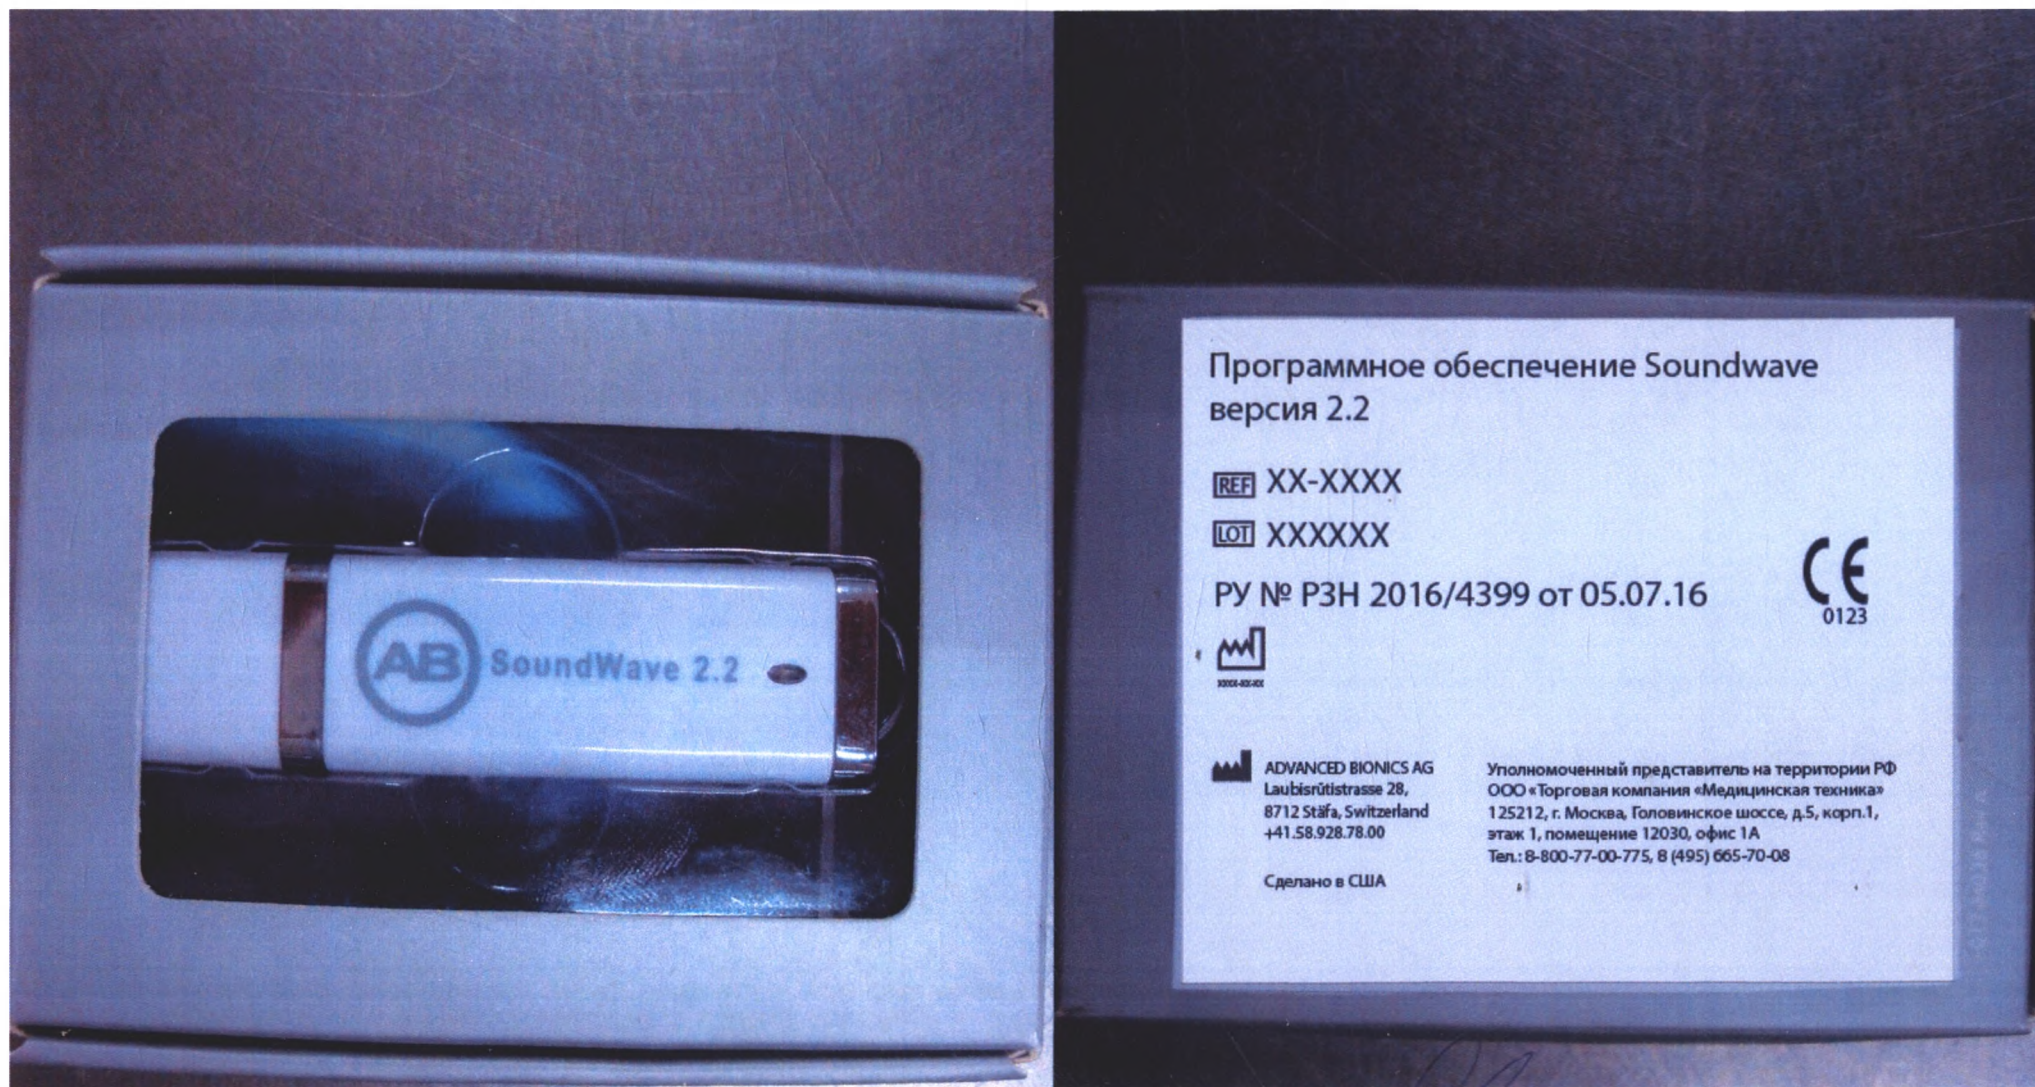

Генеральный директор ООО «Торговая компания «Медицинская Техника»

Е.И. Ладутько



ООО "ТК "Медицинская техника"
В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 22 листов.
" 16 " 01 20 19 г.
Должность _____ Подпись _____