


↓ Воротничок

~~Приложение 1 к протоколу № 34/13~~

вкладыш ортопедический корректирующий

Арт. 1-ОВ-1

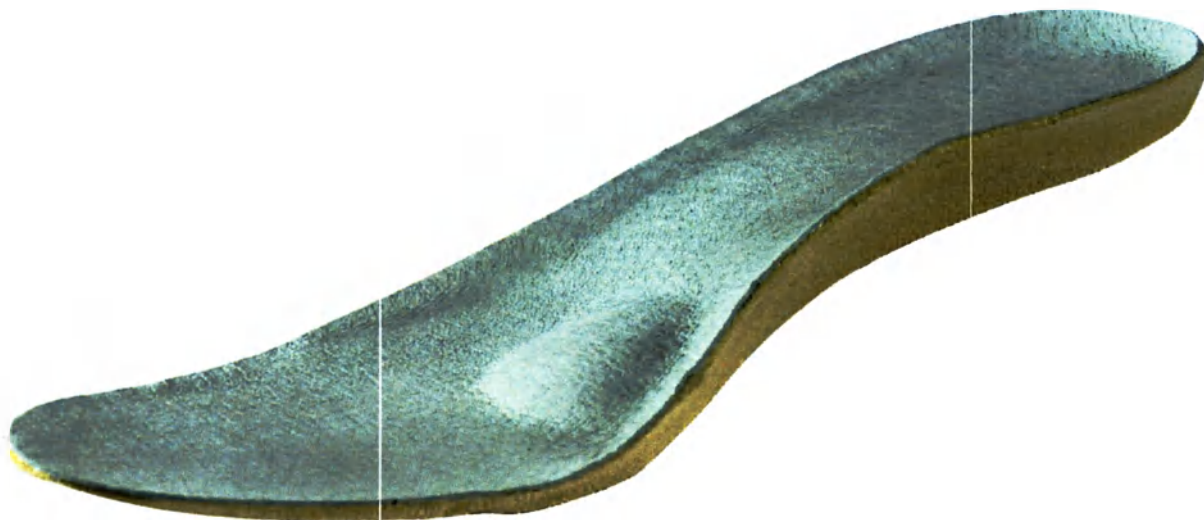

Приложение 1

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия



Акт № 52 ОПТИ/2013 оценки результатов технических испытаний медицинского изделия распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего документа без разрешения ОС «Энергия плюс»