


УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»

 Н.В. Макарова
«21» января 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКРИМАЛЬНЫЙ ИНТУБАЦИОННЫЙ НАБОР



FCI S.A.S.

20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS

30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359

PHONE: 800-932-4202



1.	Параметры инфракрасного набора ВКА арт. (S1.1000)	1	шт.	1850833	2018-03	2023-02
в составе:						
	два зонта для установки в клипсовую трубу	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	спинеры	12	шт.			

Рисунок 1 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1000



Рисунок 3 – Комплектность арт. S1.1000

1.	Лапароскопический набор Вика арт. (S1.1000)	1	шт.	1850833	2018-03	2023-02
в составе:						
	два зонда предостановленные в силиконовую трубу	3	шт.			
инструкция		1	шт.			
стикеры		12	шт.			



Рисунок 4 - Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1000

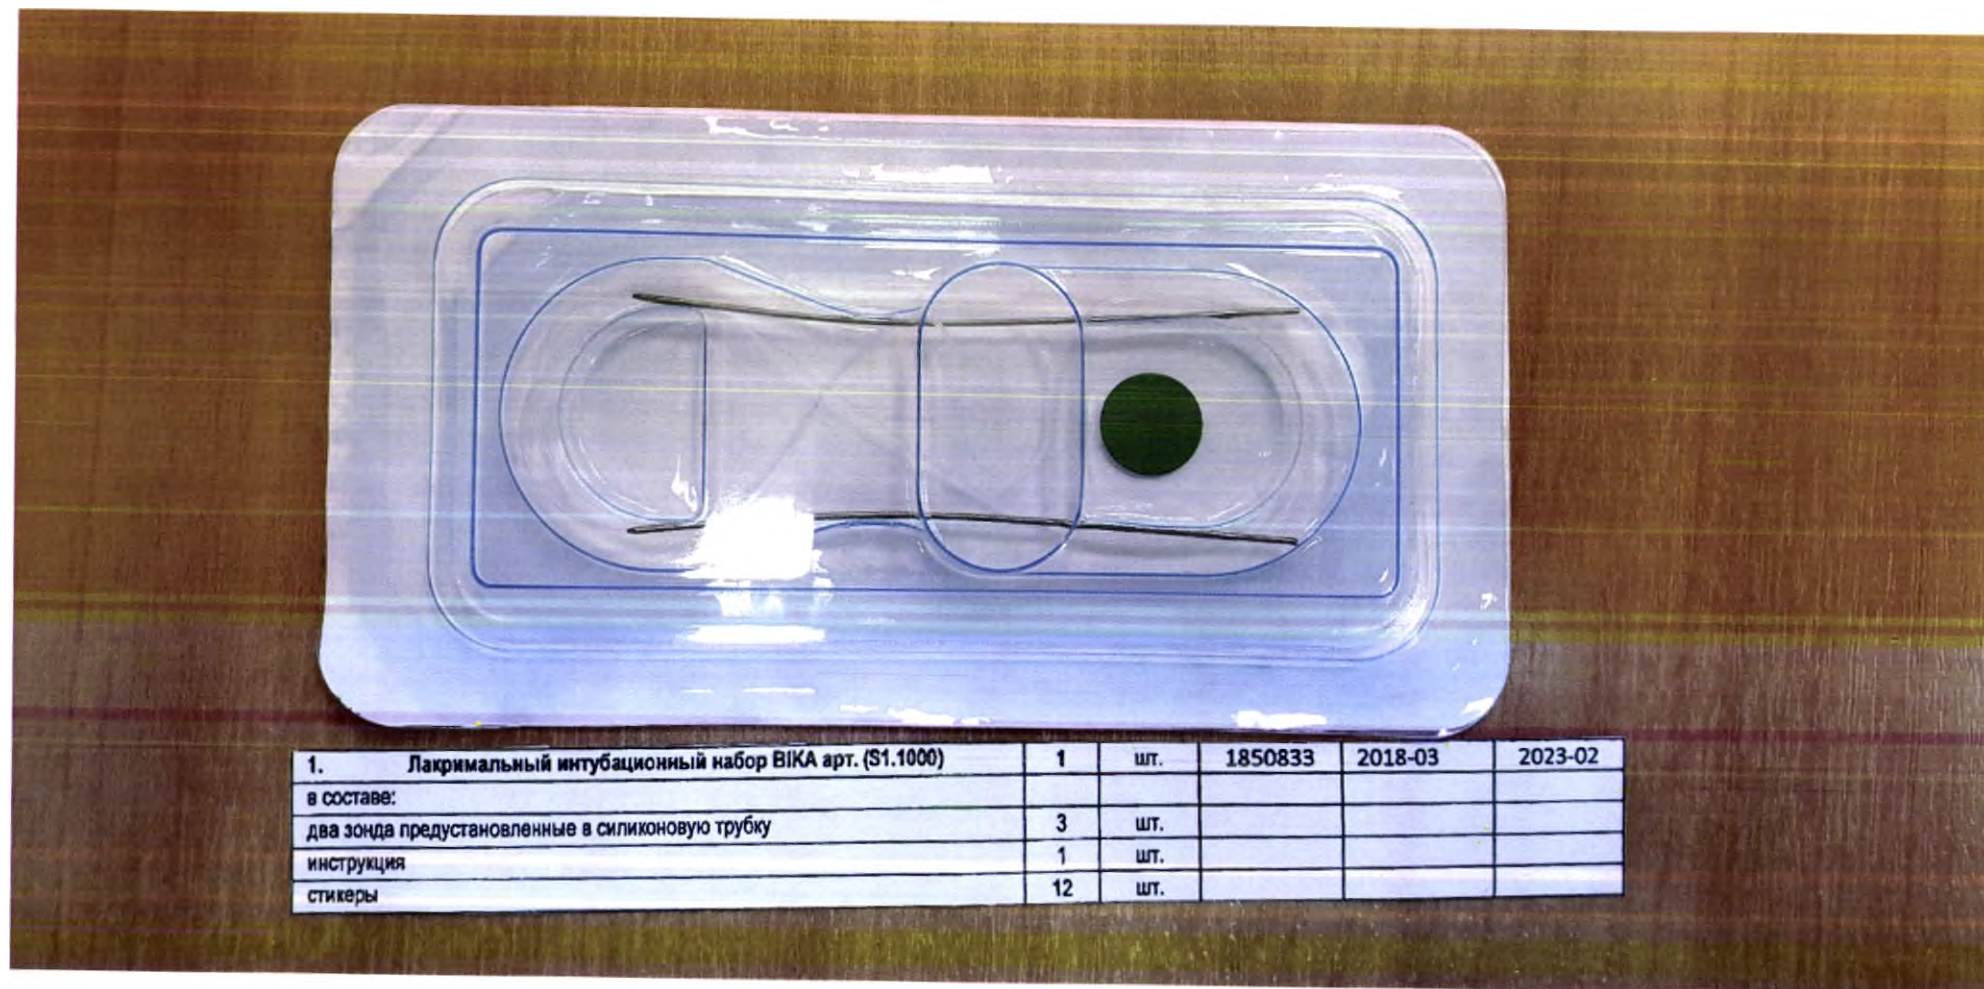


Рисунок 5 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1000

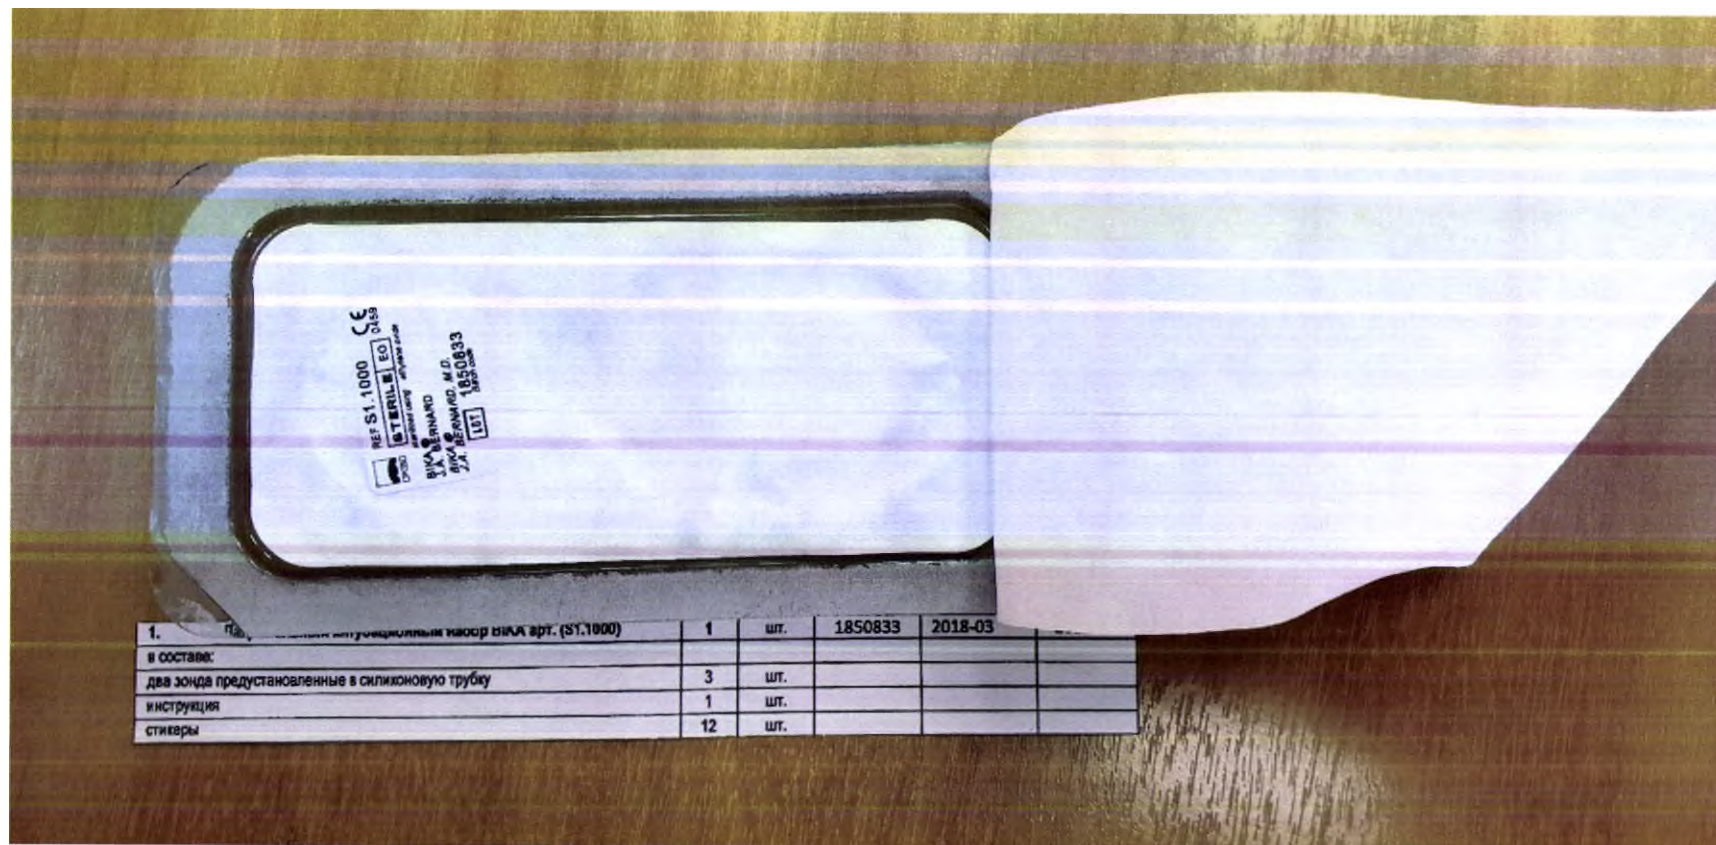


Рисунок 6 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1000

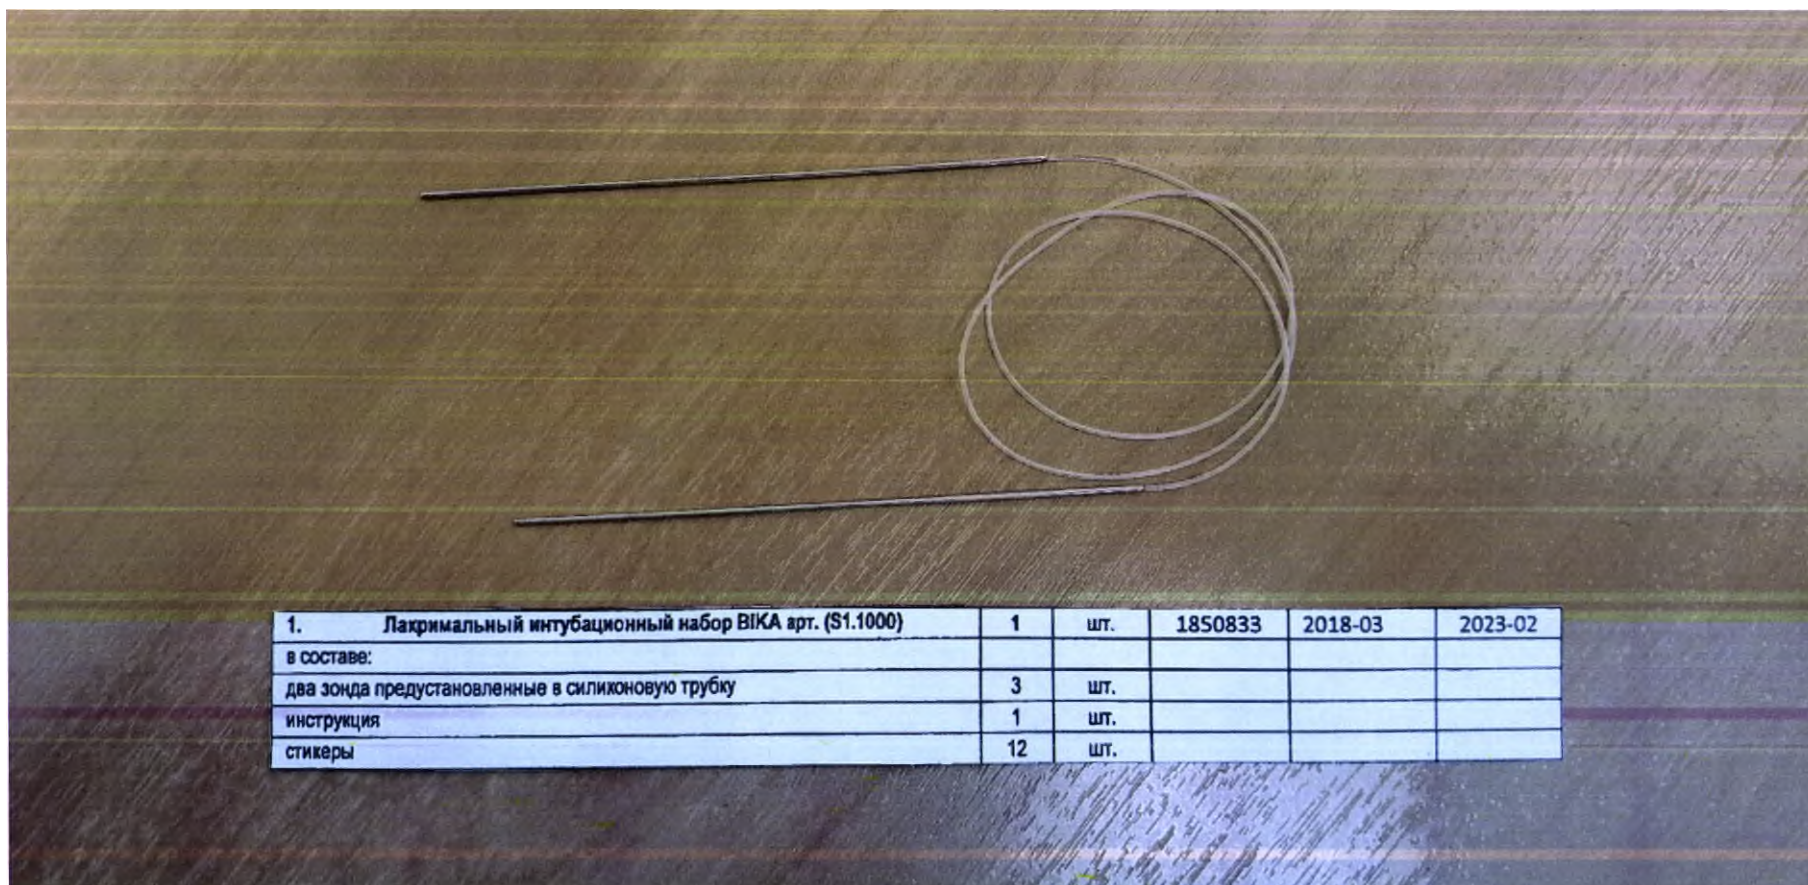


Рисунок 7 – Лагримальный интубационный набор ВІКА, арт. S1.1000



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



2. Дополнительный инфузионный набор ВКА с РРР покрытием арт. (SI.1010)	1	шт.	1851153	2018-03	2023-02
в составе:					
два зонда предназначенные в кислородную трубку	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			

Рисунок 8 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. SI.1010

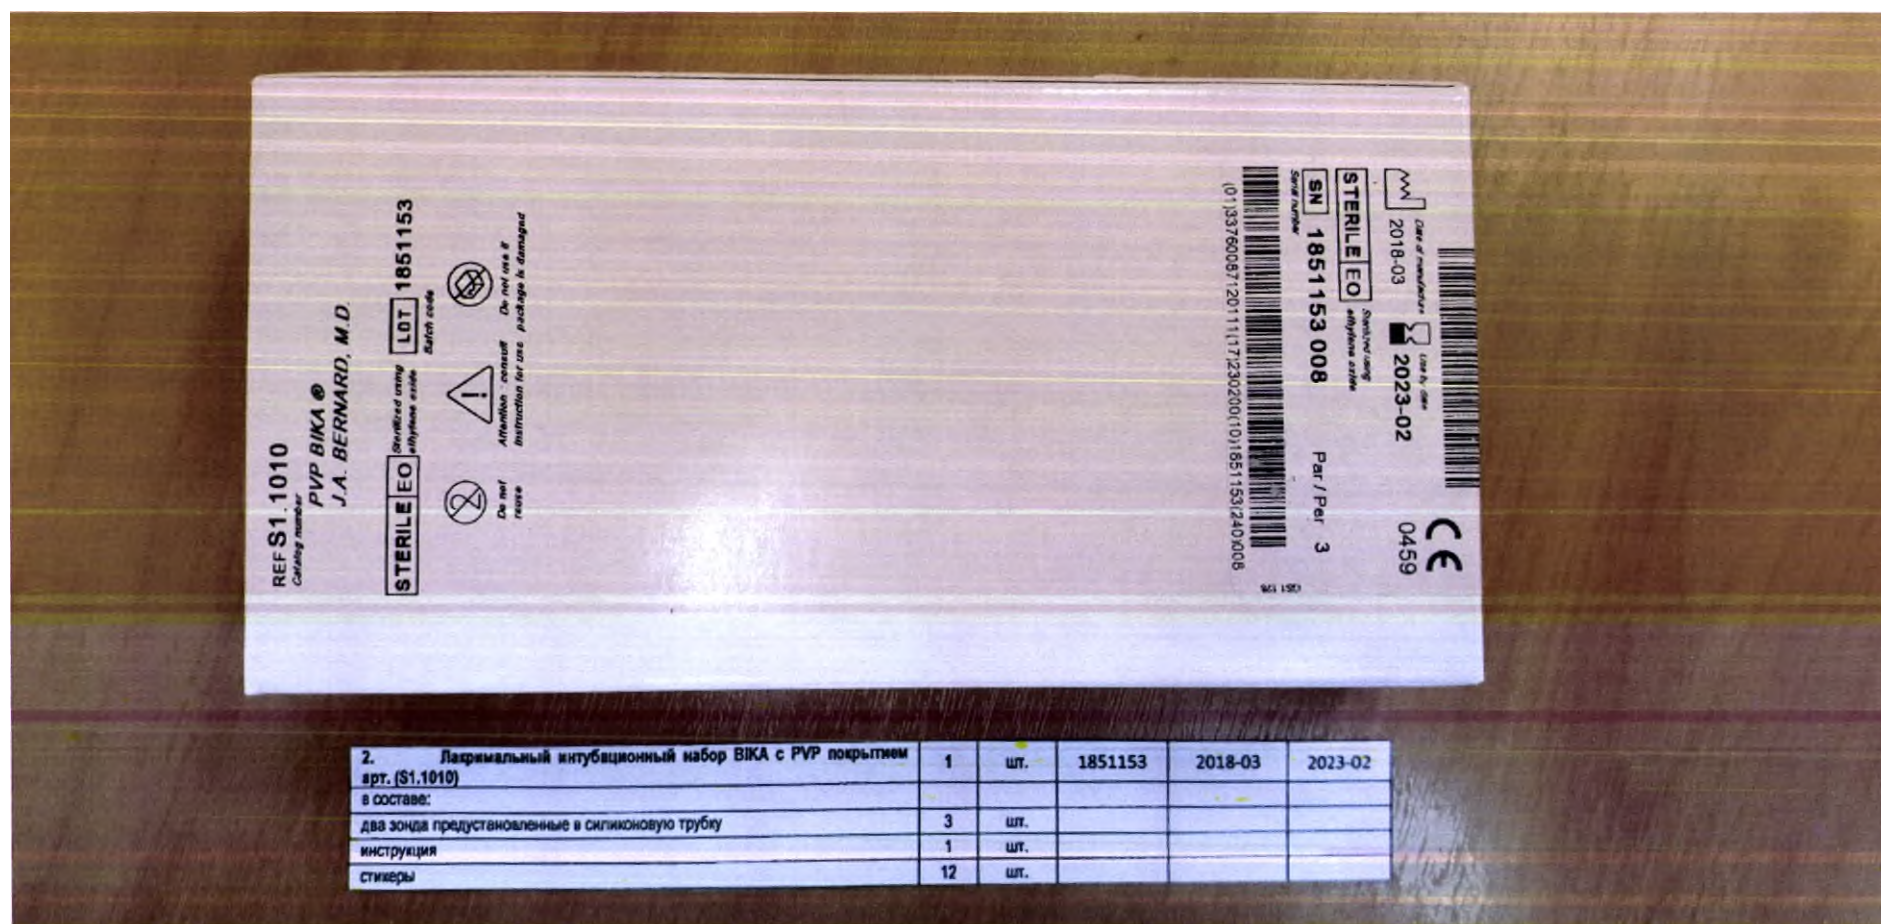


Рисунок 9 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1010



Рисунок 10 – Комплектность арт. S1.1010



Рисунок 11 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1010

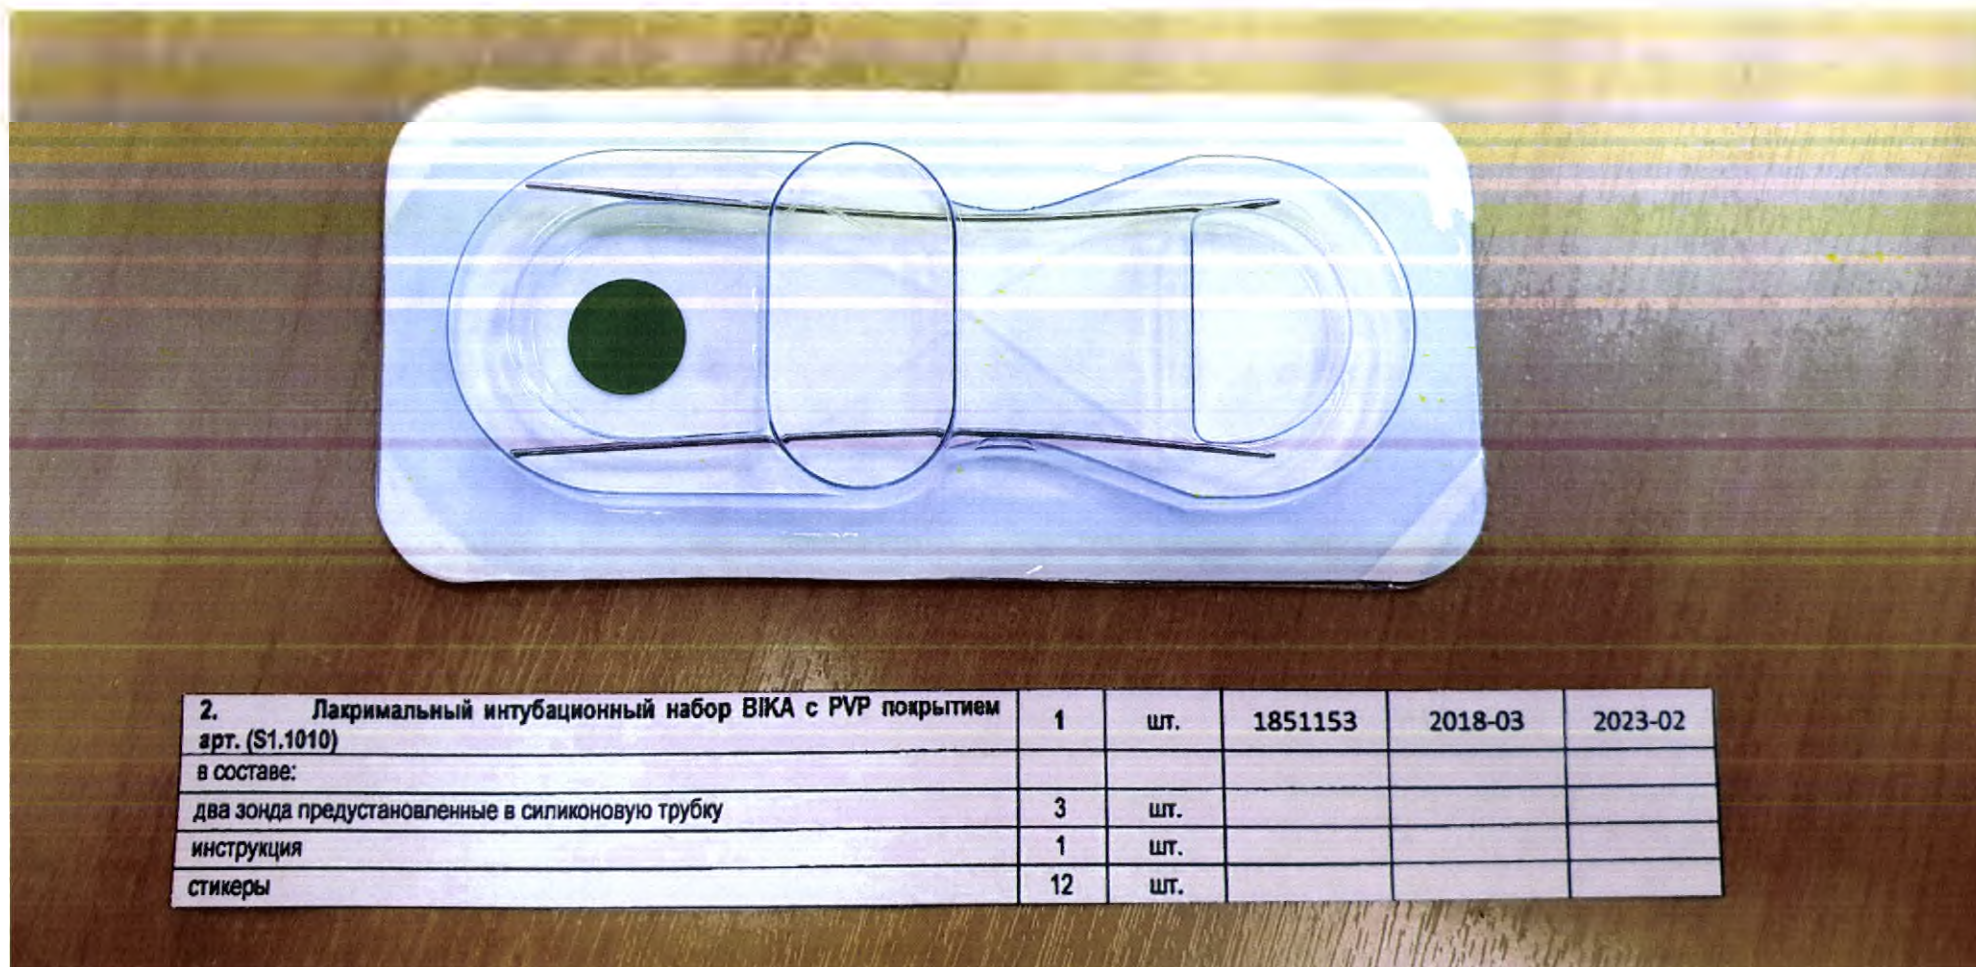


Рисунок 12 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1010

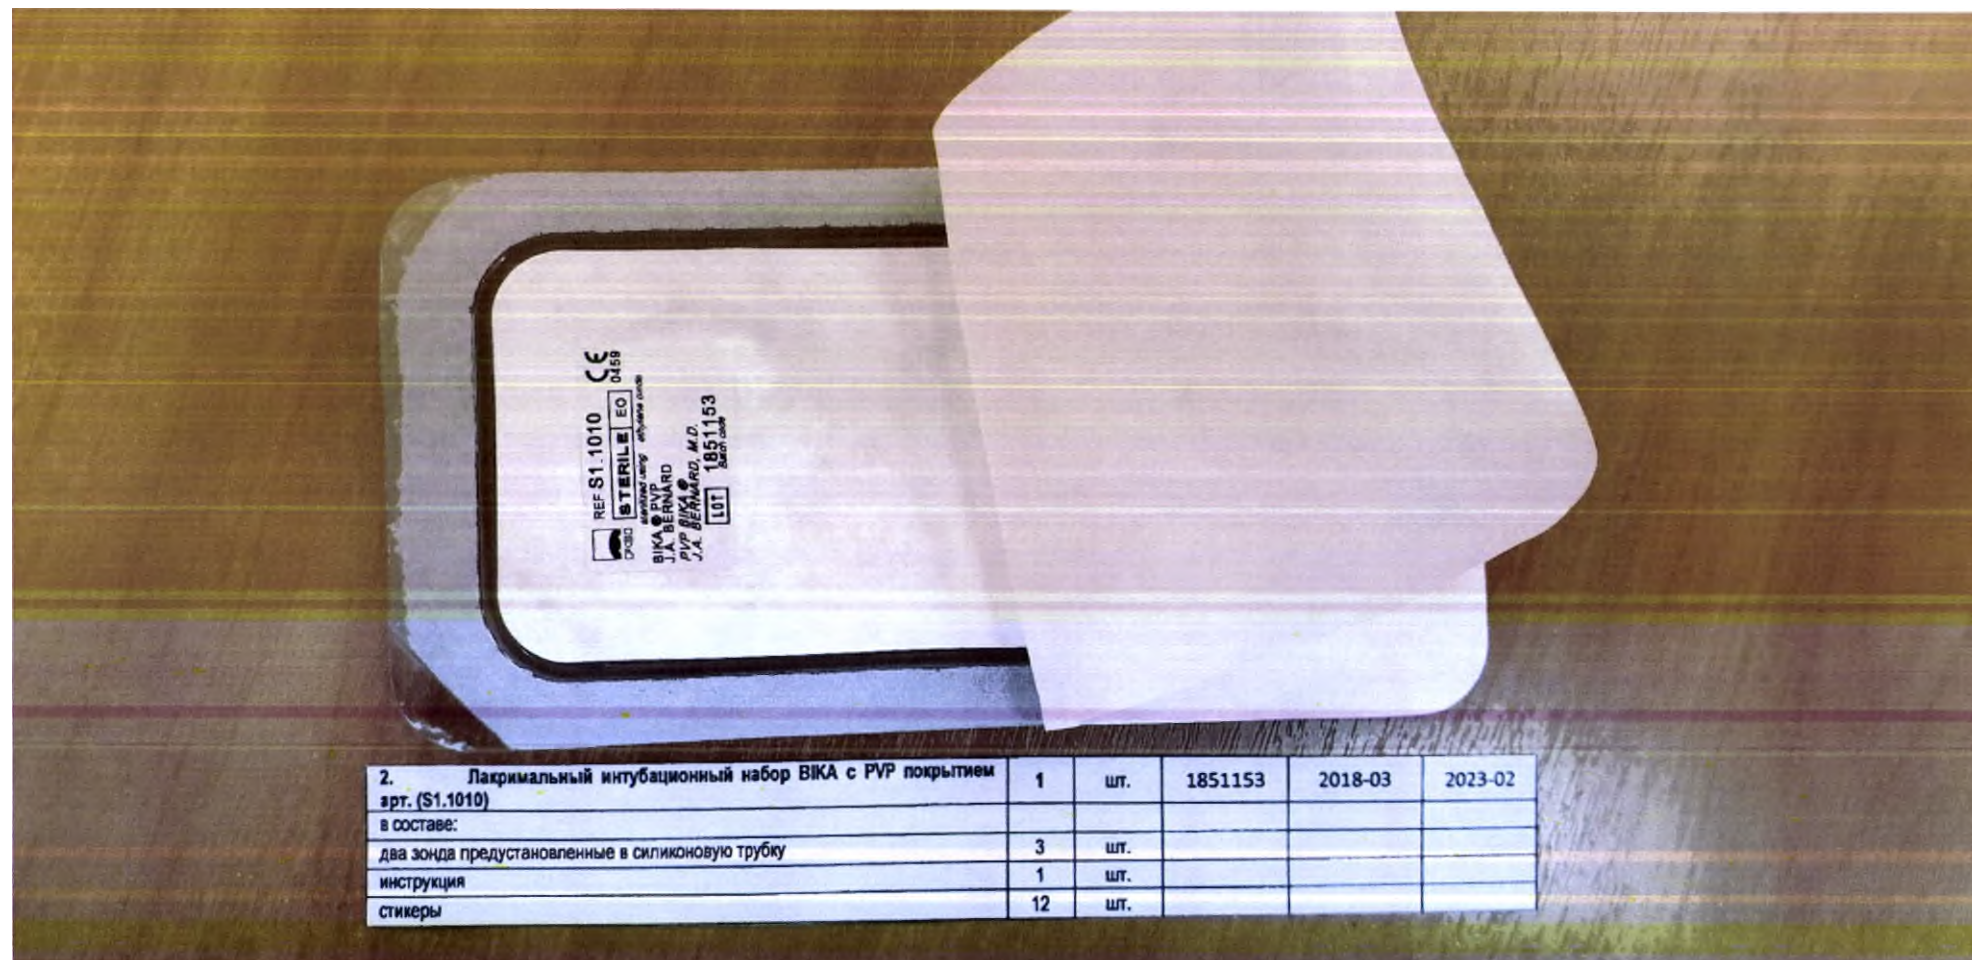


Рисунок 13 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1010

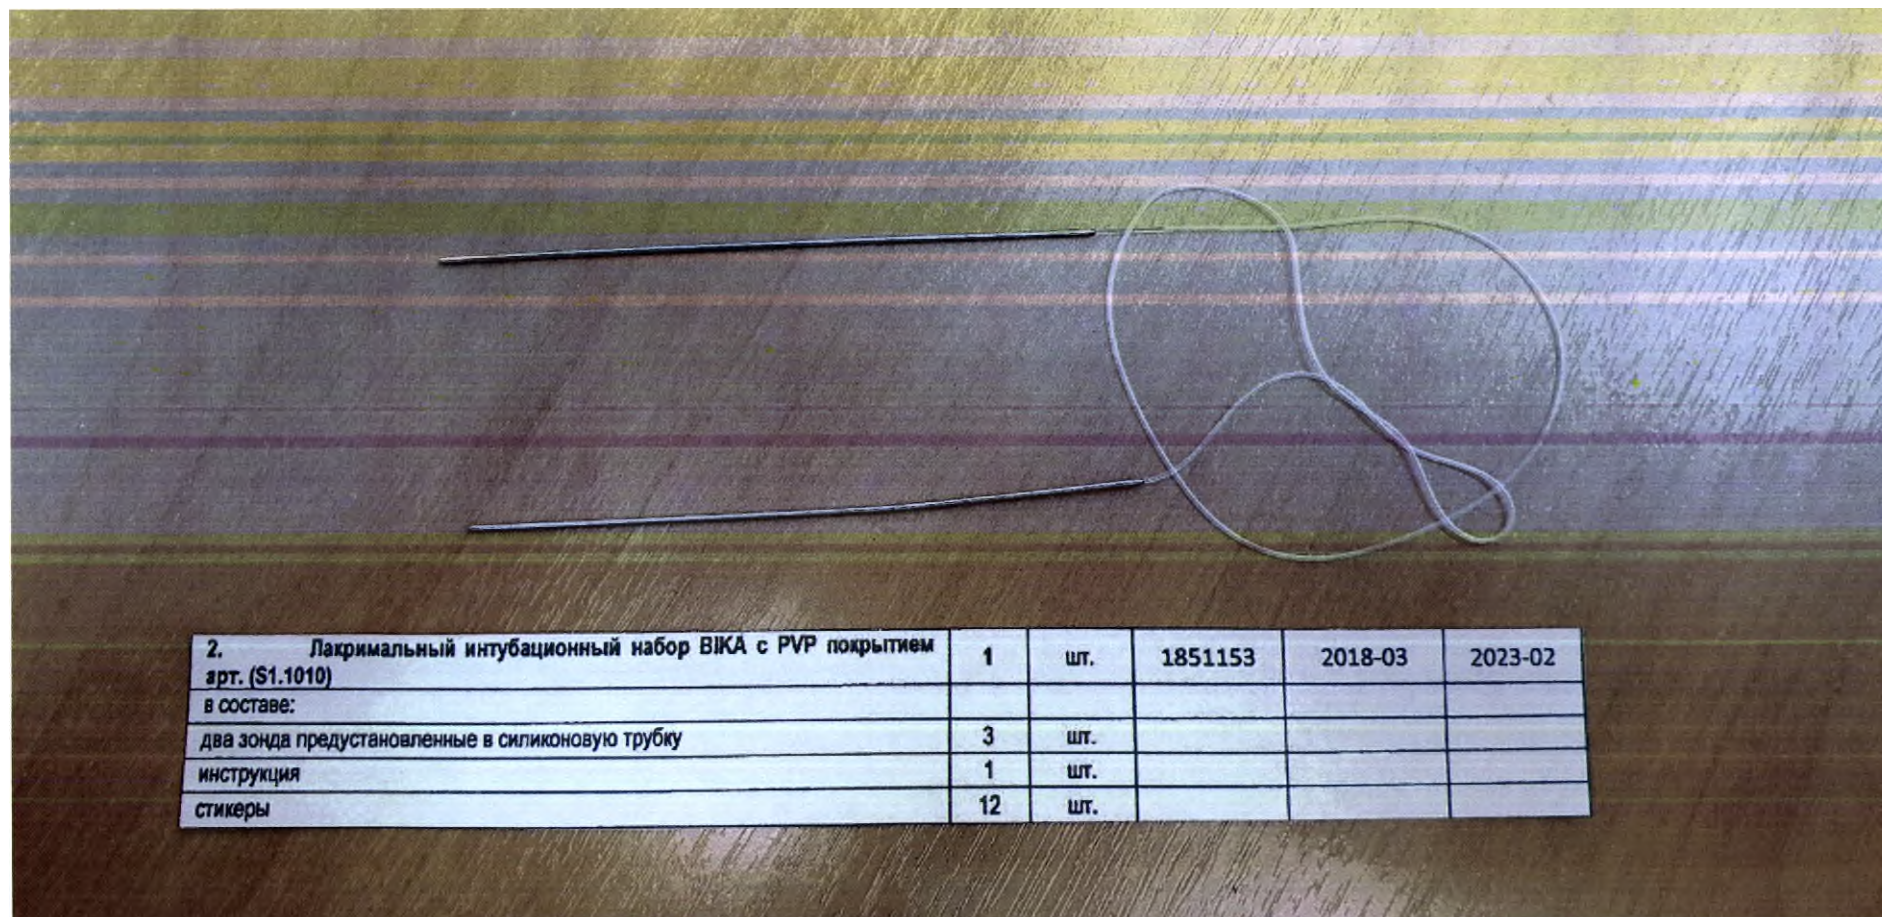


Рисунок 14 – Лакримальный интубационный набор ВІКА с PVP покрытием, арт. S1.1010



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by :

FCI OPHTHALMICS
20 Winter Street
Pembroke, MA 02359
PHONE : 800-932-4202



3.	Лазерный интубационный набор ВКА с РРР покрытием арт. (SI.1023)	1	шт.	1501142	2015-06	2020-05
	в составе:	1	шт.			
	два жюда предохранения в синем и красном трубу	1	шт.			
	инструкция	4	шт.			
	стериль					

Рисунок 15 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. SI.1023

3.	Парциальный интубационный набор ВКА с PVP покрытием арт. (S1.1023)	1	шт.	1501142	2015-06	2020-05
	в составе:					
	Для зонда предназначенное в силиконового трубку	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стериль	4	шт.			

Рисунок 16 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1023

Indications : Larmoiements

2015-06 2020-05

LOT 1501142 Ind.: 025

STERILE EO

5°C 41°F 45°C 113°F

GS1-128

(01)13760087120131(17)200500(10)1501142(240)025

REF S1.1023 BIKA*
DIFFERENTIELLE PVP

3145992
Implant ophtalmologique lacrymal,
canaliculo-nasal

TRAITEMENT PVP

3162950
Implant ophtalmologique lacrymal,
supplément, traitement hydrophilisant

Indications : Epiphora

STERILE EO

2015-06 2020-05

CE 0459

5°C 41°F 45°C 113°F



Рисунок 17 – Комплектность арт. S1.1023

3.	Ларингальный интубационный набор ВІКА с РVP покрытием			
арт. (S1.1023)	1	шт.	1501142	2015-06
в составе:				
два зонда предназначенные в силиконовую трубку	1	шт.		
инструкция	1	шт.		
стикеры	4	шт.		



Рисунок 18 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1023

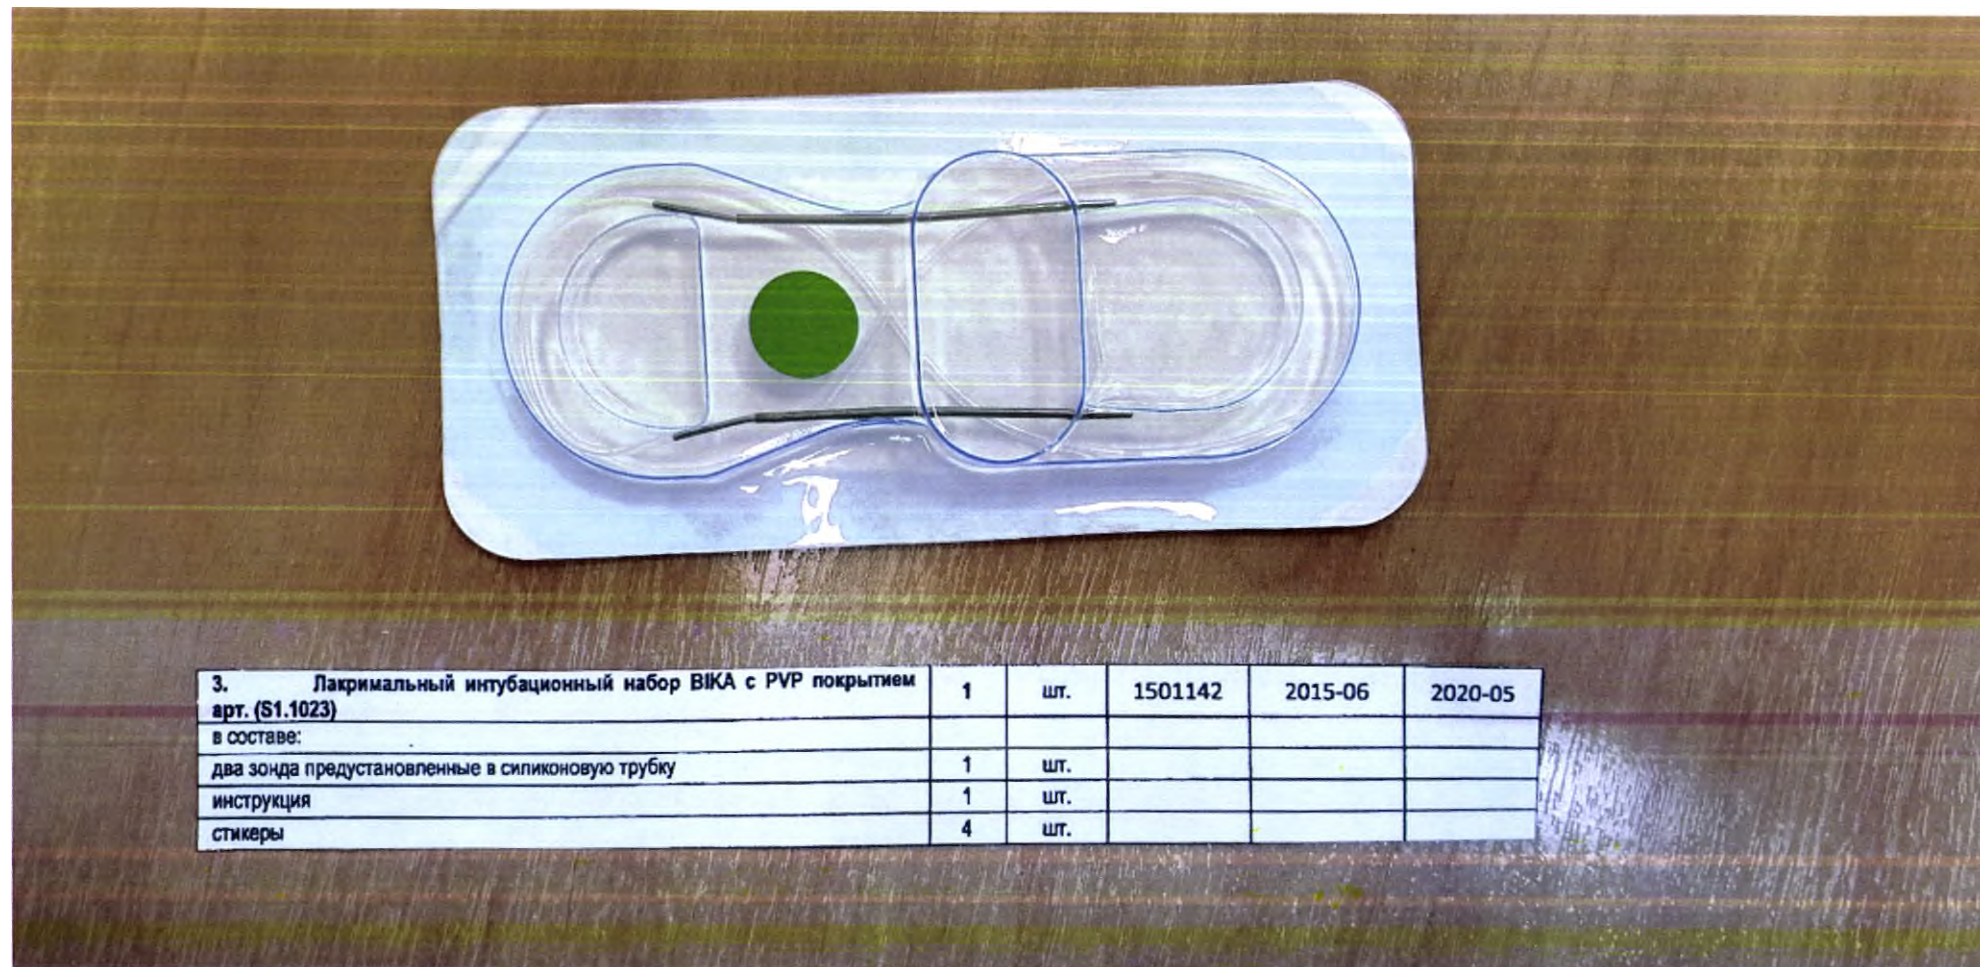


Рисунок 19 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1023

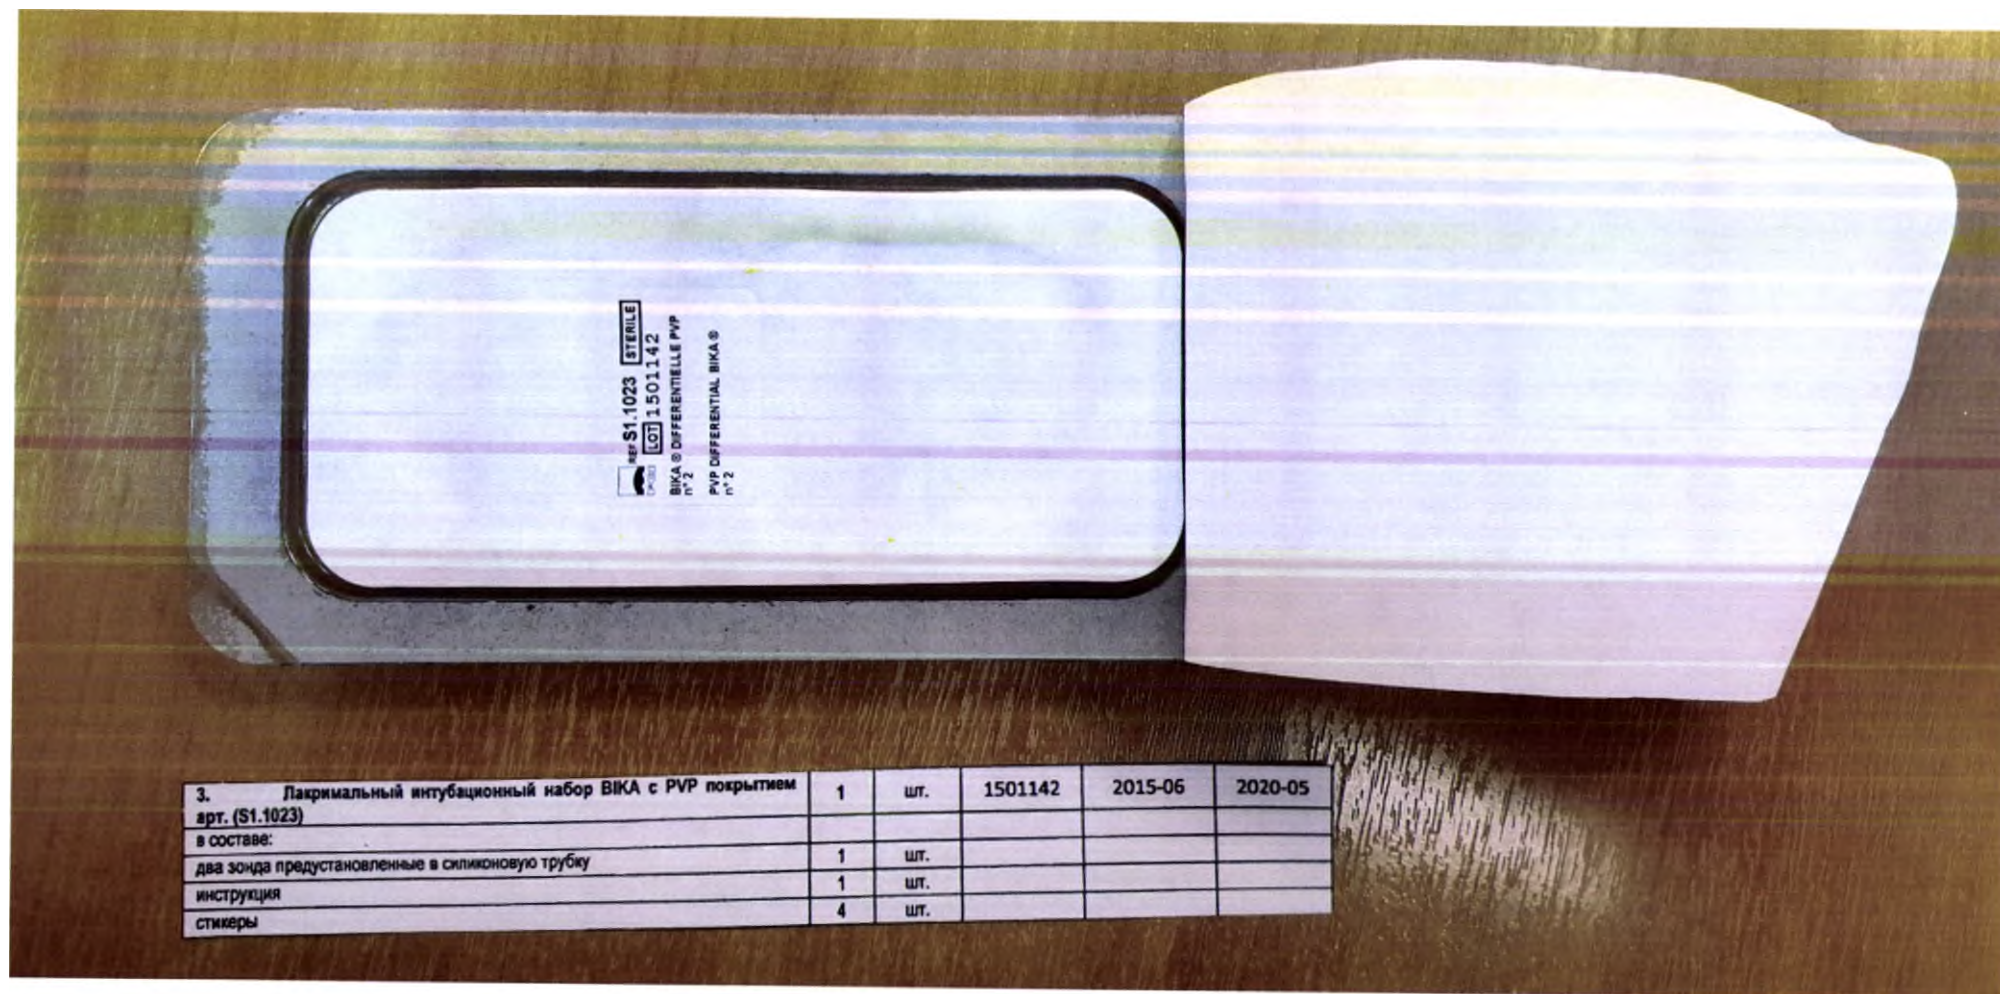


Рисунок 20 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1023

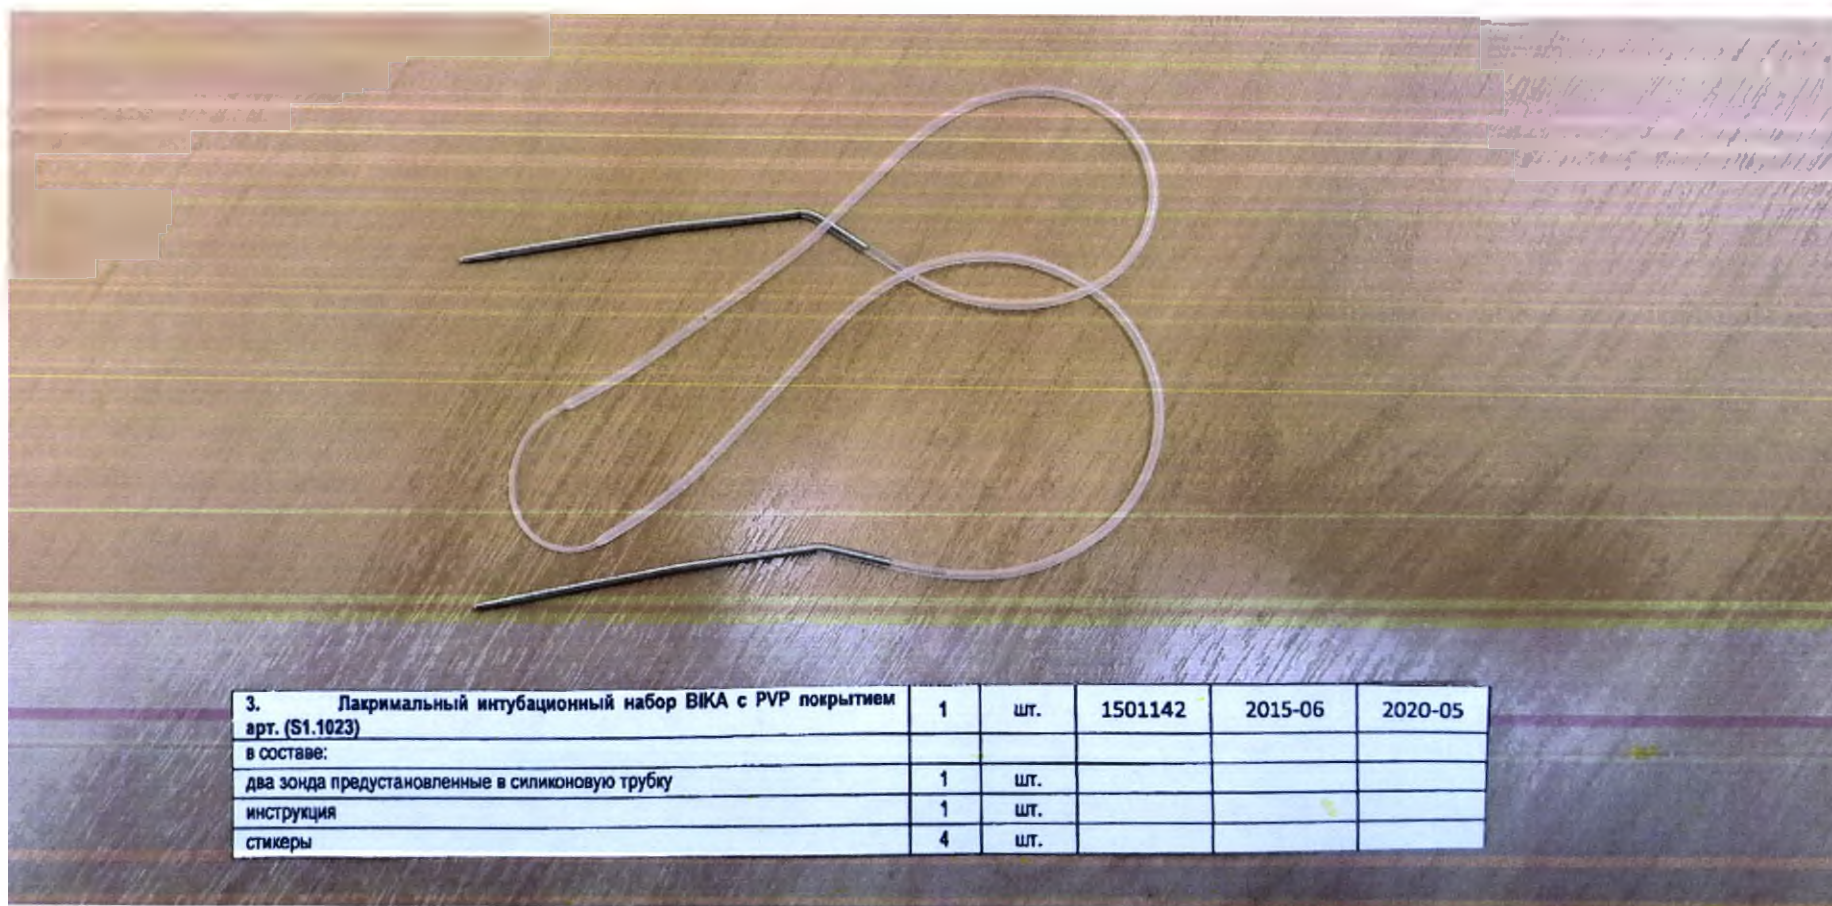


Рисунок 21 – Лакримальный интубационный набор ВІКА с PVP покрытием, арт. S1.1023



Рисунок 22 – Потребительская упаковка (вид спереди), арт. S1.1100

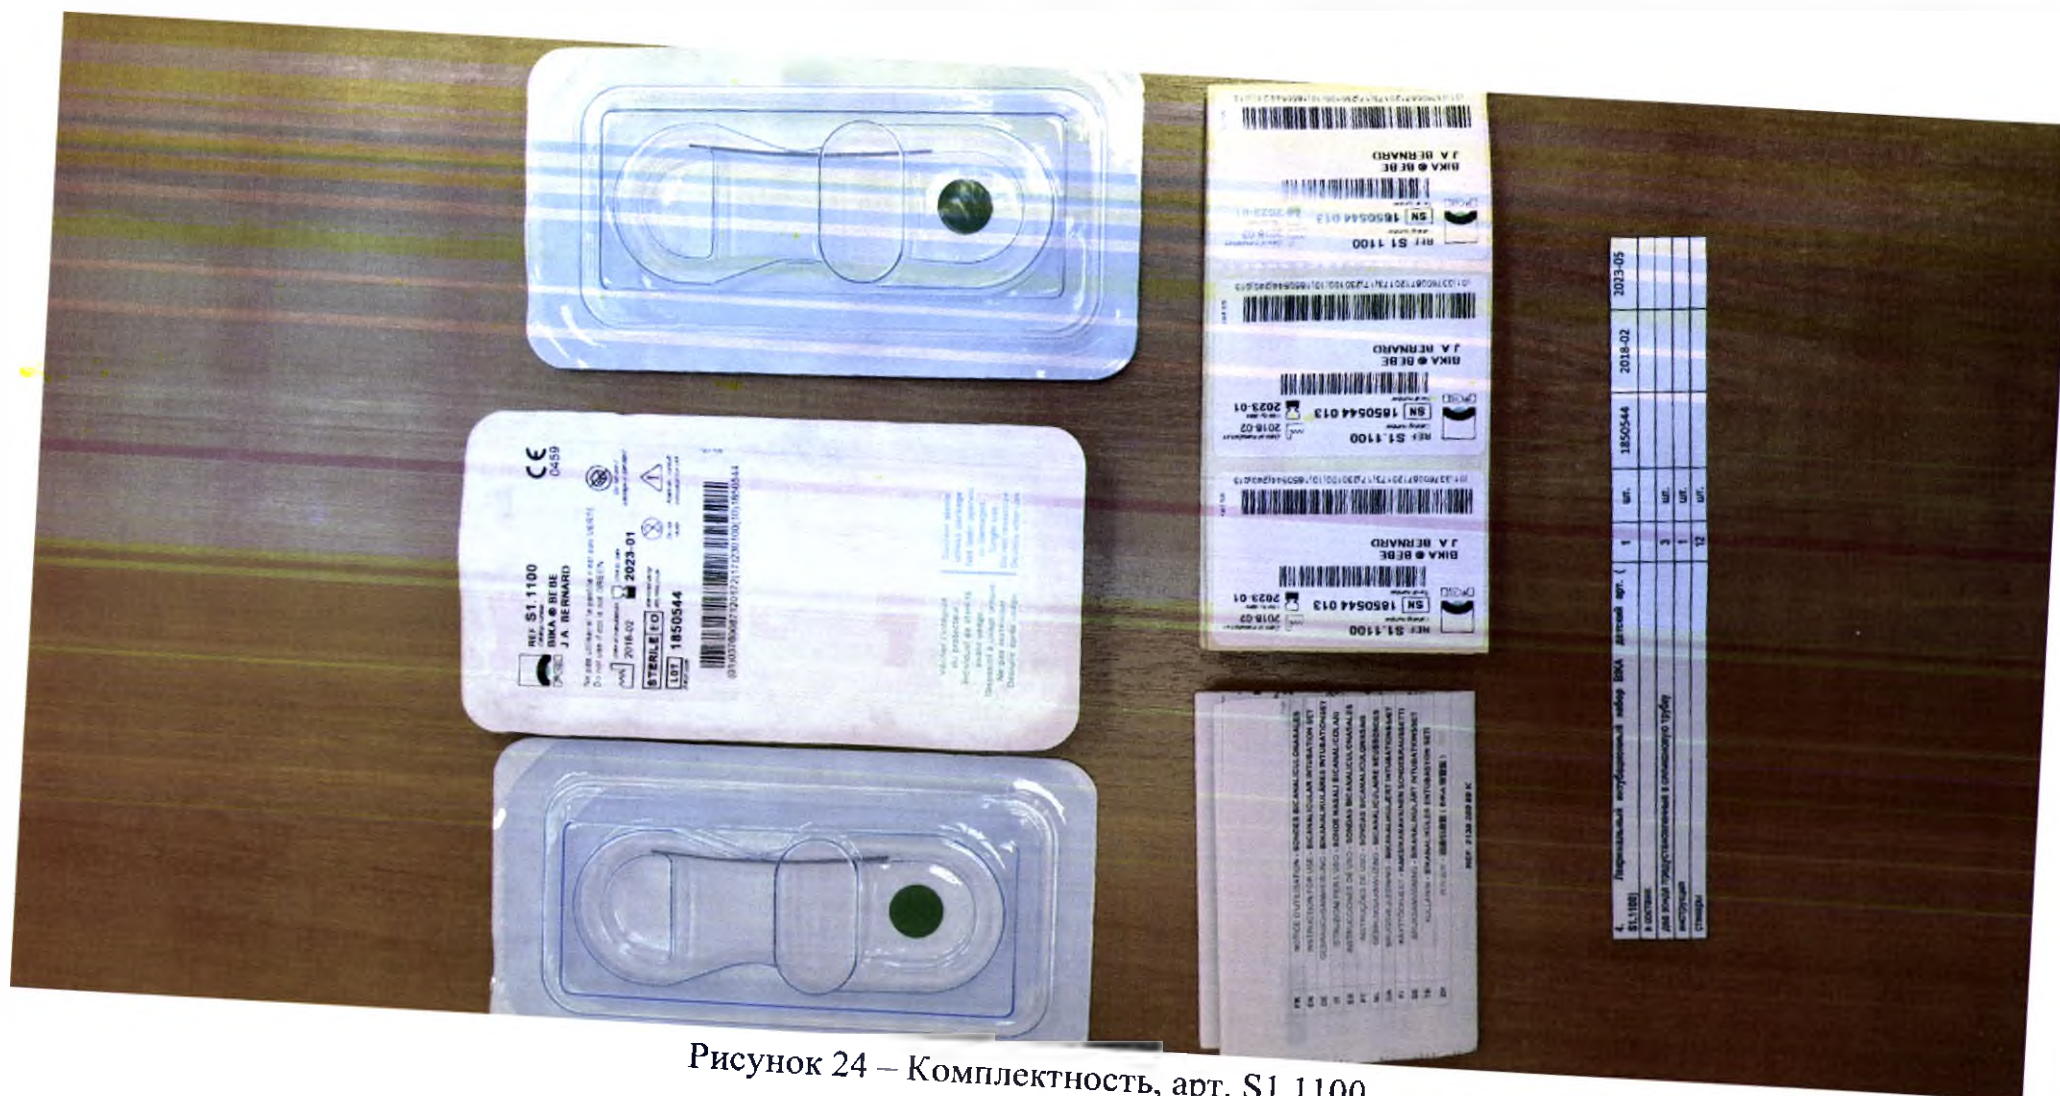


Рисунок 24 – Комплектность, арт. S1.1100

4. Лагримальный интубационный набор ВІКА детский арт. (S1.1100)	1	шт.	1850544	2018-02	2023-05
в составе:					
два зонда установленные в силиконовую трубку	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			

Рисунок 25 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) , арт. S1.1100



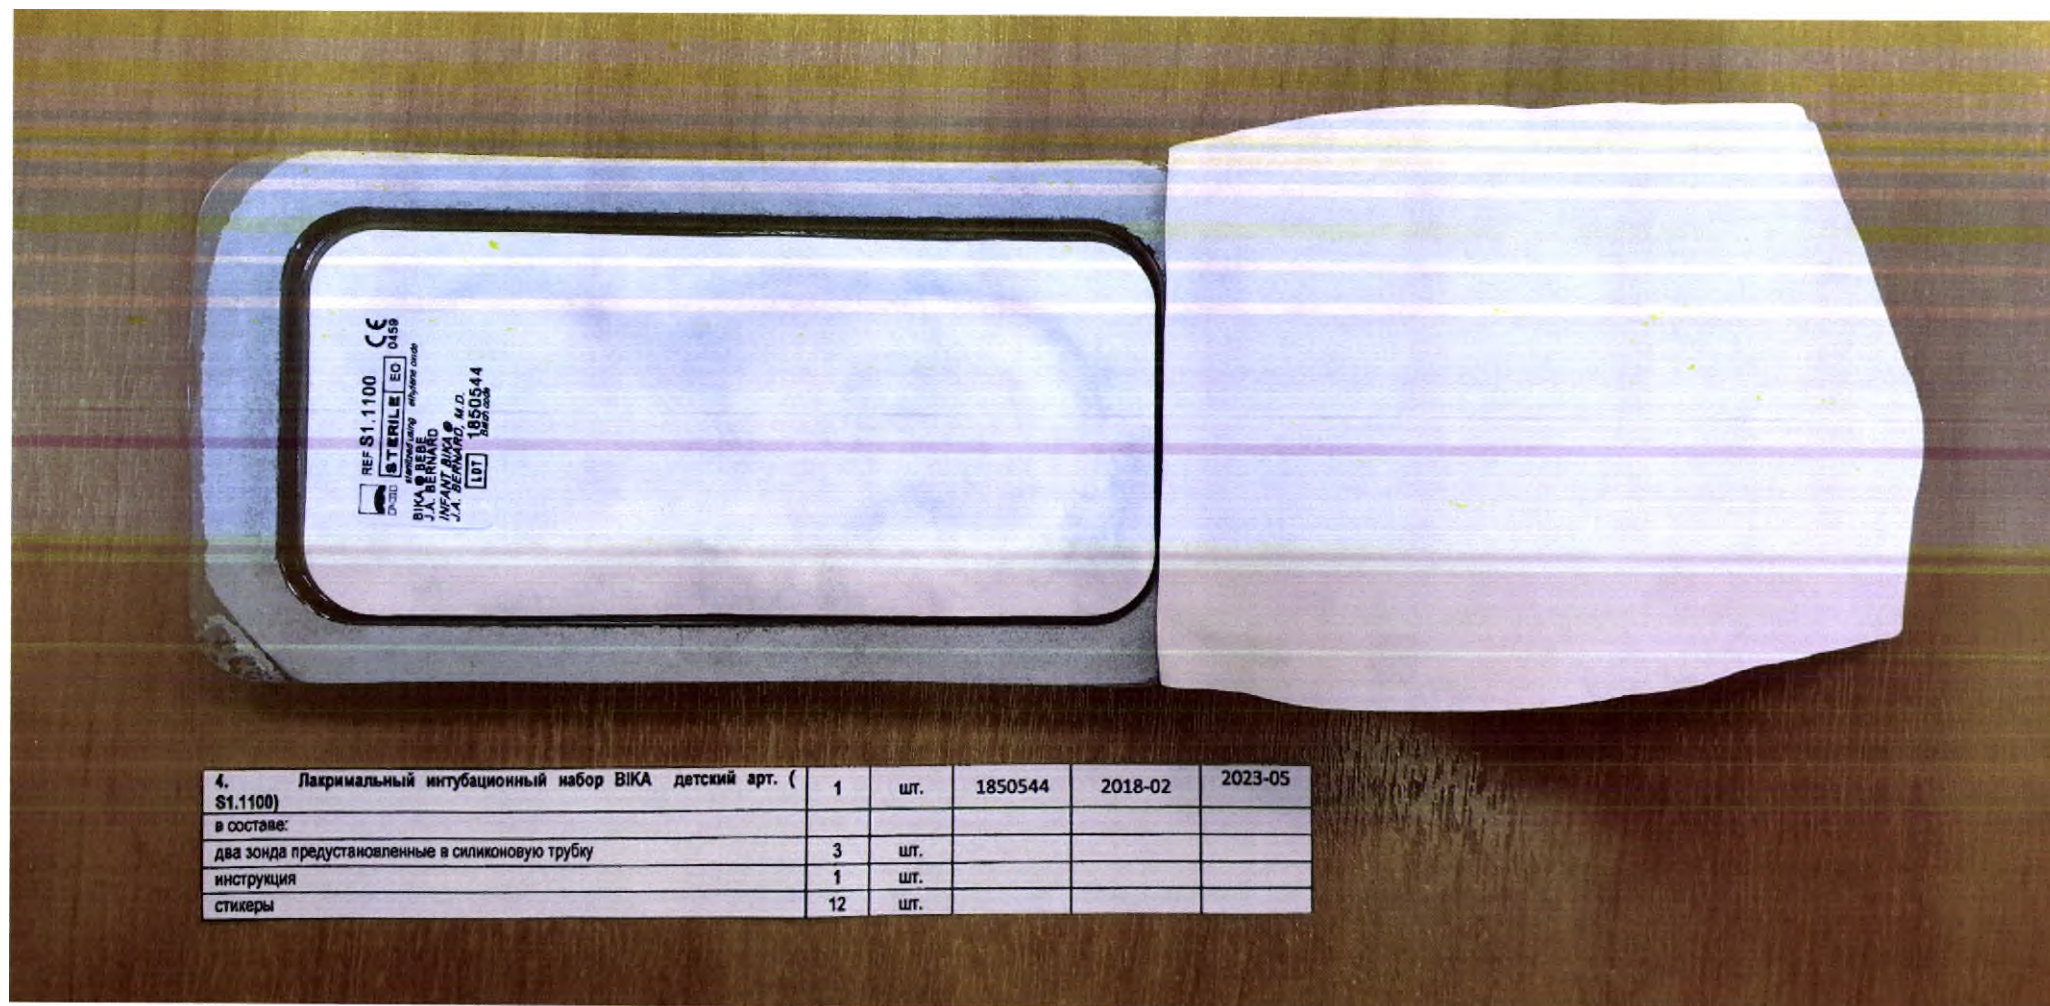


Рисунок 26 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) , арт. S1.1100

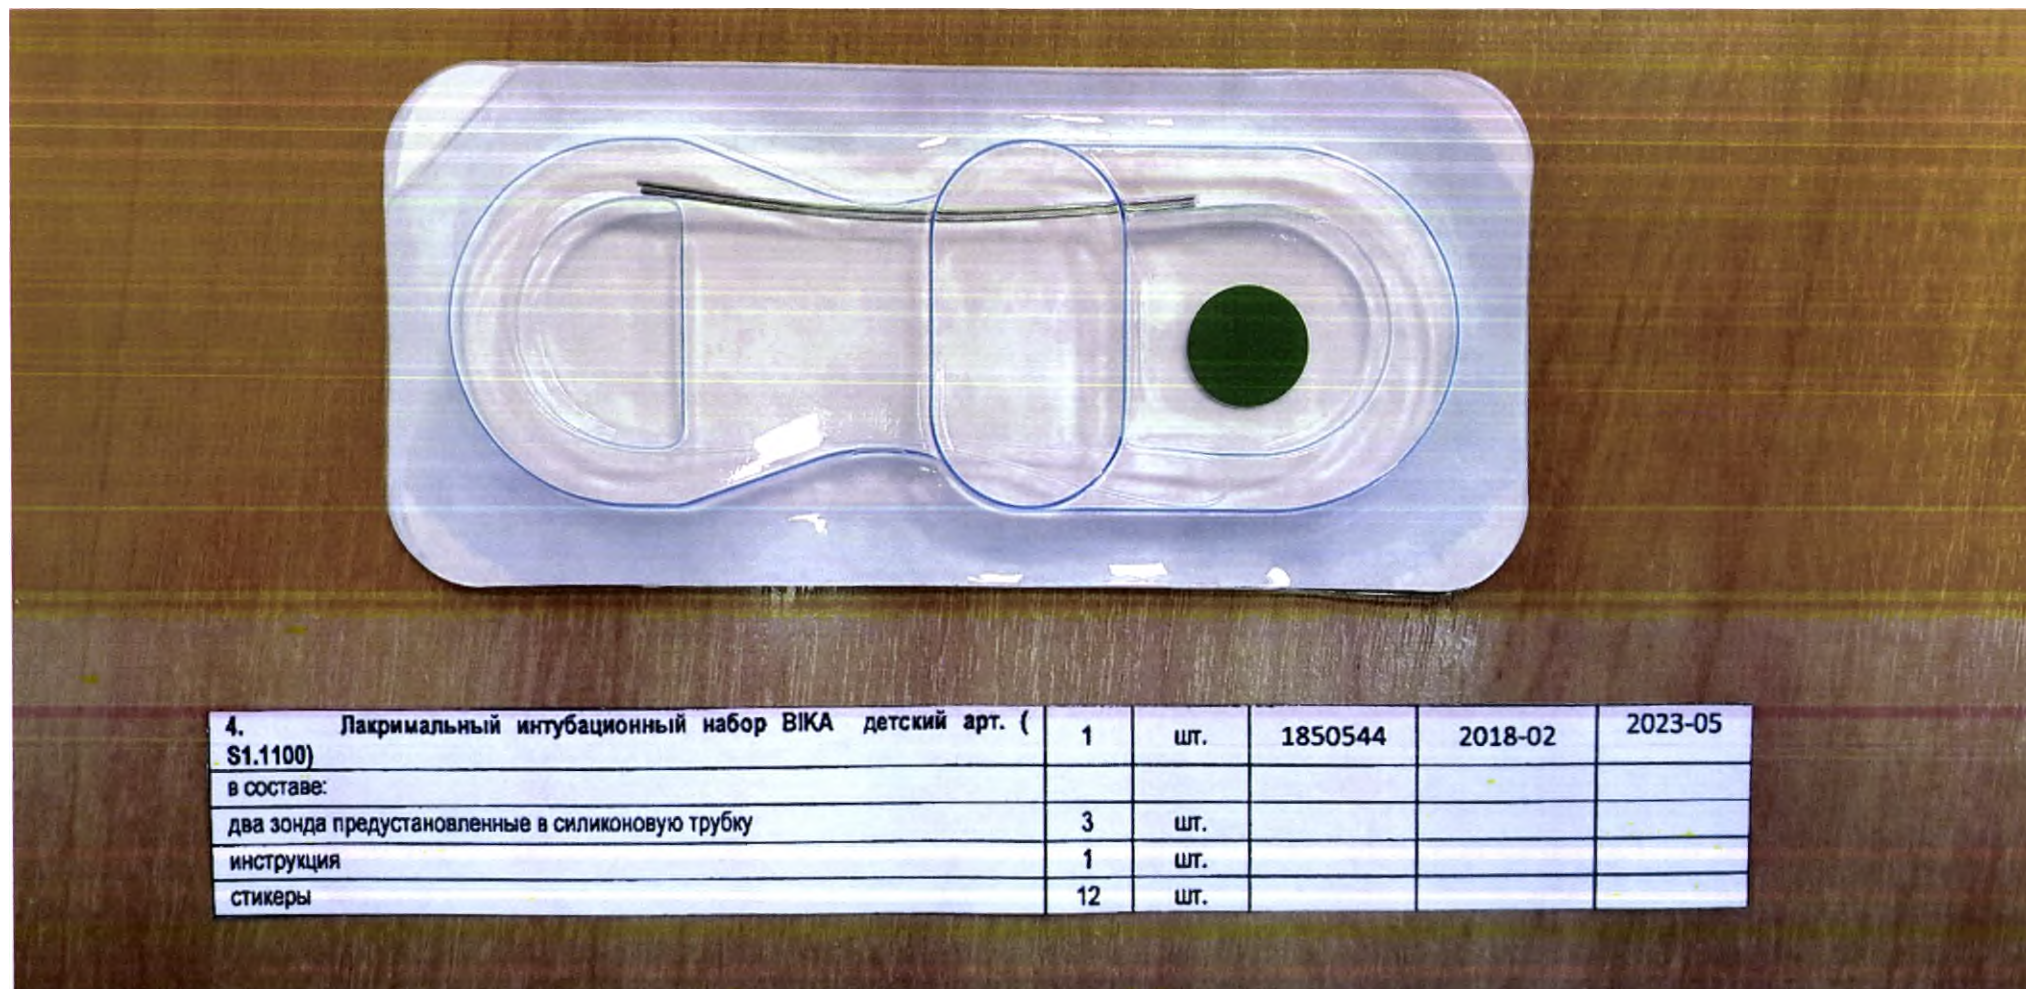


Рисунок 27 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) , арт. S1.1100

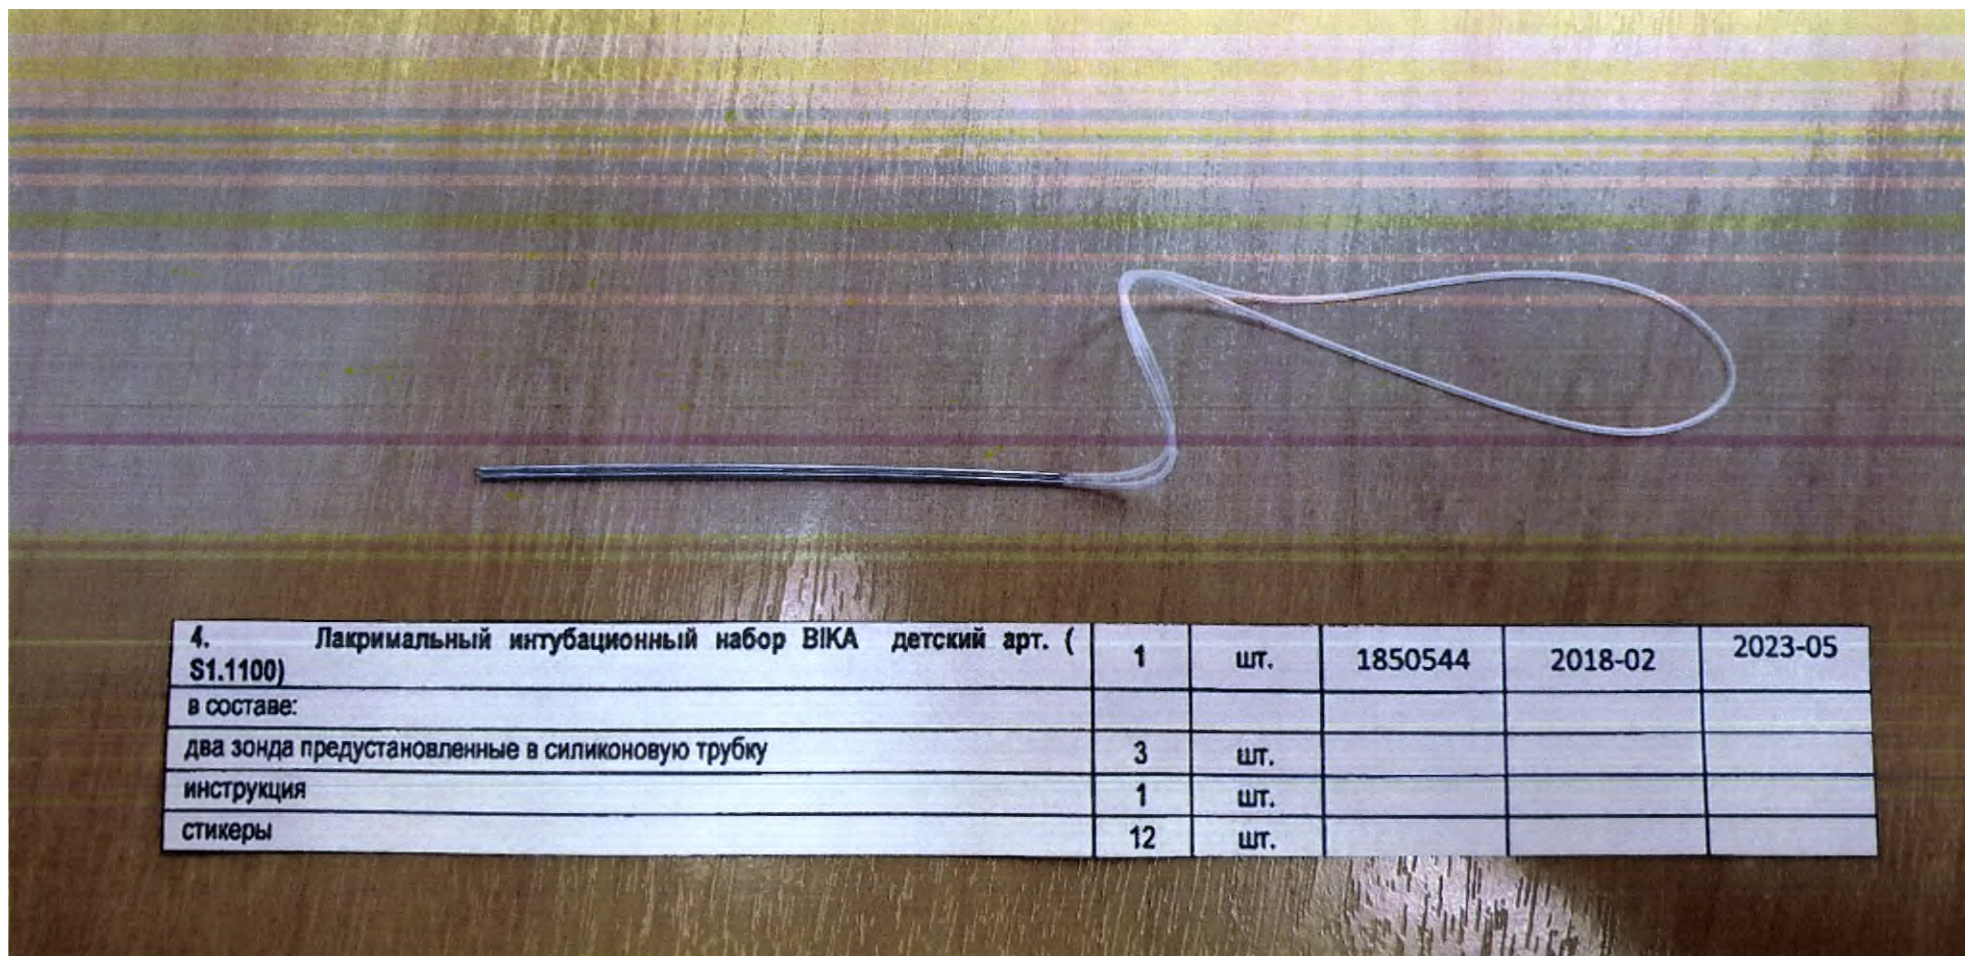


Рисунок 28 – Лакримальный интубационный набор ВІКА детский, арт. S1.1100

5.	Ларингальный интубационный набор ВКА арт. (S1.1281)	1	шт.	1701239	2017-06	2022-05
в составе:						
для зонда предназначенные в комплекте трубки		1	шт.			
инструкция		1	шт.			
стимулы		4	шт.			



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by :

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE : 800-932-4202




Рисунок 29 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1281



5.	Лагримальный интубационный набор ВІКА арт. (S1.1281)	1	шт.	1701239	2017-06	2022-05
	в составе:					
	два зонда предустановленные в силиконовую трубку	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	4	шт.			

Рисунок 30 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1281

Рисунок 31 – Комплектность арт. S1.1281

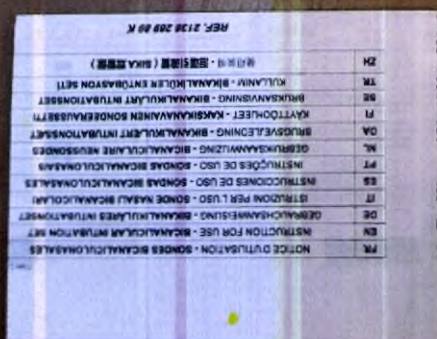

5. Дополнительный интубационный набор BIKA арт. (S1.1281)					
в составе:	1	шт.	1701239	2017-06	2022-05
для зонда, предназначенные в силиконовую трубку	1	шт.			
инструкция	1	шт.			
стерильный	4	шт.			

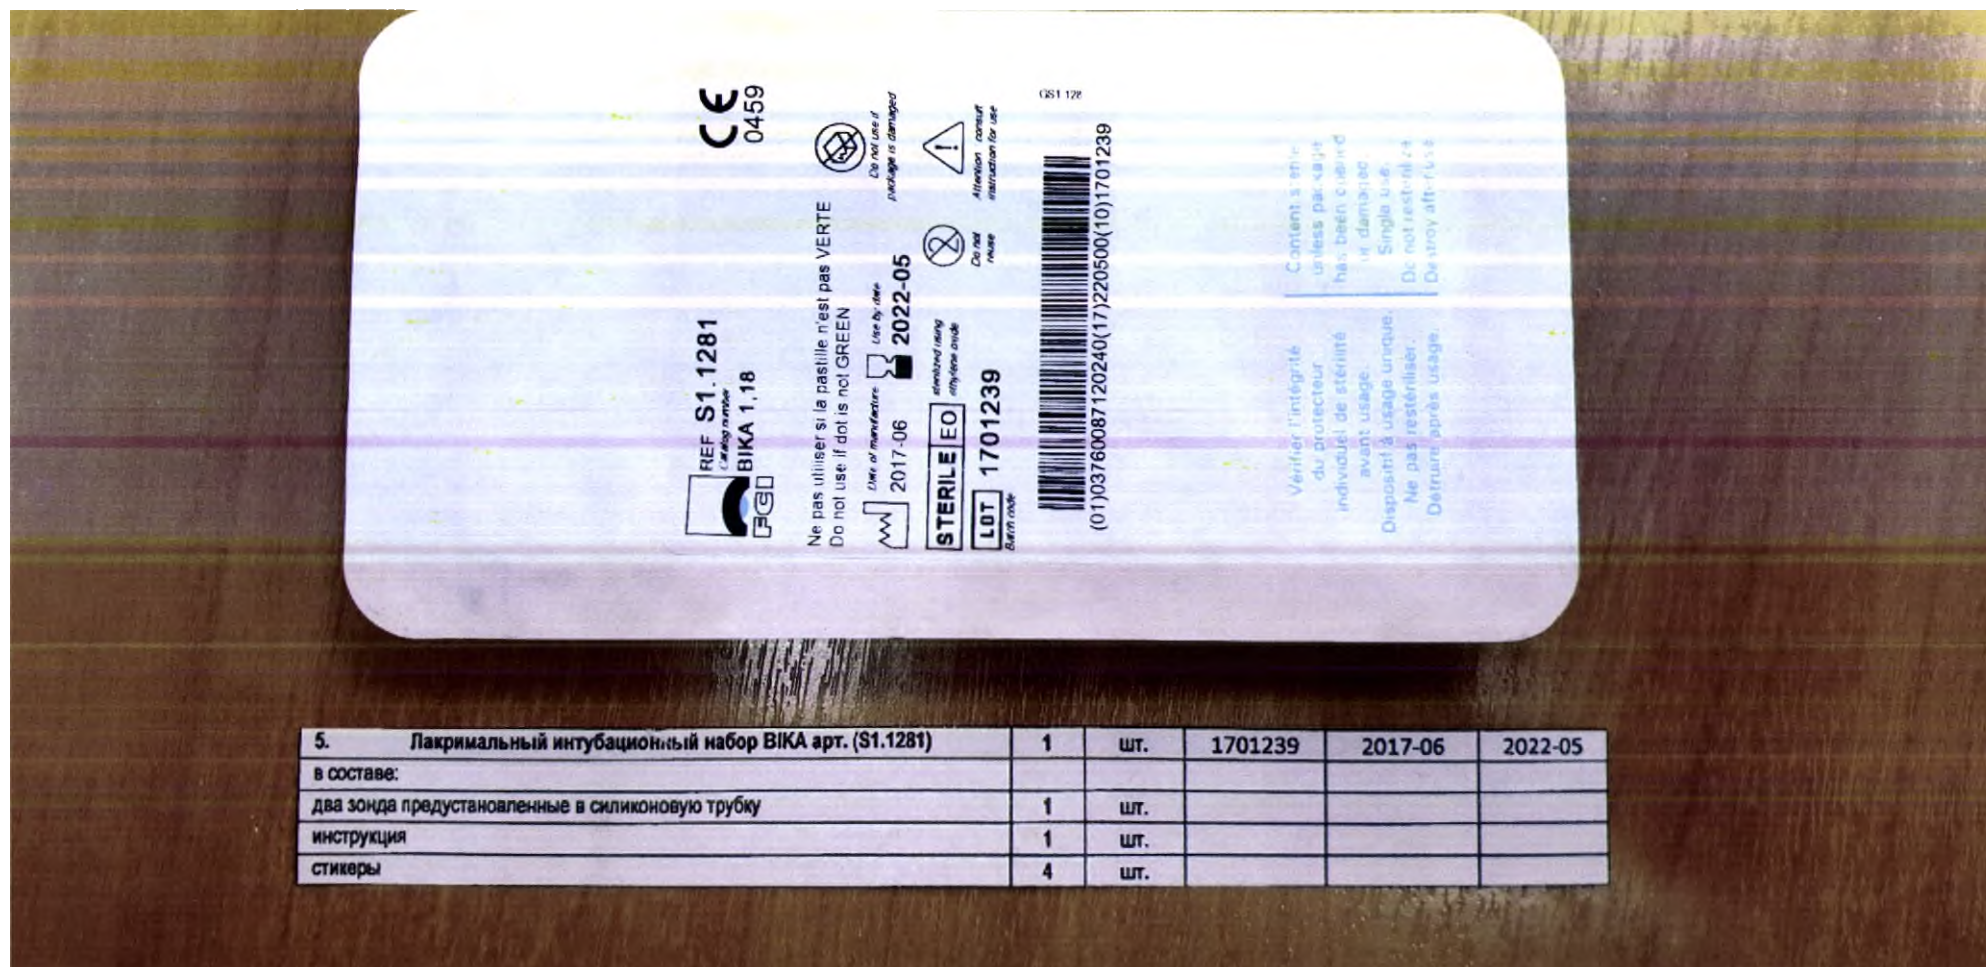


Рисунок 32 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1281

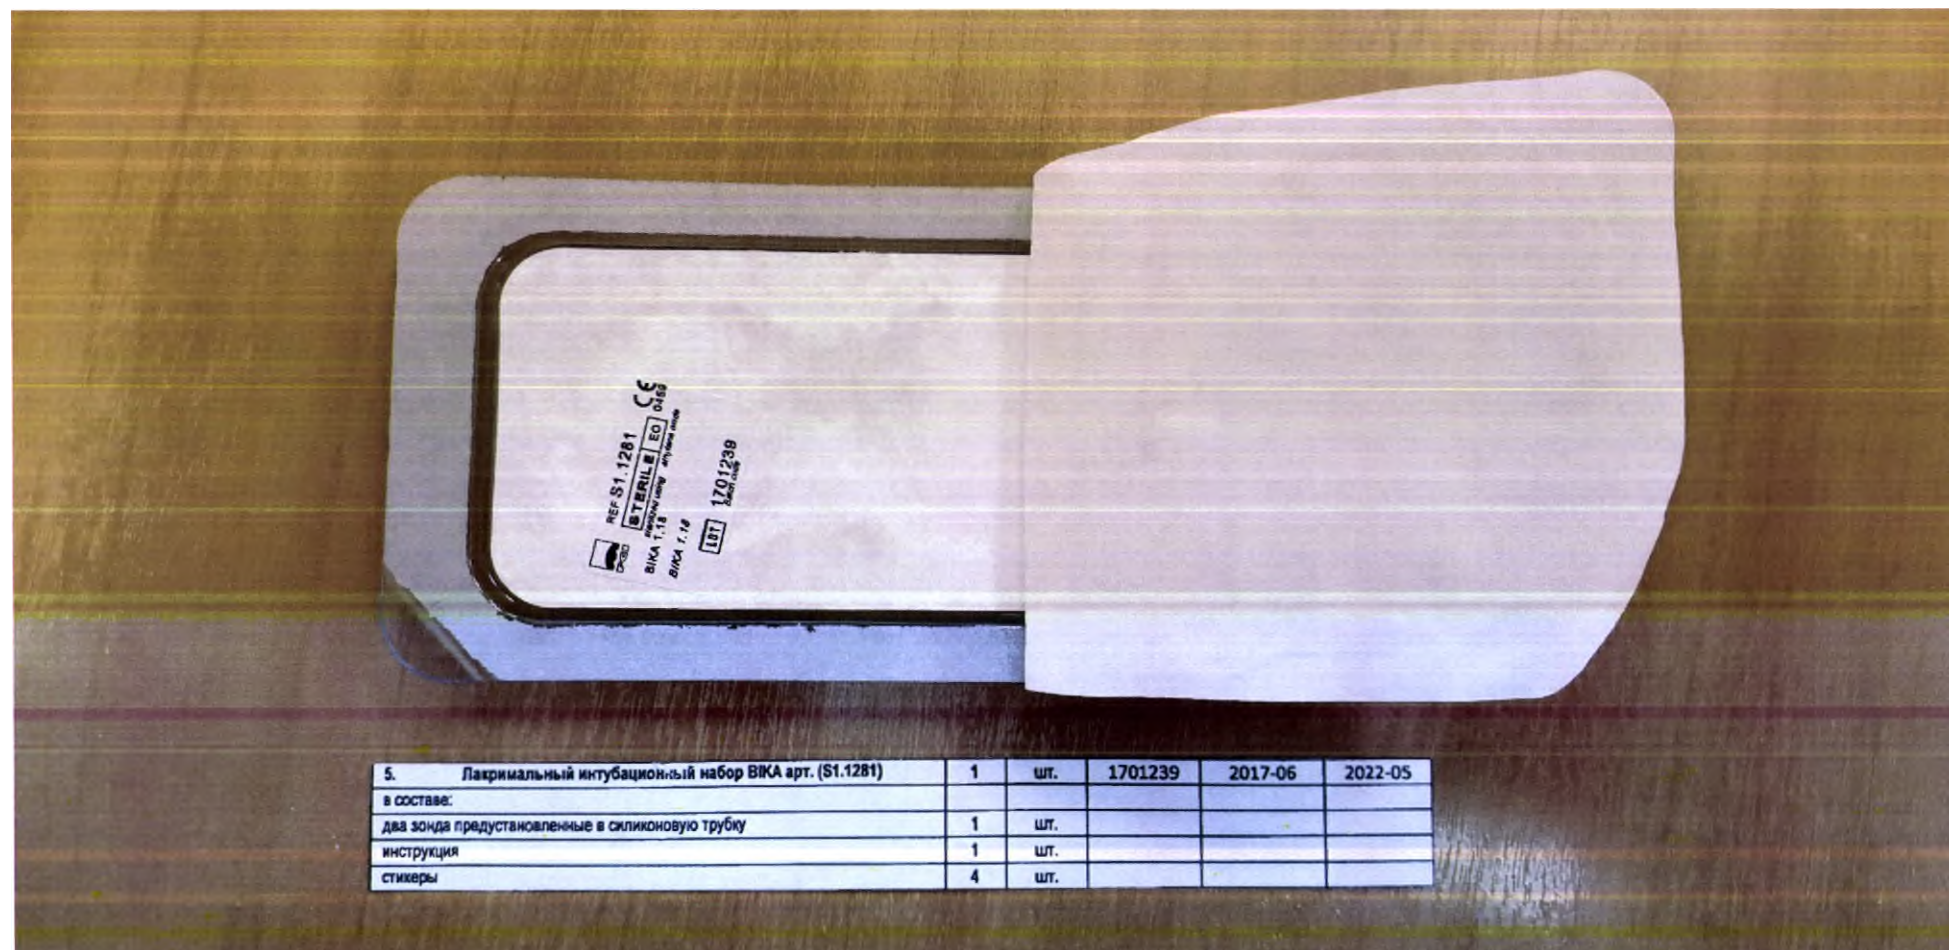


Рисунок 33 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1281

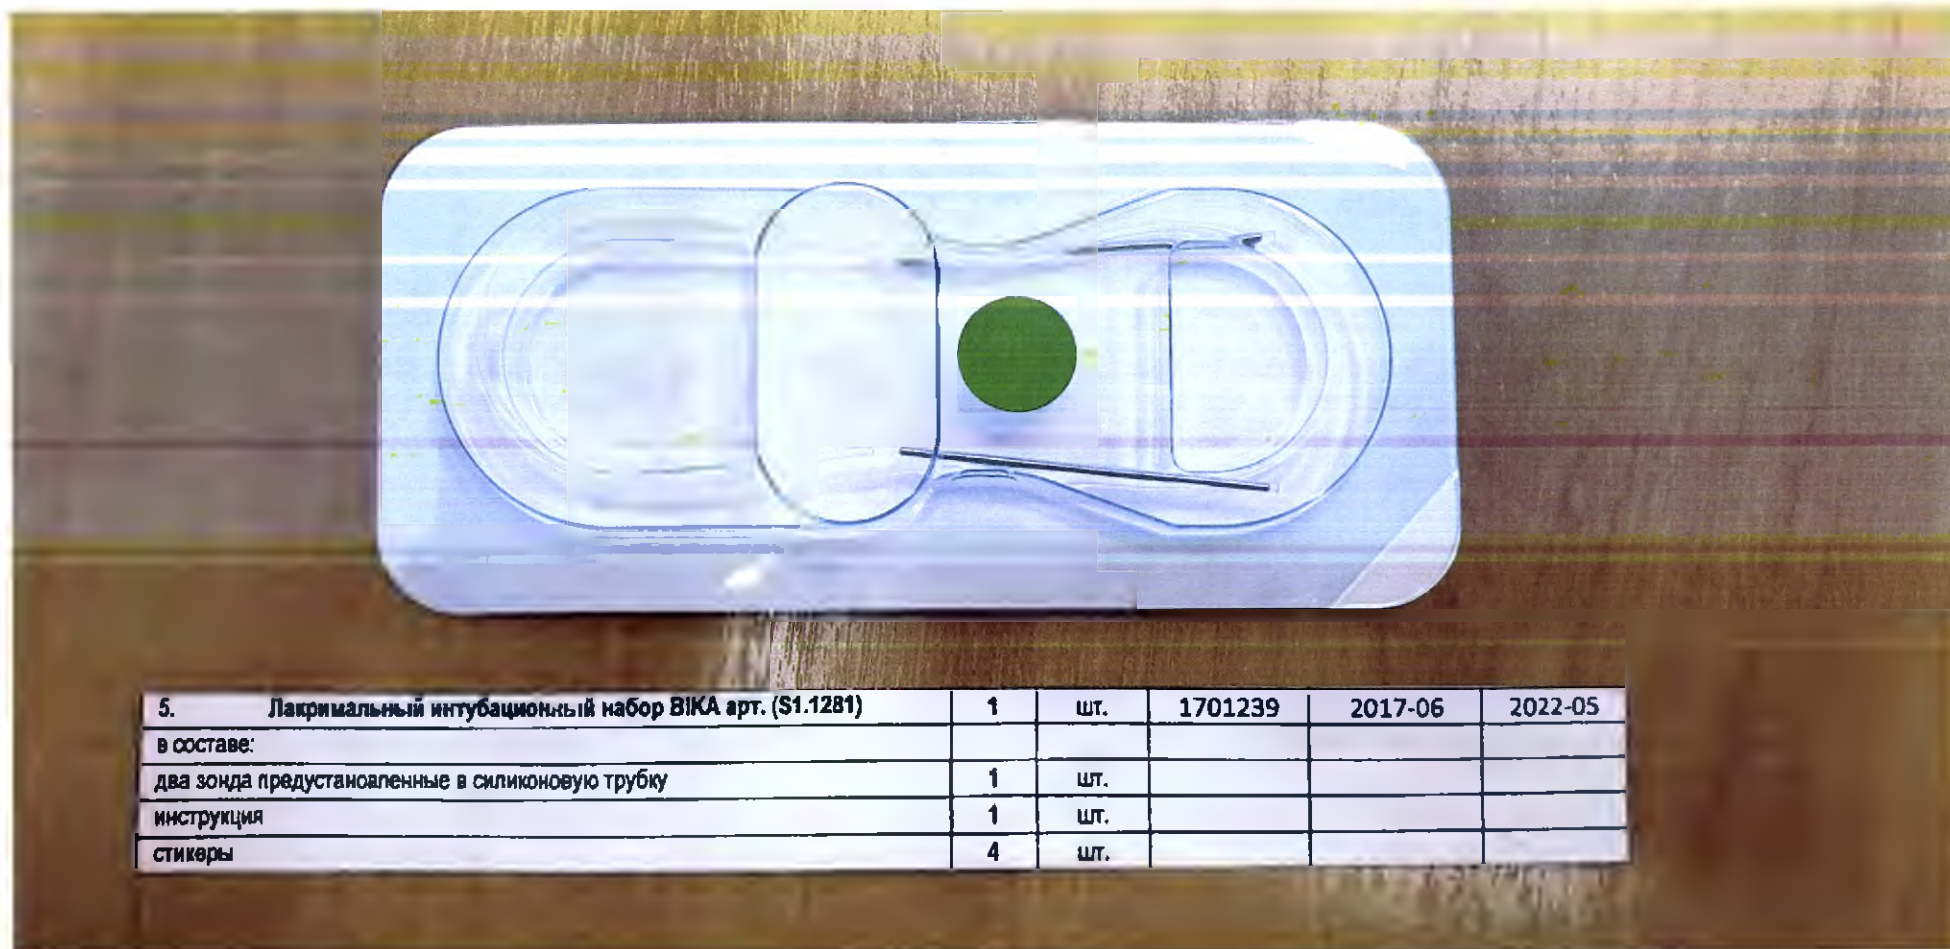


Рисунок 34 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1281

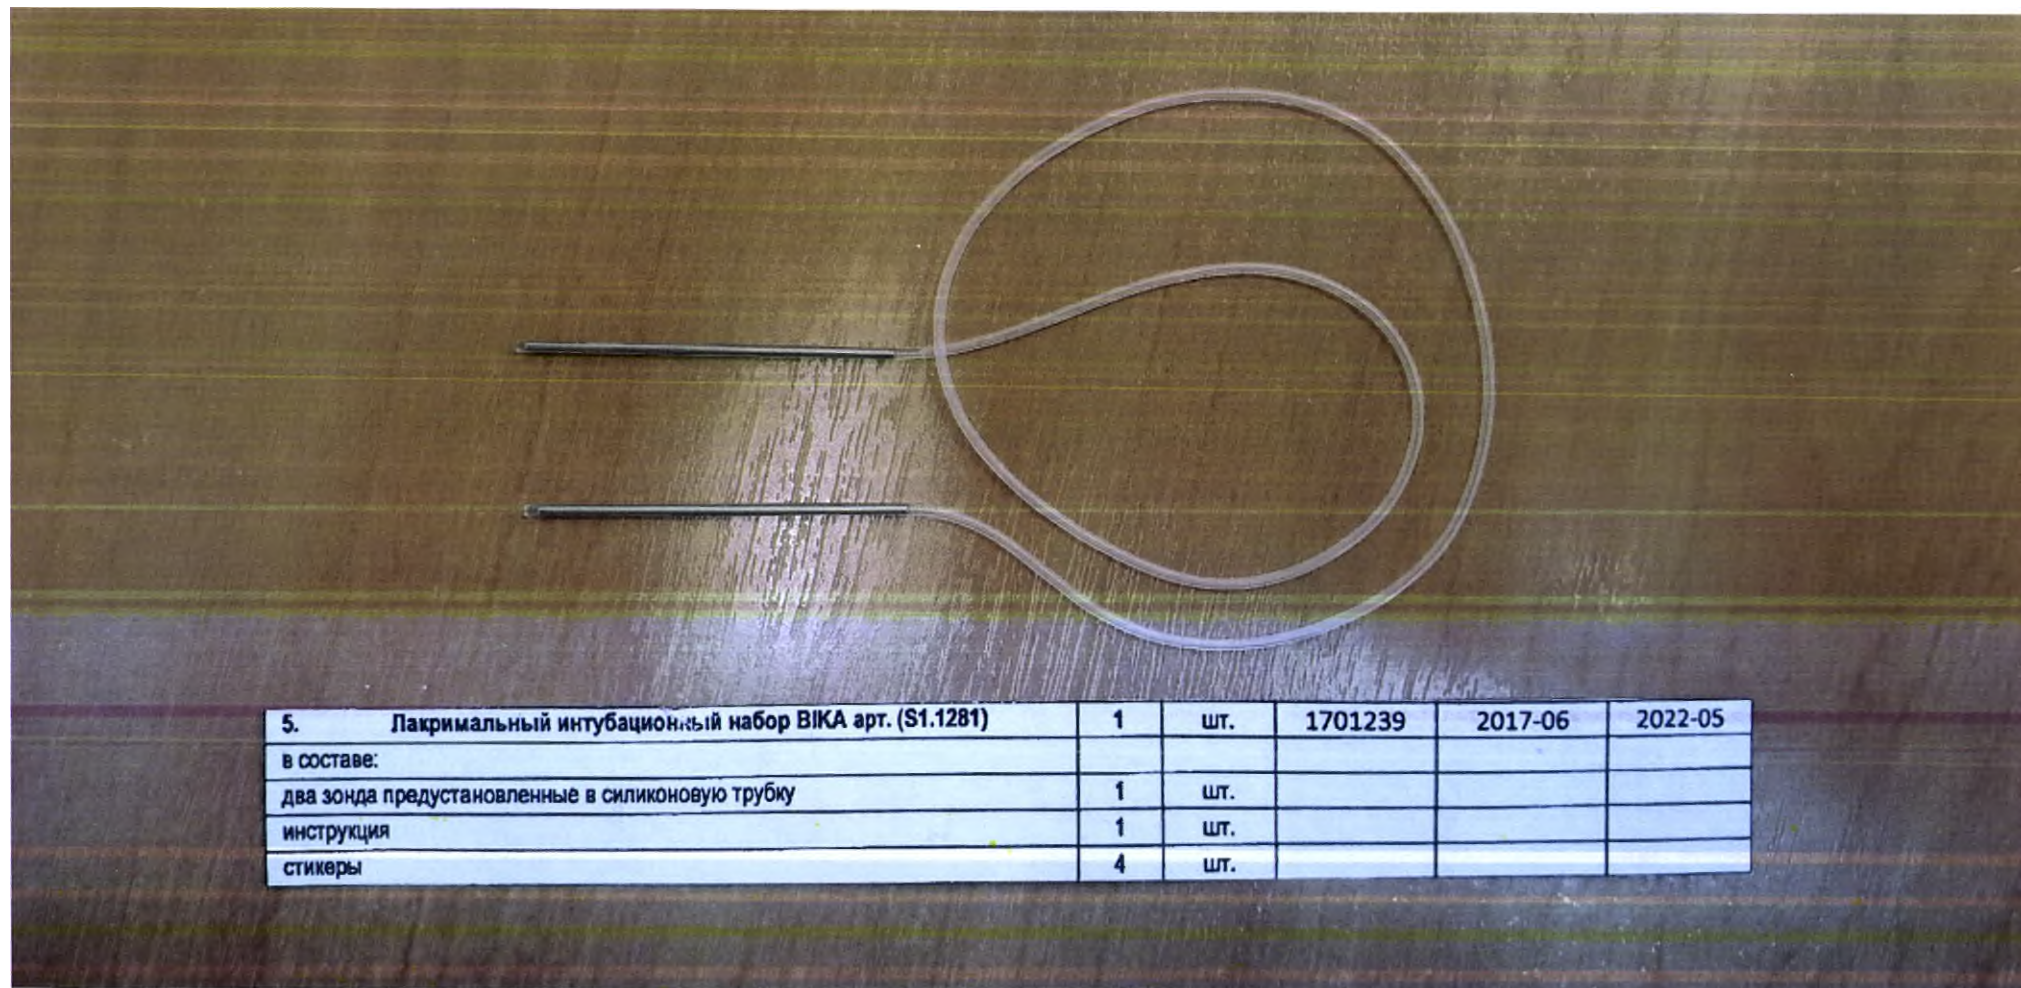


Рисунок 35 – Лакримальный интубационный набор ВІКА, арт. S1.1281



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE : 800-932-4202



6.	Паспортный инструкционный набор ВКА (арт. S1.1400)	1	шт.	1702378	2018-01	2022-12
	в состав:					
	два листа предустановленные в оптический трюбу	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	12	шт.			

Рисунок 36 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1400

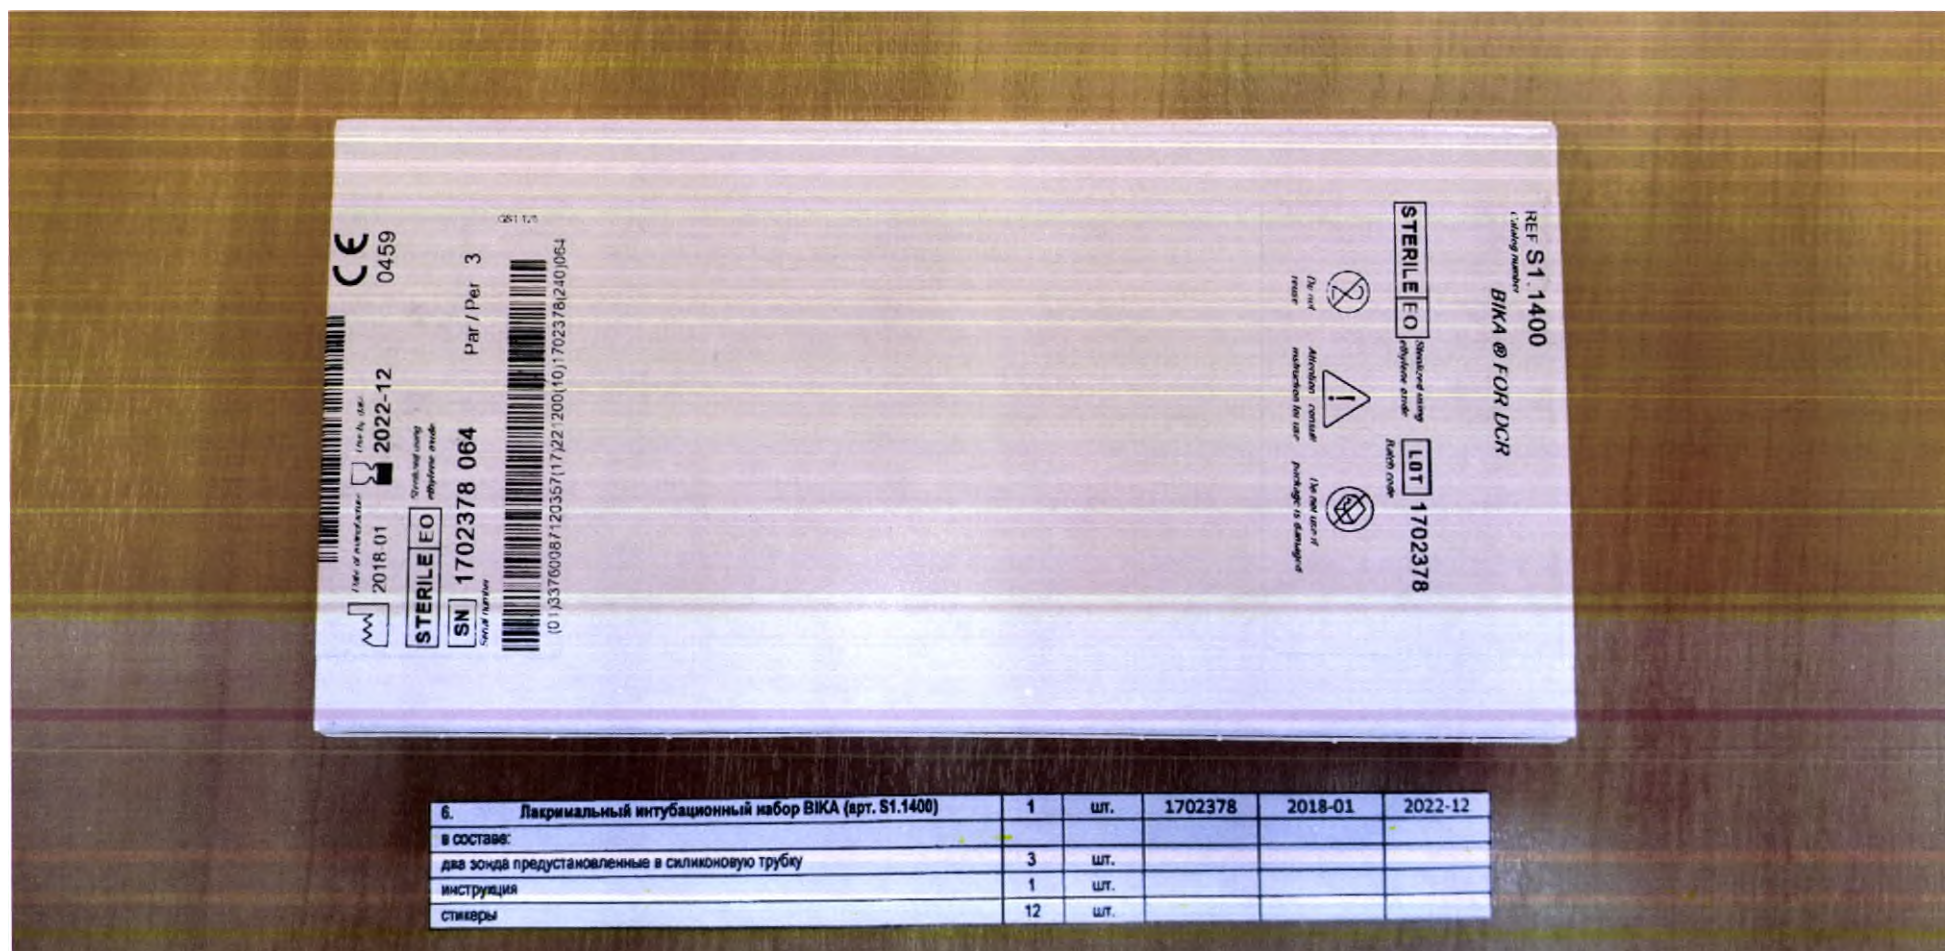


Рисунок 37 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1400



Рисунок 38 – Комплектность арт. S1.1400

6.	Лагримальный интубационный набор ВКА (арт. S1.1400)	1	шт.	1702378	2018-01	2022-12
	в составе:					
	два зонда предустановленные в силиконовую трубку	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	12	шт.			

Рисунок 39 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1400



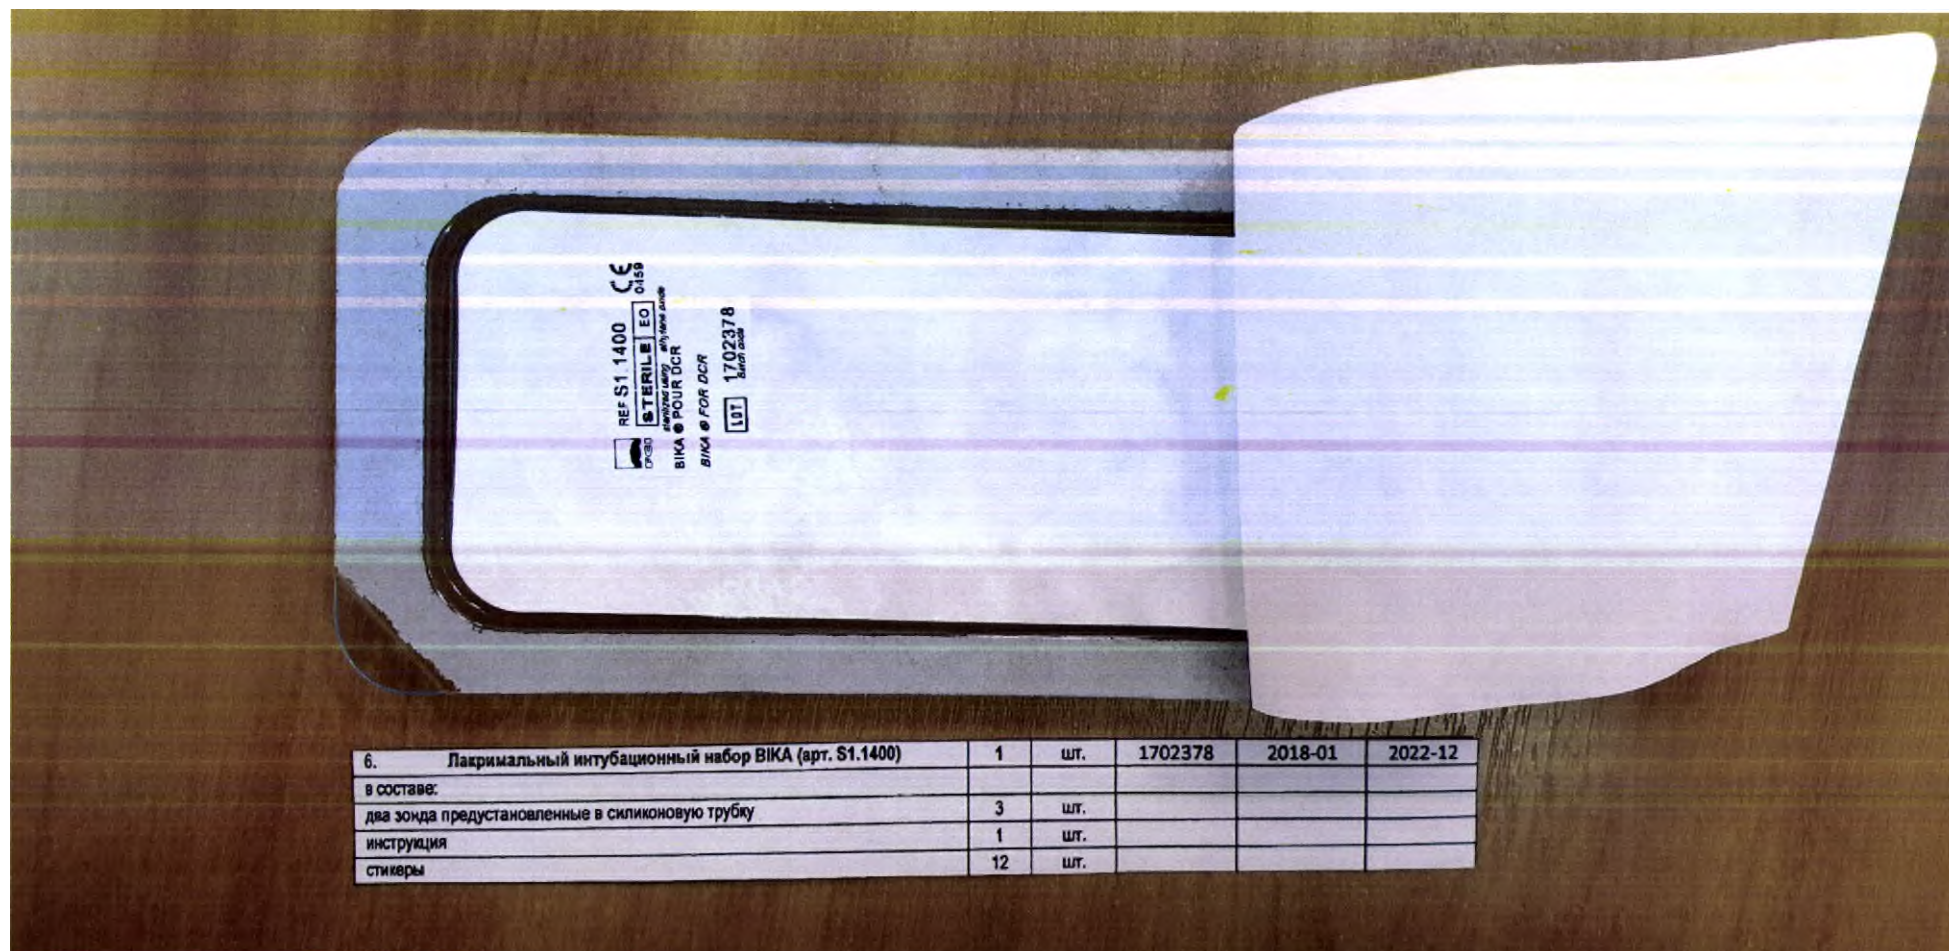


Рисунок 40 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1400

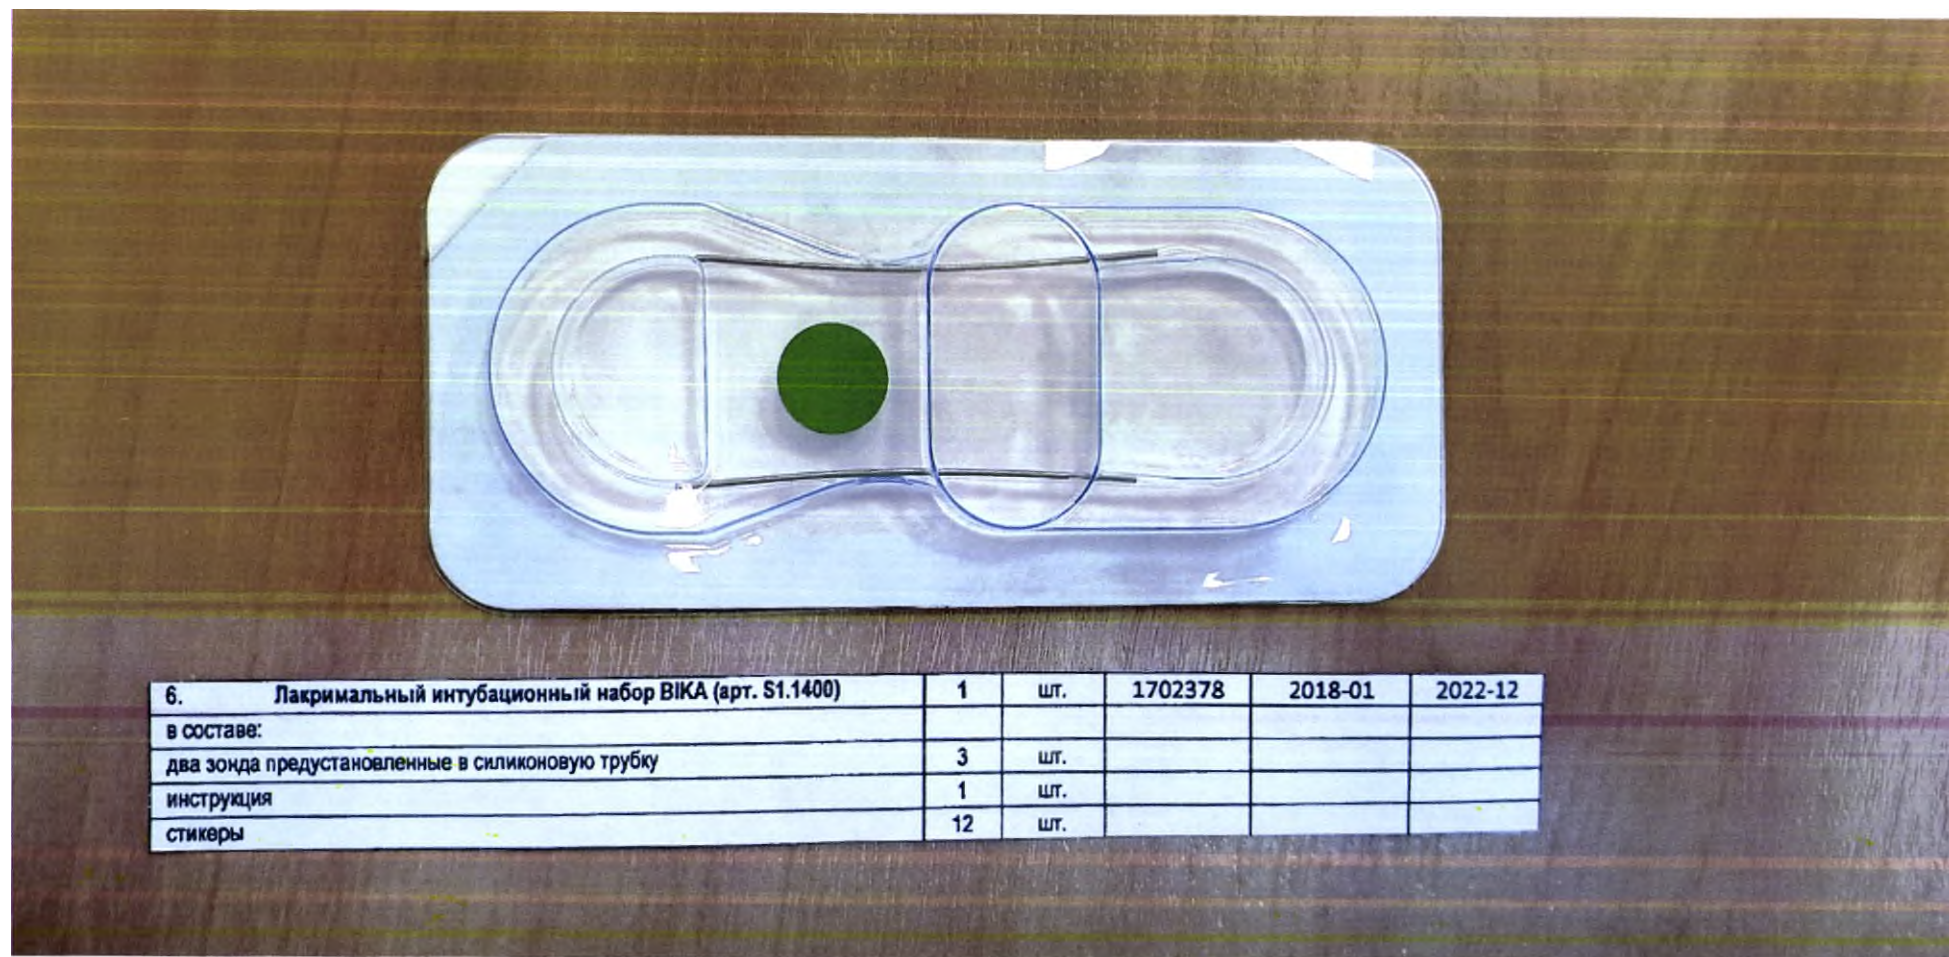


Рисунок 41 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1400

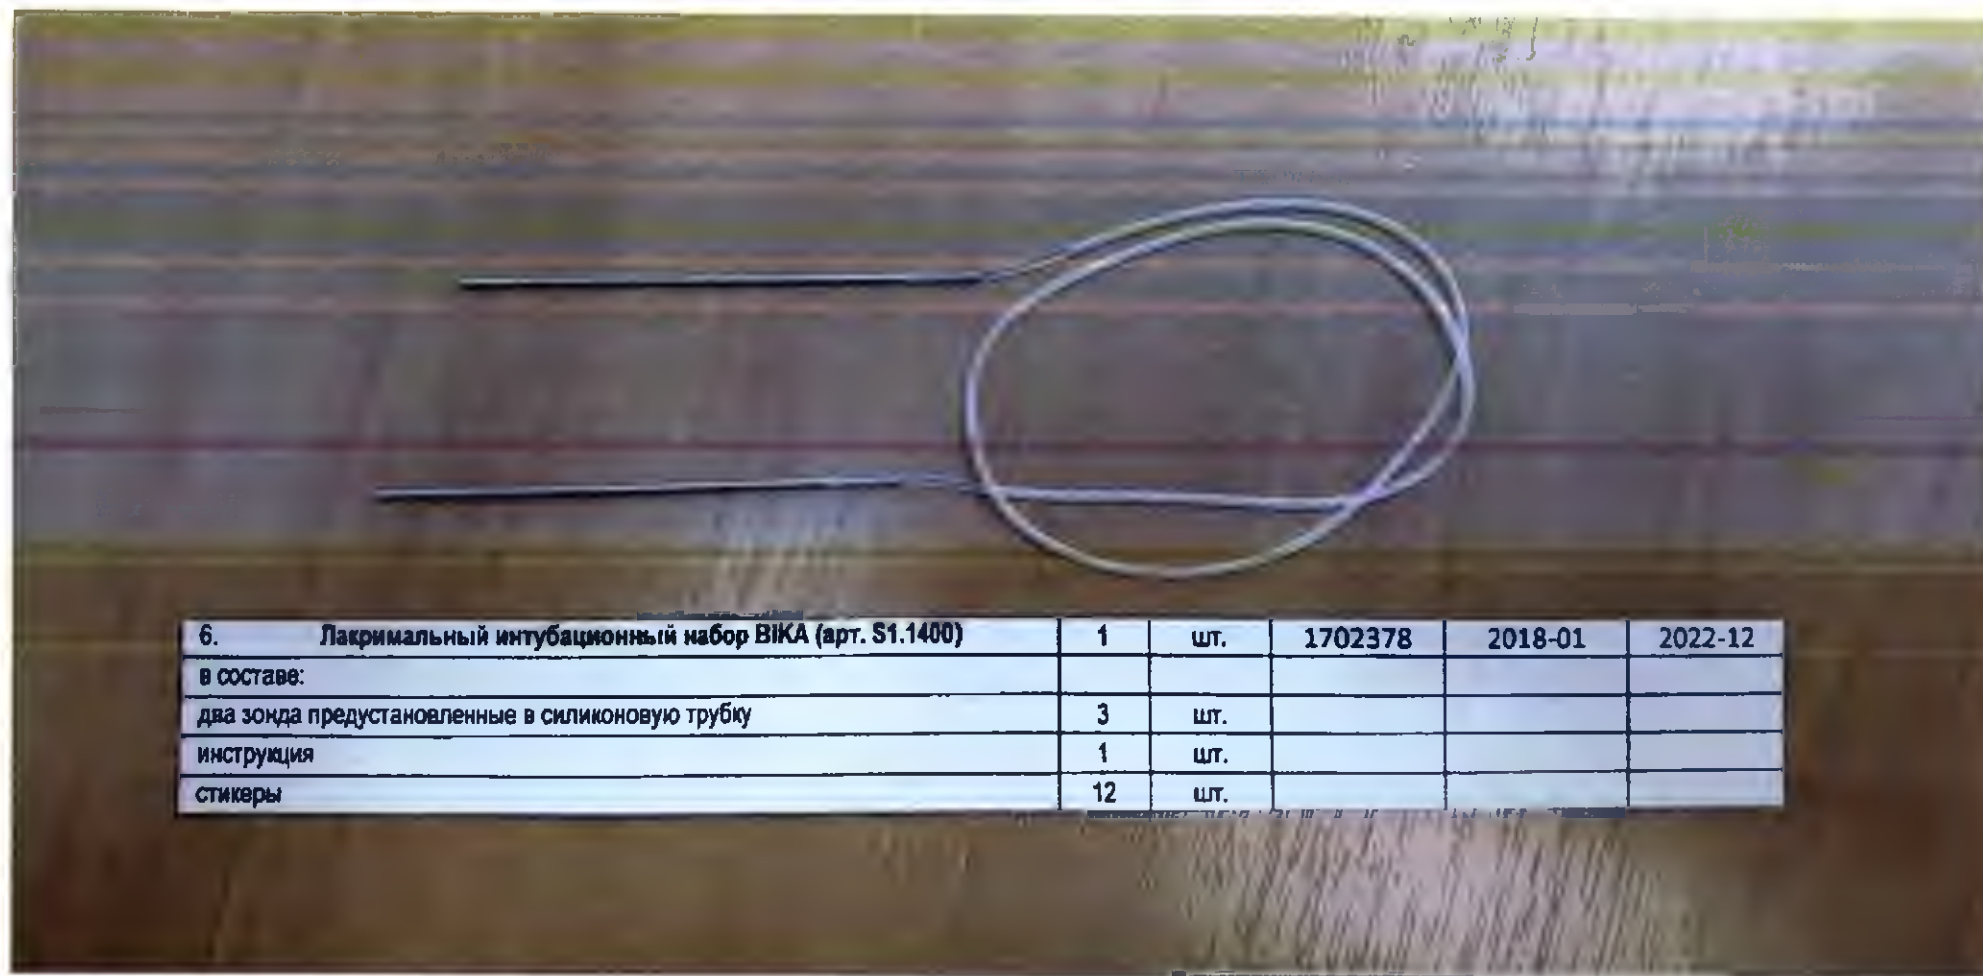


Рисунок 42 – Лакримальный интубационный набор ВІКА, арт. S1.1400




FCI S.A.S.
 20-22, rue Louis Armand
 75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
 30 Corporate Park Drive
 Suite # 310/320
 Pembroke, MA 02359
 PHONE: 800-932-4202



7.	Лазерный инфракрасный набор ВКА в летней (арт. S1.1300)	1	шт.	1850357	2018-02	2023-01
	в составе:					
	для зонта предустановленные в оптический трубу	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	список	12	шт.			

Рисунок 43 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1300



7.	Парциальный интубационный набор ВІКА ІІ детский (арт. S1.1300)	1 шт.	1850357	2018-02	2023-01
	в составе:	3 шт.			
	два зонда предназначенные в силиконовую трубку	1 шт.			
	инструкция	12 шт.			
	стериль				

Рисунок 44 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1300



Рисунок 45 – Комплектность арт. S1.1300

7. Лагримальный интубационный набор ВКА II детский (арт. S1.1300)	1	шт.	1850357	2018-02	2023-01
в составе:					
два зонда предустановленные в силиконовую трубку	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			



Рисунок 46 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1300

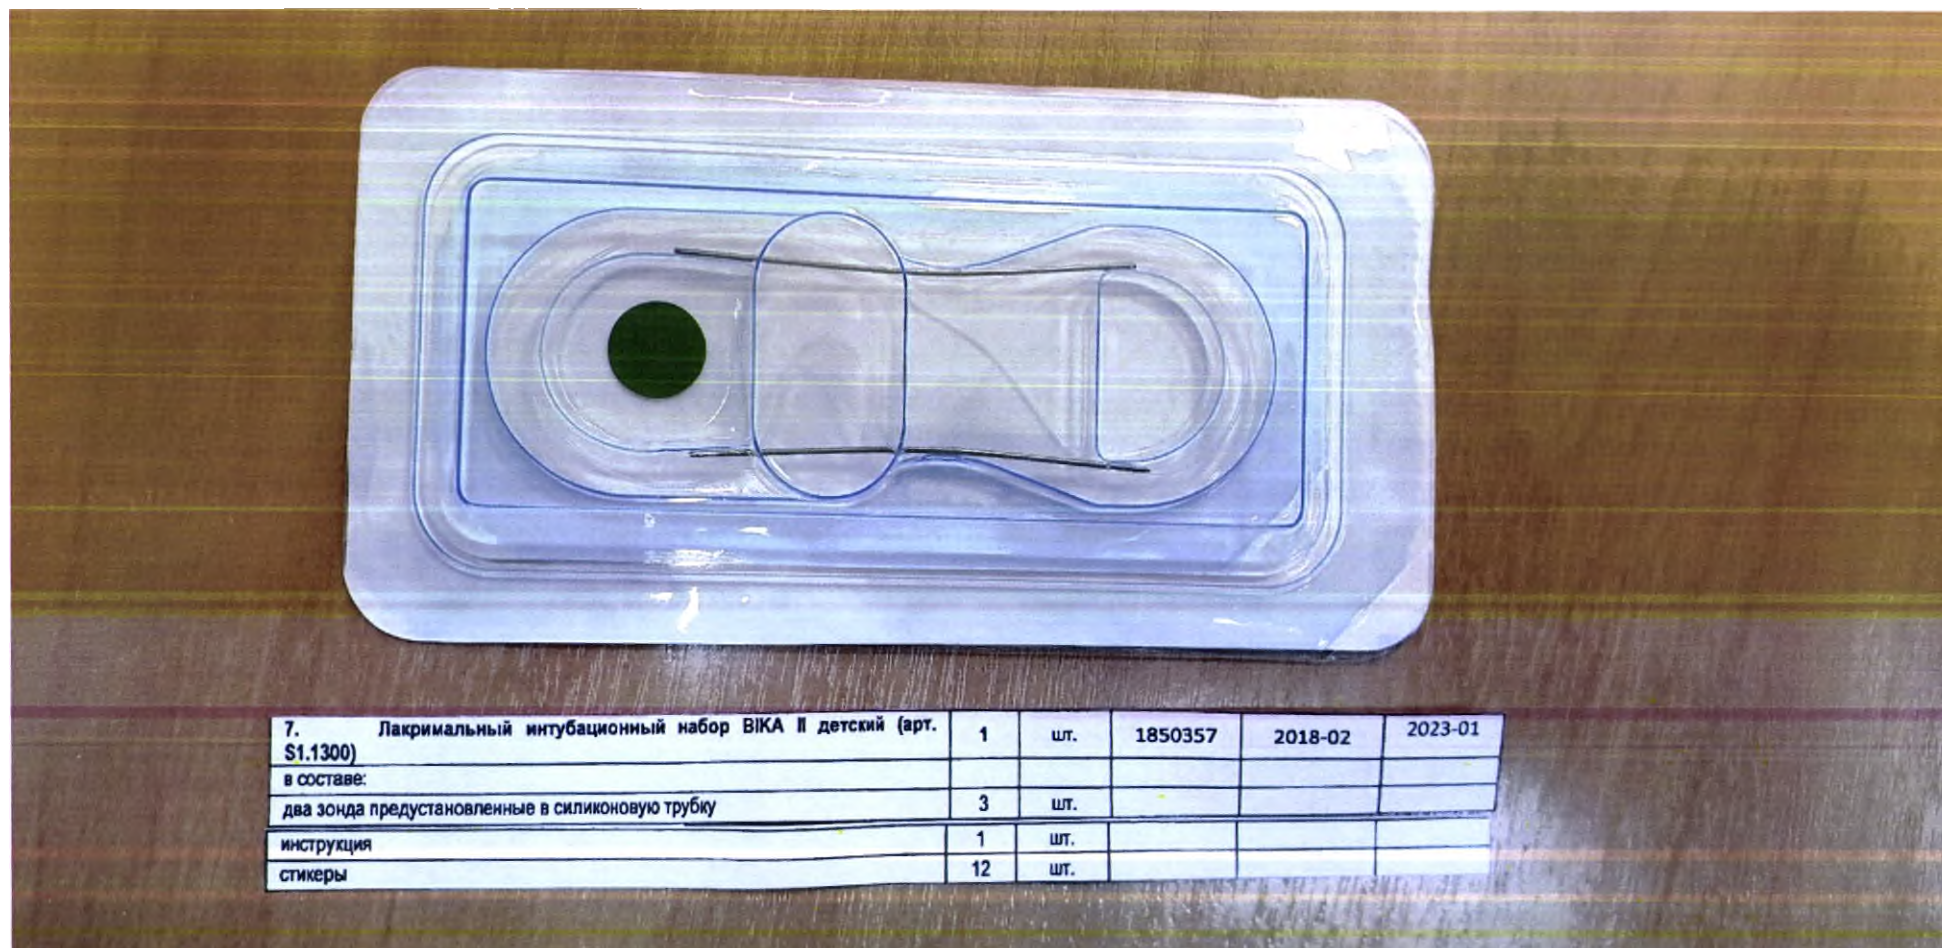


Рисунок 47 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1300

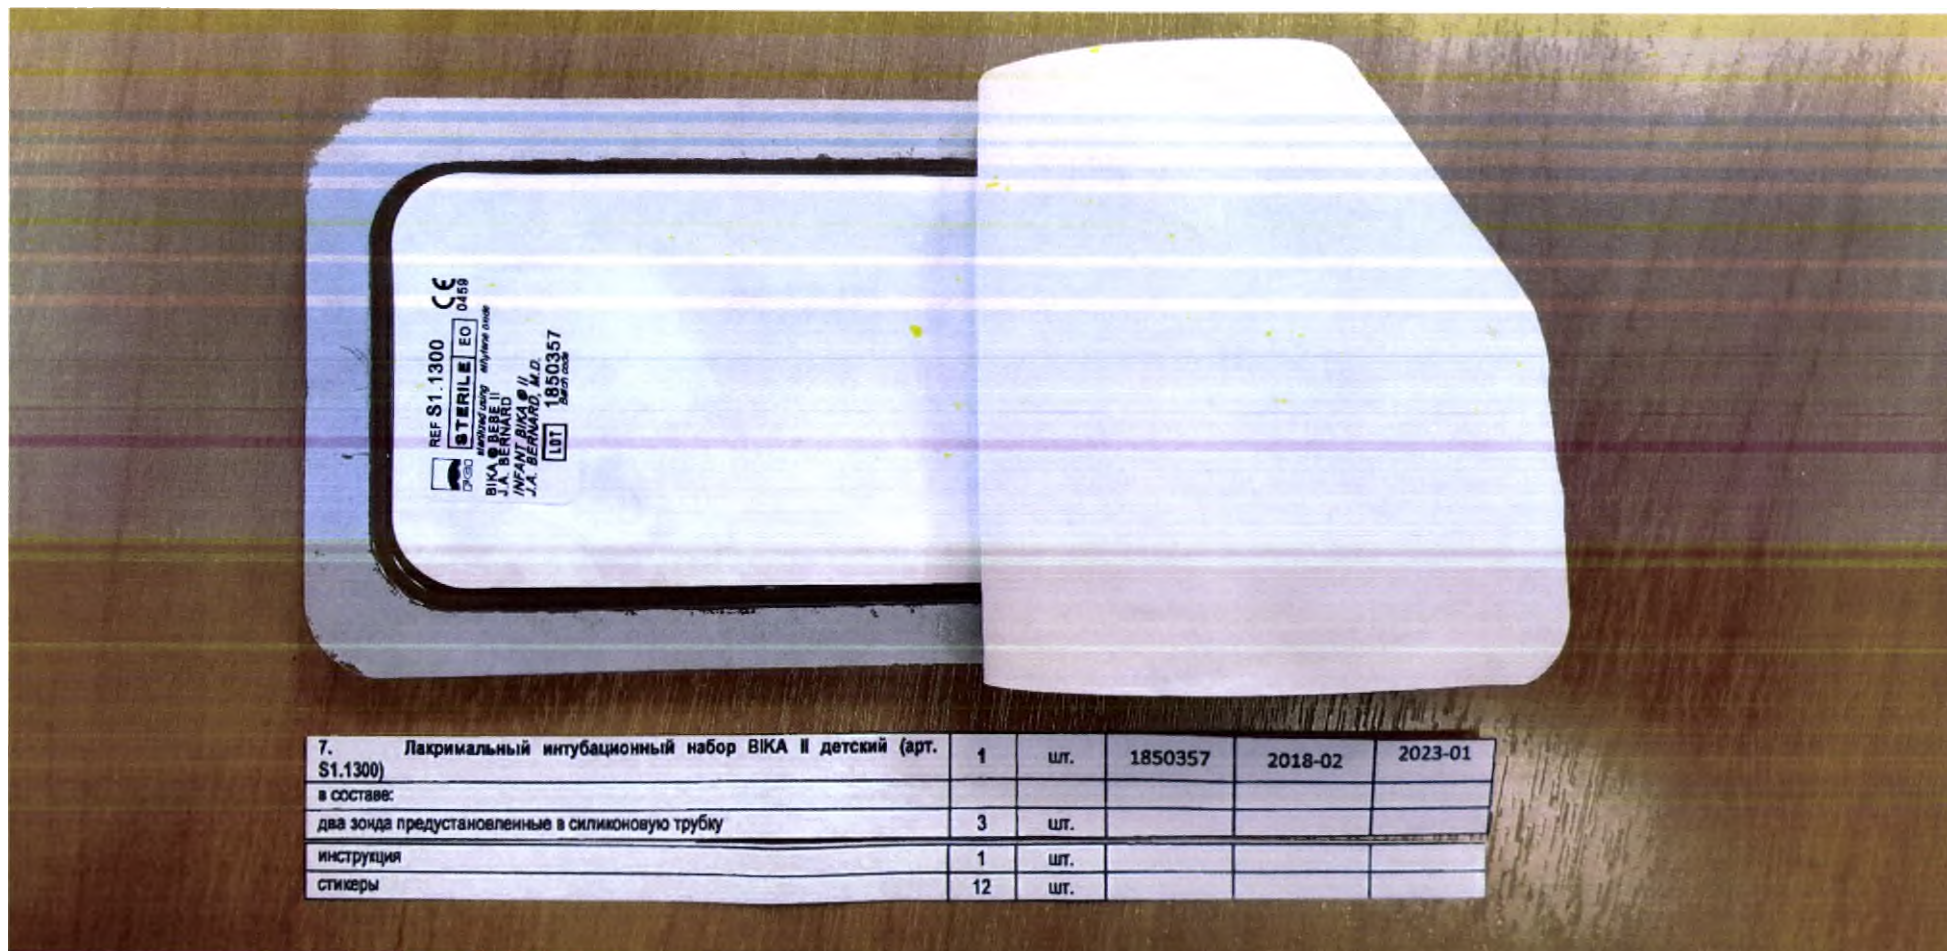


Рисунок 48 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1300

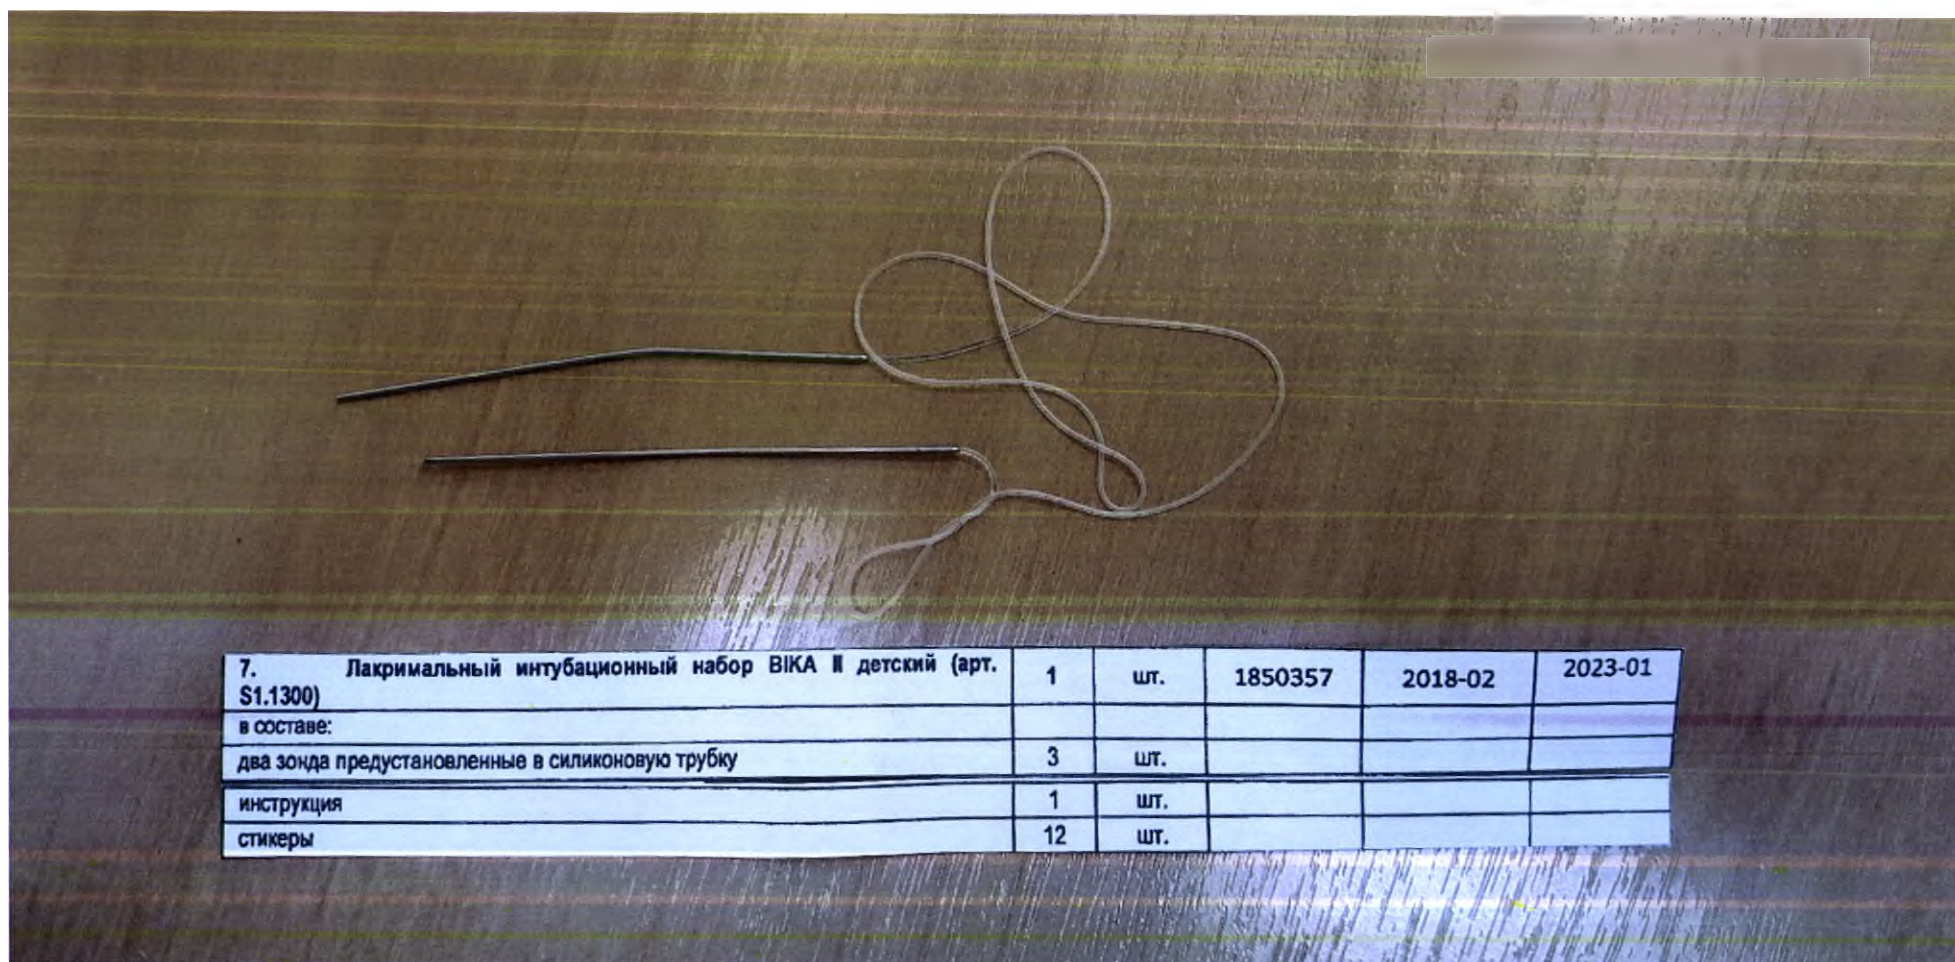


Рисунок 49 – Лакримальный интубационный набор ВІКА ІІ детский, арт. S1.1300



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



в. Лазерный интубационный набор ВКА II детский с РУР	1	шт.	1851617	2018-04	2023-03
подручник (арт. S1.1320)					
в составе:					
два зонда промывочные в слезноносовую трубку	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стериль	12	шт.			

Рисунок 50 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1320



Рисунок 51 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1320



Рисунок 52 – Комплектность арт. S1.1320

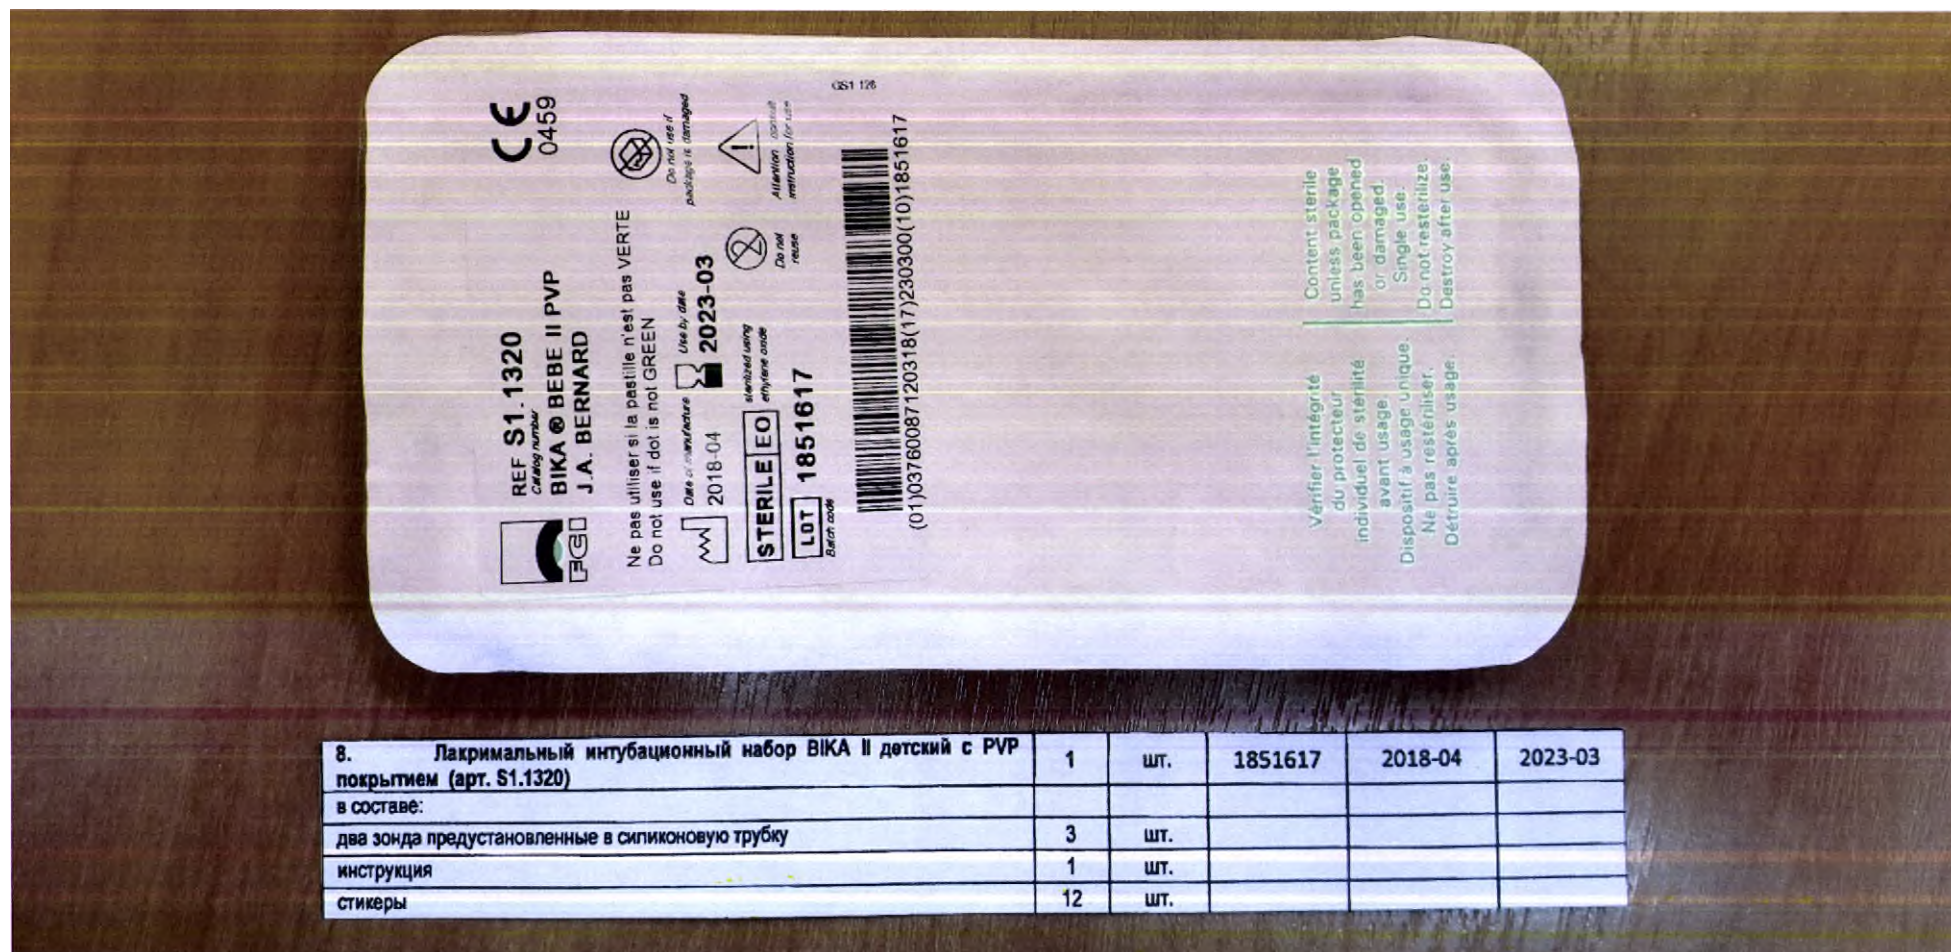


Рисунок 53 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1320

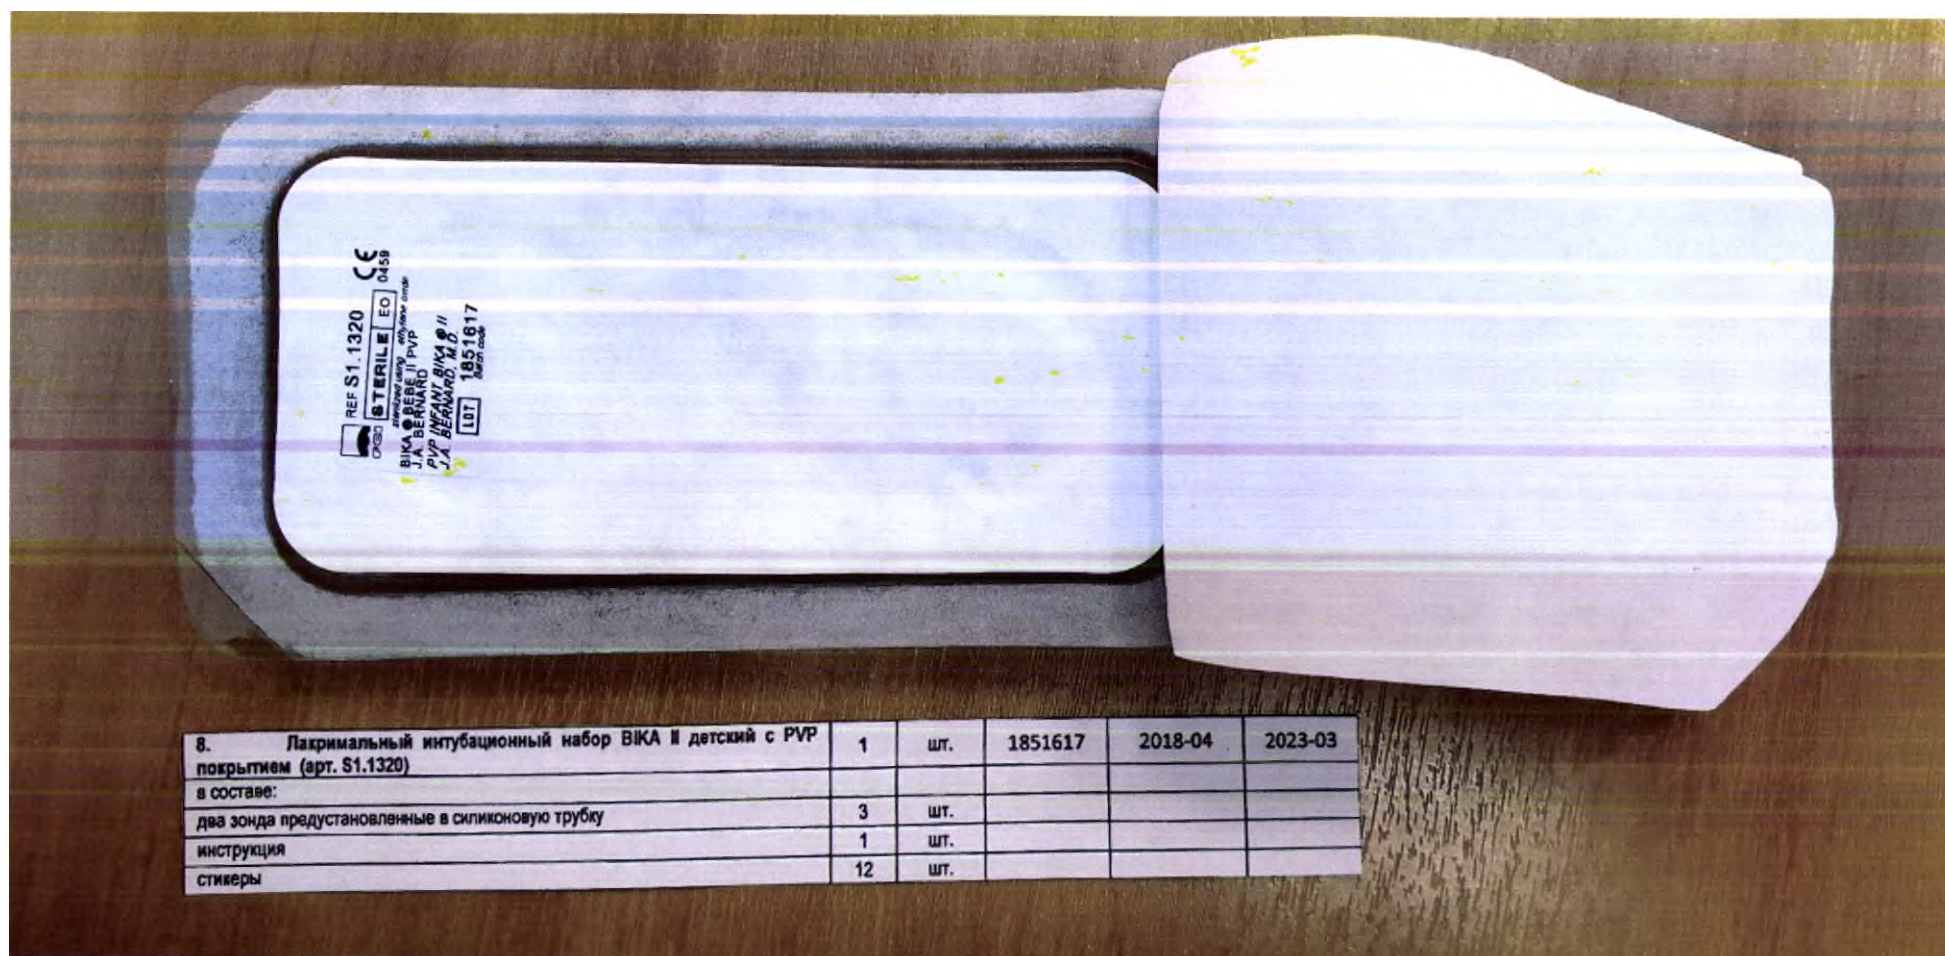


Рисунок 54 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1320

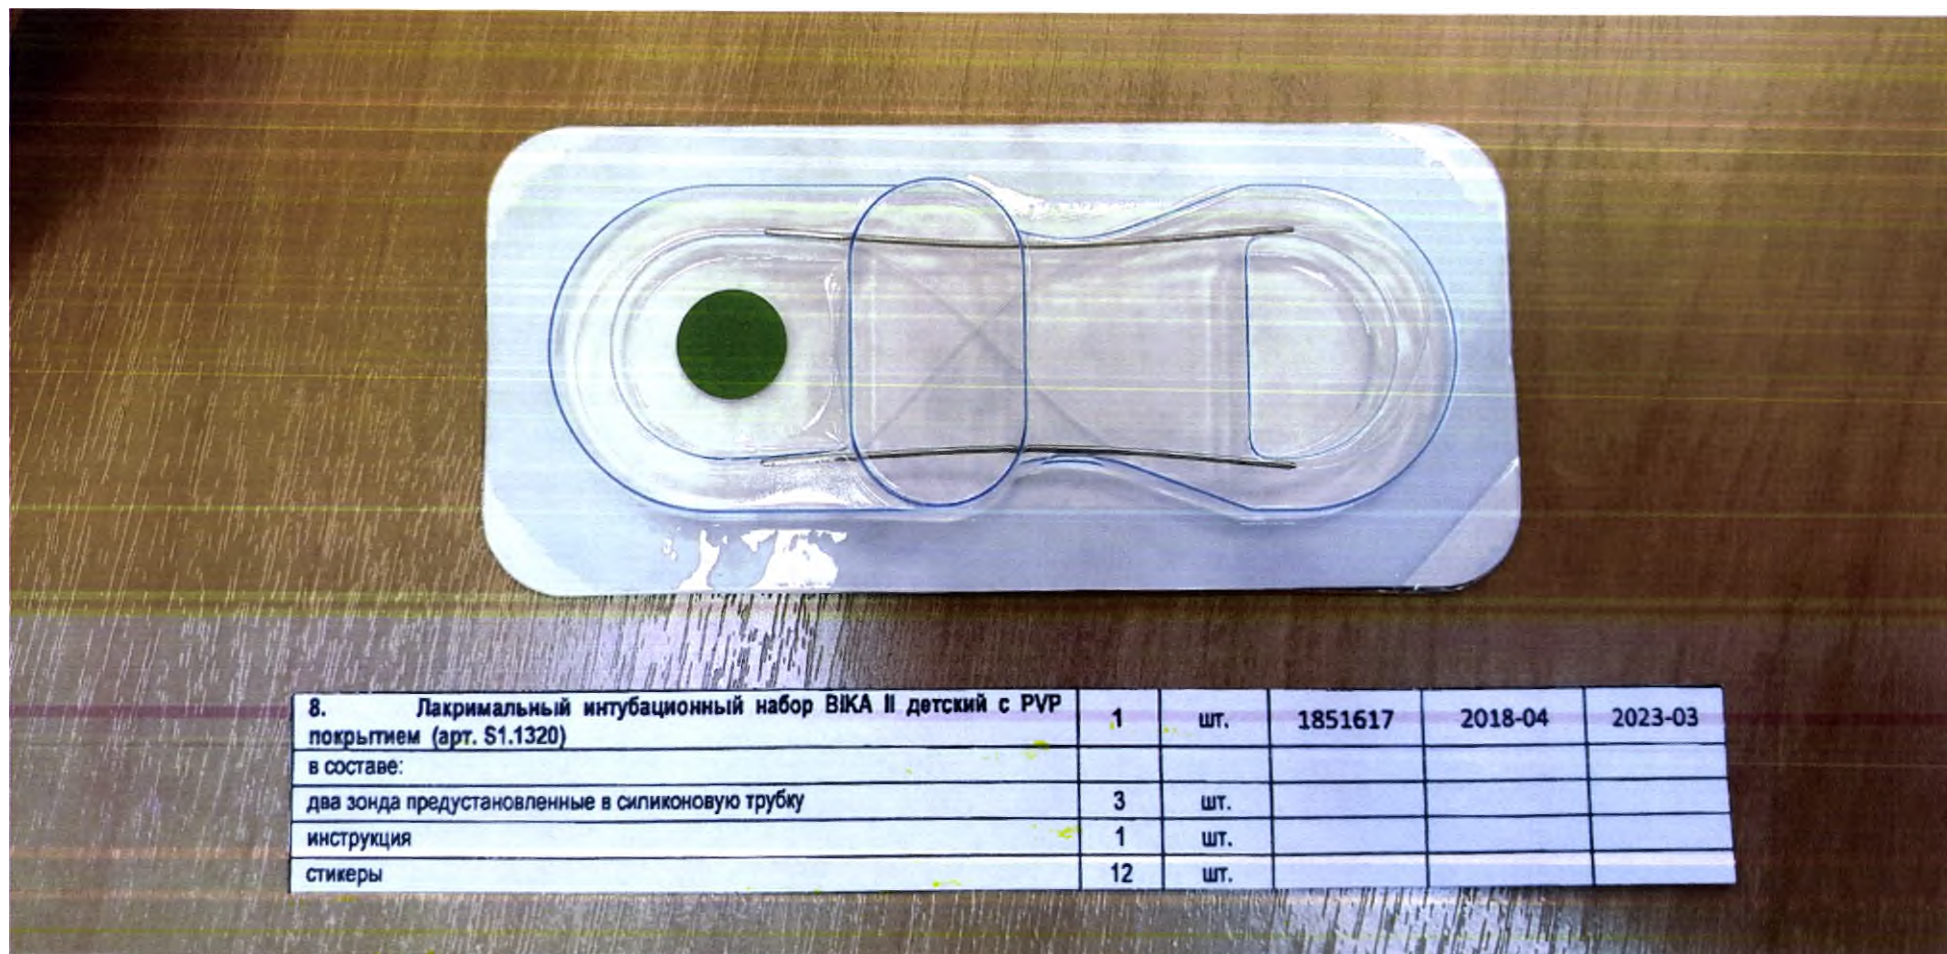


Рисунок 55 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1320

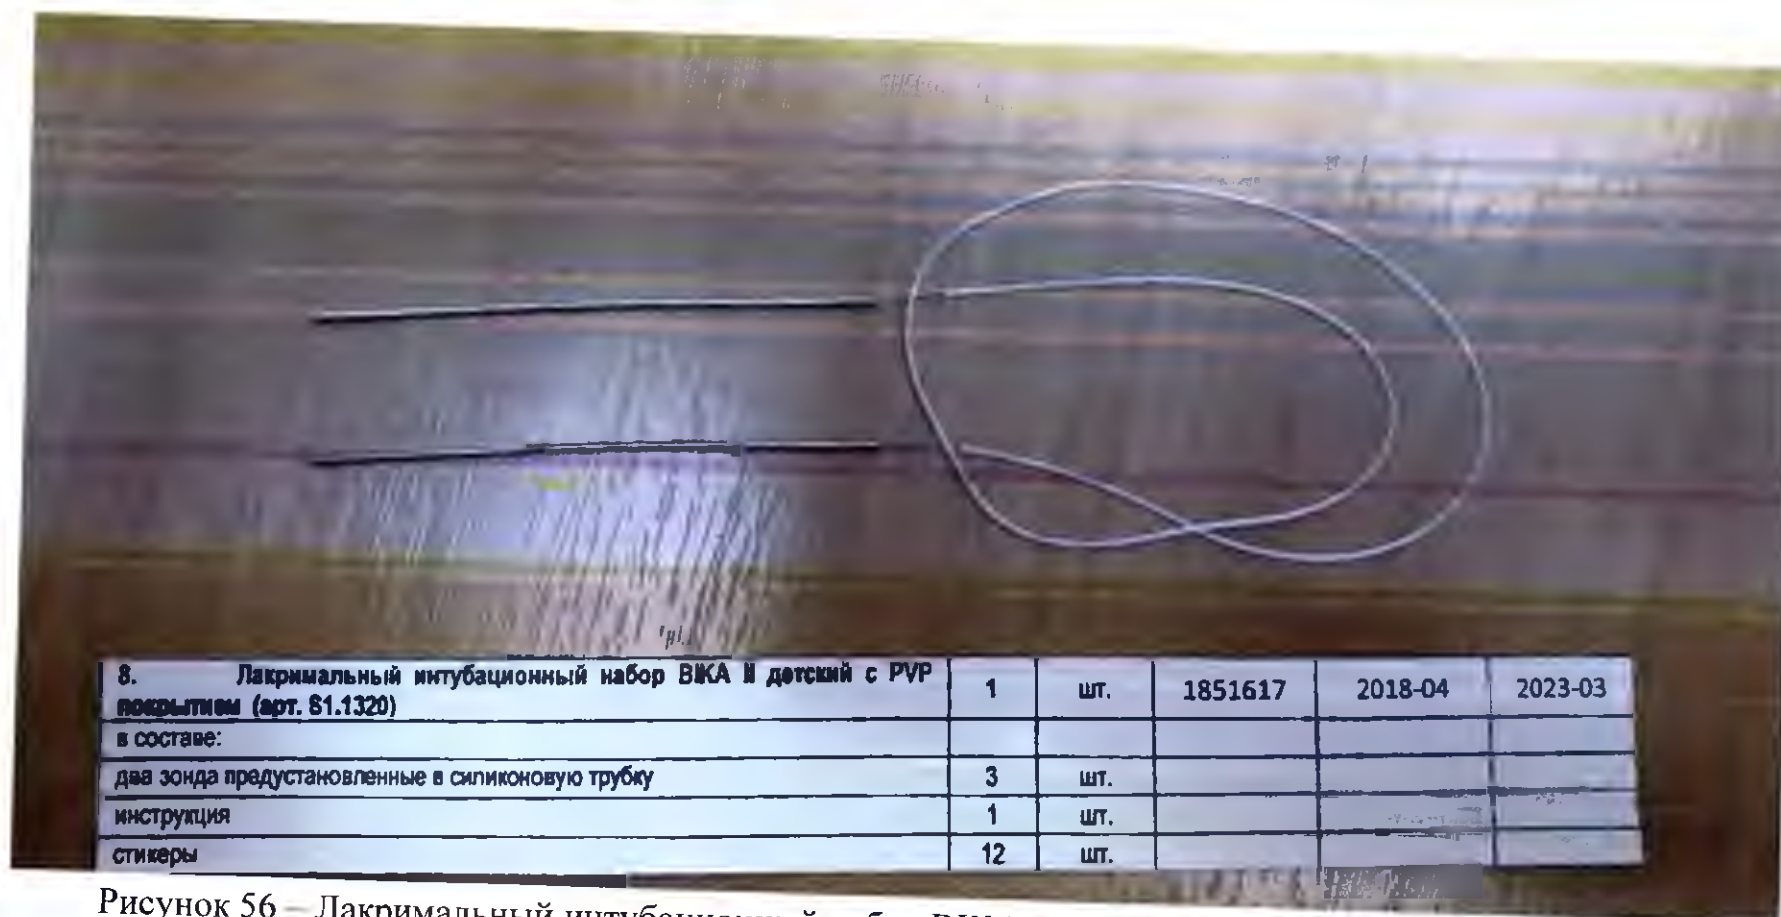


Рисунок 56 – Лакримальный интубационный набор ВІКА ІІ детский с PVP покрытием арт. S1.1320



FCI S.A.S.

20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS

30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359

PHONE: 800-932-4202



№	Наименование интрузионный набор ИОНОКА (арт. S1.1630)	1	шт.	1850518	2018-02	2023-01
в состав:						
защ. предостановленный в скрининговую группу		3	шт.			
инструкция		1	шт.			
спирты		12	шт.			

Рисунок 57 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1630

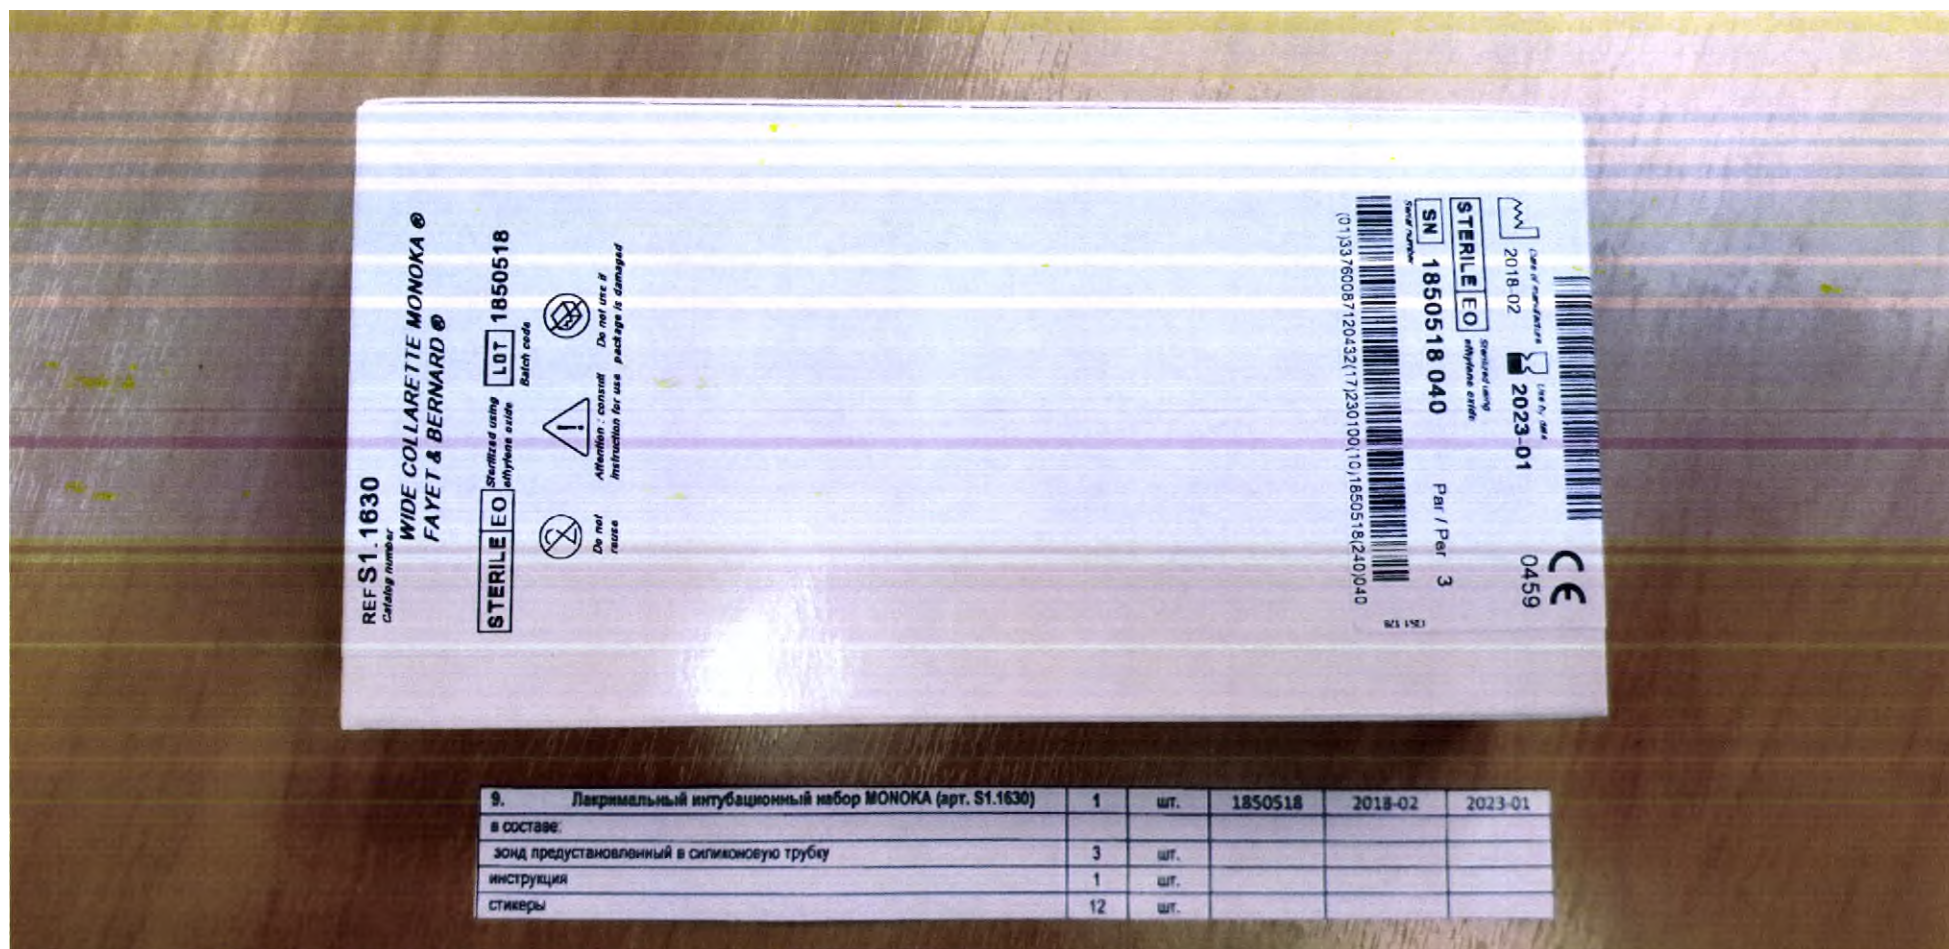


Рисунок 58 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1630



Рисунок 59 – Комплектность арт. S1.1630



9.	Лапаримильный интубационный набор МОНОКА (арт. S1.1630)	1	шт.	1850518	2018-02	2023-01
в составе:						
зона предустановленный в силиконовую трубку	3	шт.				
инструкция	1	шт.				
стериль	12	шт.				

Рисунок 60 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1630

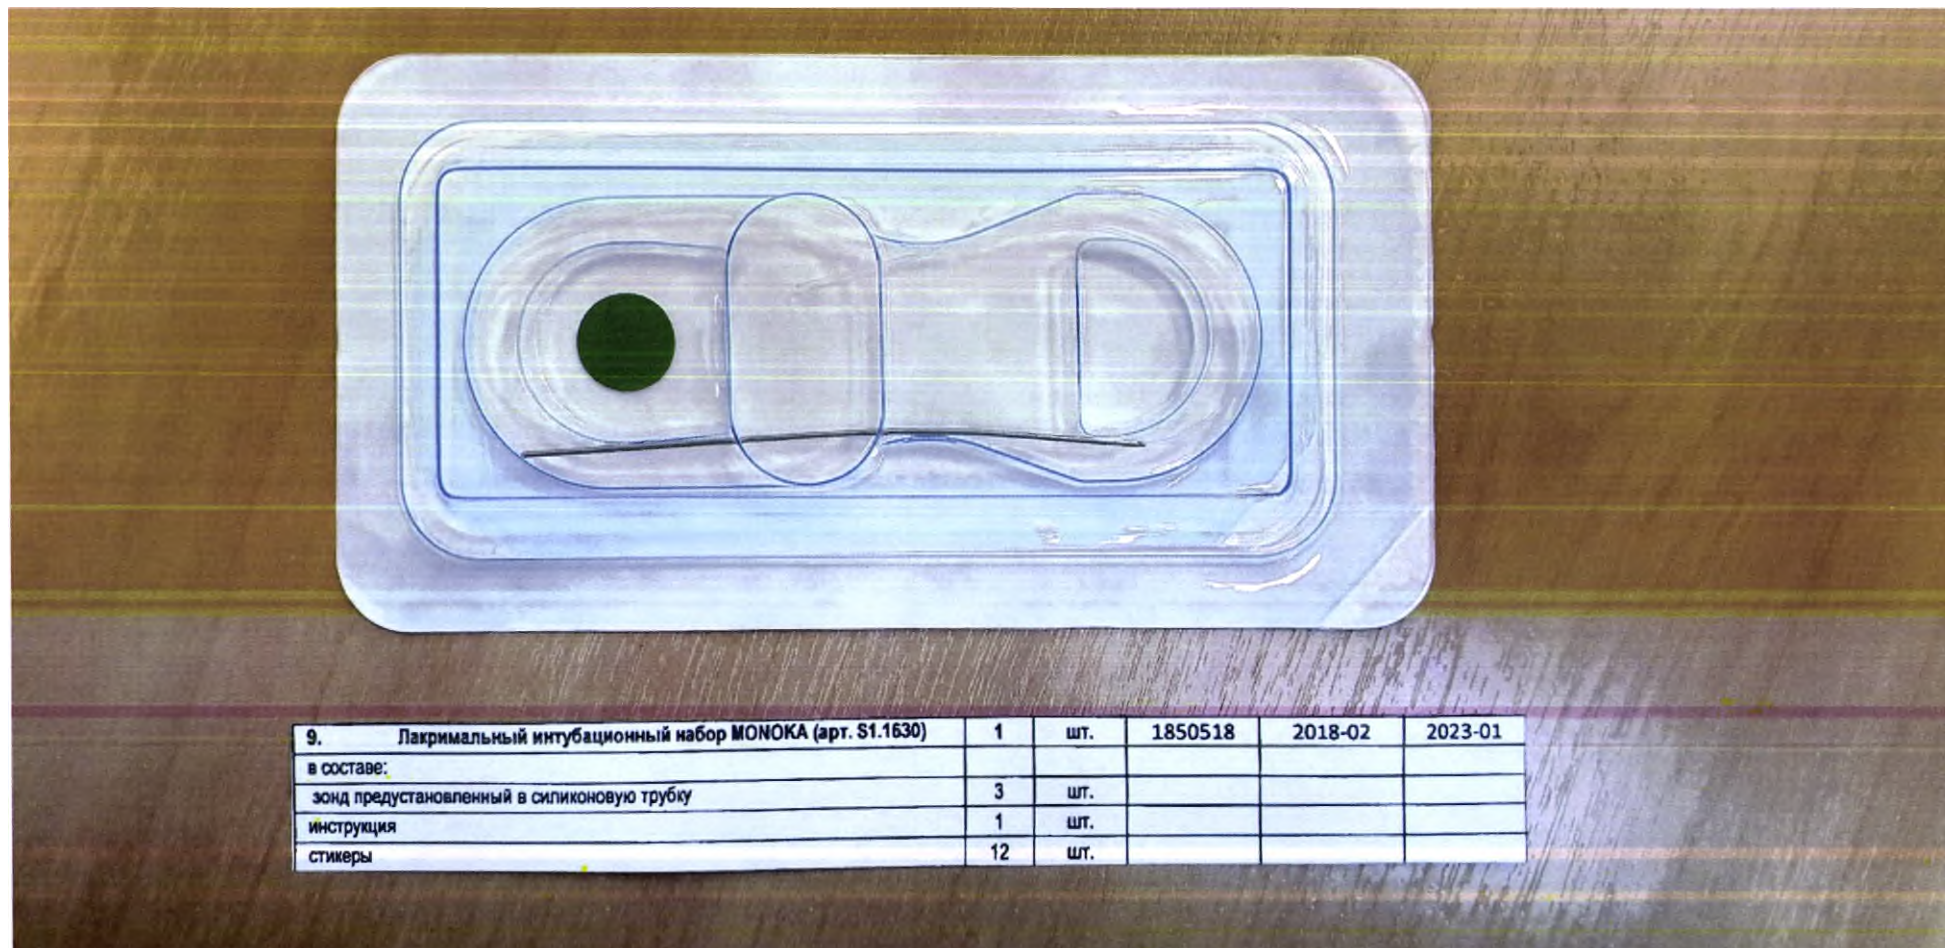


Рисунок 61 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1630

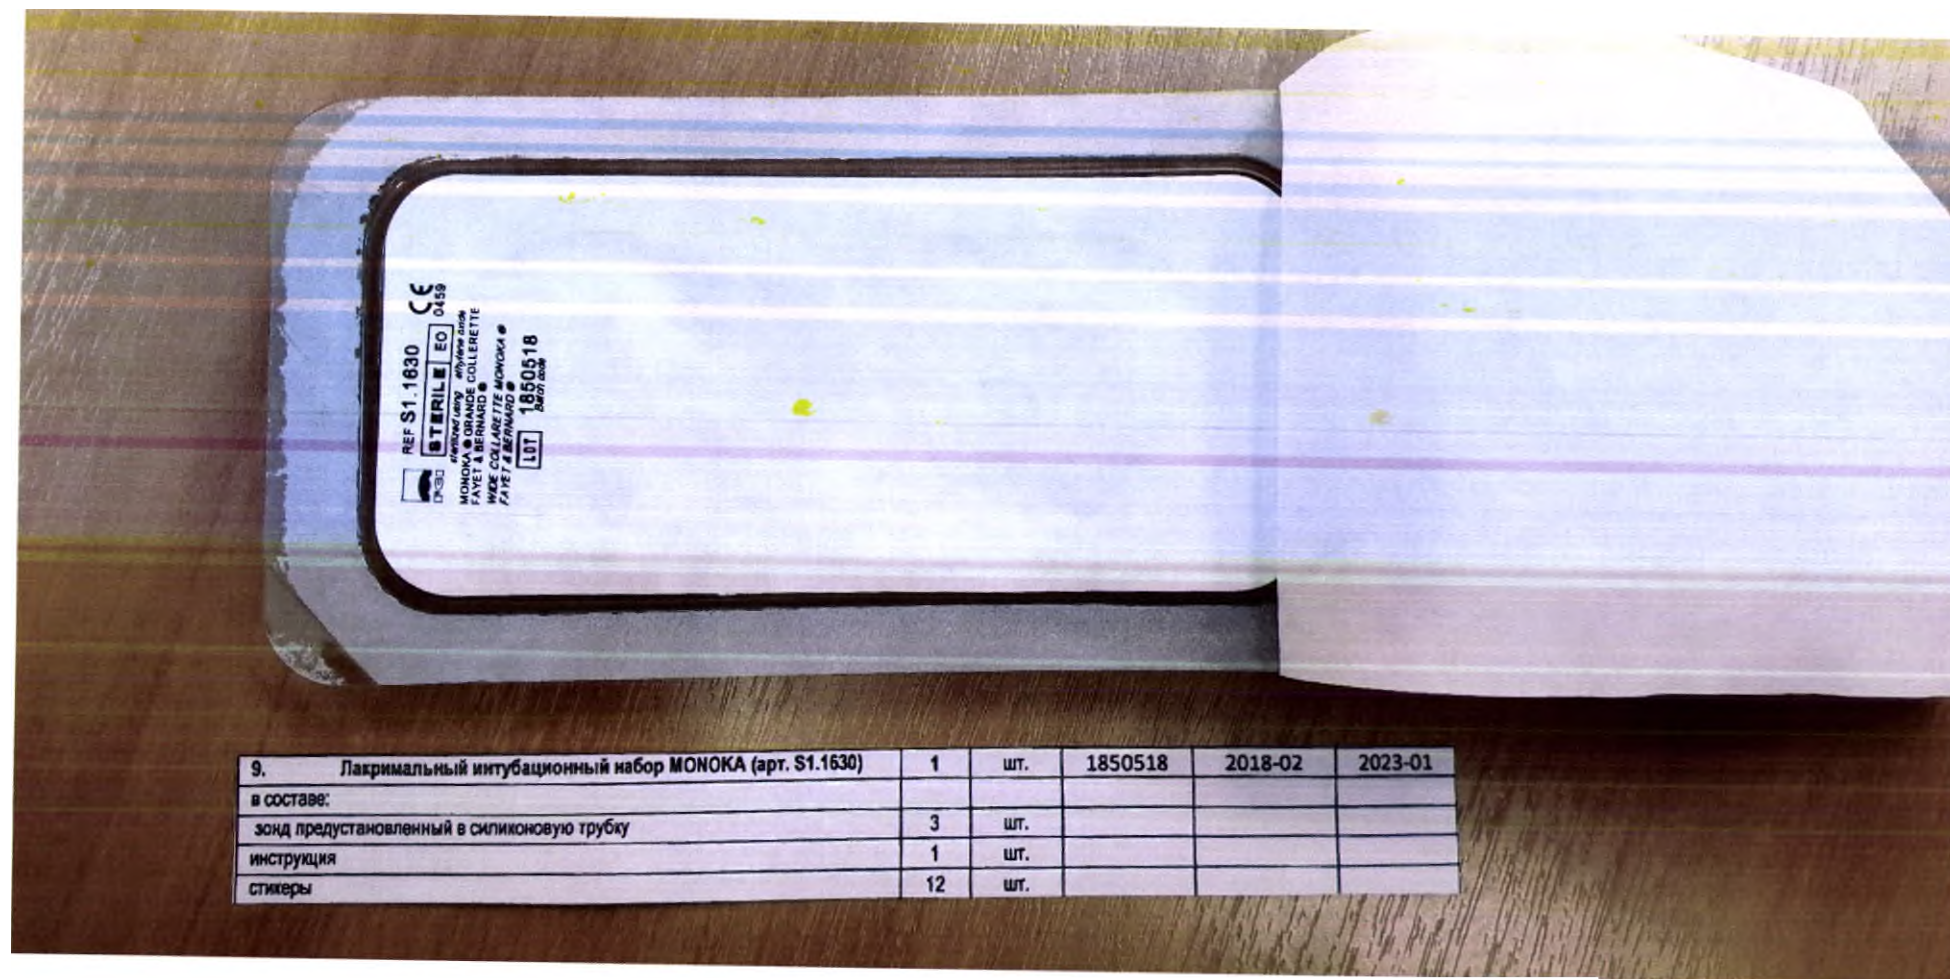


Рисунок 62 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1630

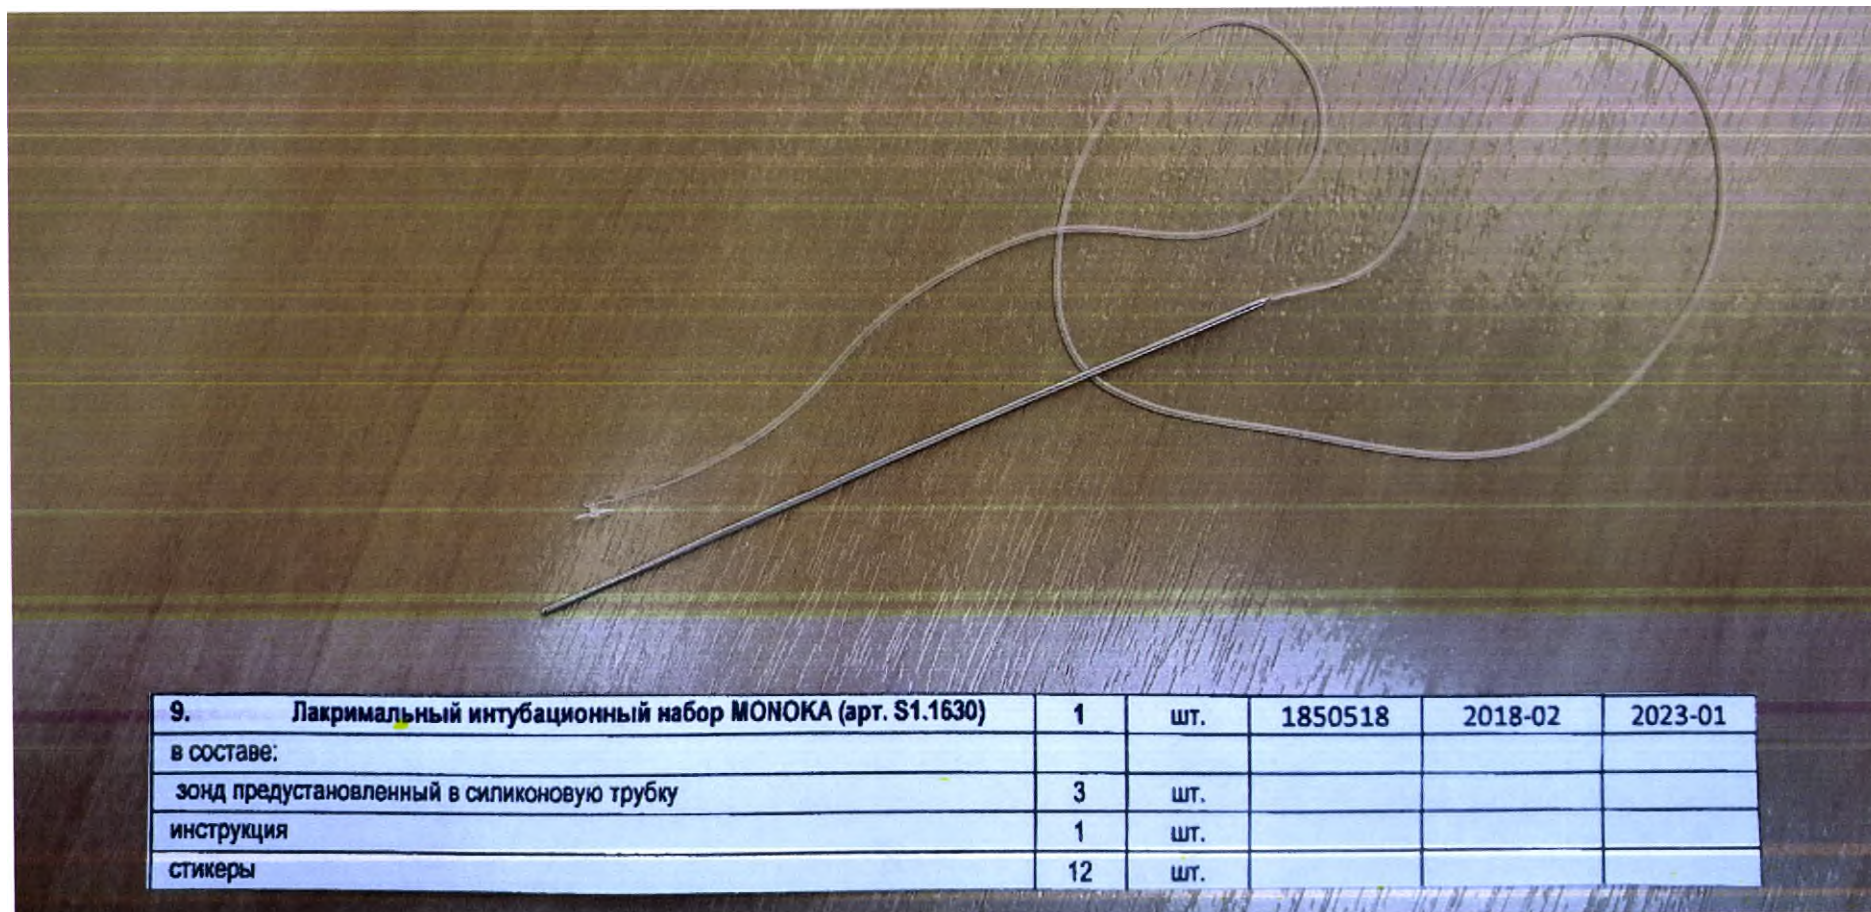


Рисунок 63 – Лакримальный интубационный набор MONOKA, арт. S1.1630



Рисунок 64 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1660

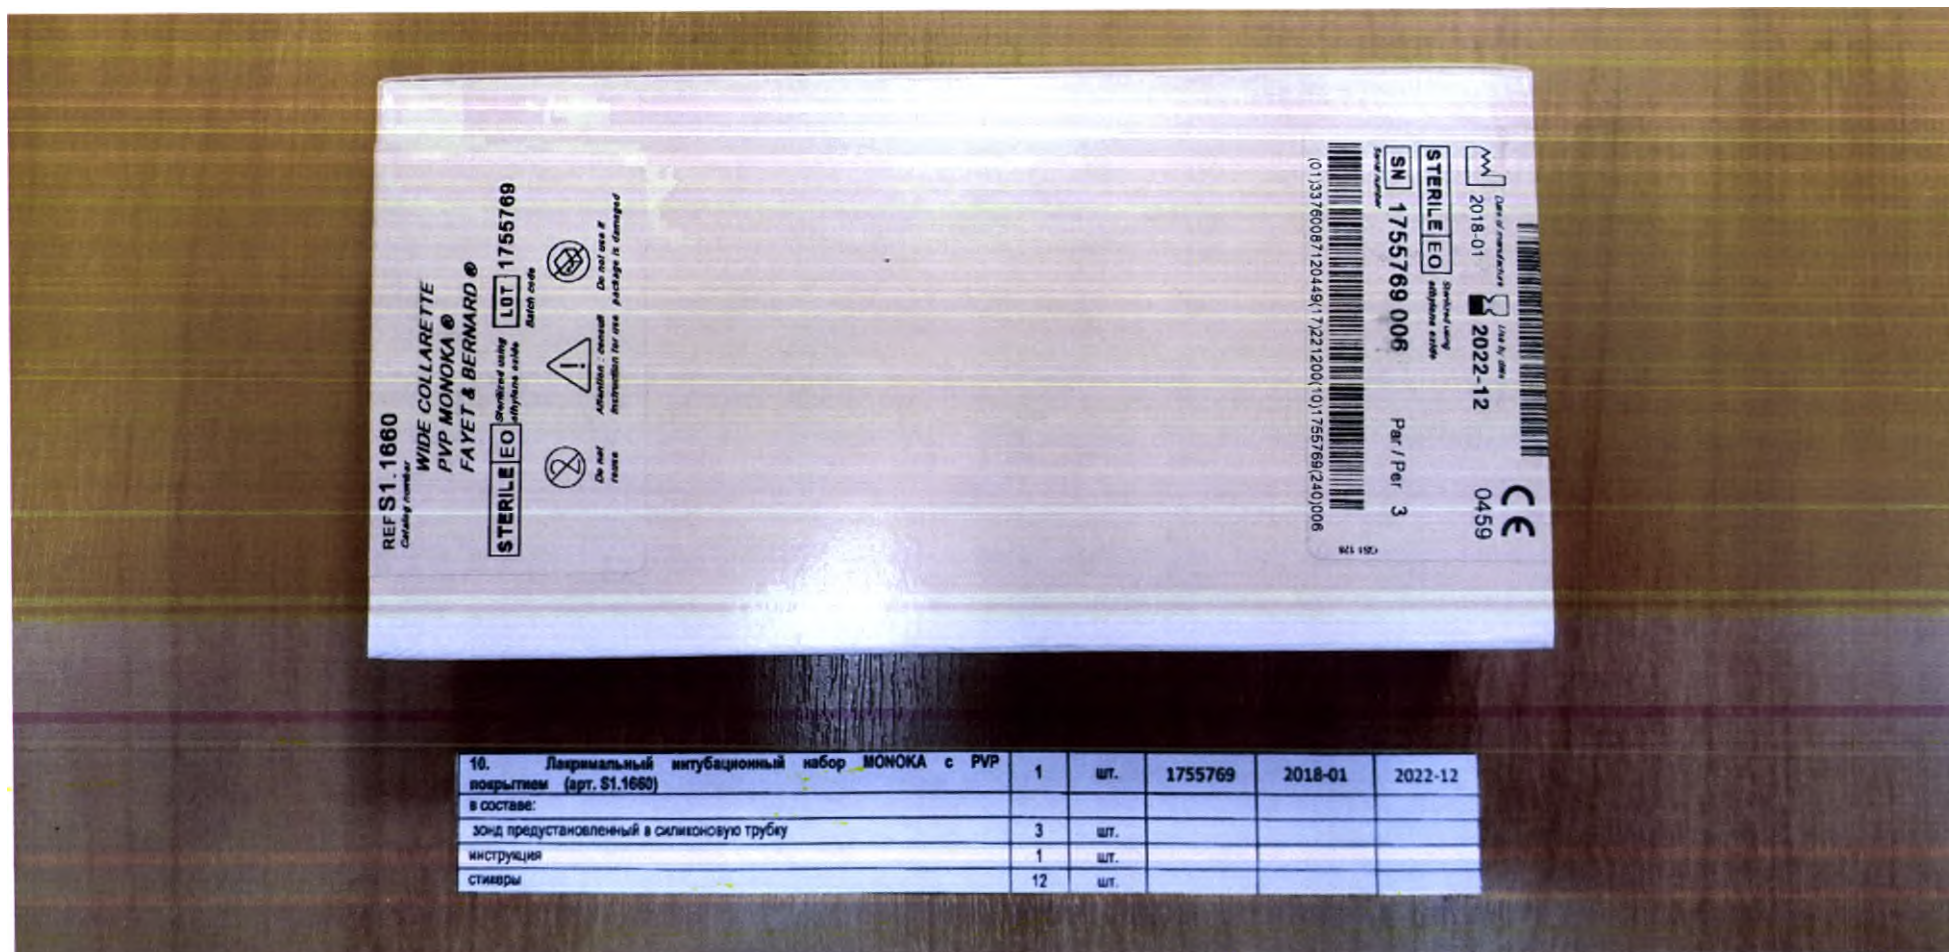


Рисунок 65 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1660



Рисунок 66 – Комплектность арт. S1.1660



Рисунок 67 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1660

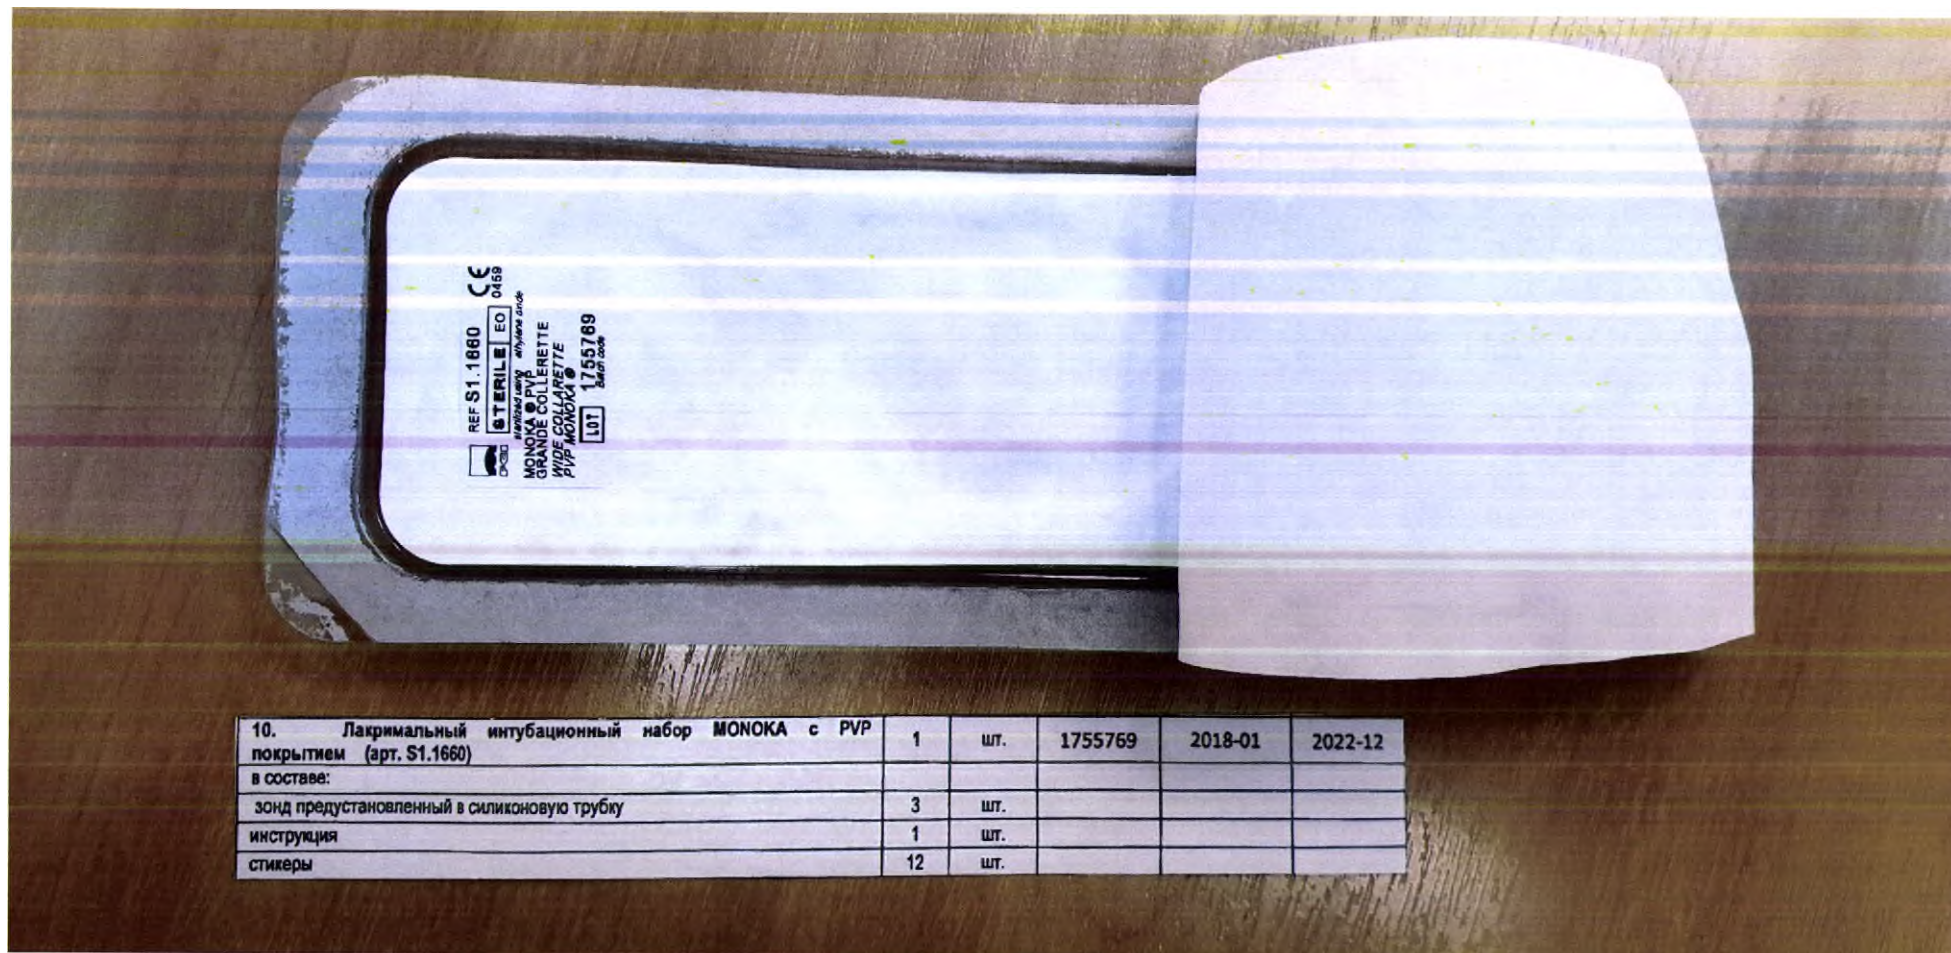


Рисунок 68 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1660

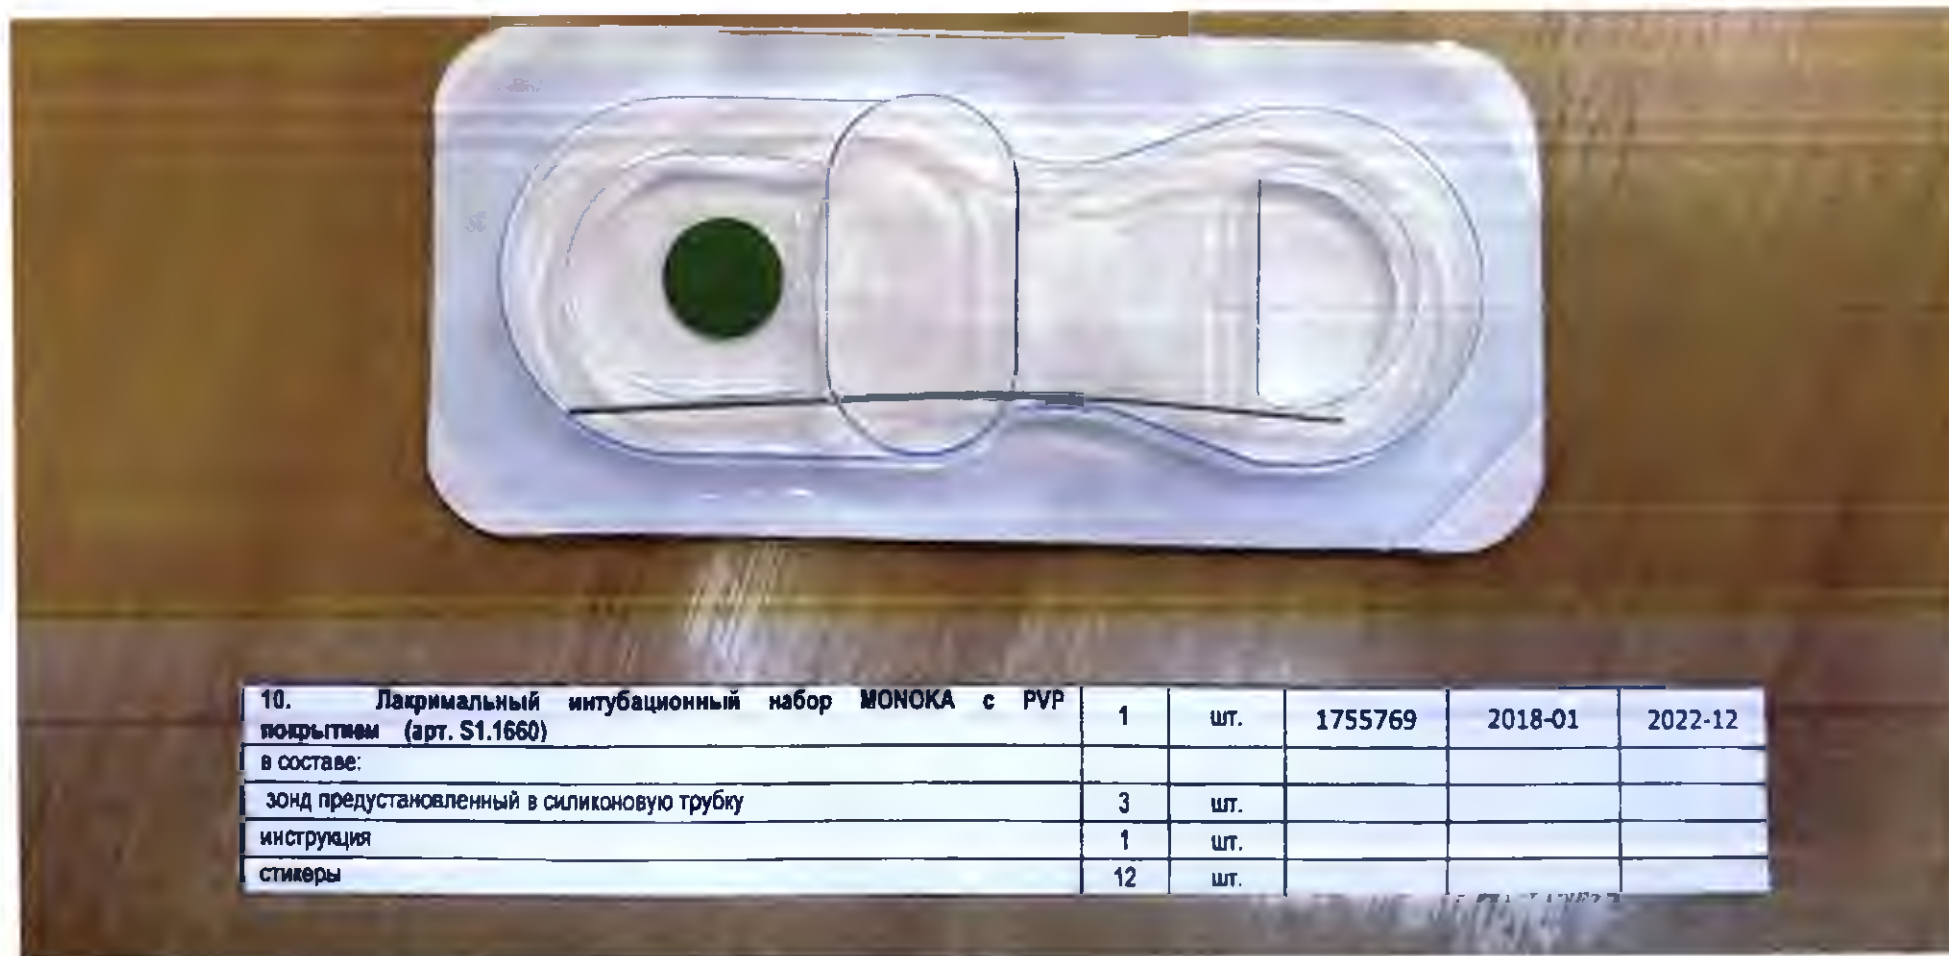


Рисунок 69 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1660

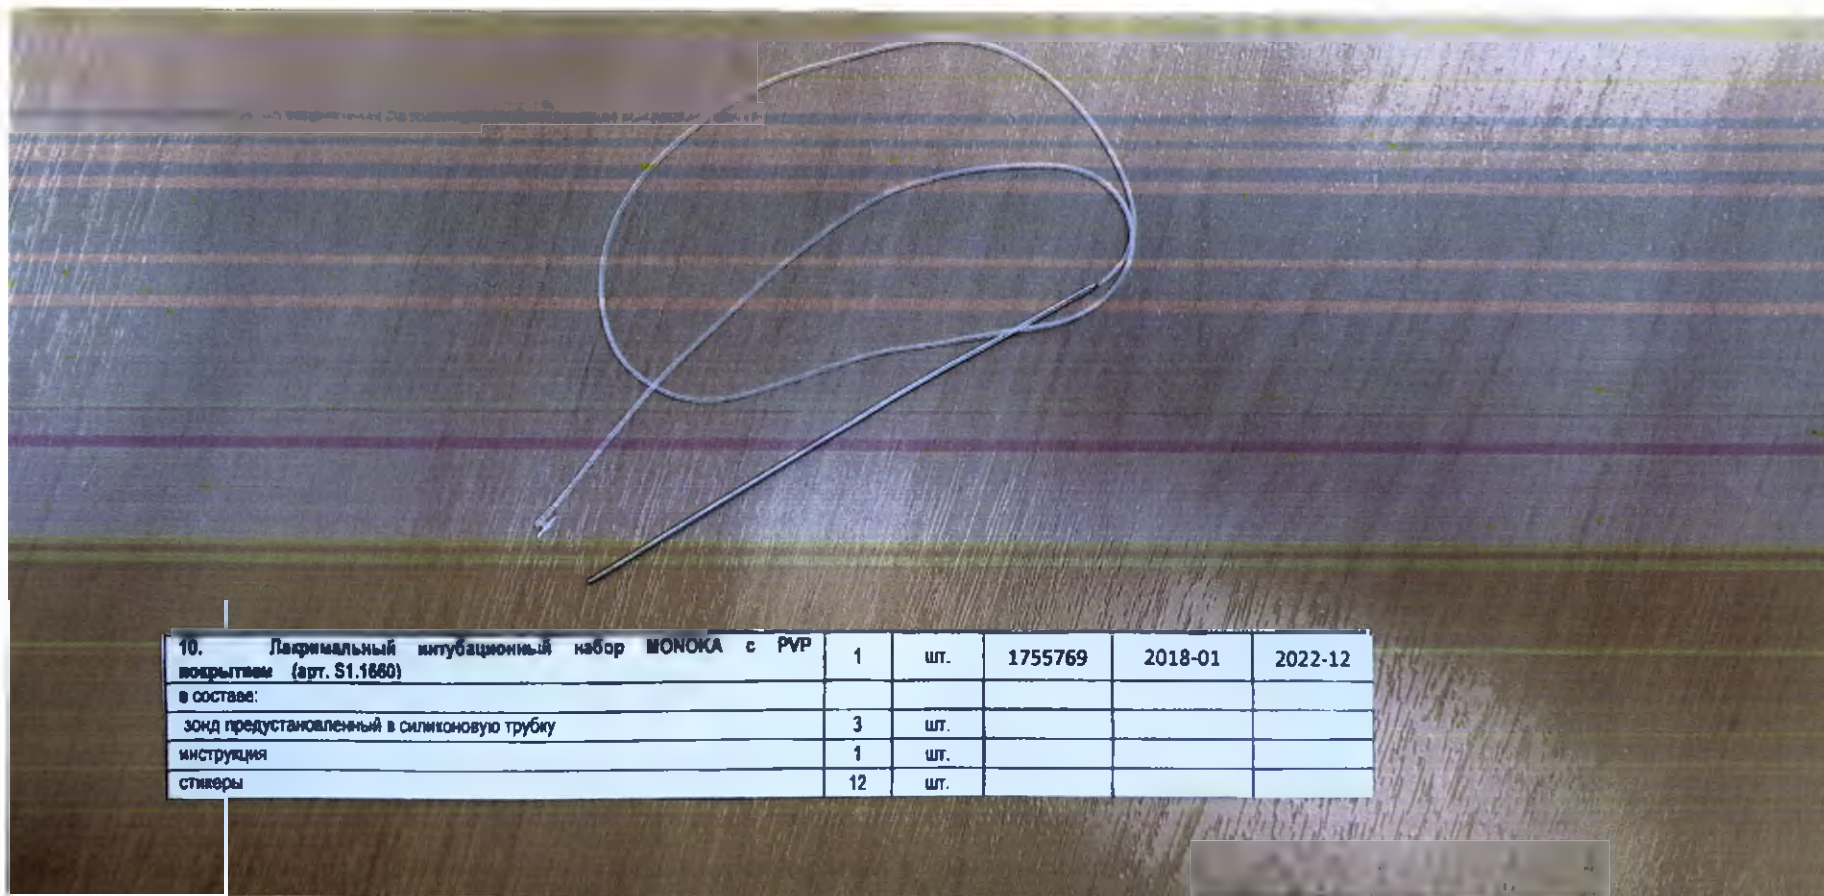


Рисунок 70 – Лакримальный интубационный набор MONOKA с PVP покрытием, арт. S1.1660



Рисунок 71 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. SI.1710



11.	Лахримальный интубационный набор MONOKA (арт. S1.1710)	1	шт.	1851316	2018-04	2023-03
в составе:						
	зонд предустановленный в силиконовую трубу	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	12	шт.			

Рисунок 72 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1710



Рисунок 73 – Комплектность арт. S1.1710

11.	Лазерный интубационный набор MONOKA (арт. S1.1710)	1	шт.	1851316	2018-04	2023-03
в составе:						
зонд предназначенный в силиконовую трубку		3	шт.			
инструкция		1	шт.			
стерильный		12	шт.			



Рисунок 74 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1710

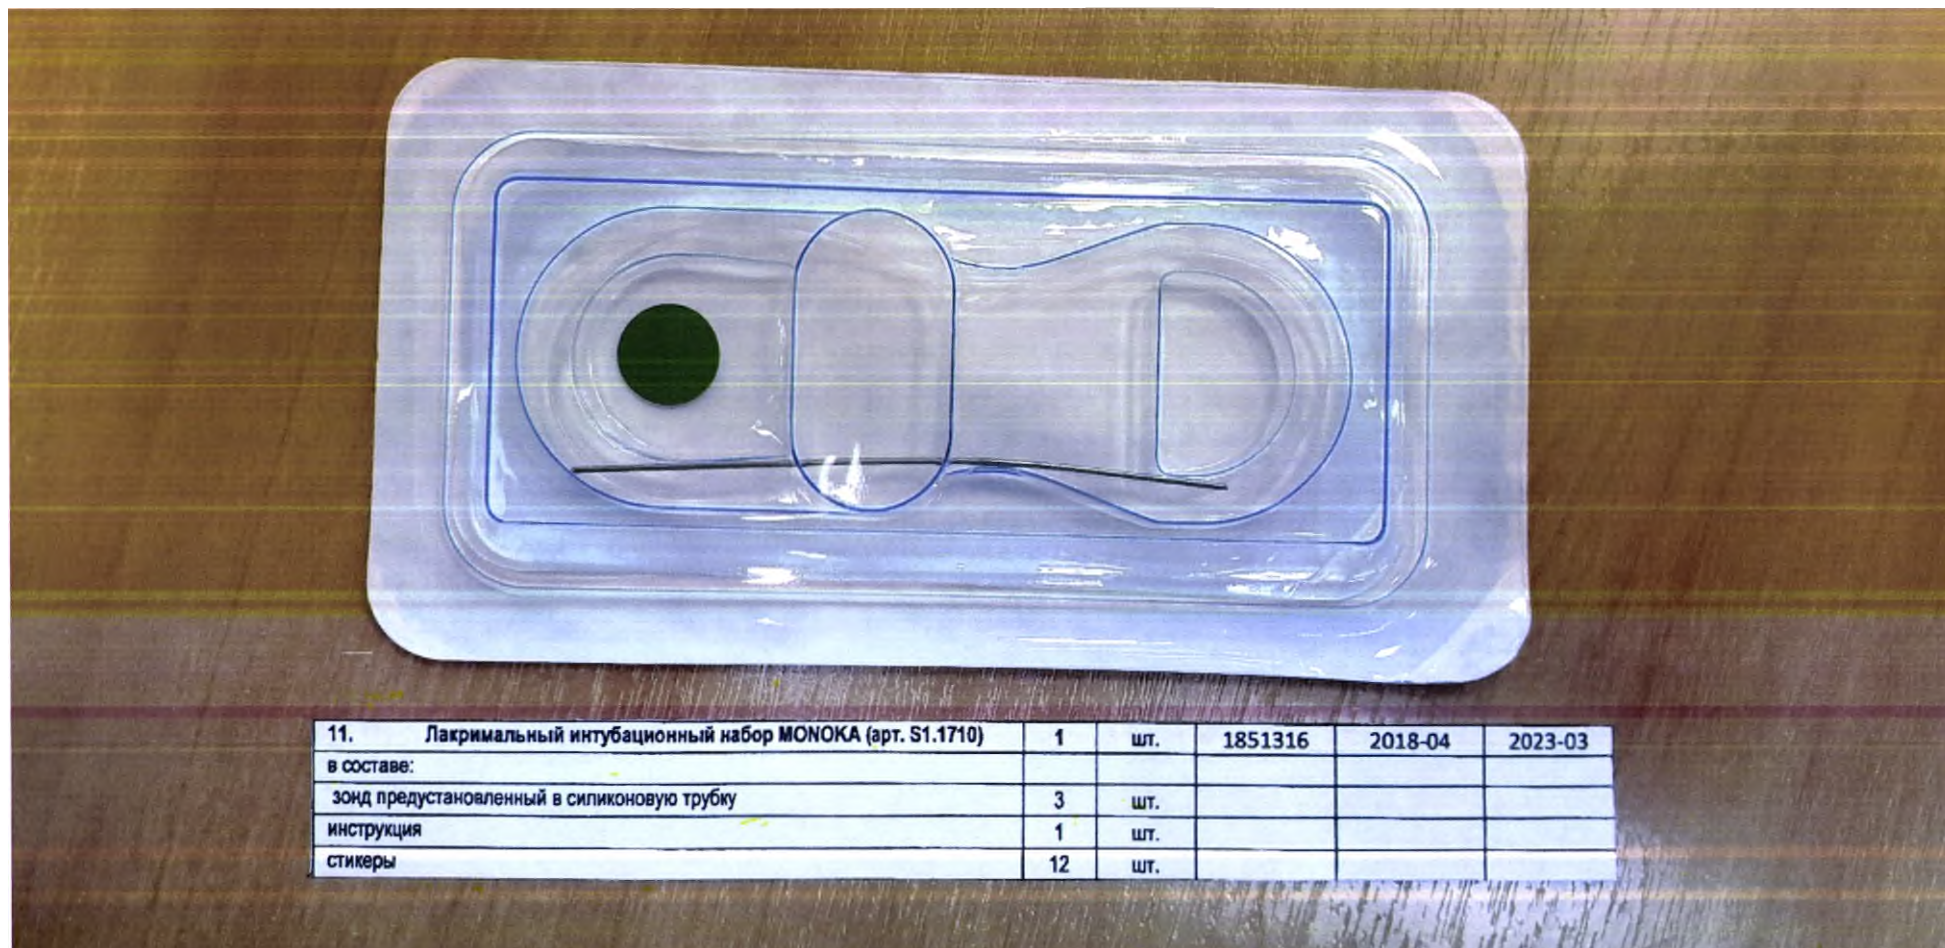


Рисунок 75 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1710

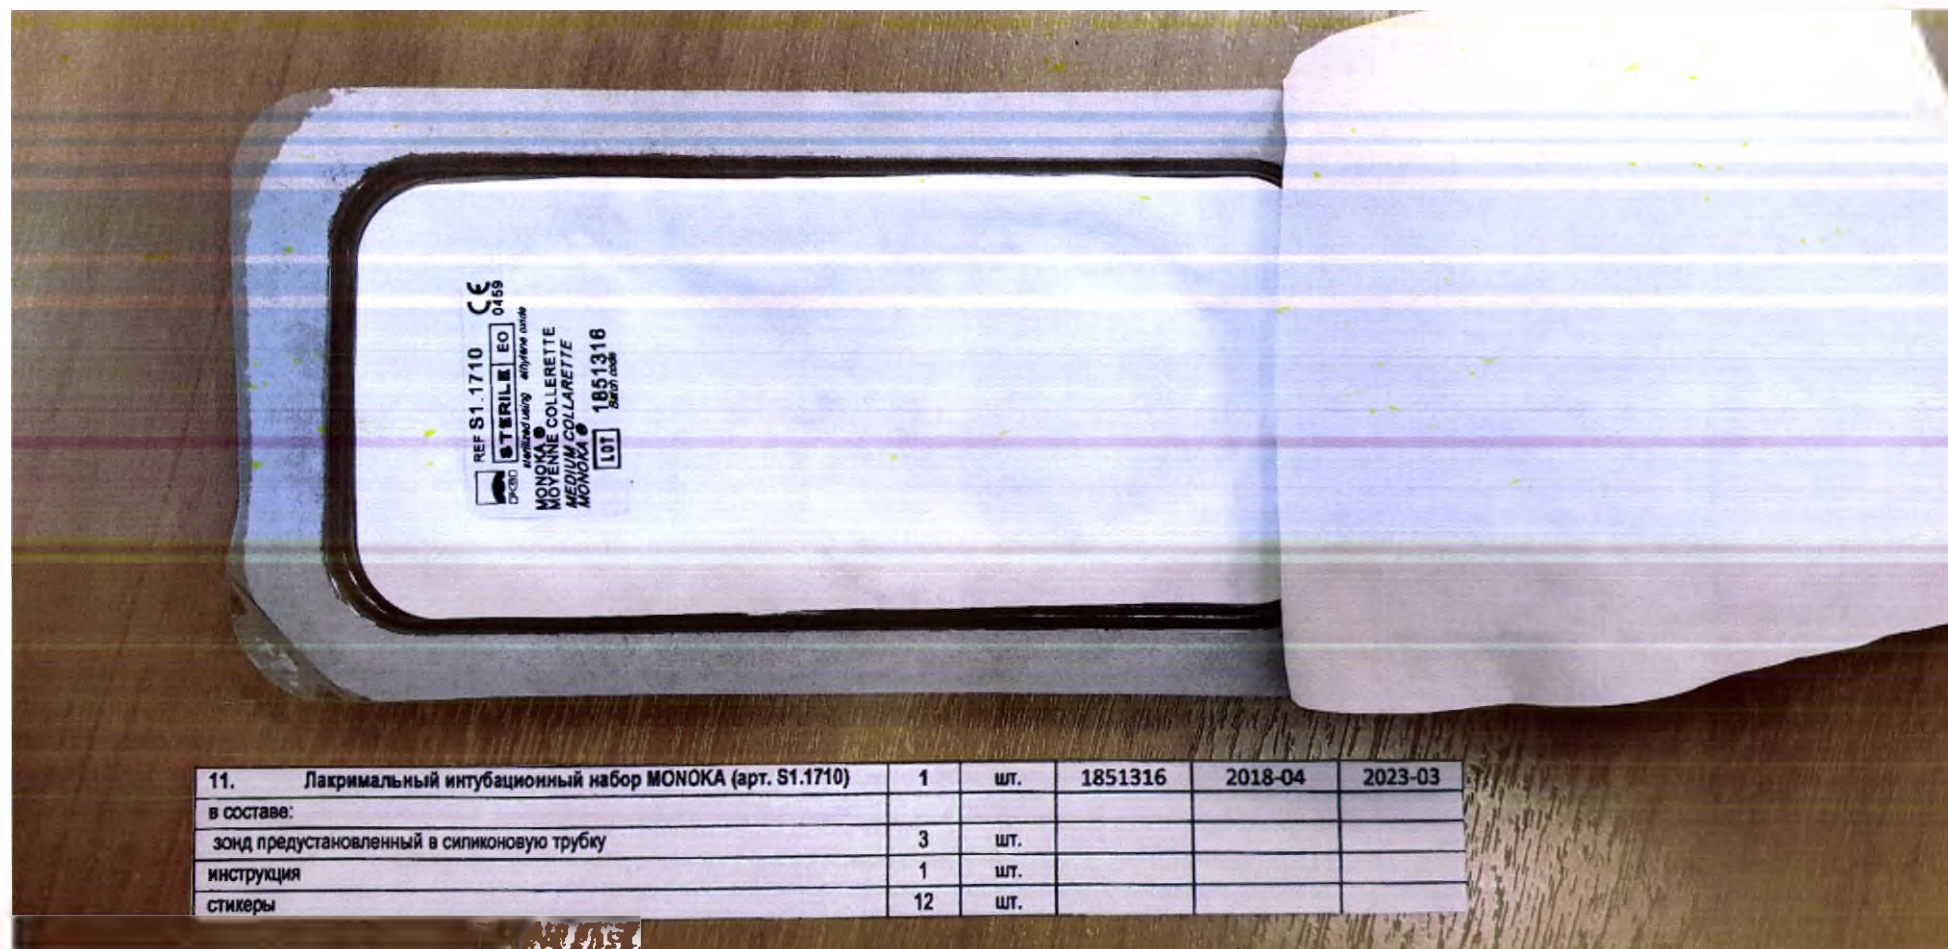


Рисунок 76 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1710



Рисунок 77 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1710

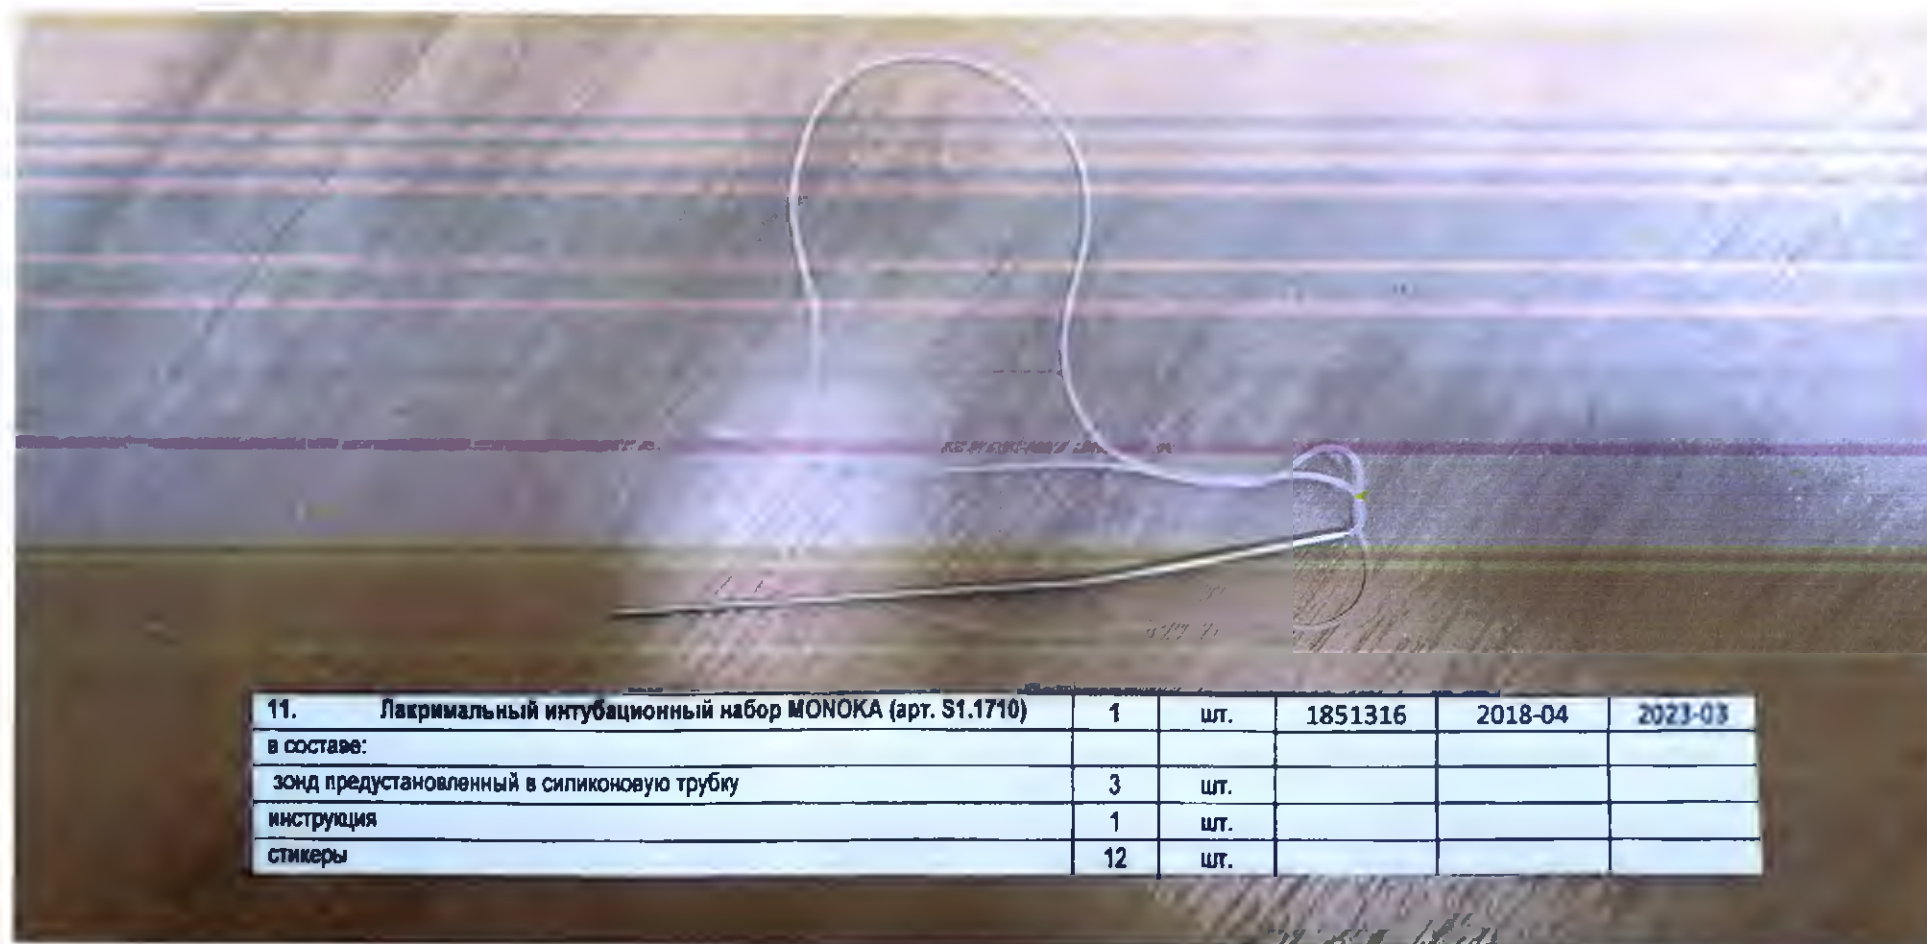


Рисунок 78 – Лакримальный интубационный набор MONOKA, арт. S1.1710

Рисунок 79 – Потребительская упаковка (вид сверху) арт. S1.1620

№	Наименование лекарственного средства	Формы выпуска	Срок годности	Срок хранения	Срок годности
1	С1.1620	1	12	12	12
2	С1.1620	1	12	12	12
3	С1.1620	1	12	12	12
4	С1.1620	1	12	12	12
5	С1.1620	1	12	12	12
6	С1.1620	1	12	12	12
7	С1.1620	1	12	12	12
8	С1.1620	1	12	12	12
9	С1.1620	1	12	12	12
10	С1.1620	1	12	12	12
11	С1.1620	1	12	12	12
12	С1.1620	1	12	12	12



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202





Рисунок 80 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1620



Рисунок 81 – Комплектность арт. S1.1620



Рисунок 82 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1620

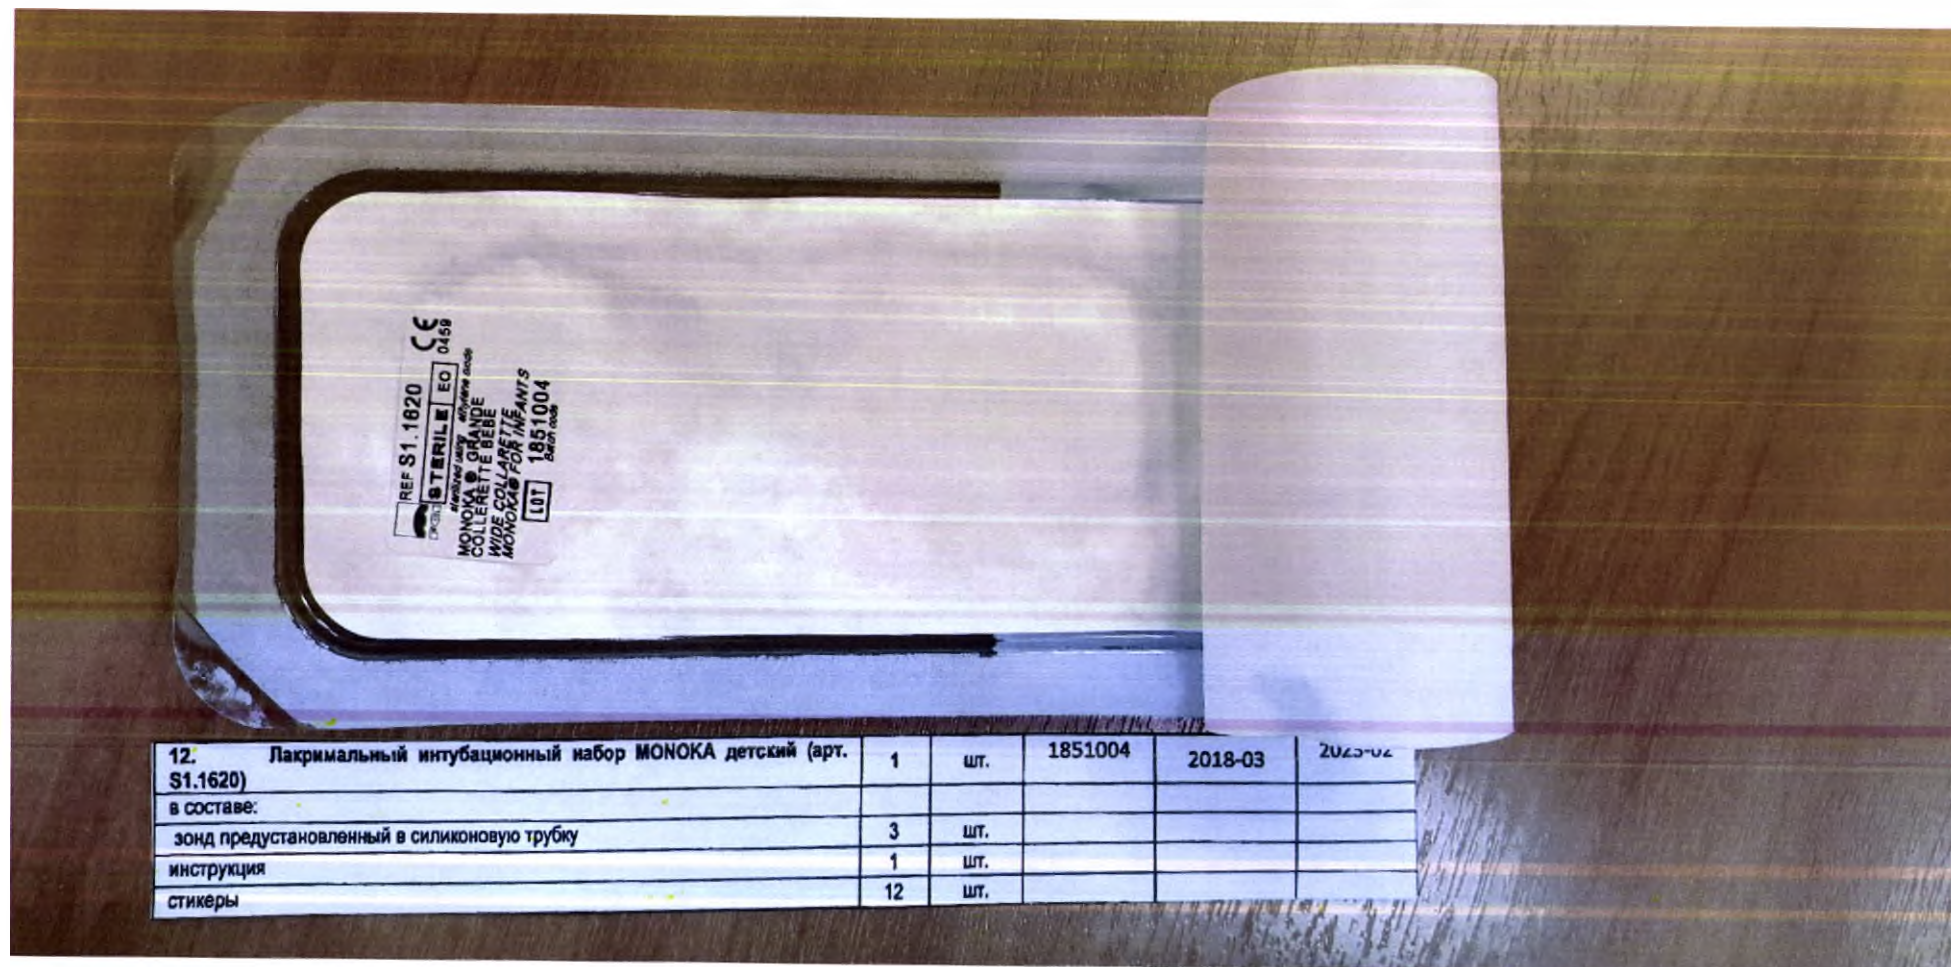


Рисунок 83 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1620

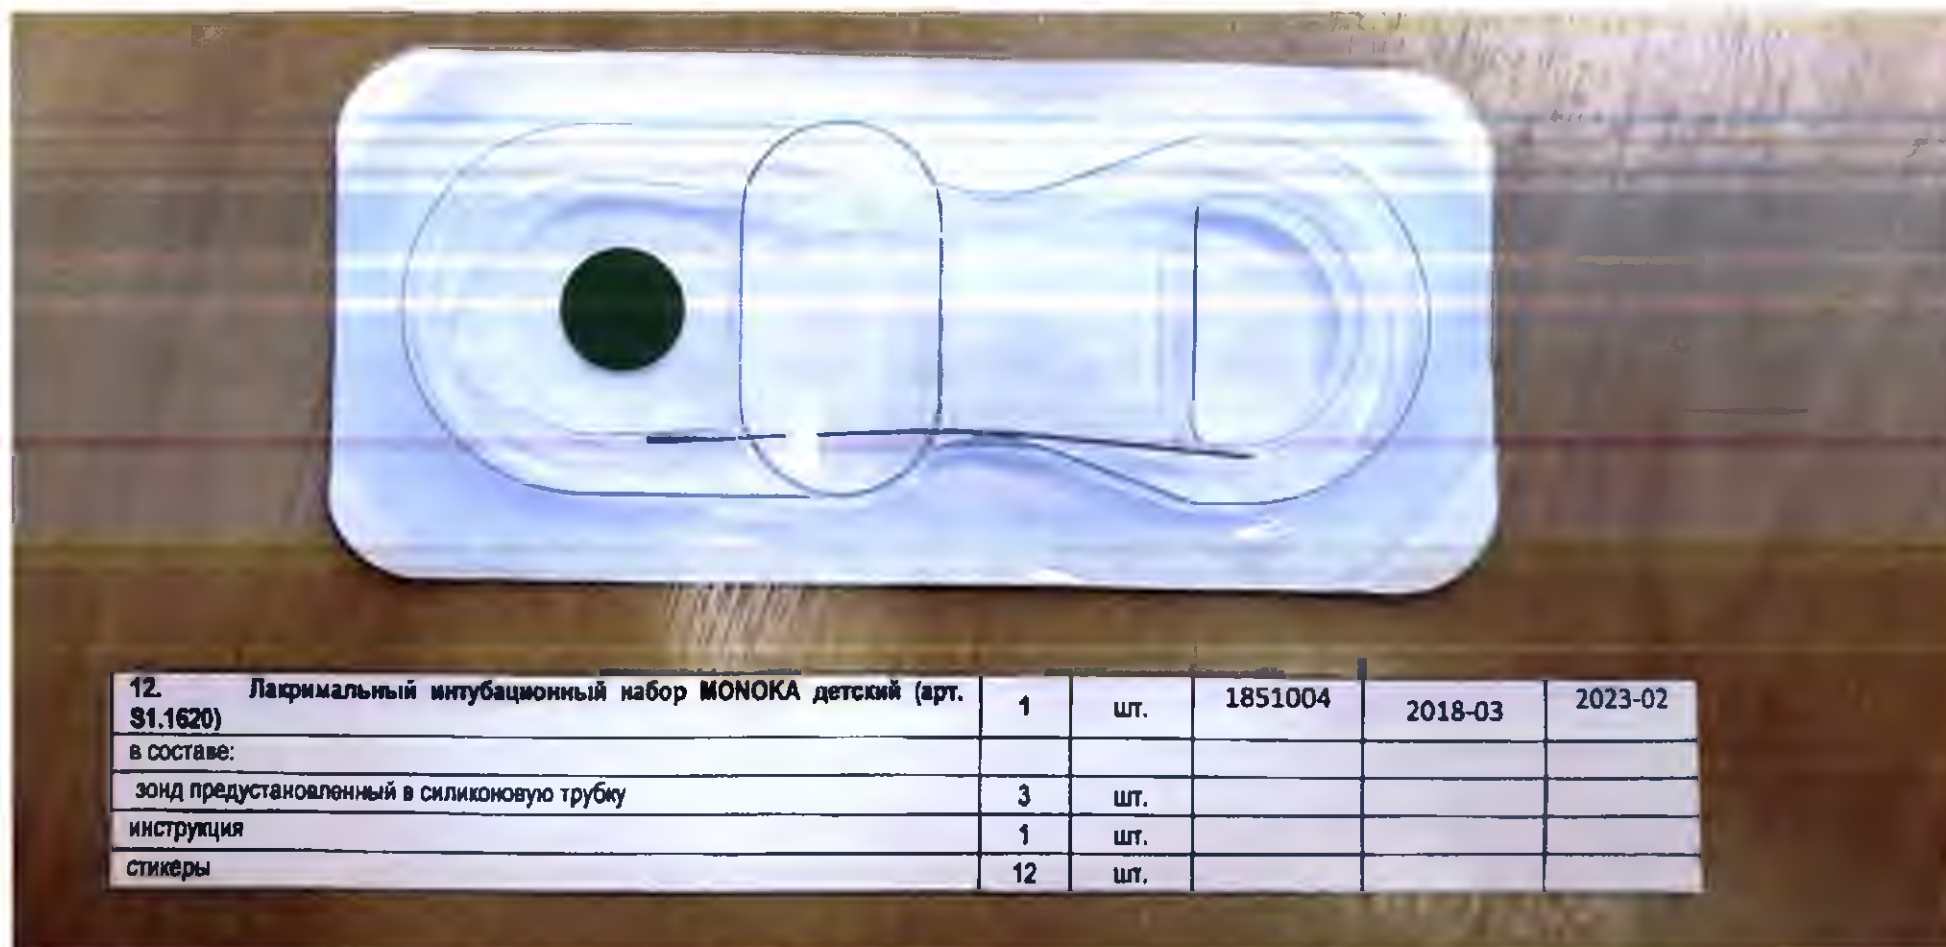


Рисунок 84 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1620

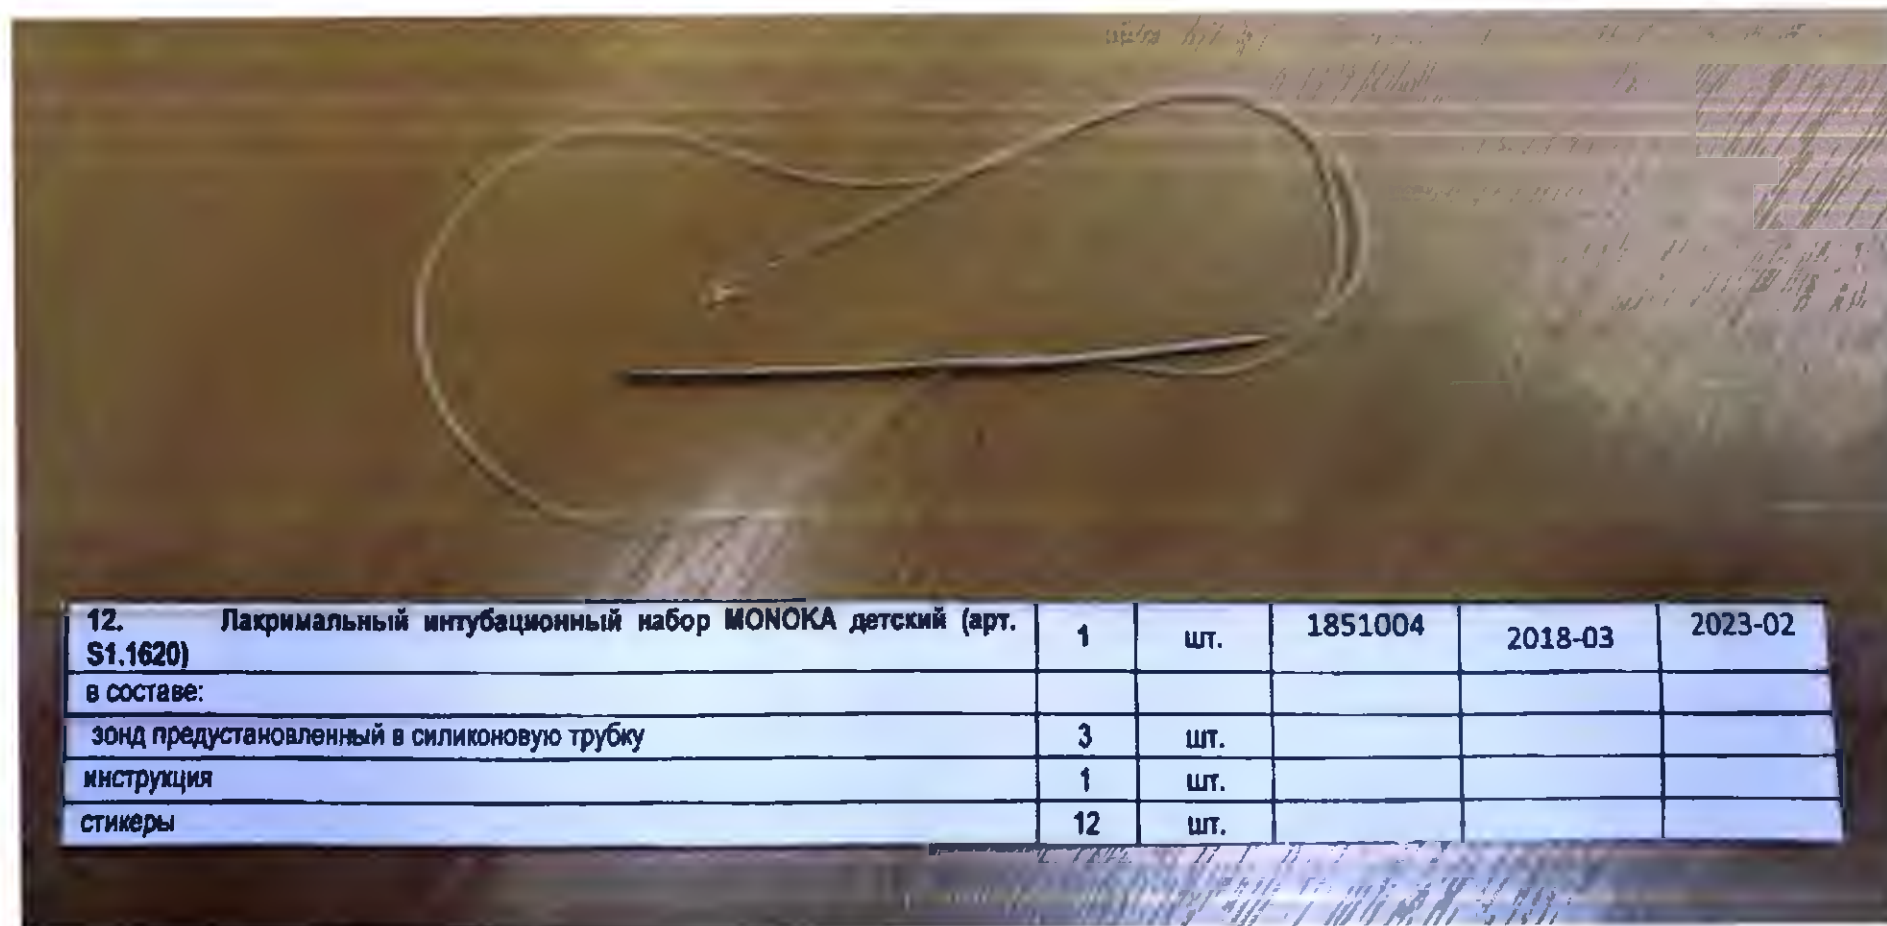


Рисунок 85 – Лакримальный интубационный набор MONOKA детский, арт. S1.1620



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



13.	Параметрический инфракрасный набор MINI MONOKA (арт. S1.1500)	1	шт.	1850520	2018-02	2023-01
в составе:						
	Оптический трюба с загрузкой	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	спинеры	12	шт.			

Рисунок 86 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1500

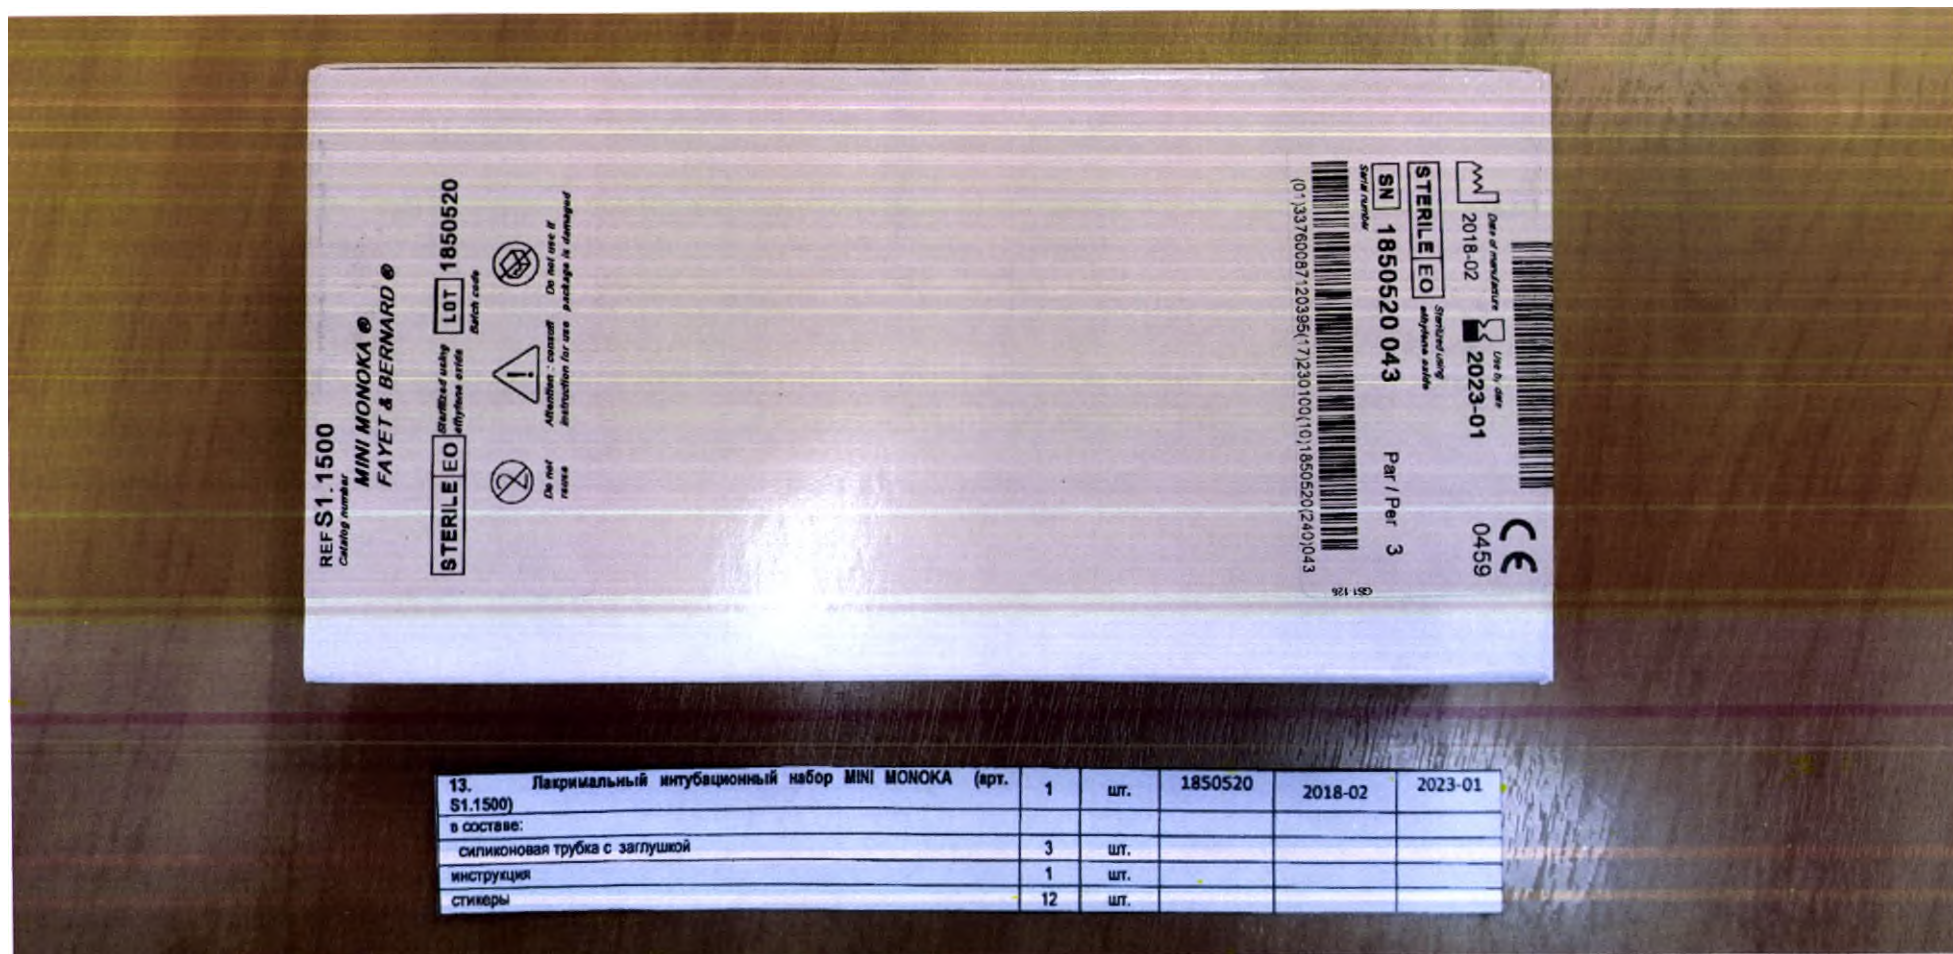


Рисунок 87 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1500



Рисунок 88 – Комплектность арт. S1.1500



13.	Лакричный интубационный набор MINI MONOKA (арт. S1.1500)	1	шт.	1850520	2018-02	2023-01
	в составе:					
	силиконовая трубка с заглушкой	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	12	шт.			

Рисунок 89 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1500

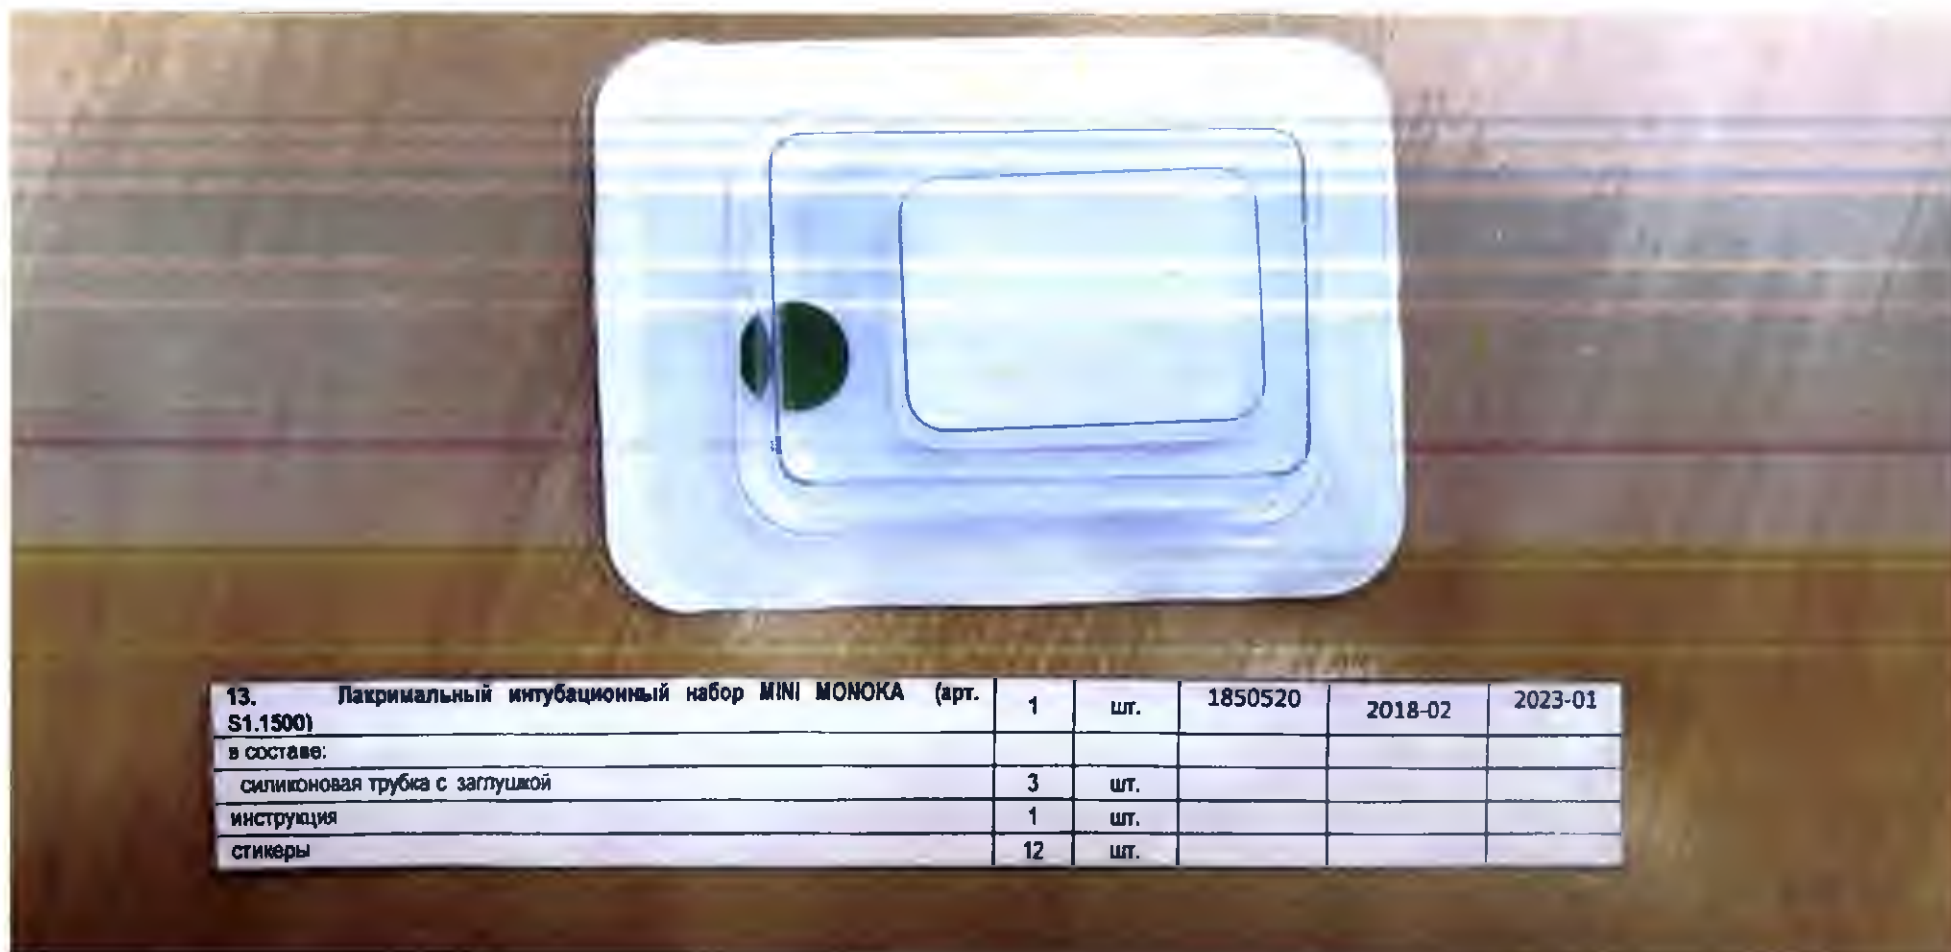


Рисунок 90 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1500

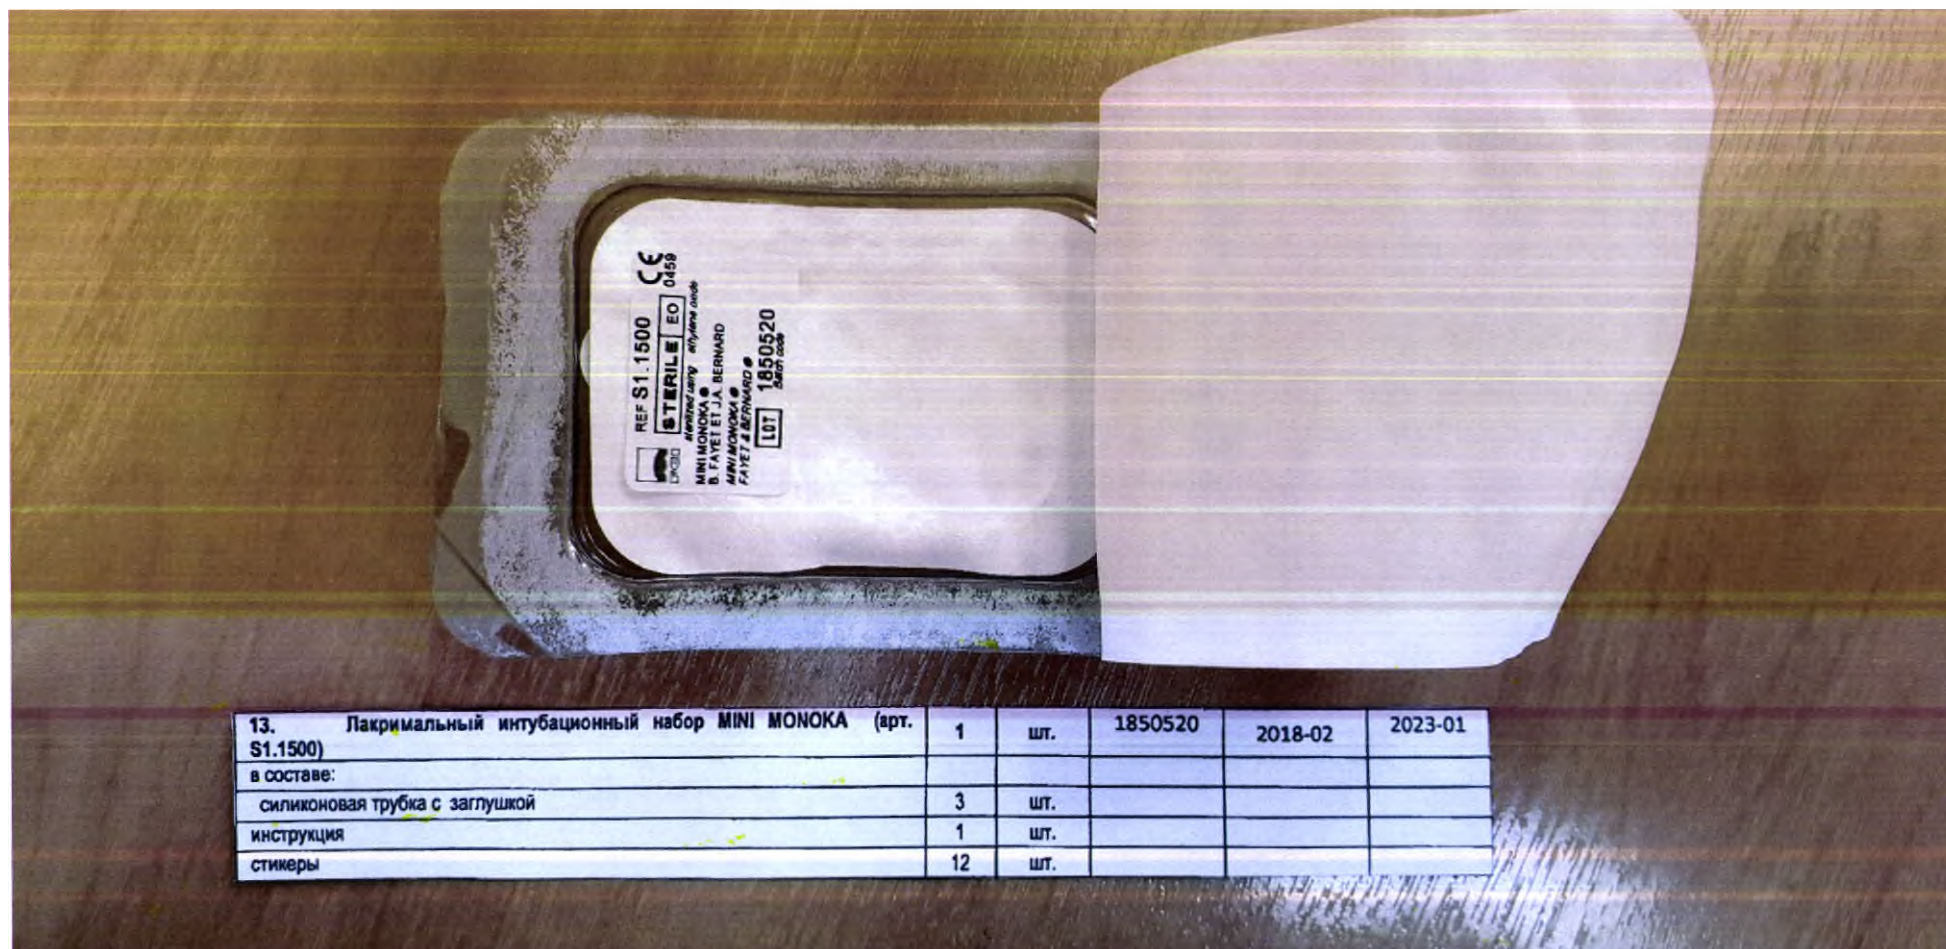


Рисунок 91 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1500



Рисунок 92 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1500

13. Лакримальный интубационный набор MINI MONOKA (арт. S1.1500)						
в составе:	1	шт.	1850520	2018-02	2023-01	
силиконовая трубка с заглушкой	3	шт.				
инструкция	1	шт.				
стикеры	12	шт.				

Рисунок 93 – Лакримальный интубационный набор MINI MONOKA, арт. S1.1500

Рисунок 94 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1520



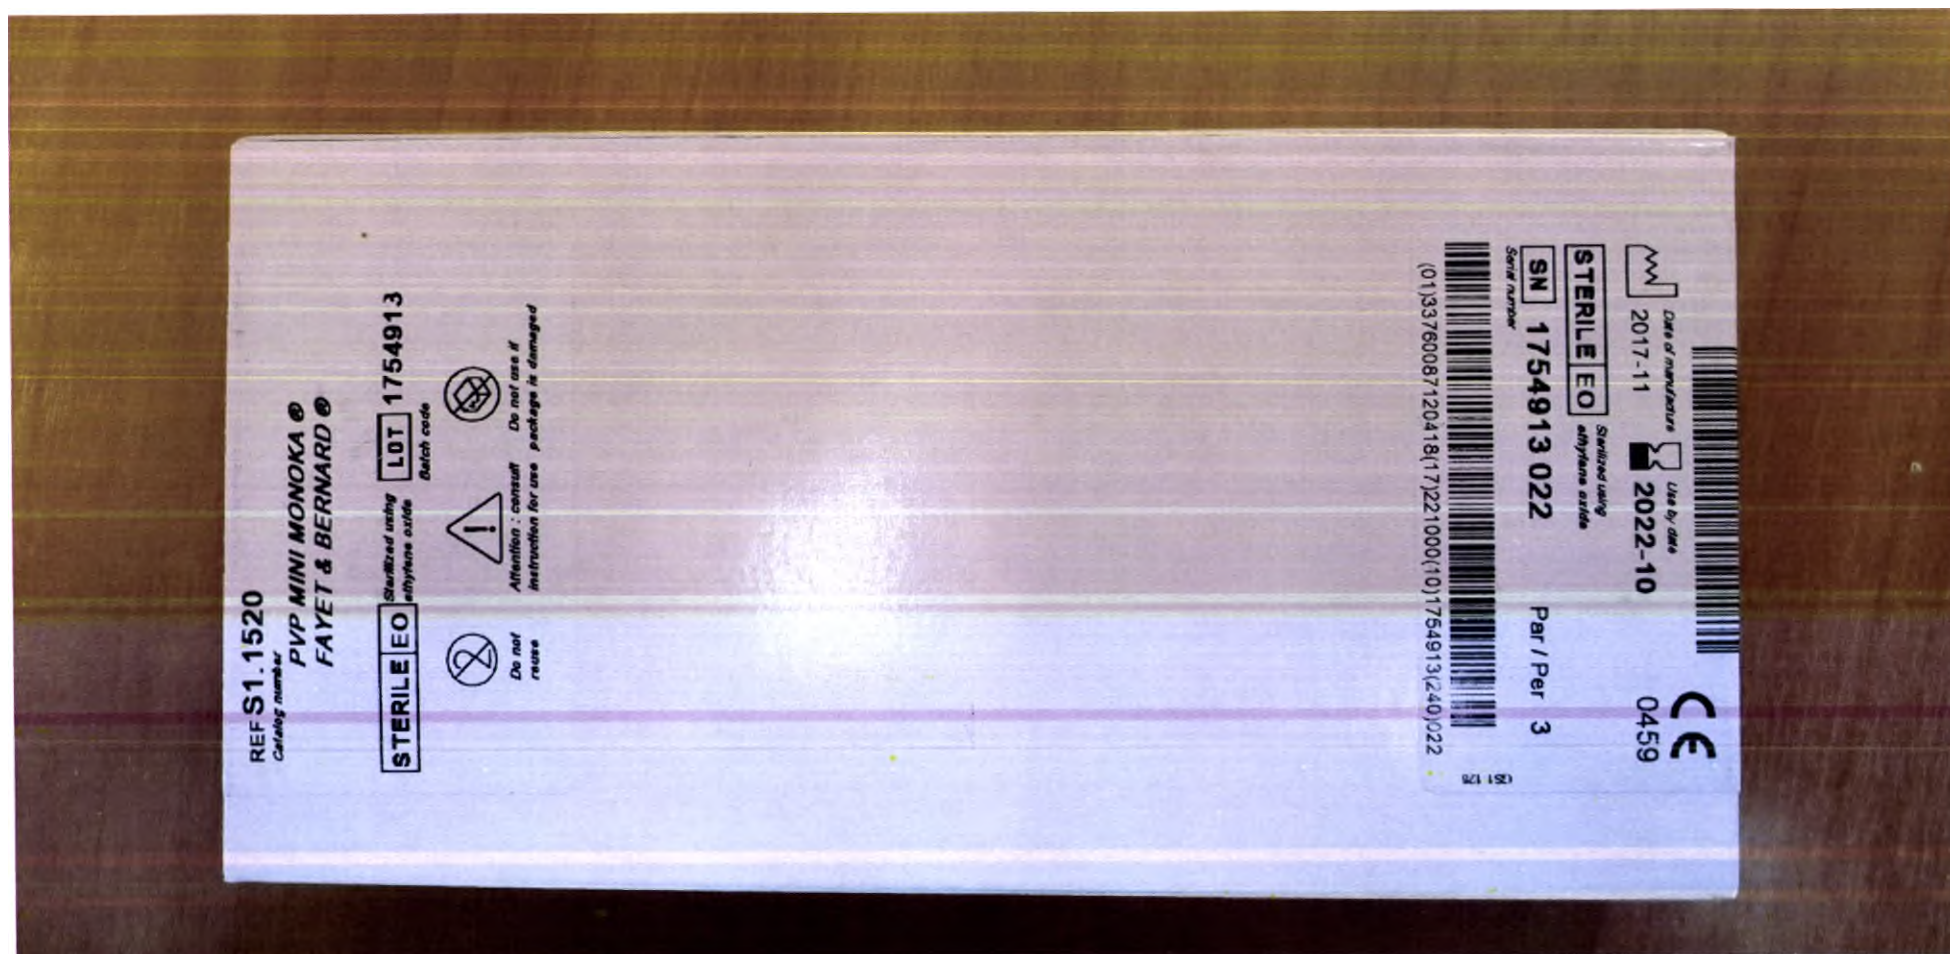


Рисунок 95 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1520

Рисунок 96 – Комплектность арт. S1.1520





REF S1.1520

Catalog number

MINI MONOKA ® PVP



B. FAYET ET J.A. BERNARD

CE
0459

Ne pas utiliser si la pastille n'est pas VERTE
Do not use if dot is not GREEN



Date of manufacture

2017-11



Use by date

2022-10



Do not use if
package is damaged

STERILE EO

sterilized using
ethylene oxide



Do not
reuse



Attention : consult
instruction for use

LOT

1754913

Batch code



(01)03760087120417(17)221000(10)1754913

CS1 128

Vérifier l'intégrité
du protecteur
individuel de stérilité
avant usage.
Dispositif à usage unique.
Ne pas restériliser.
Détruire après usage.

Content sterile
unless package
has been opened
or damaged.
Single use.
Do not resterilize.
Destroy after use.

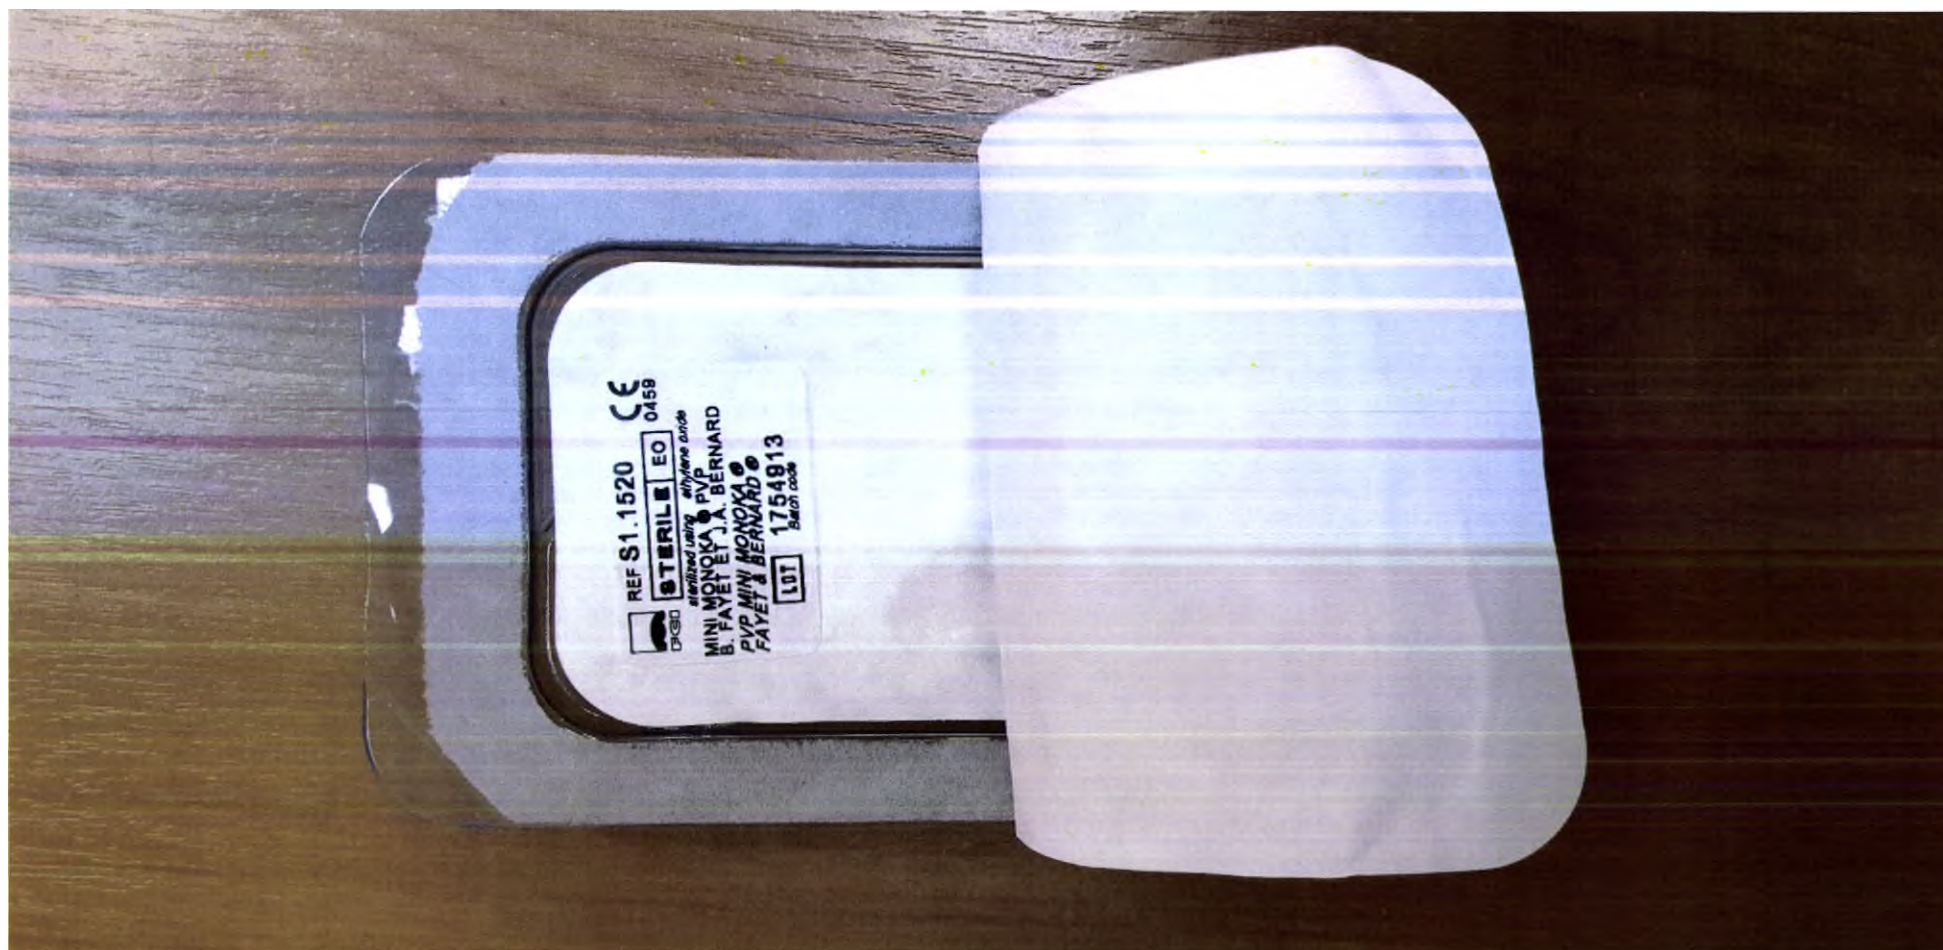


Рисунок 98 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1520

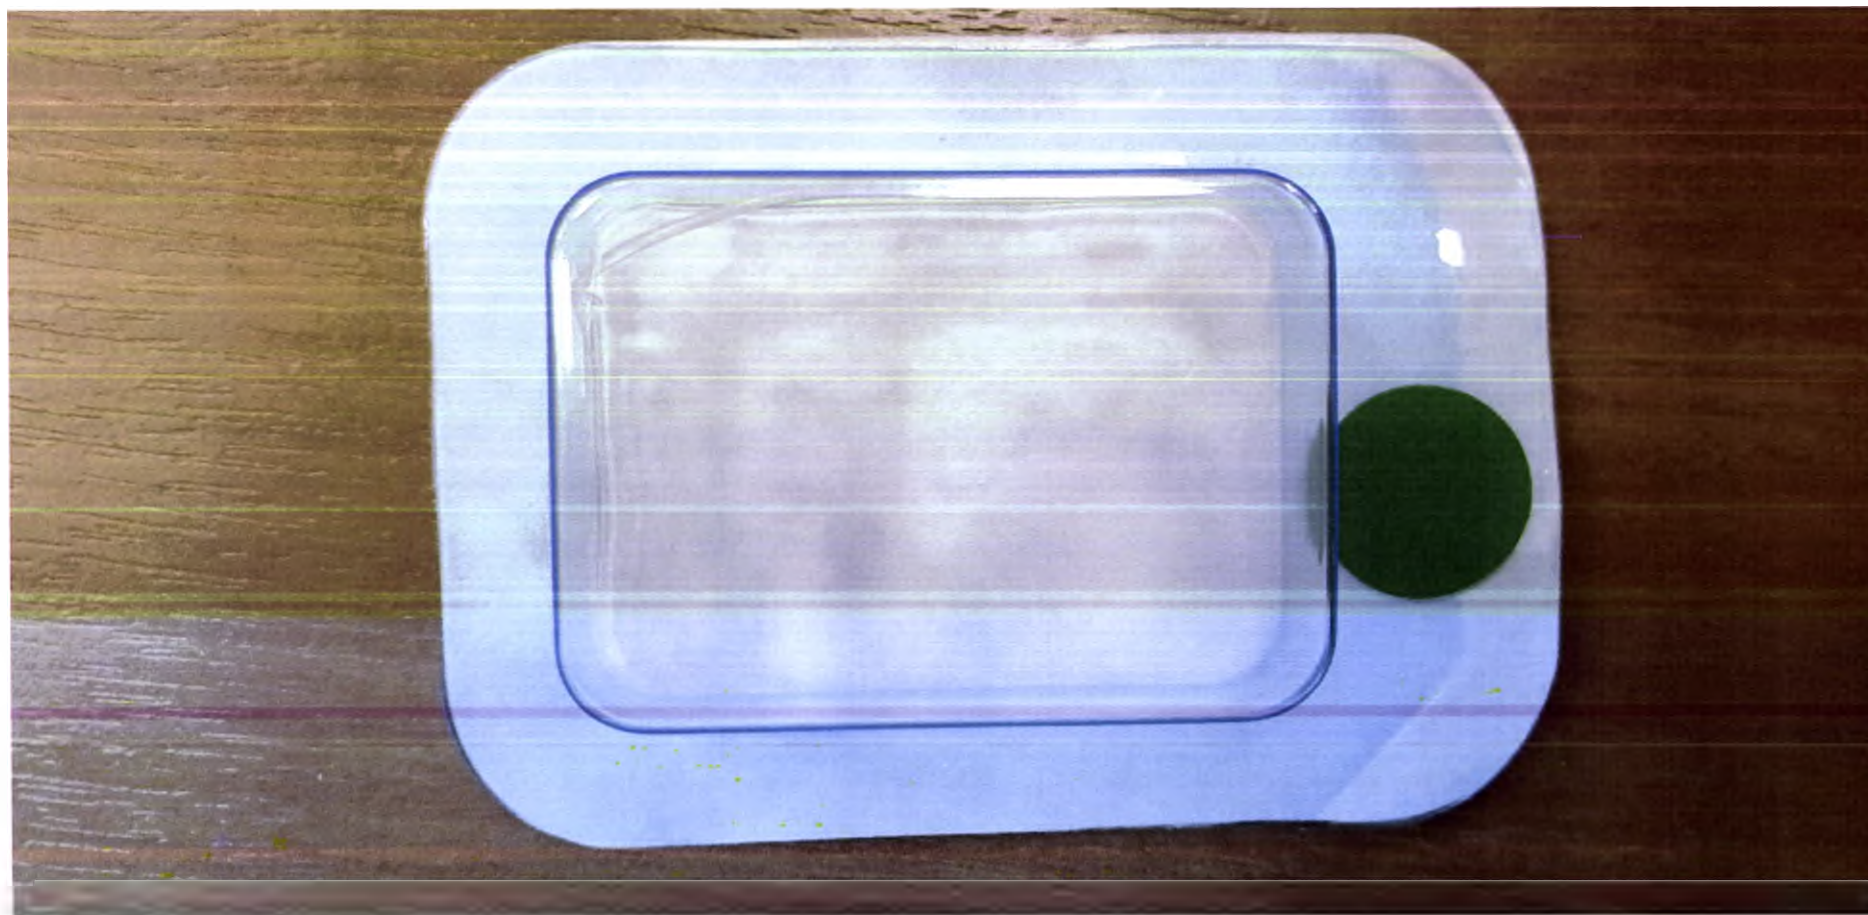


Рисунок 99 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1520



14. Лакримальный интубационный набор MINI MONOKA с PVP покрытием (арт. S1.1520)	1	шт.	1754913	2017-11	2022-10
в составе:					
силиконовая трубка с заглушкой	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			

Рисунок 100 – Лакримальный интубационный набор MINI MONOKA с PVP покрытием, арт. S1.1520



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



15.	Патриальный интубационный набор с автомобильским	1	шт.	1851296	2018-04	2023-03
	продаваемый под названием по Регистру (арт. S1.1800)					
	в составе:					
	зонд широкий с силиконовой трубкой	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стерильный	12	шт.			

Рисунок 101 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1800

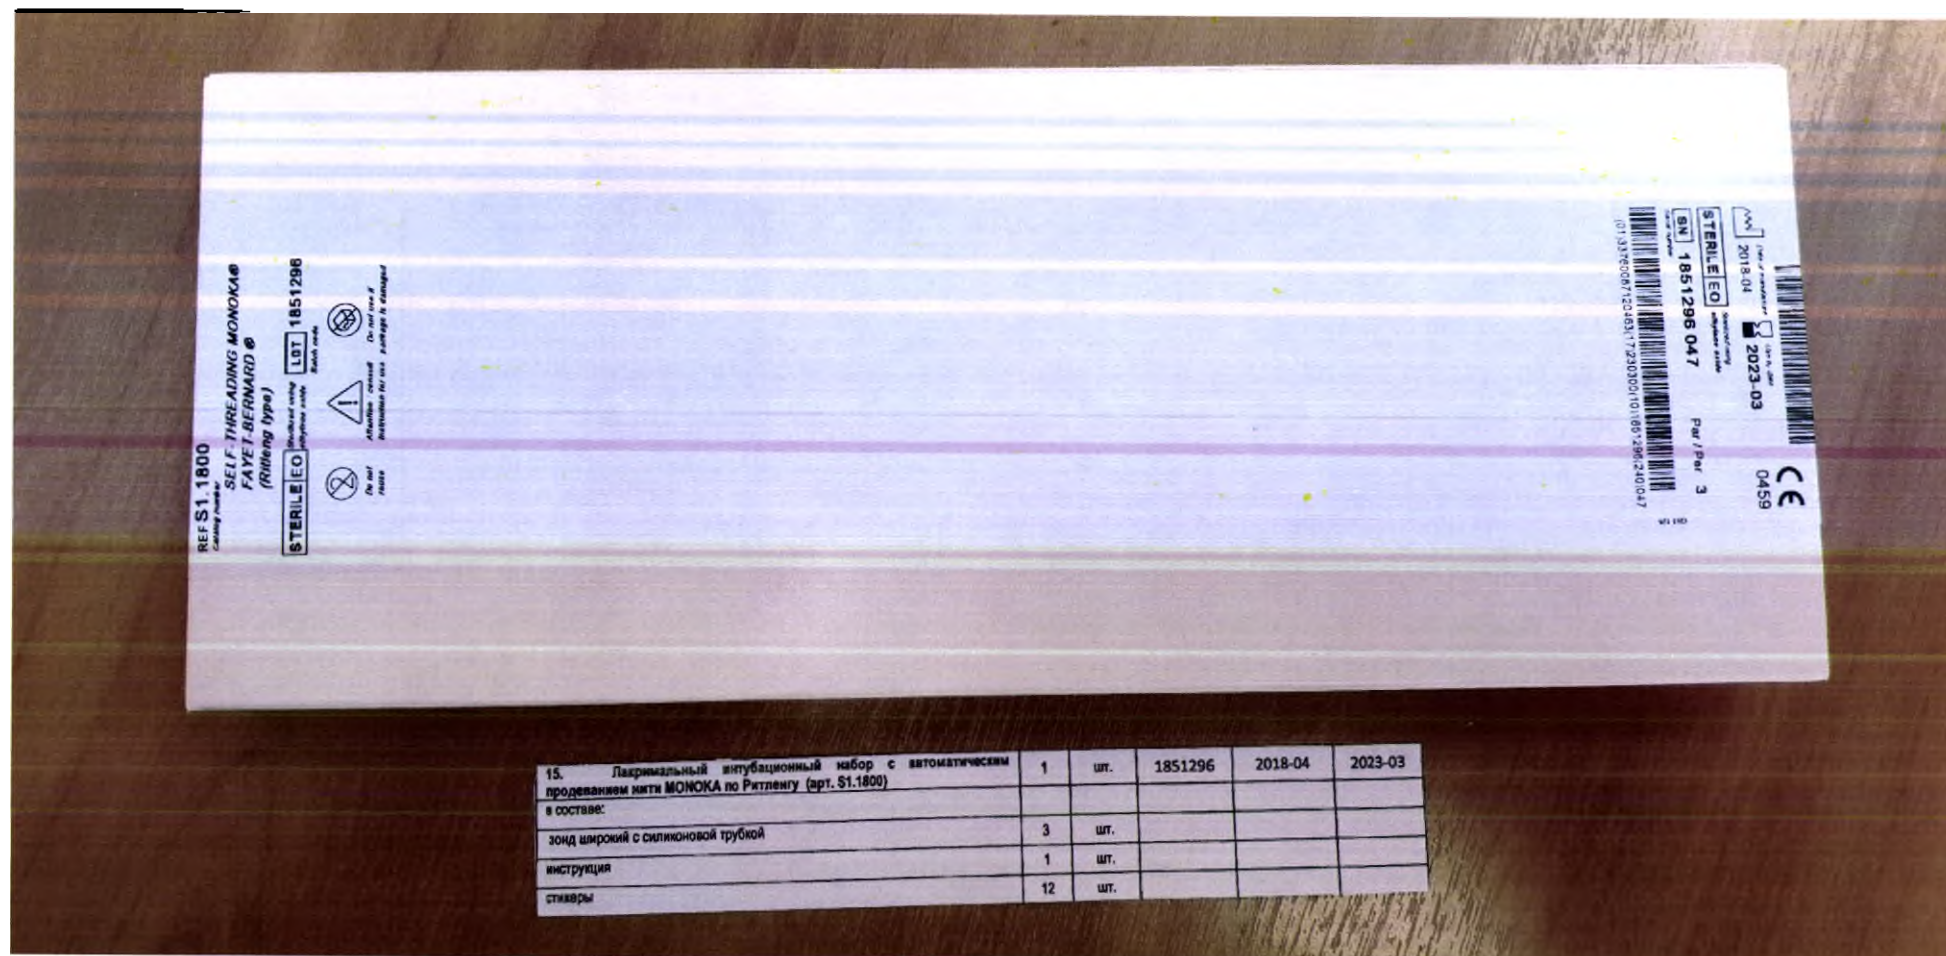


Рисунок 102 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1800



Рисунок 103 – Комплектность арт. S1.1800



15. Лагрималъный интубационный набор с автоматическим продавливанием нити MONOKA по Ритленгу (арт. S1.1800)	1	шт.	1851296	2018-04	2023-03
в составе:					
зонд широкий с силиконовой трубкой	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стимулы	12	шт.			

Рисунок 104 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1800

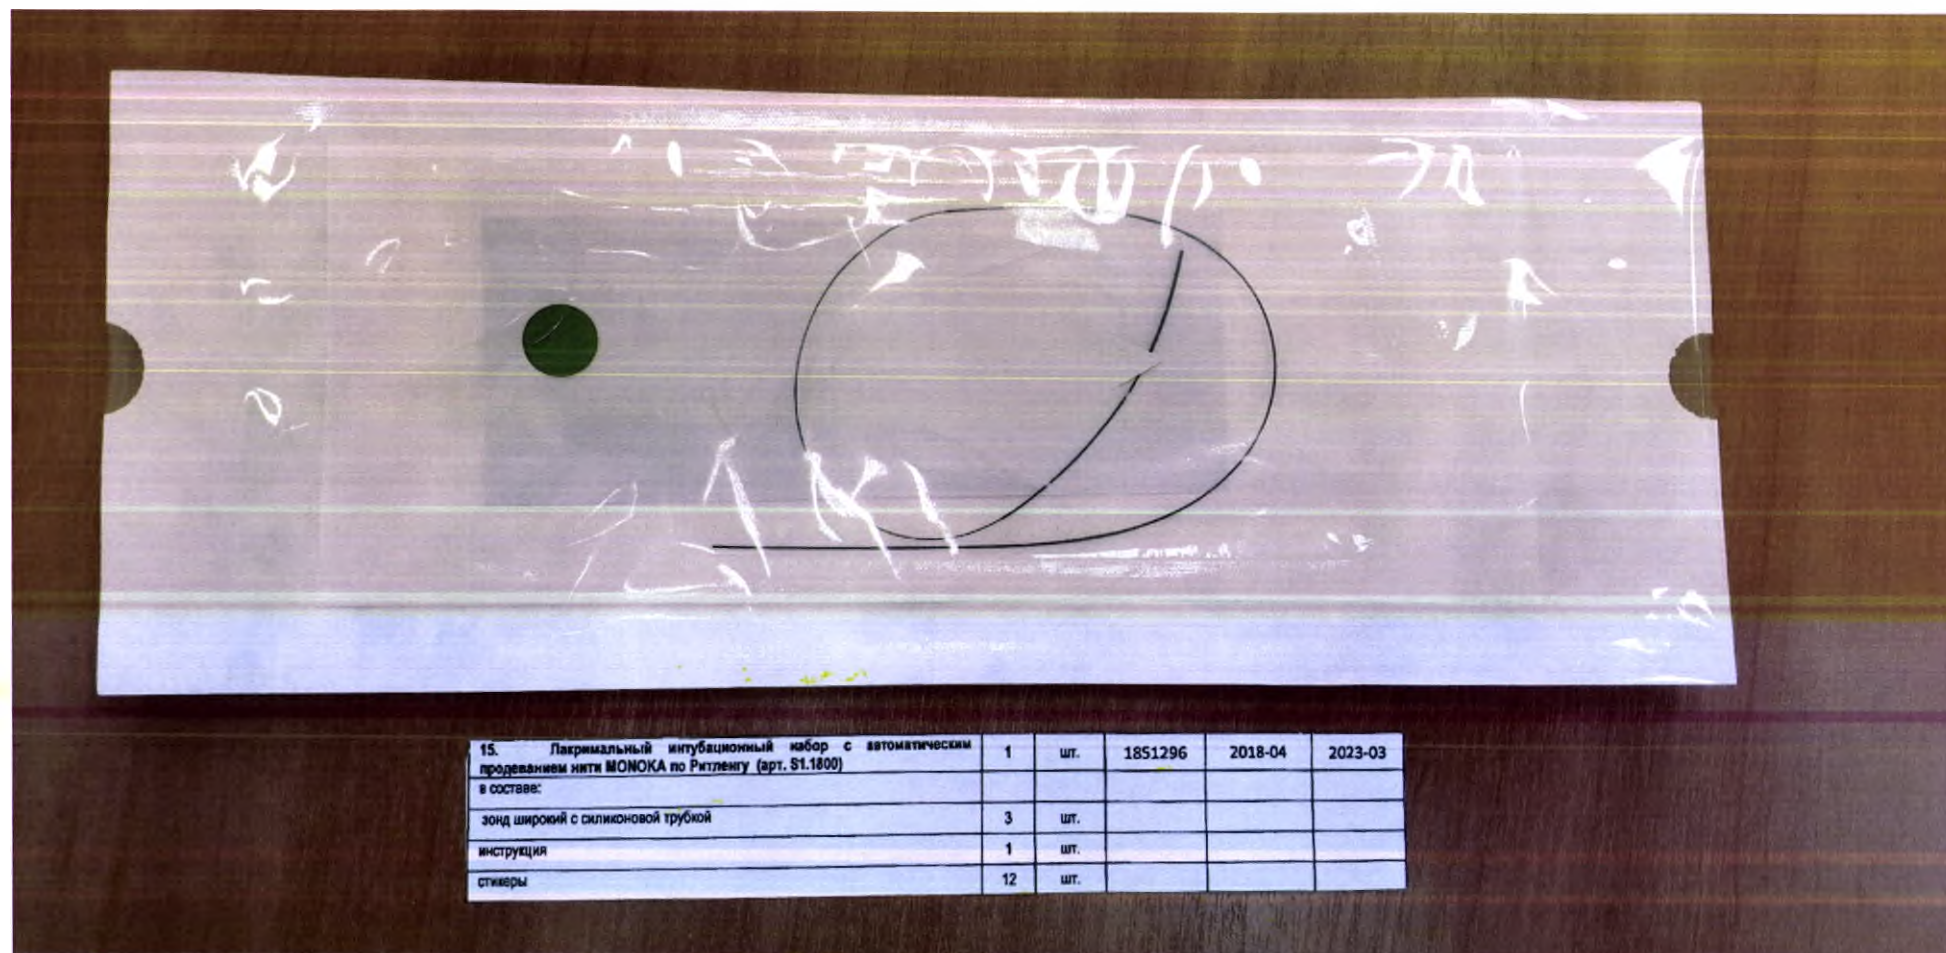


Рисунок 105 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1800

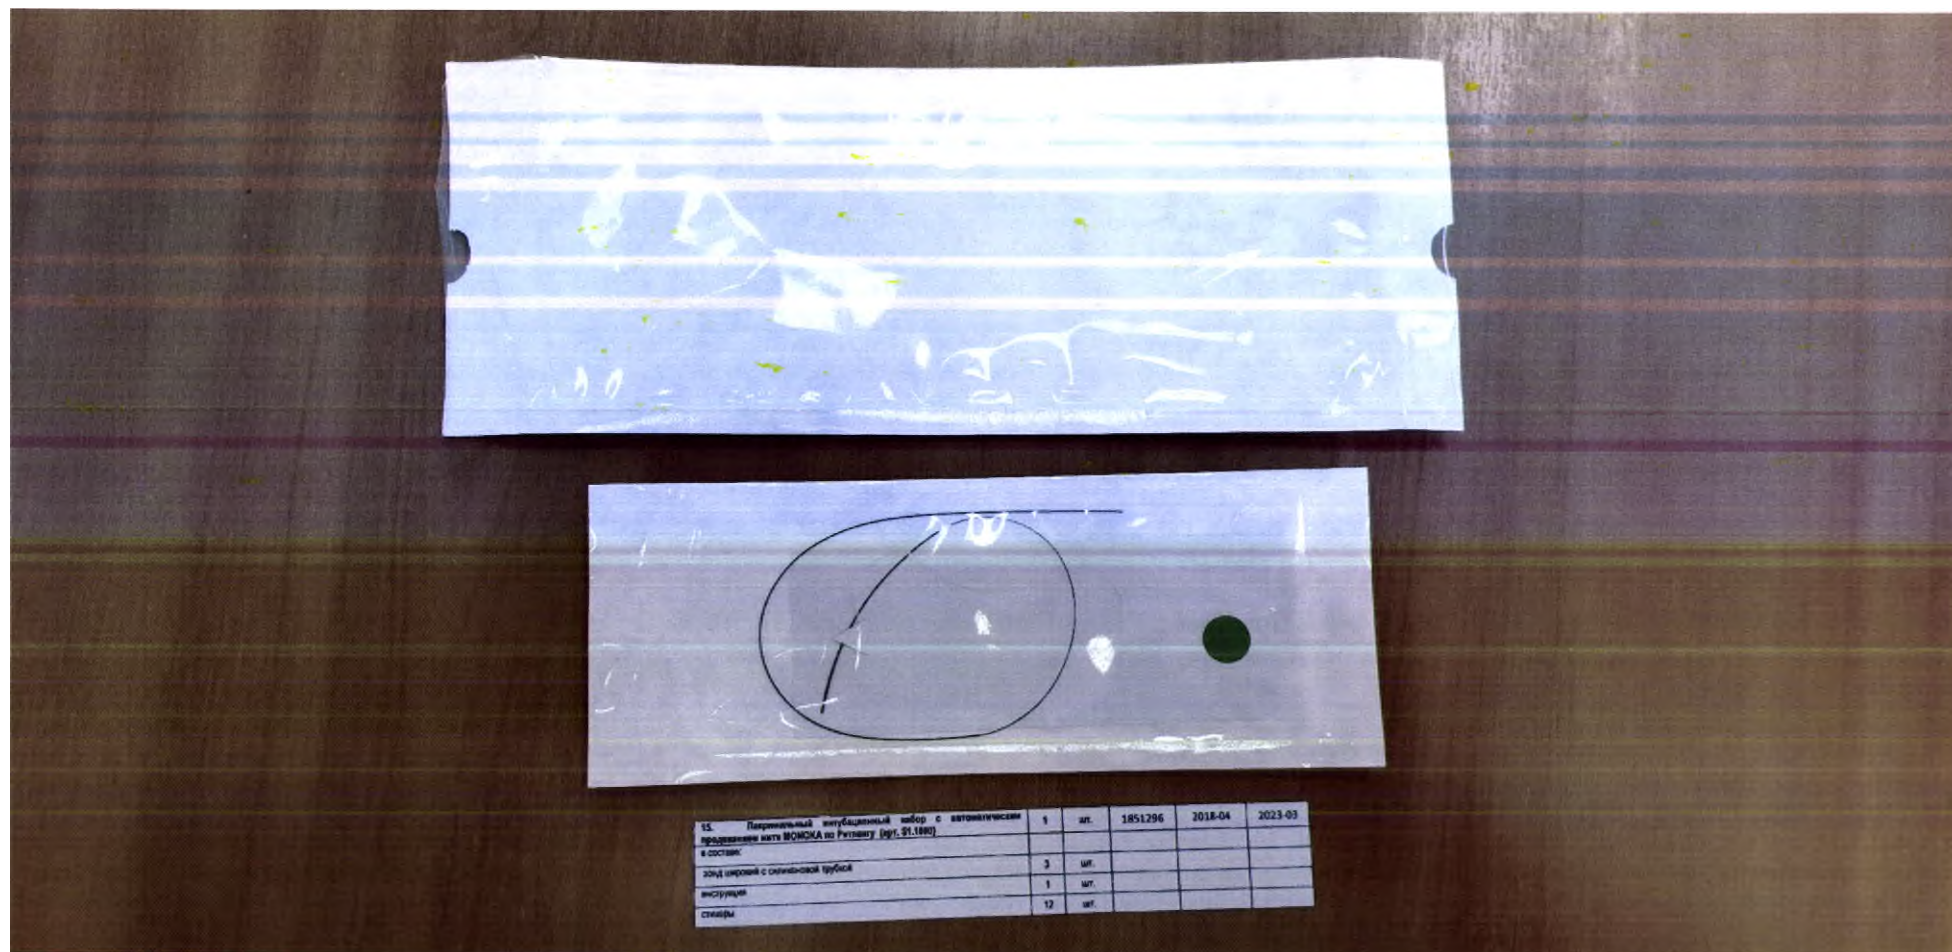


Рисунок 106 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1800



Рисунок 107 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1800

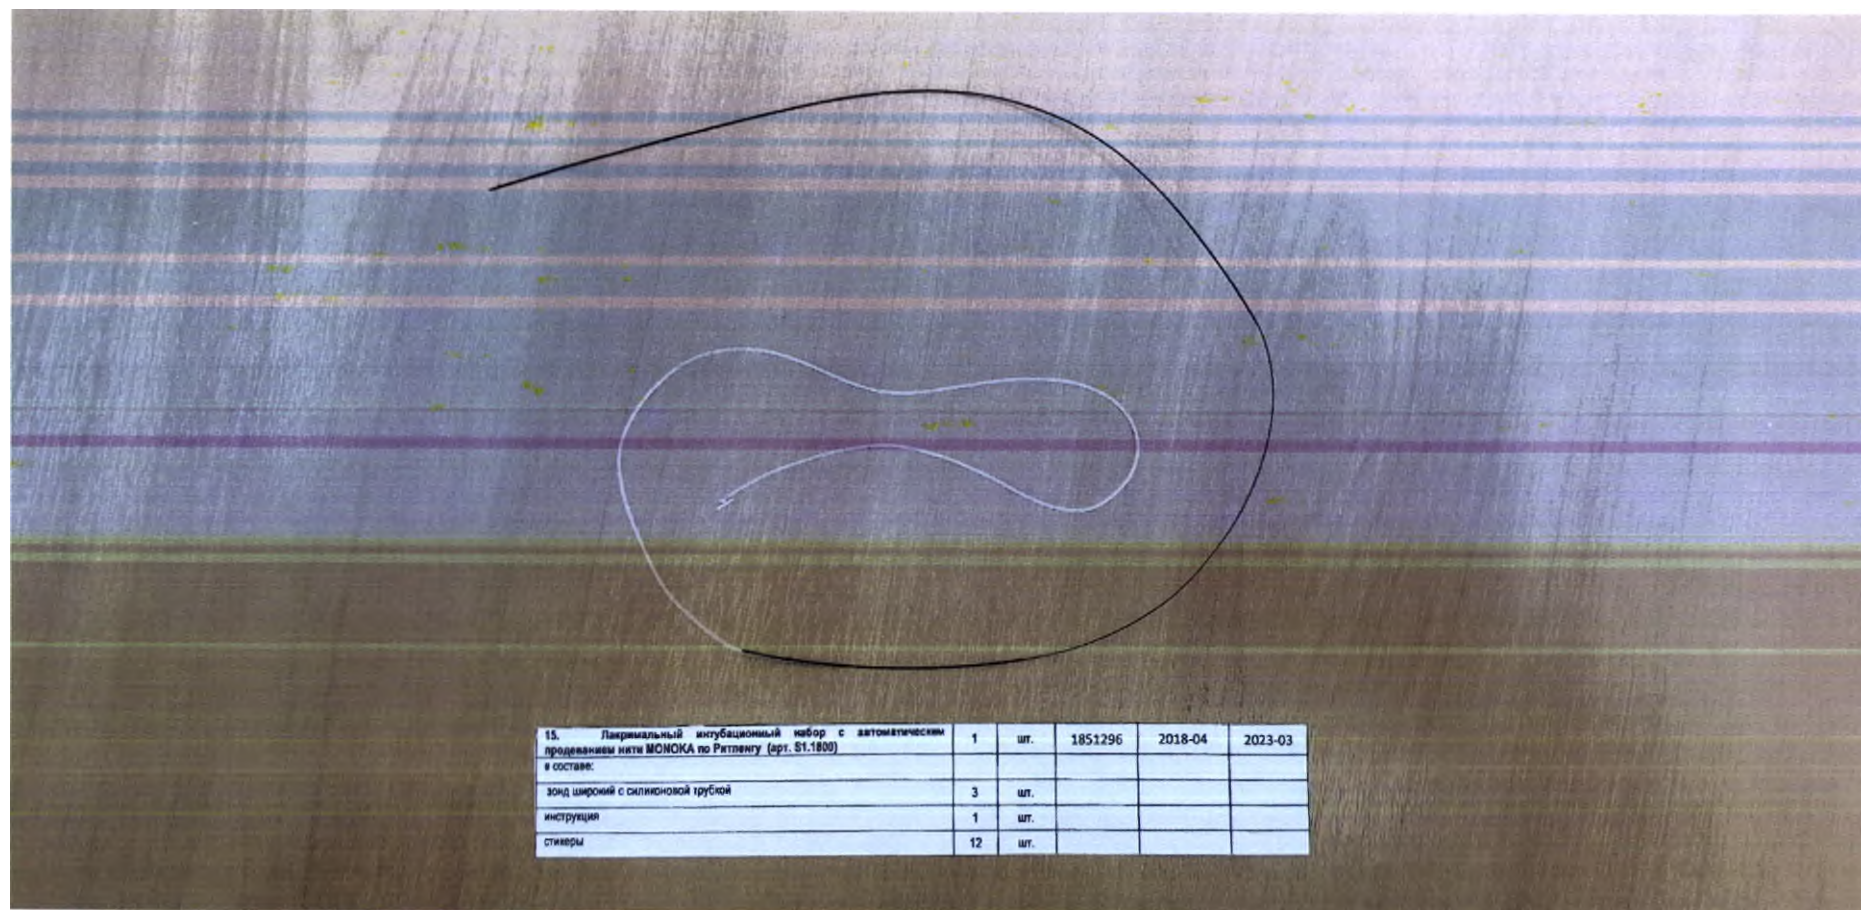


Рисунок 108 – Лакримальный интубационный набор с автоматическим продеванием нити MONOKA по Ритленгу, арт. S1.1800



FCI S.A.S.

20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS

30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



16.	Разрешительный информационный набор с автомобильными	1	шт.	1850140	2018-01	2022-12
в составе:						
	Зонд, средний с силиконовой трубкой	3	шт.			
	Инструкция	1	шт.			
	Стекла	12	шт.			

Рисунок 109 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1810

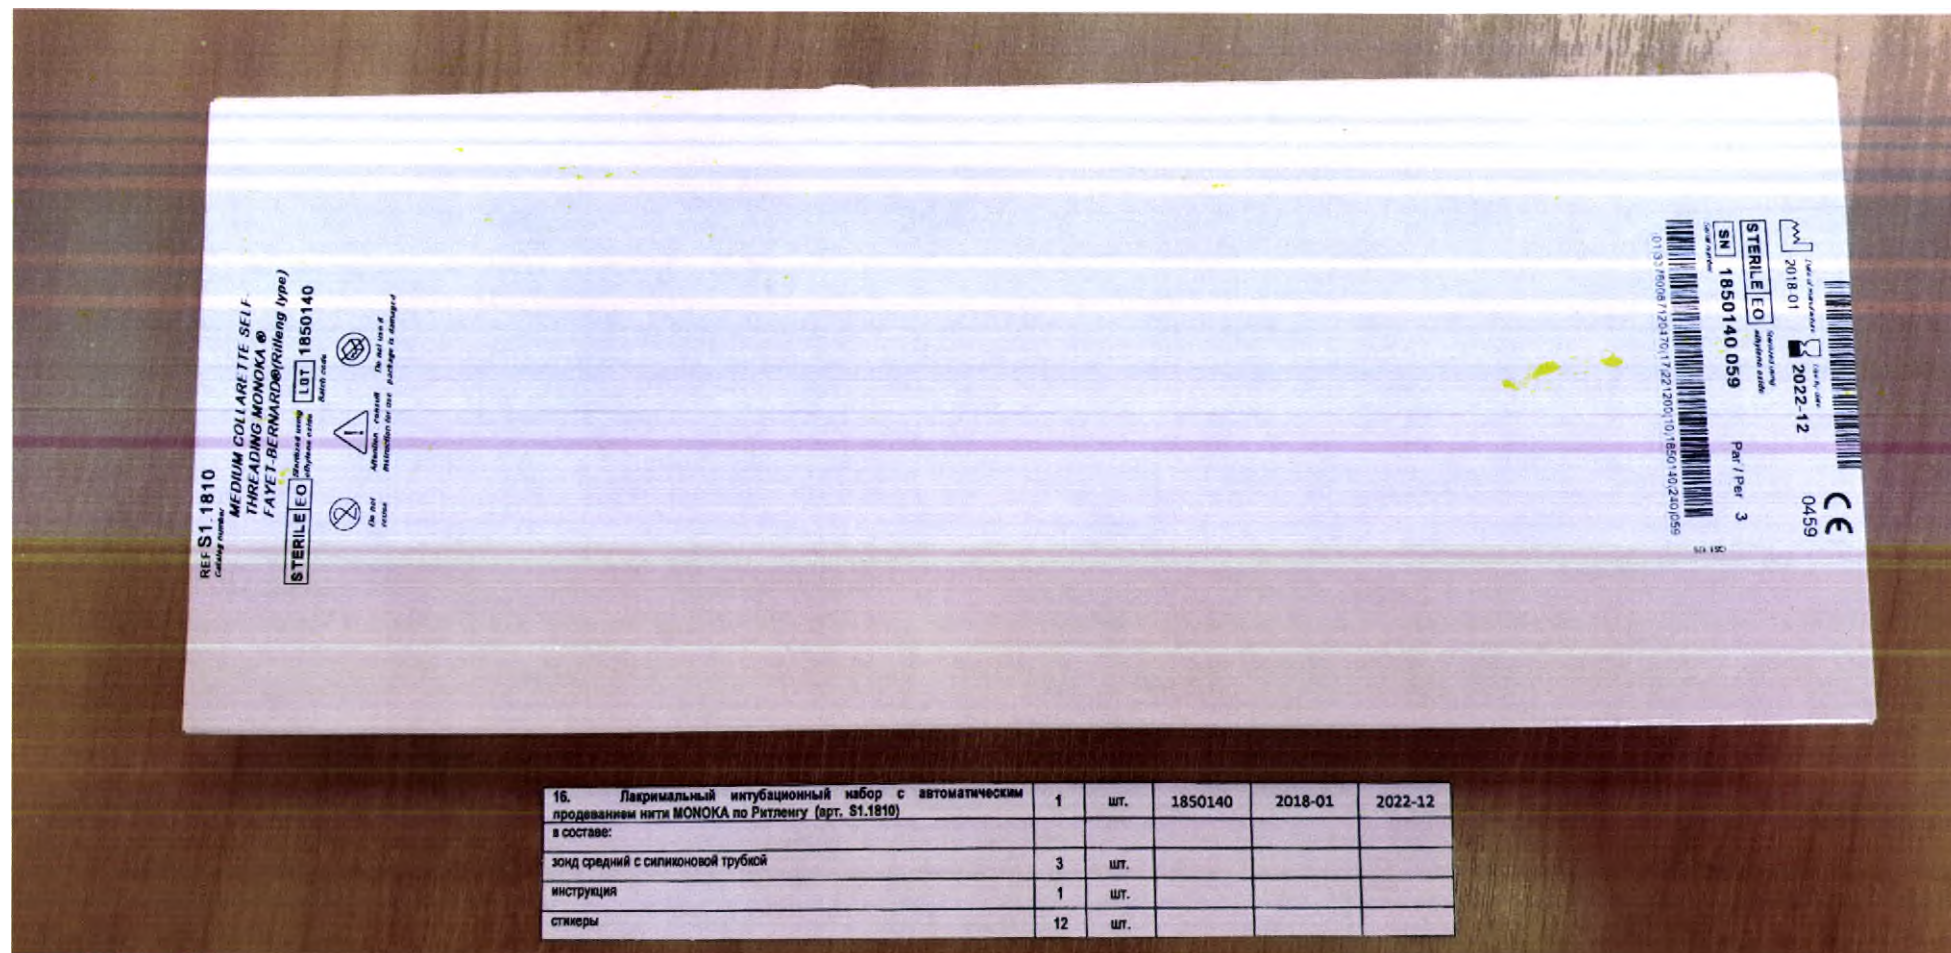


Рисунок 110 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1810



Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.
Dispositif à usage unique.
Ne pas re-stériliser.

Verify integrity of each sterility protection before use.
Single use.
Do not re-sterilize.



REF S1.1810

Order number
MONOKA® DE FAYET-
BERNARD® MOYENNE

COLLERETTE (Technique de Ritteng)

Ne pas utiliser si la pastille n'est pas VERTE
Do not use if dot is not GREEN



Date of manufacture
2018-01



Use by date
2022-12



STERILE EO

sterilized using
ethylene oxide



LOT 1850140

Batch code



Do not
reuse



Attention: consult
instruction for use

CE
0459



(01)03780087120479(17)221200(10)1850140

16. Лагримальный интубационный набор с автоматическим продавливанием нити MONOKA по Ритленгу (арт. S1.1810)	1	шт.	1850140	2018-01	2022-12
в составе:					
зонд средний с силиконовой трубкой	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			

Рисунок 112 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1810



Рисунок 113 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1810

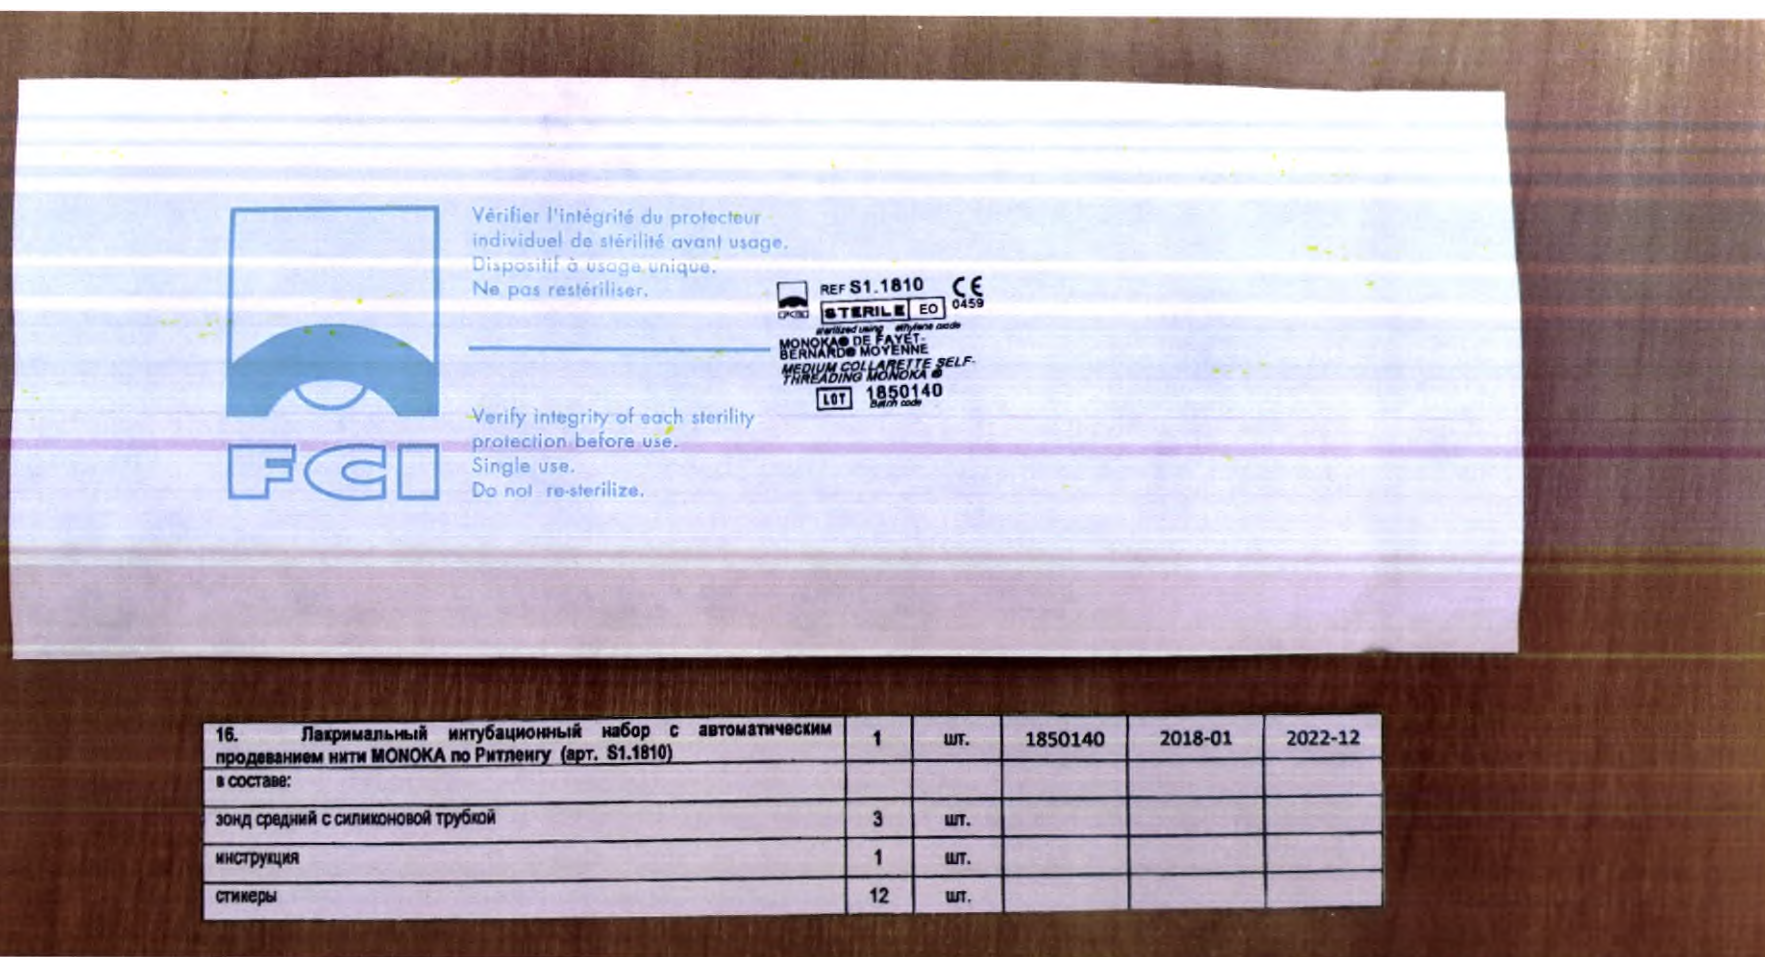


Рисунок 114 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1810

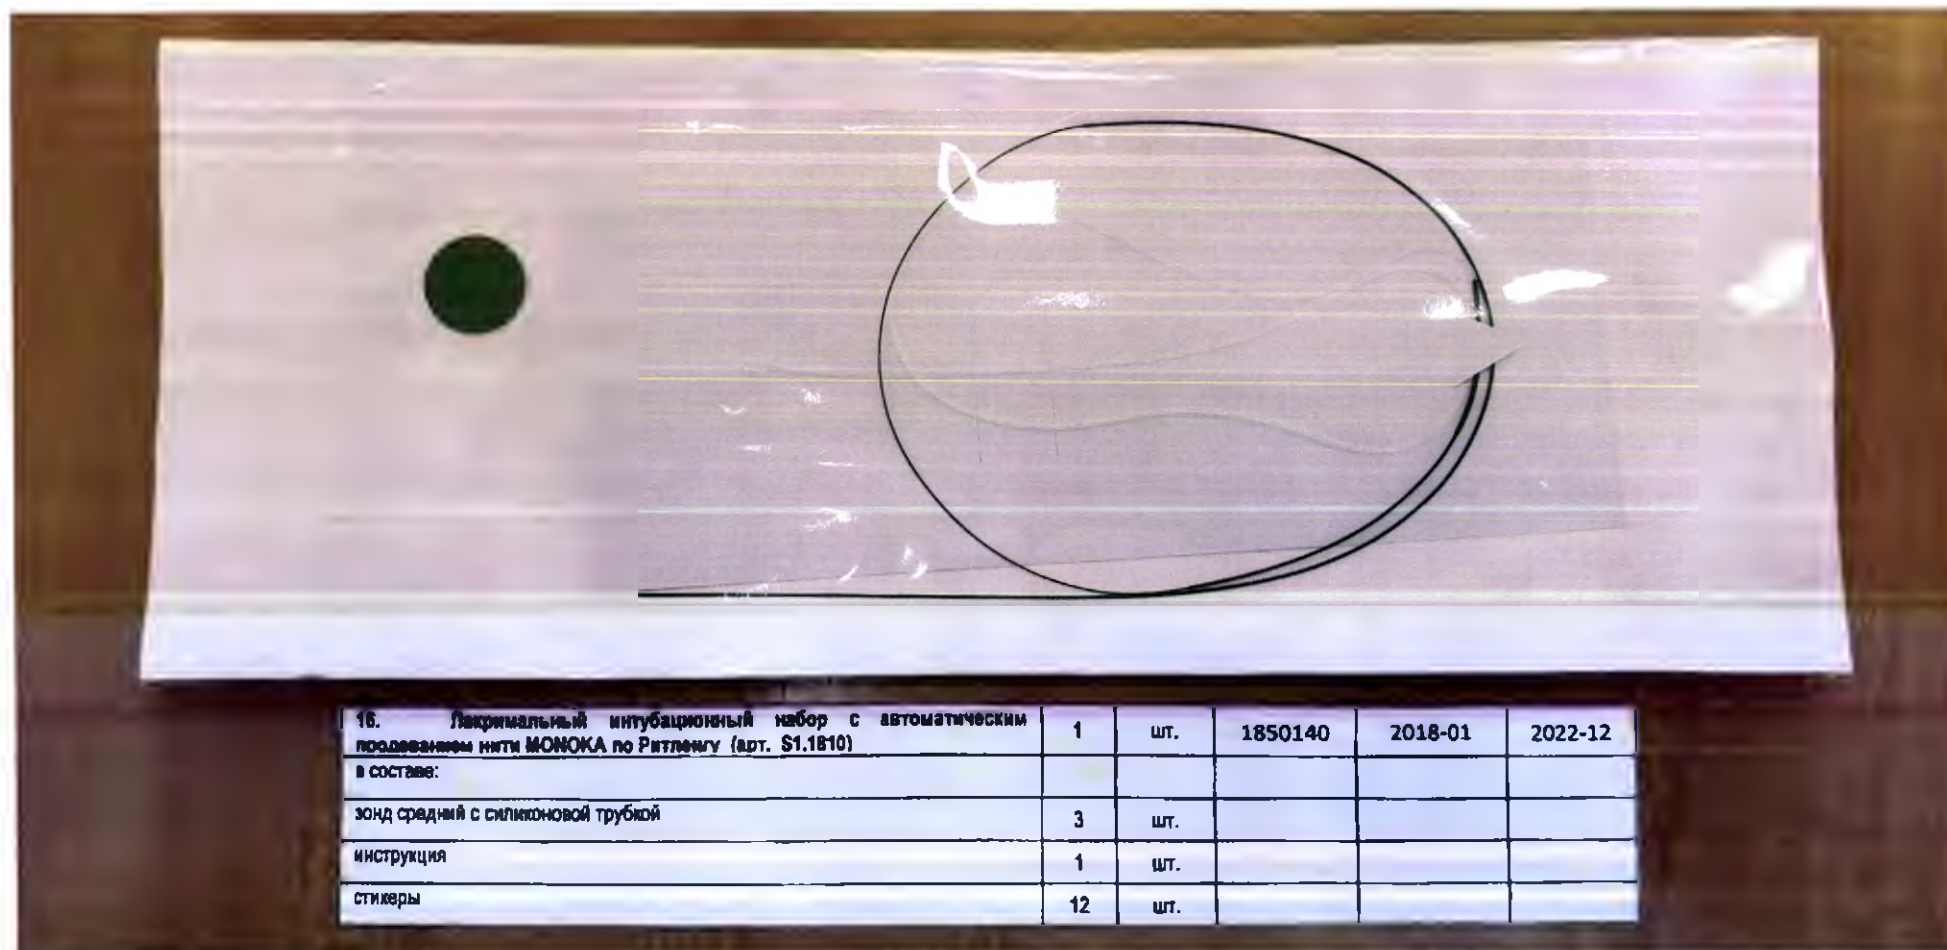


Рисунок 115 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1810

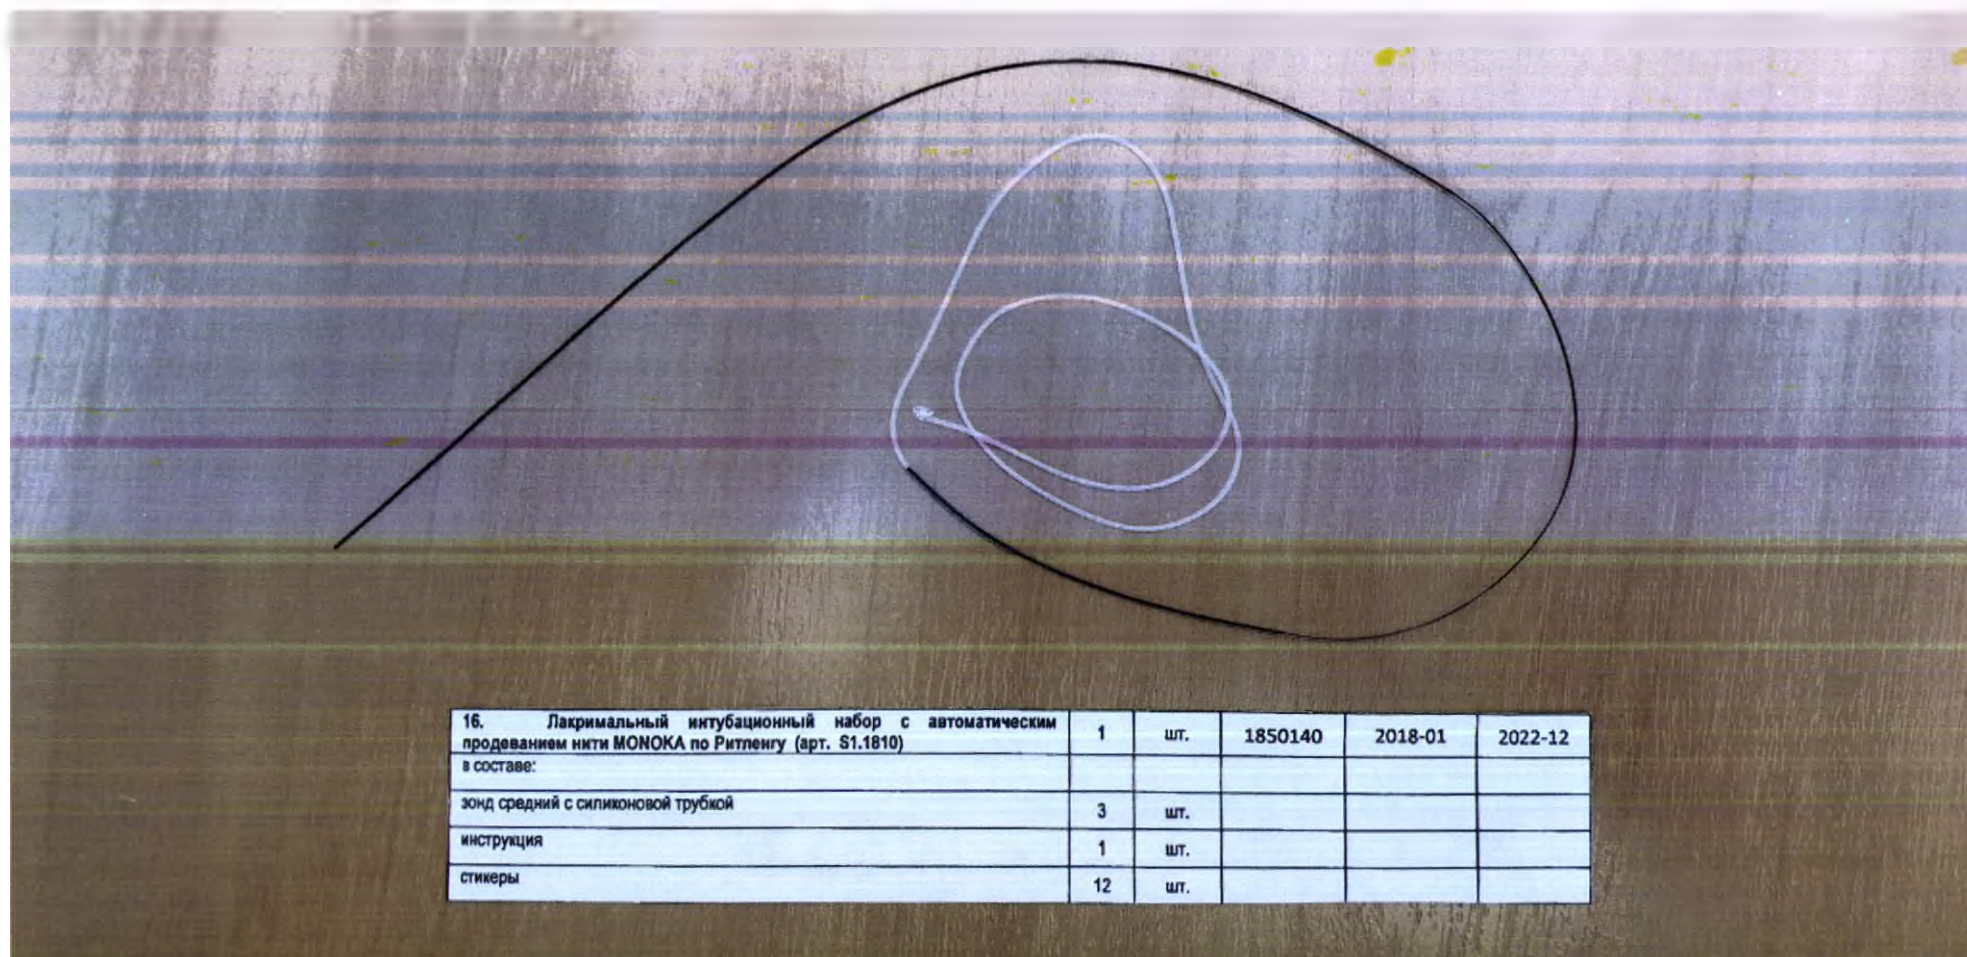


Рисунок 116 – Лакримальный интубационный набор с автоматическим продавливанием нити MONOKA по Ритленгу, арт. S1.1810



Рисунок 117 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1820

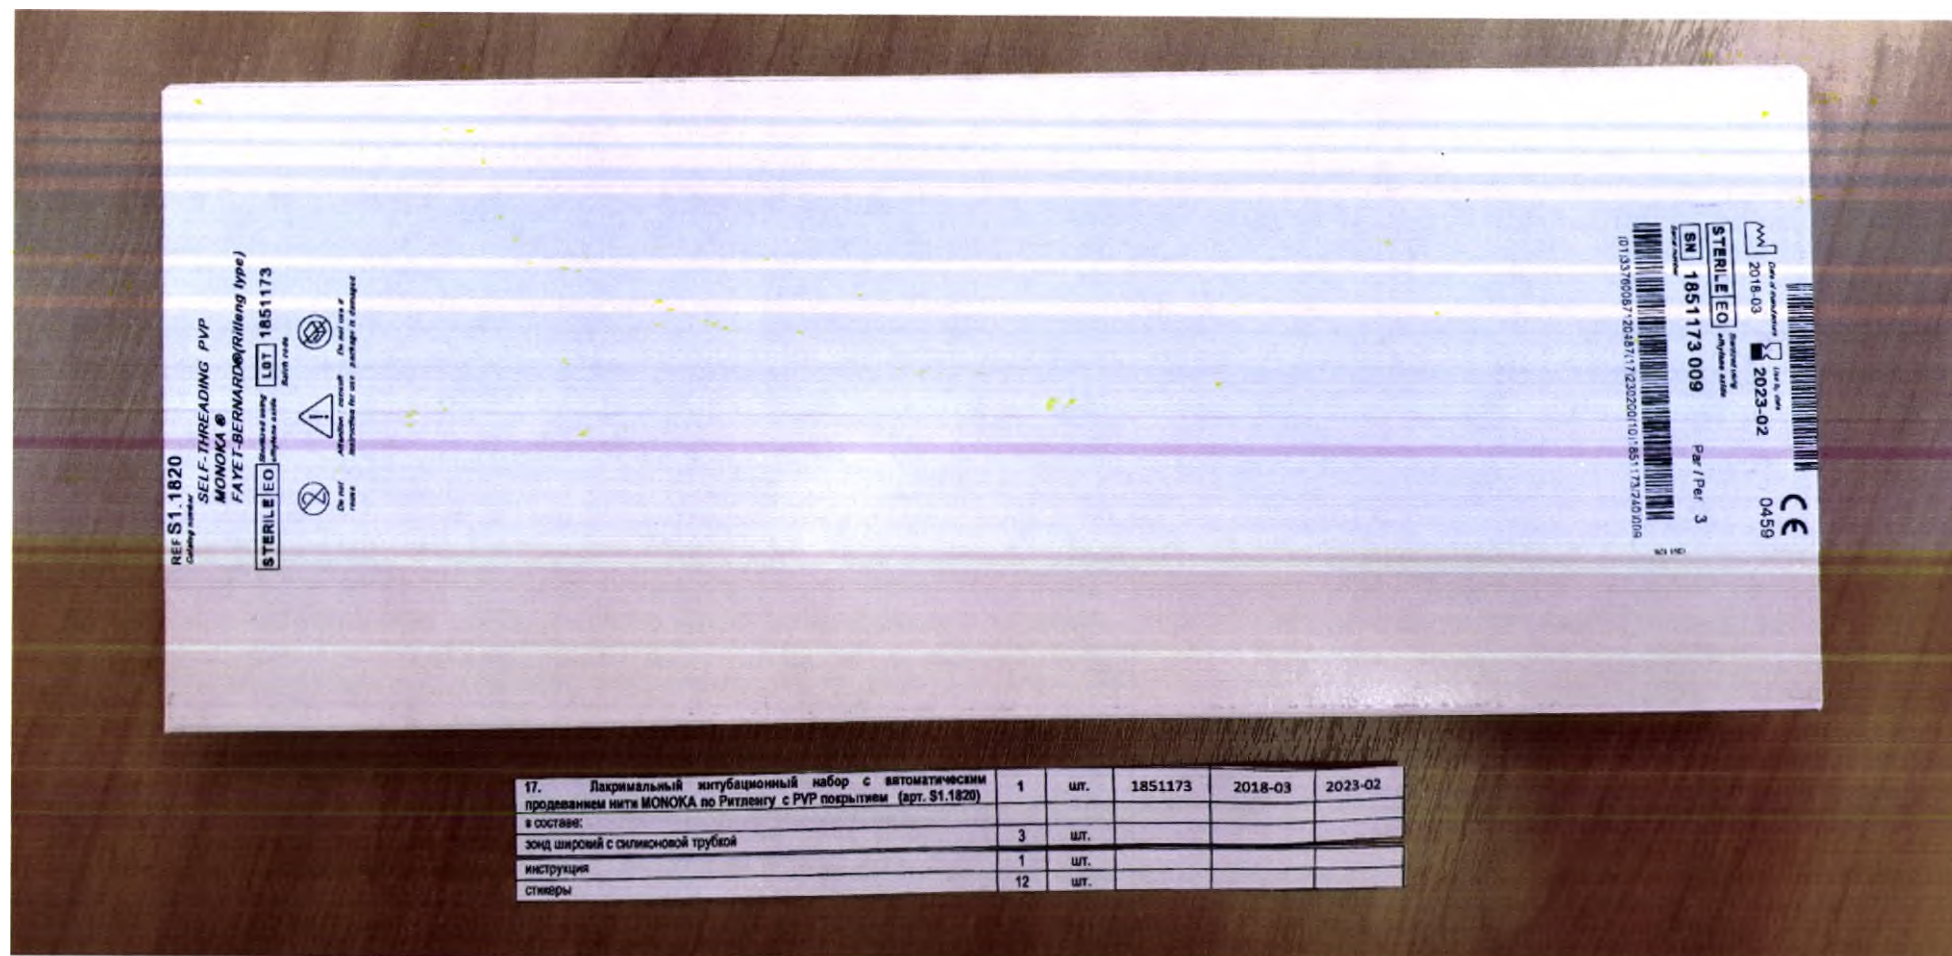


Рисунок 118 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1820



Рисунок 119 – Комплектность арт. S1.1820

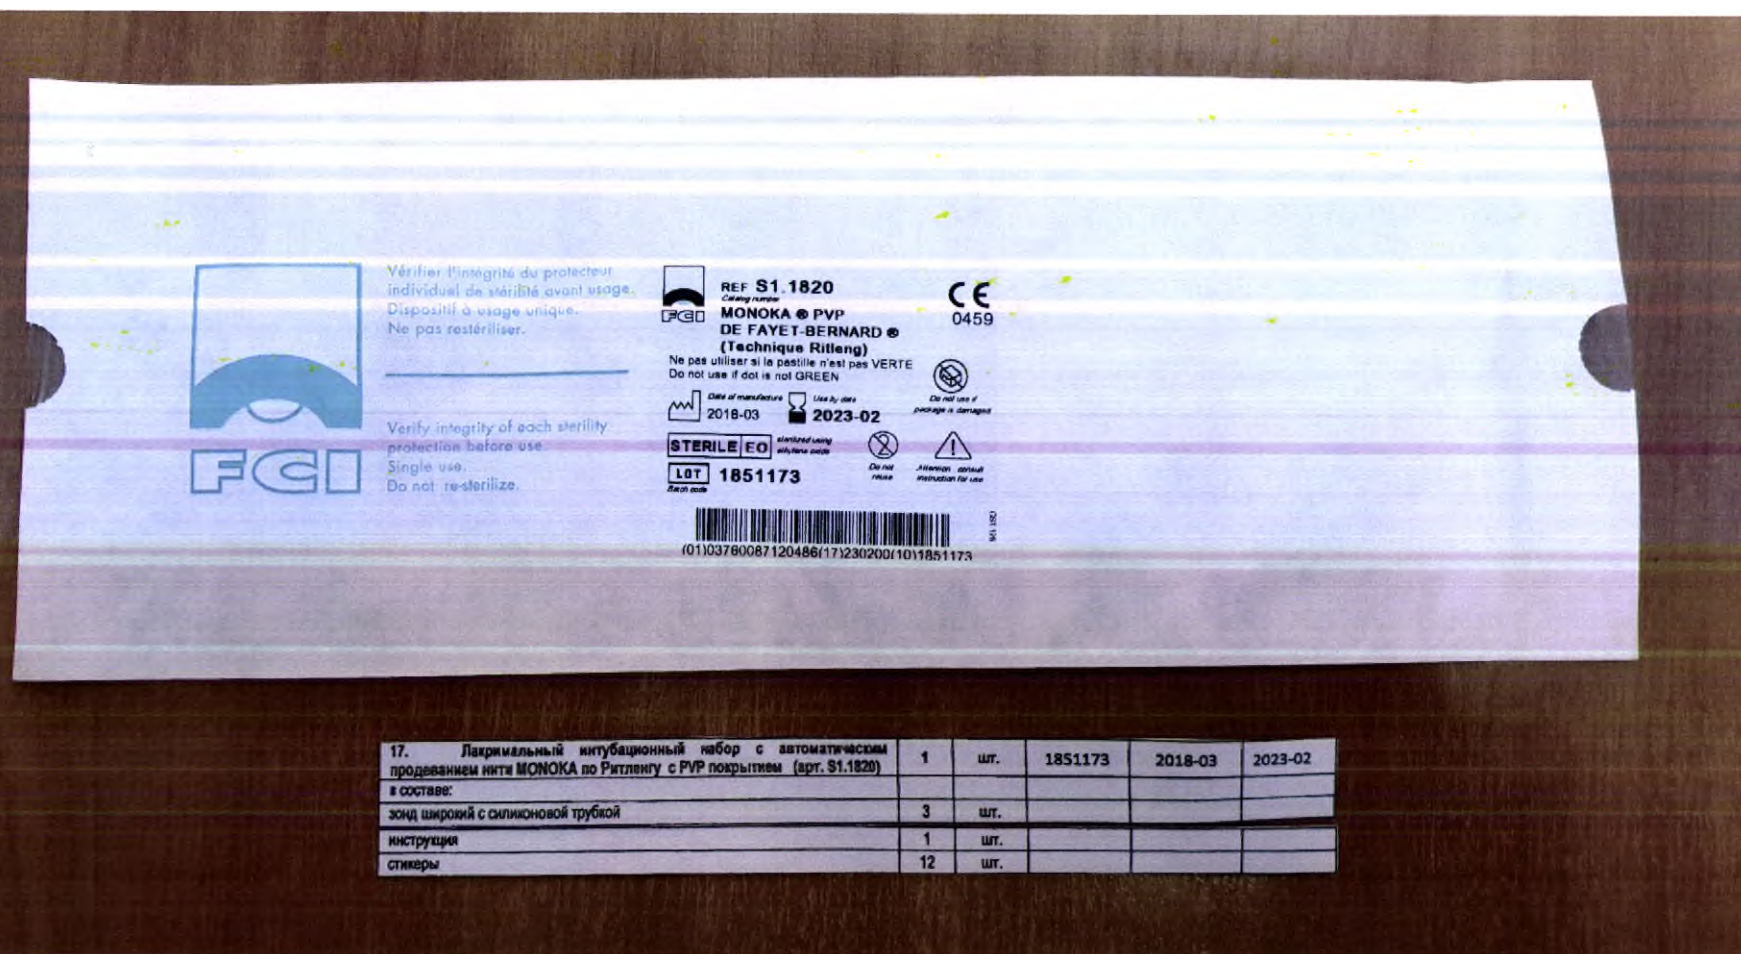


Рисунок 120 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1820



Рисунок 121 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1820



17. Лакримальный интубационный набор с автоматическим продавливанием нити MONOKA по Ритленгу с PVP покрытием (арт. S1.1820)	1	шт.	1851173	2018-03	2023-02
в составе:					
зонд широкий с силиконовой трубкой	3	шт.			
инструкция	1	шт.			
стикеры	12	шт.			

Рисунок 122 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1820

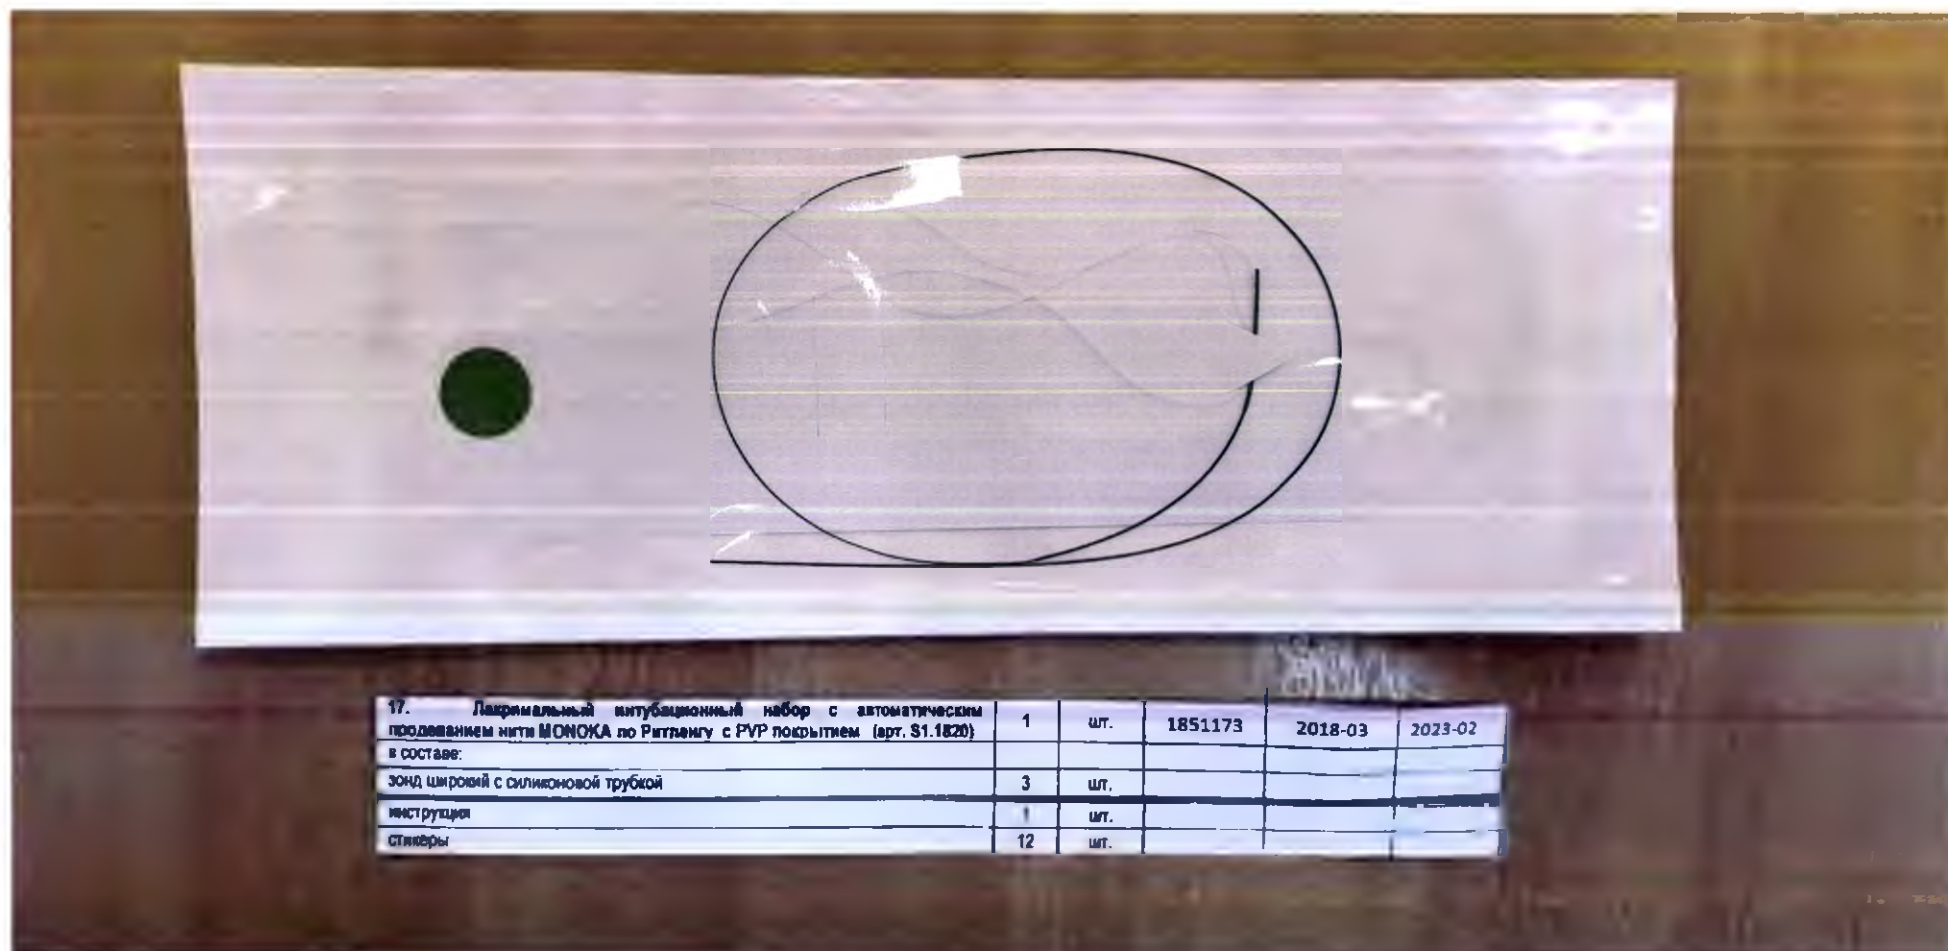


Рисунок 123 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1820

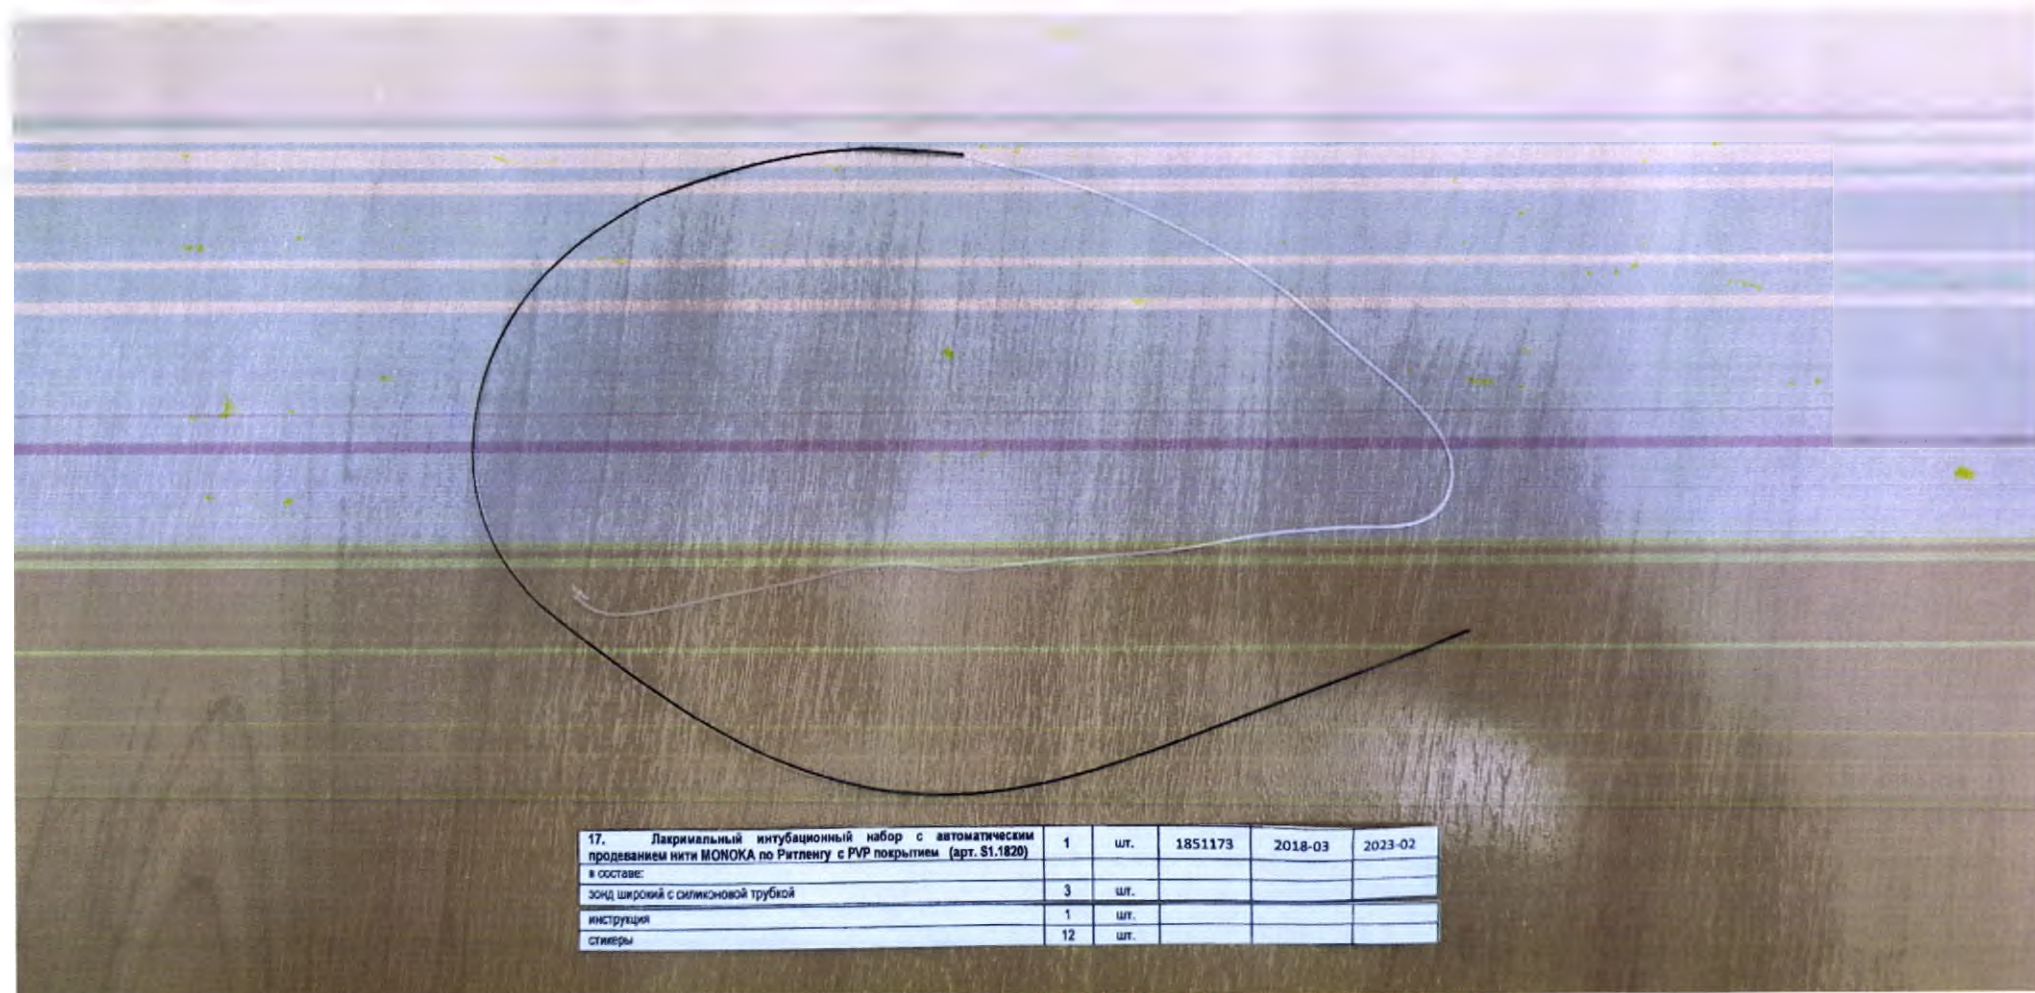


Рисунок 124 – Лакримальный интубационный набор с автоматическим продавливанием нити MONOKA по Ритленгу с PVP покрытием, арт. S1.1820

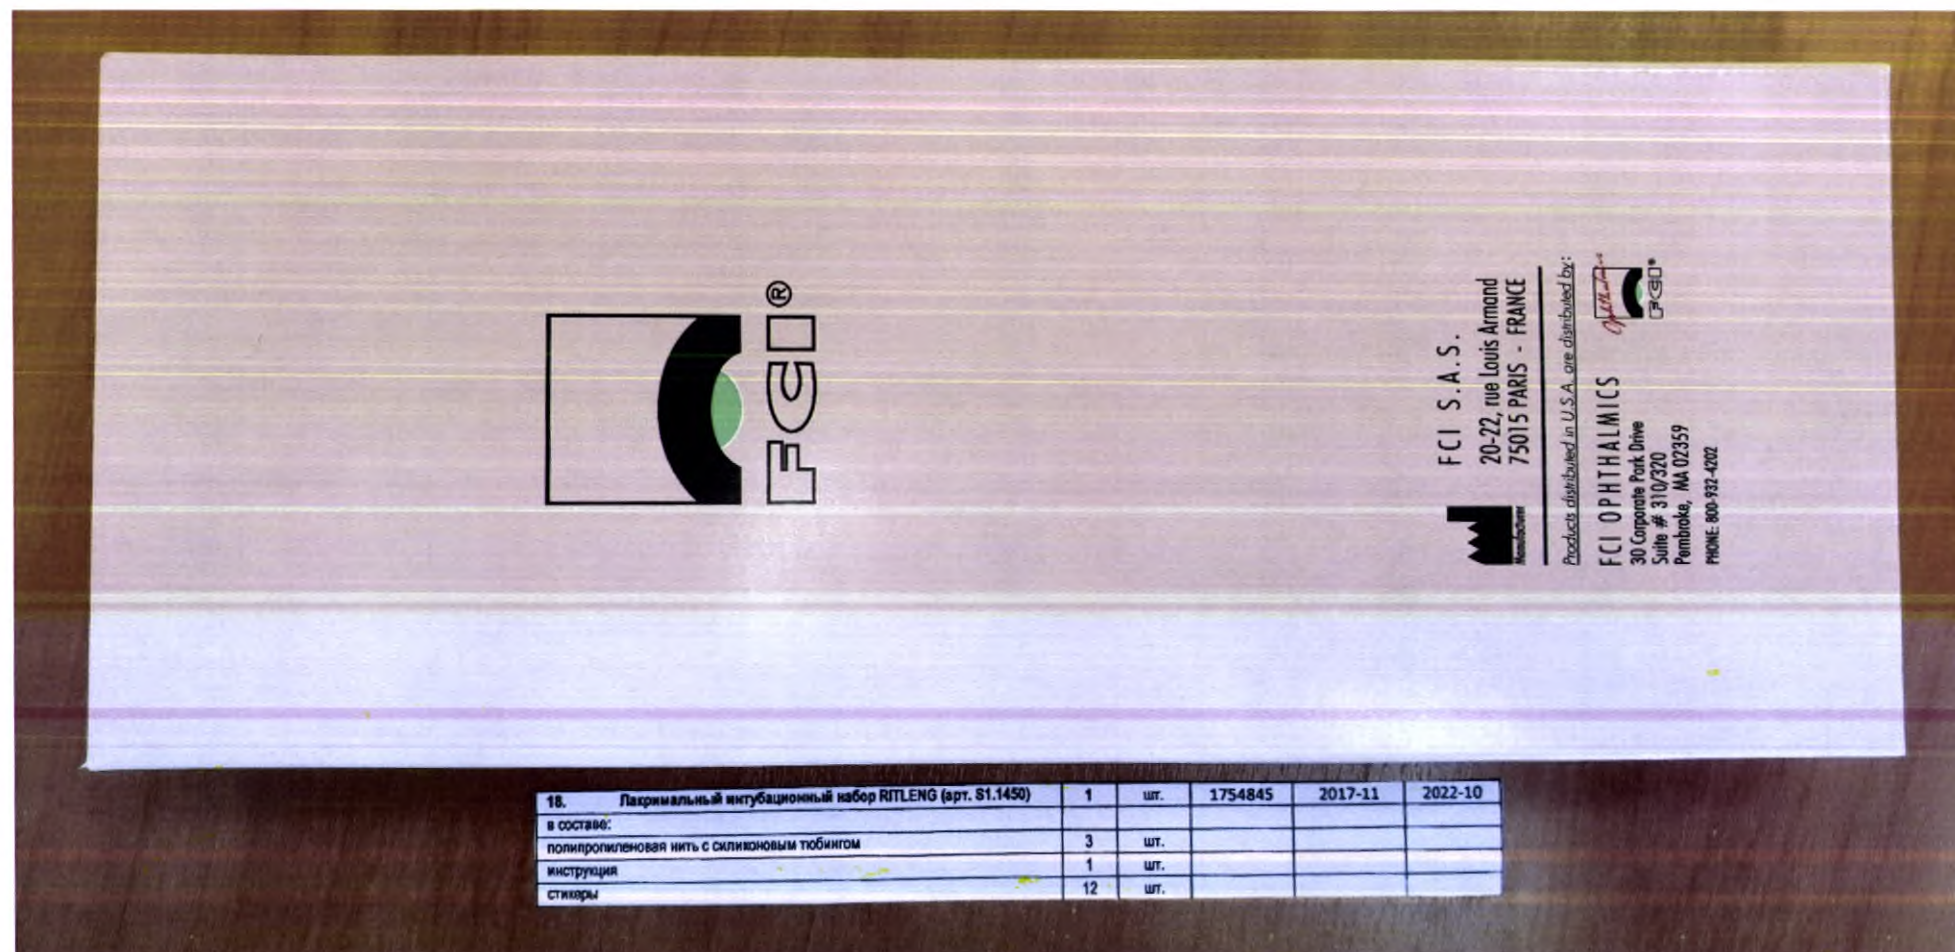


Рисунок 125 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1450



Рисунок 127 – Комплектность арт. S1.1450



Рисунок 128 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1450


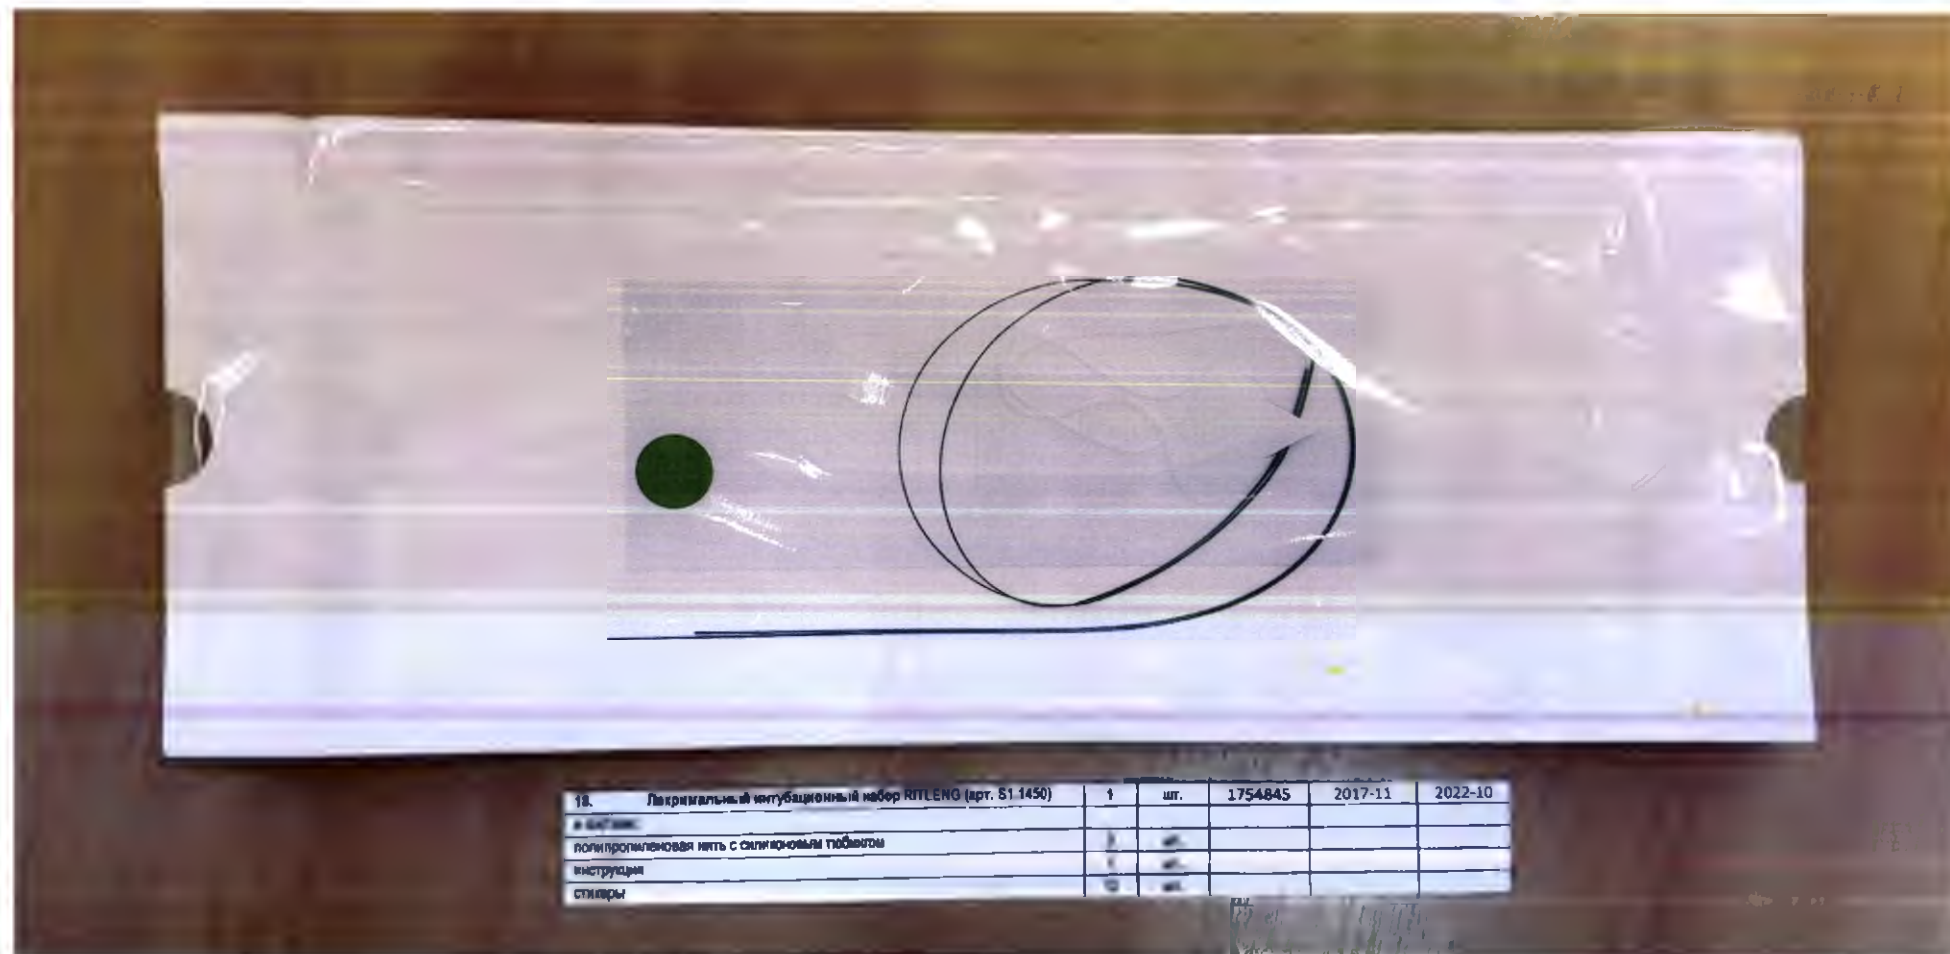


Рисунок 129 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1450

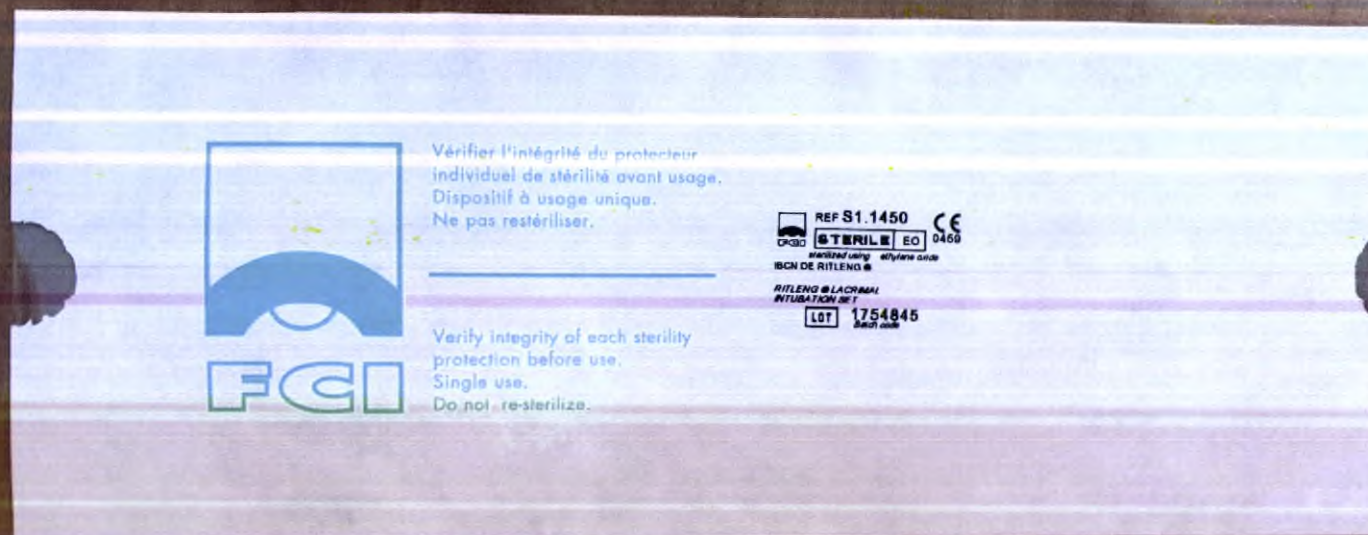

18.	Лакримальный интубационный набор RITLENG (арт. S1.1450)	1	шт.	1754845	2017-11	2022-10
в составе:						
	полипропиленовая нить с силиконовым тубингом	3	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	12	шт.			

Рисунок 130 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1450



Рисунок 131 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1450

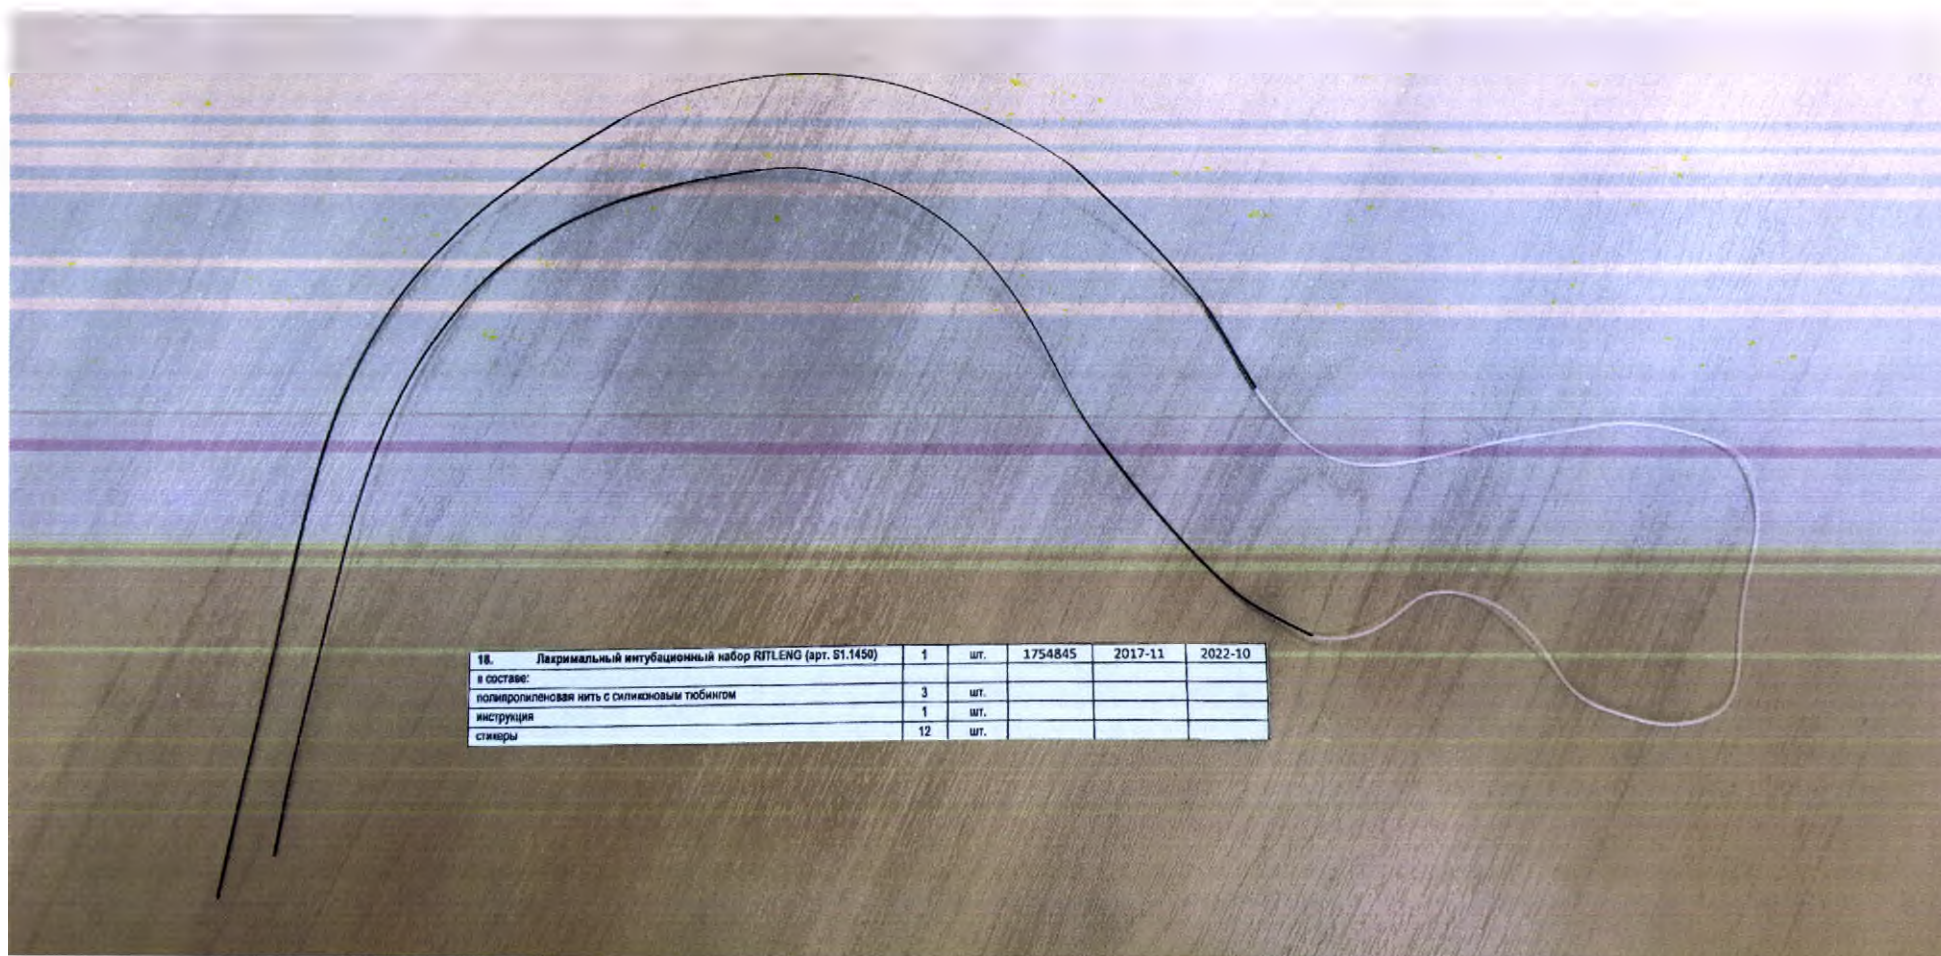


Рисунок 132 – Лакримальный интубационный набор RITLENG, арт. S1.1450



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



19.	Закупочная цена	1	шт.	1755720	2018-01	2022-12
в составе:		3	шт.			
коммерческая информация		1	шт.			
инструкция		12	шт.			
список						

Рисунок 133 - Потребительская упаковка (вид спереди) арт. St.1490

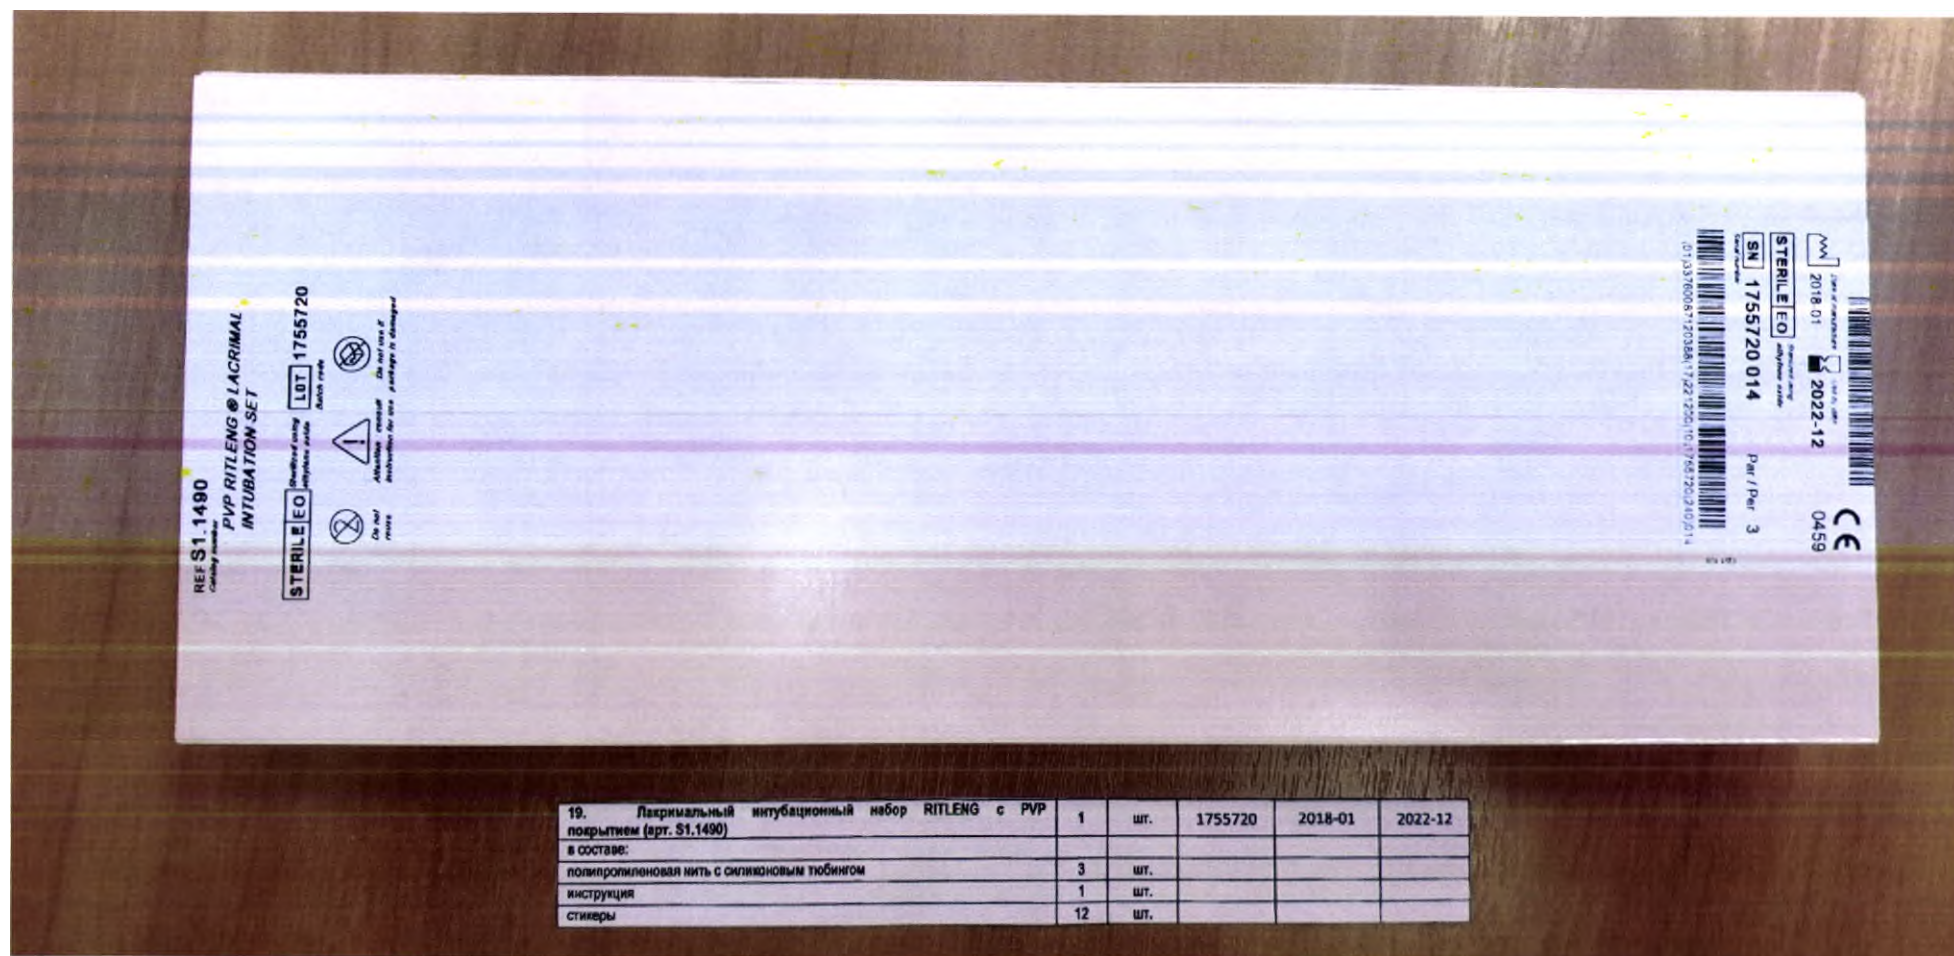


Рисунок 134 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1490



Рисунок 135 – Комплектность арт. S1.1490



Рисунок 136 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1490



Рисунок 137 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1490

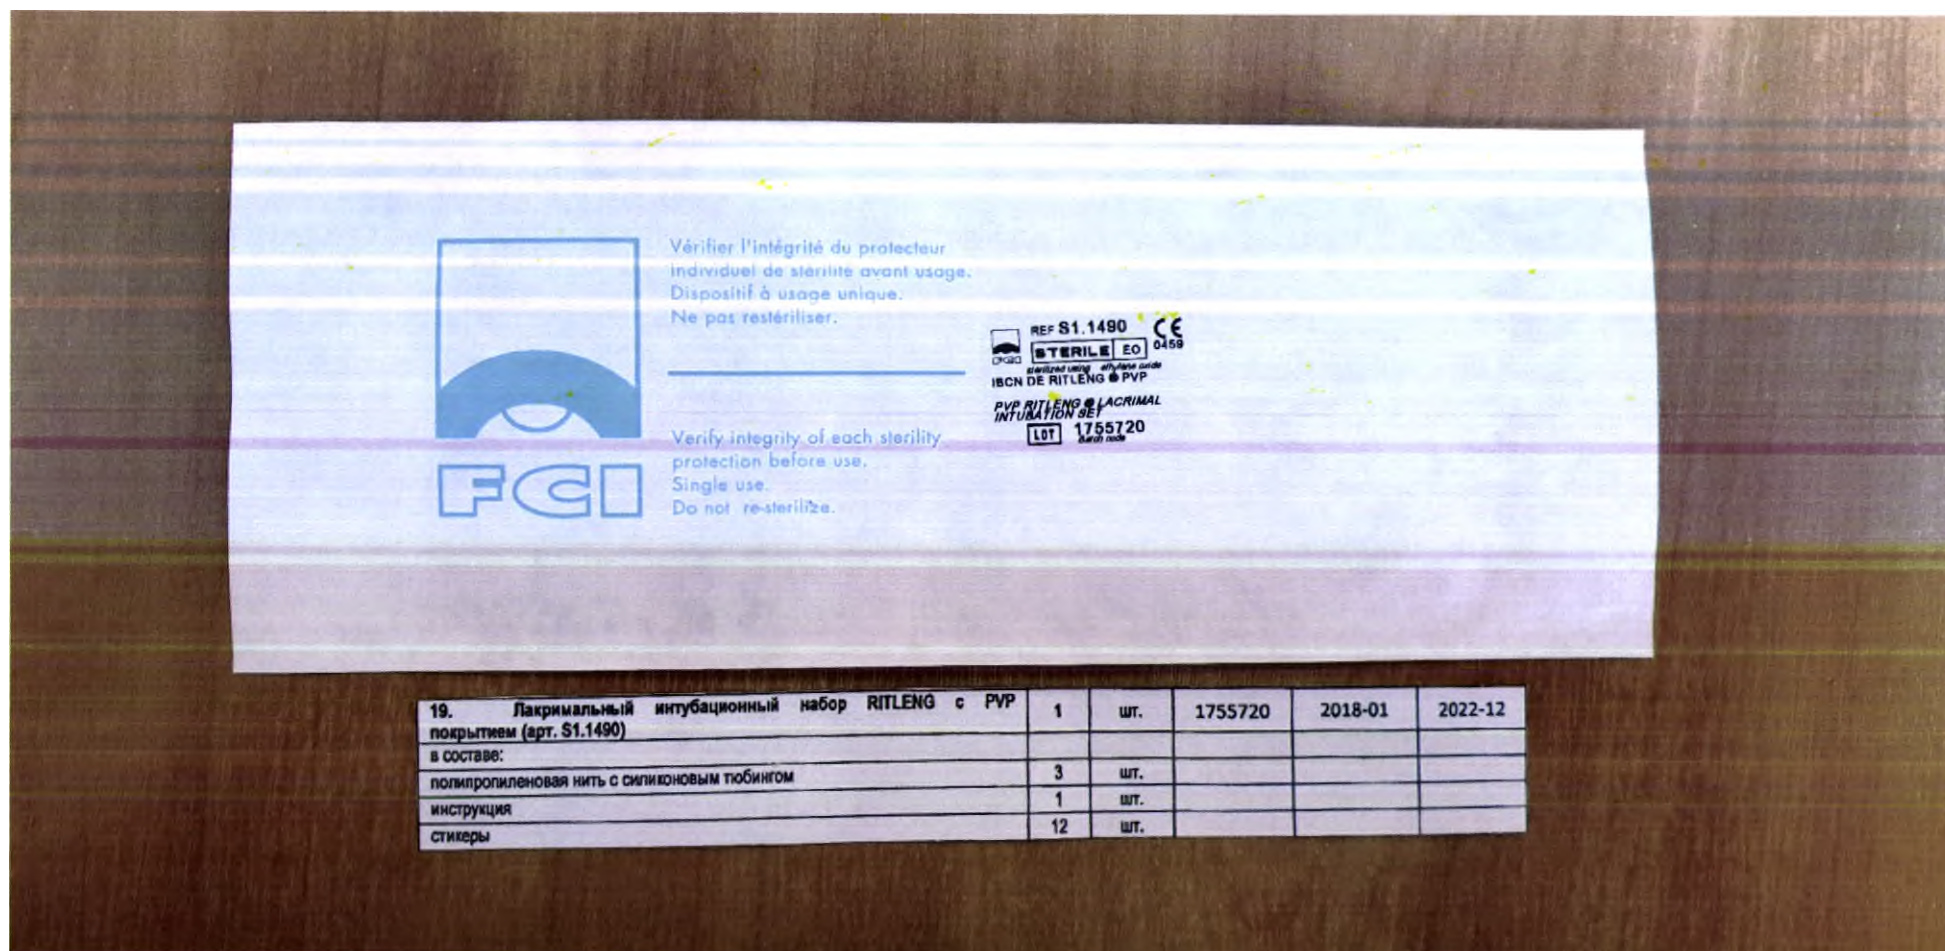


Рисунок 138 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1490

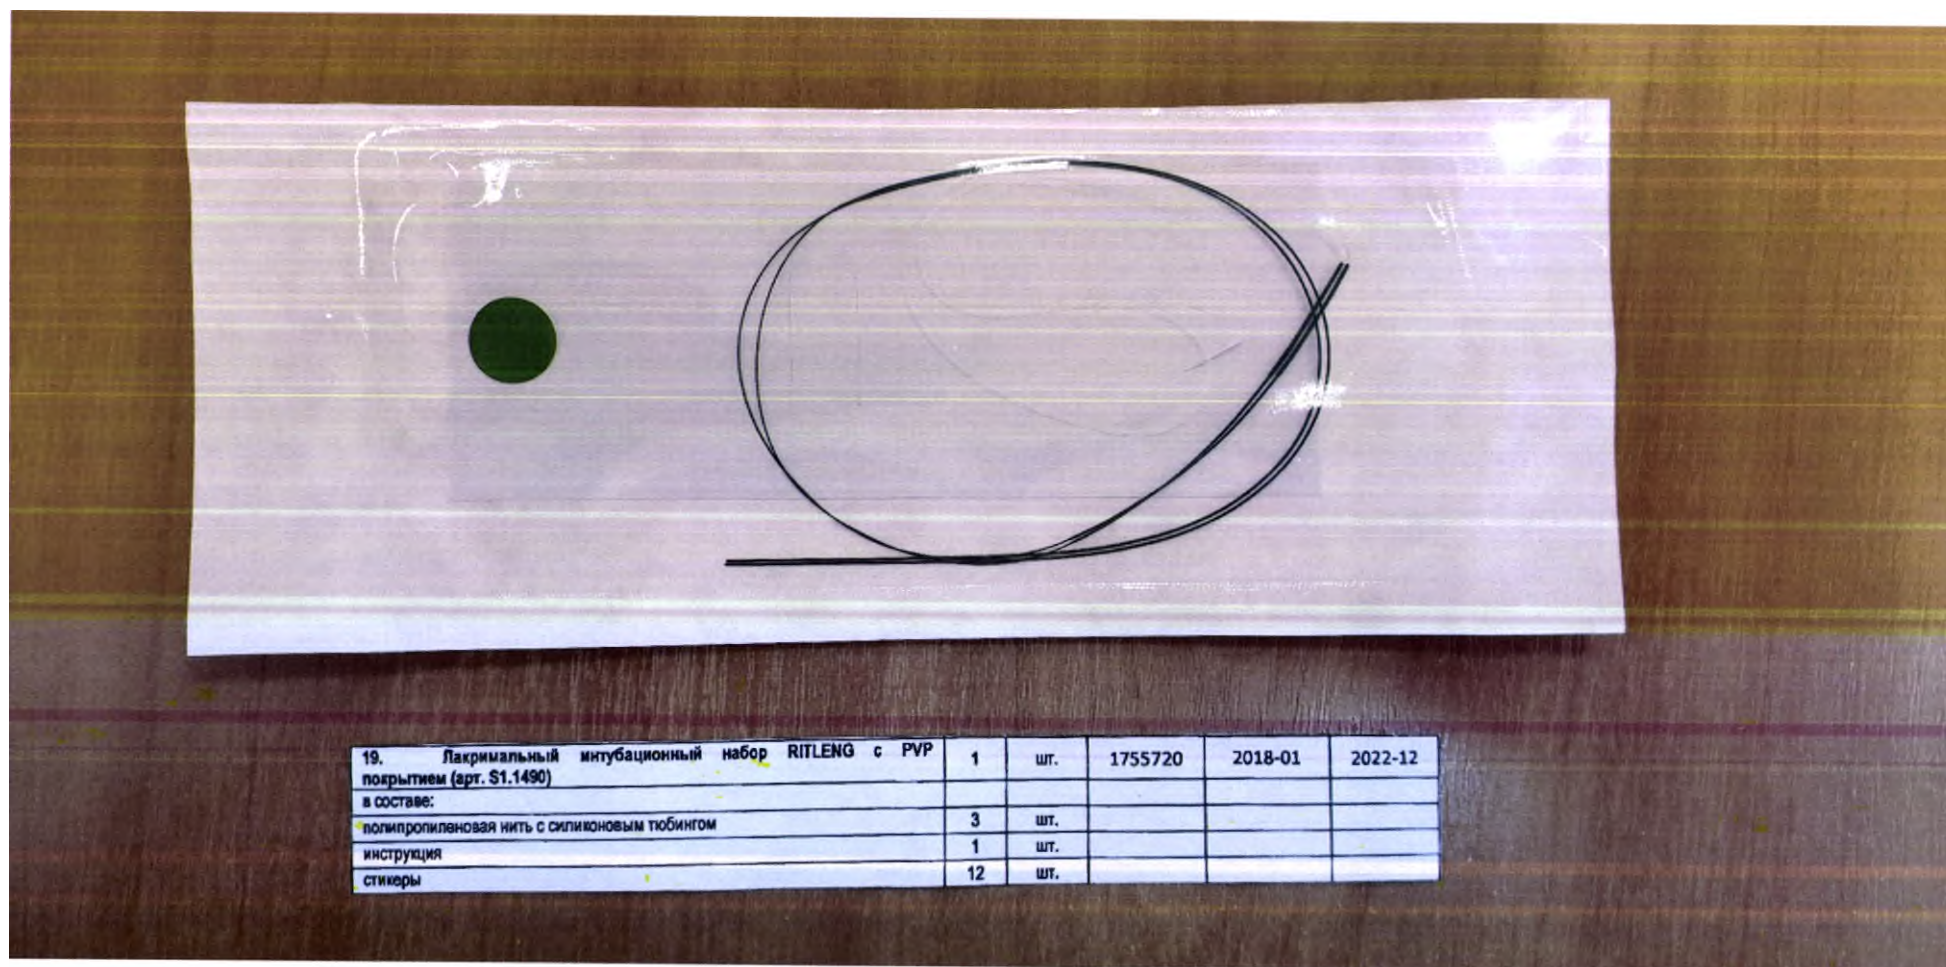


Рисунок 139 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1490

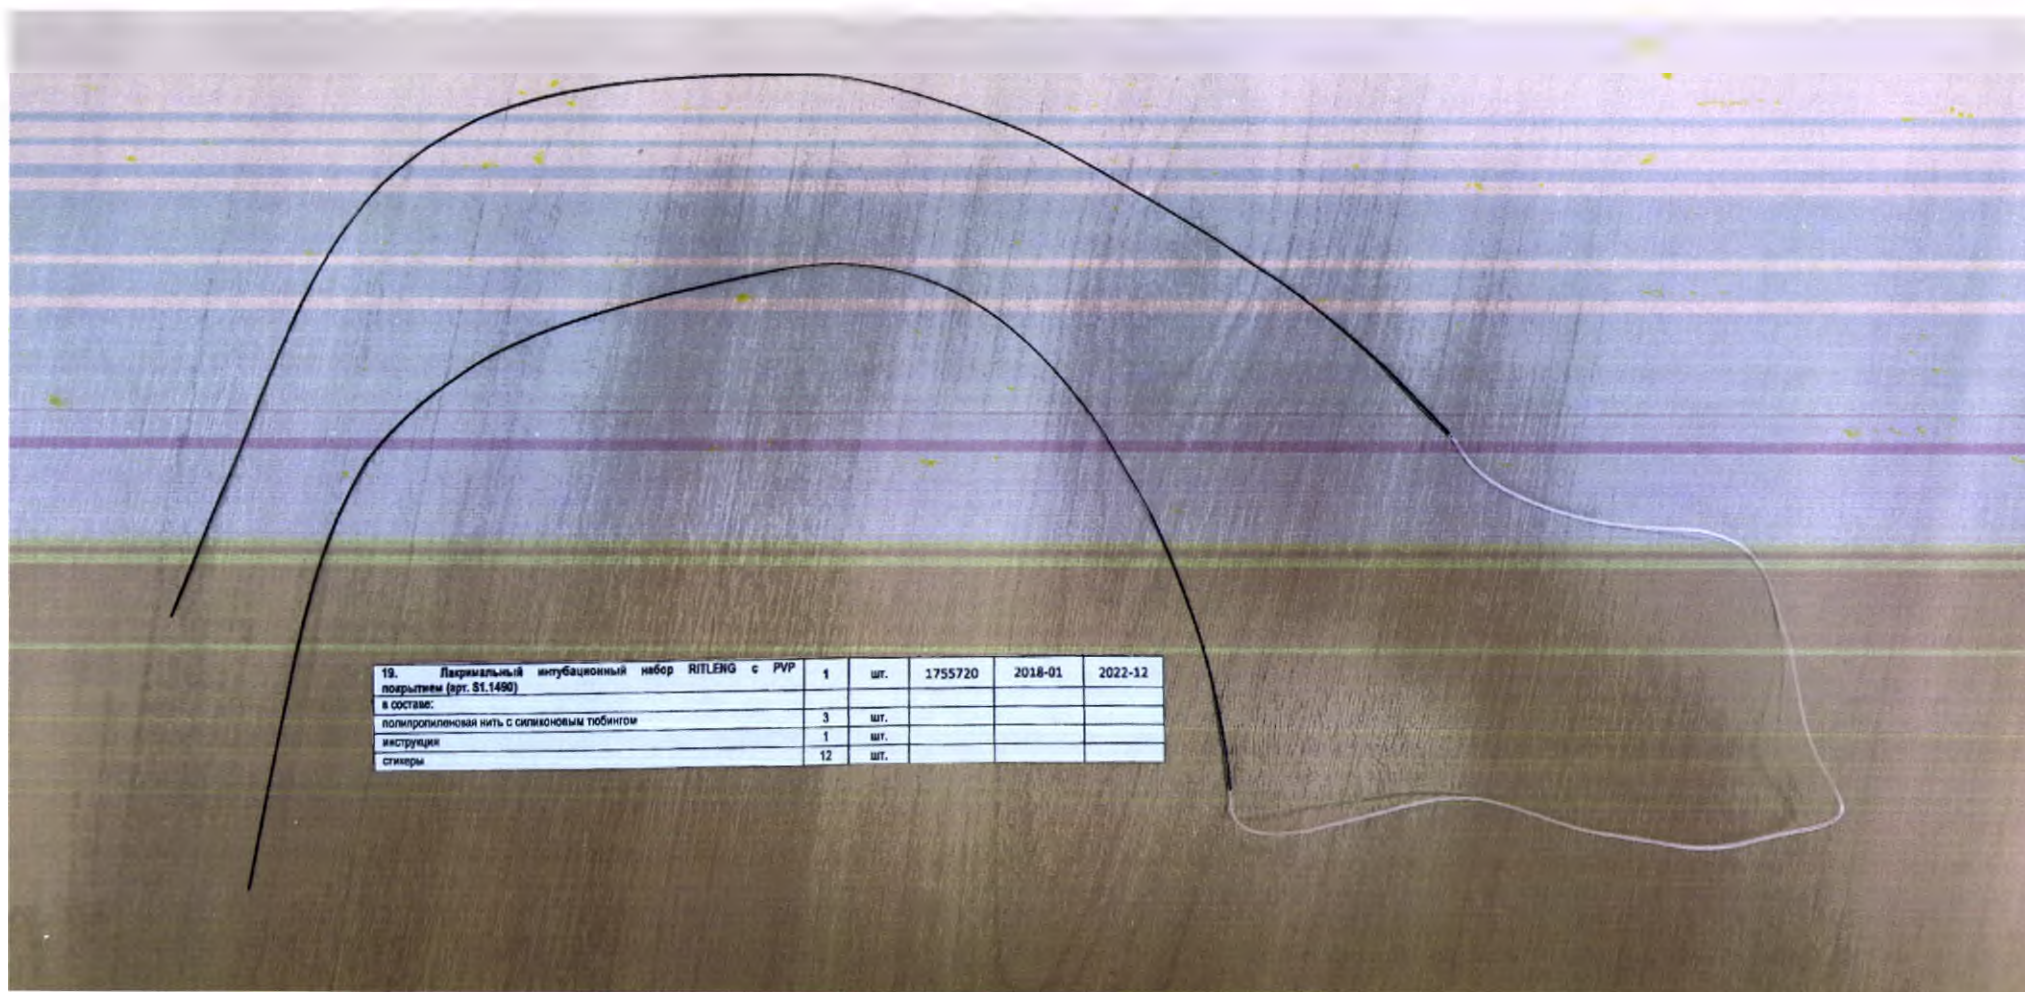


Рисунок 140 – Лакримальный интубационный набор RITLENG с PVP покрытием, арт. S1.1490



FCI S.A.S.

20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS

30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359

PHONE: 800-932-4202



20.	Параметрический интраканальный набор МАСТЕРКА (арт. S1.1608)	1	шт.	1851166	2018-03	2023-02
в составе:						
зонд с предустановленной силиконовой трубкой 30 мм и заглушкой		1	шт.			
инструкция		1	шт.			
Стимеры		4	шт.			

Рисунок 141 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1608

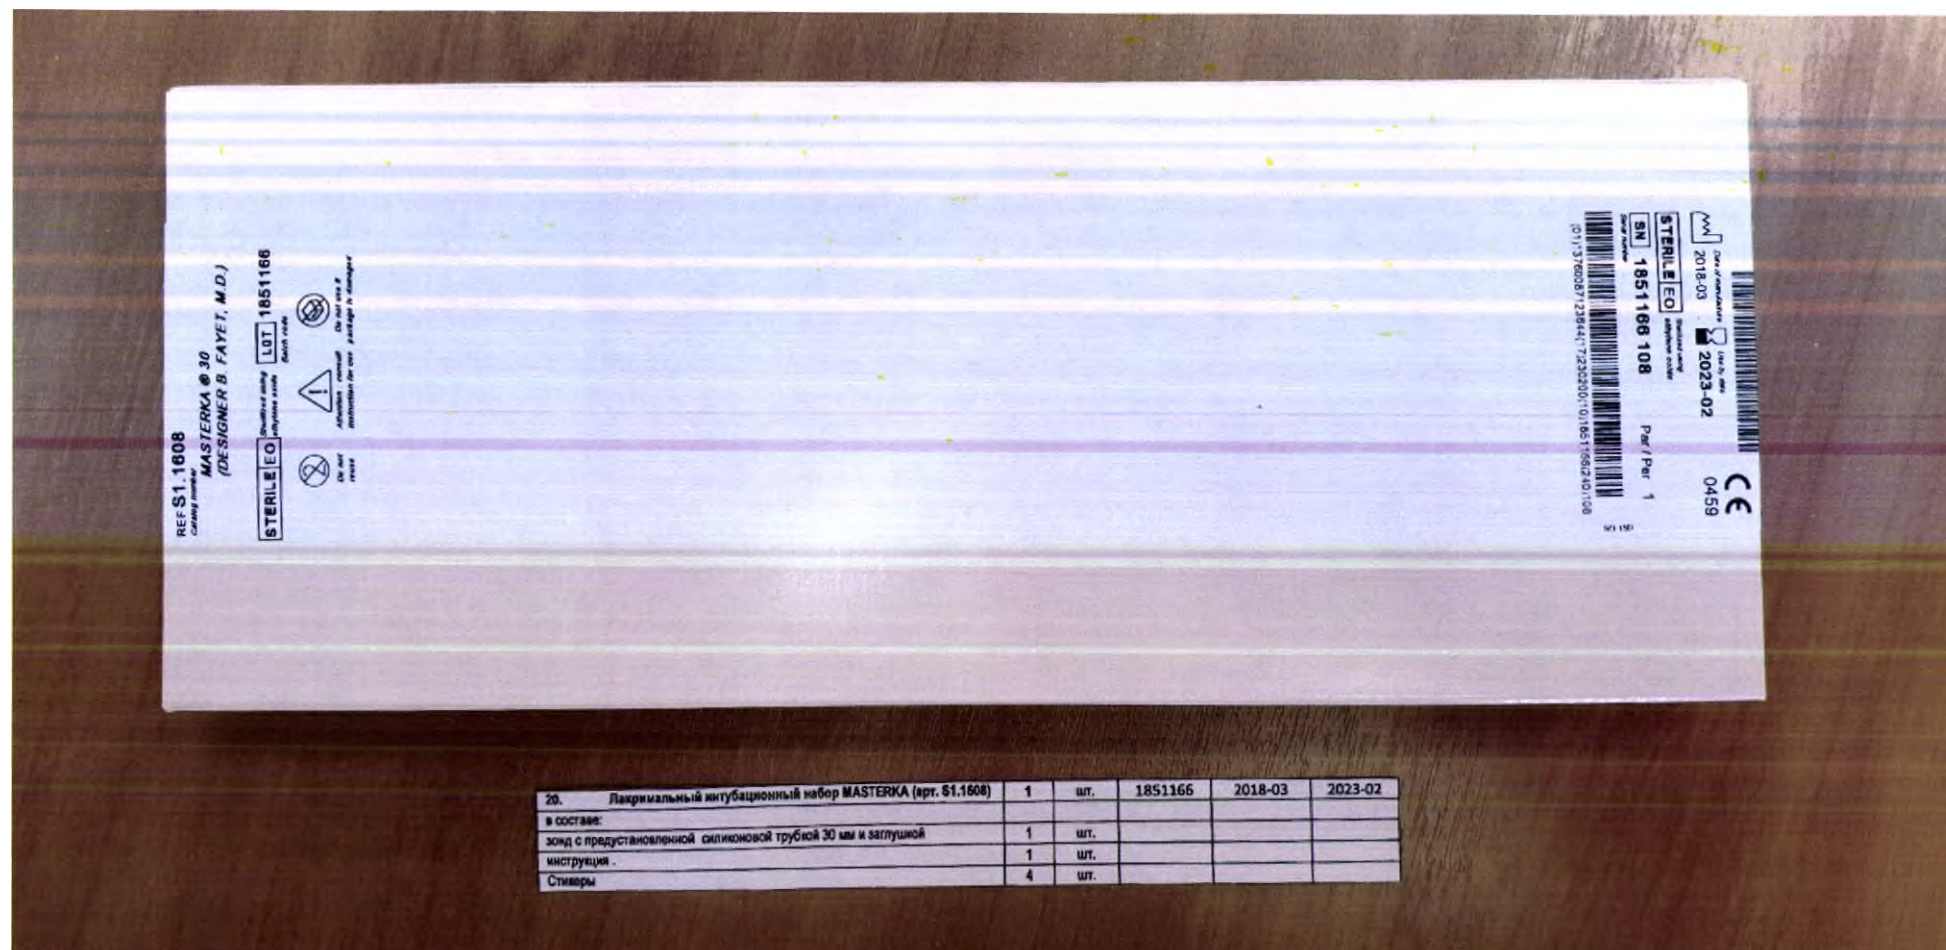


Рисунок 142 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1608



Рисунок 143 – Комплектность арт. S1.1608



Рисунок 144 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1608

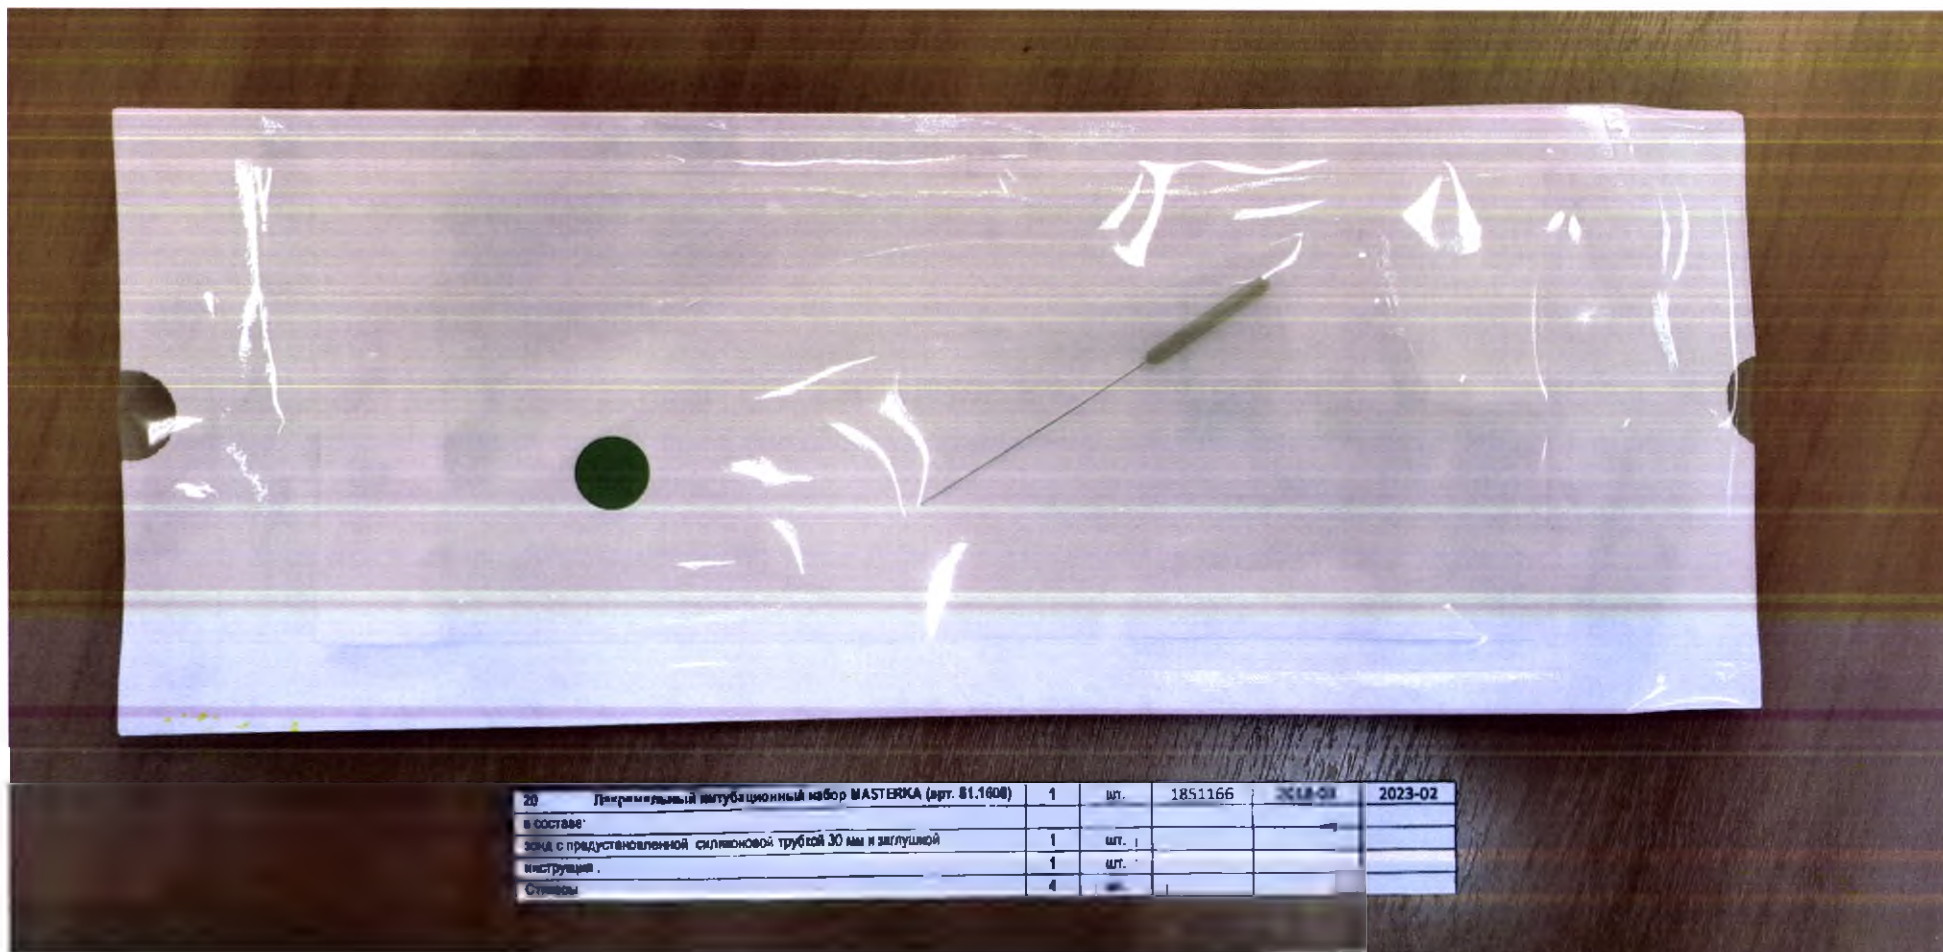


Рисунок 145 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1608

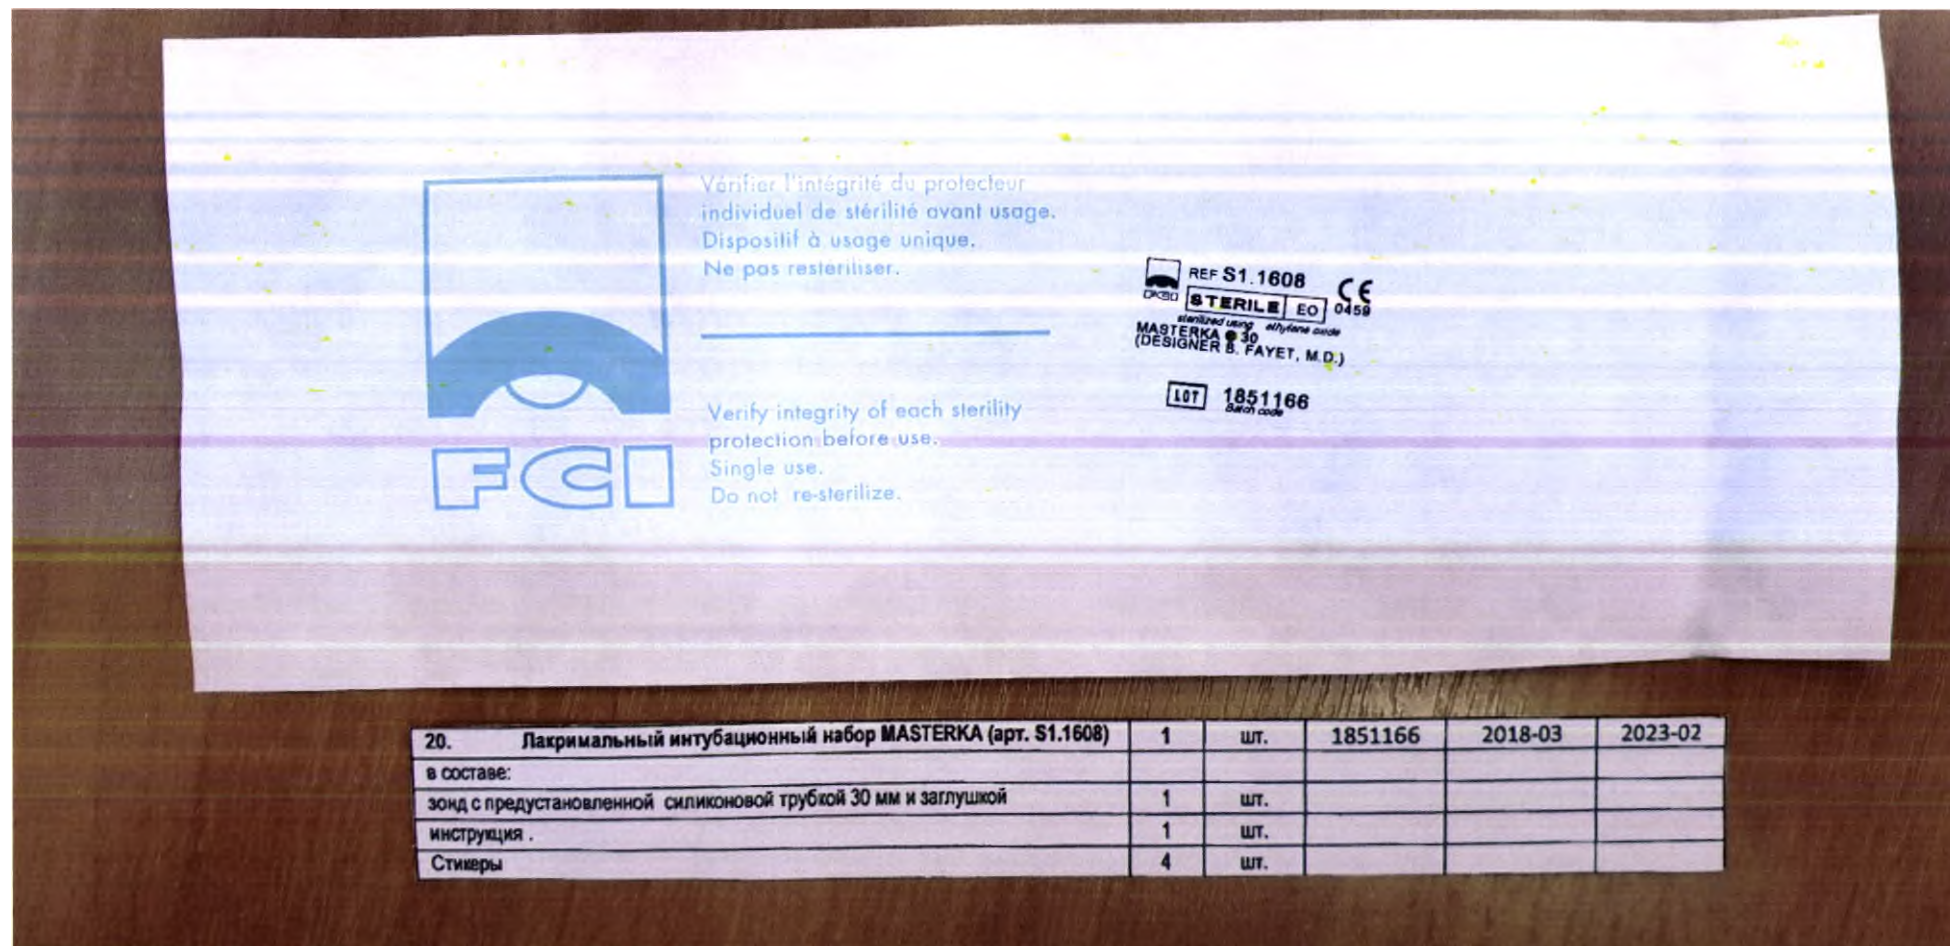


Рисунок 146 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1608

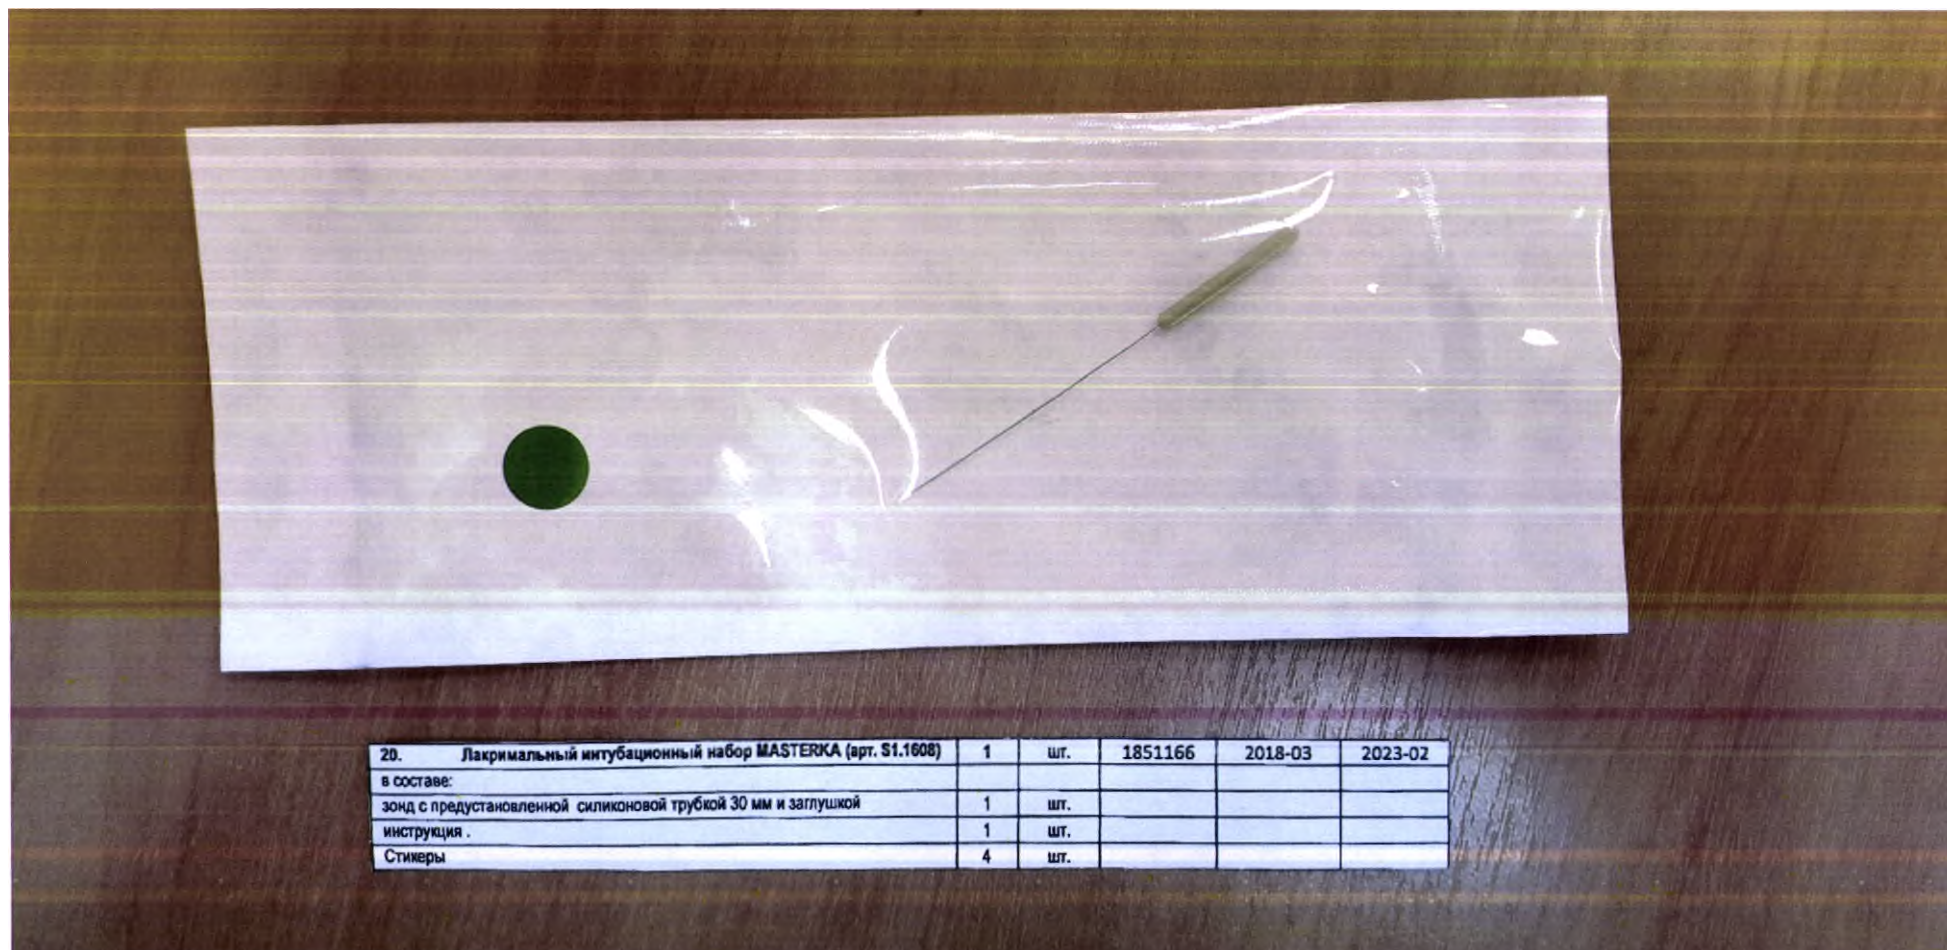


Рисунок 147 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1608

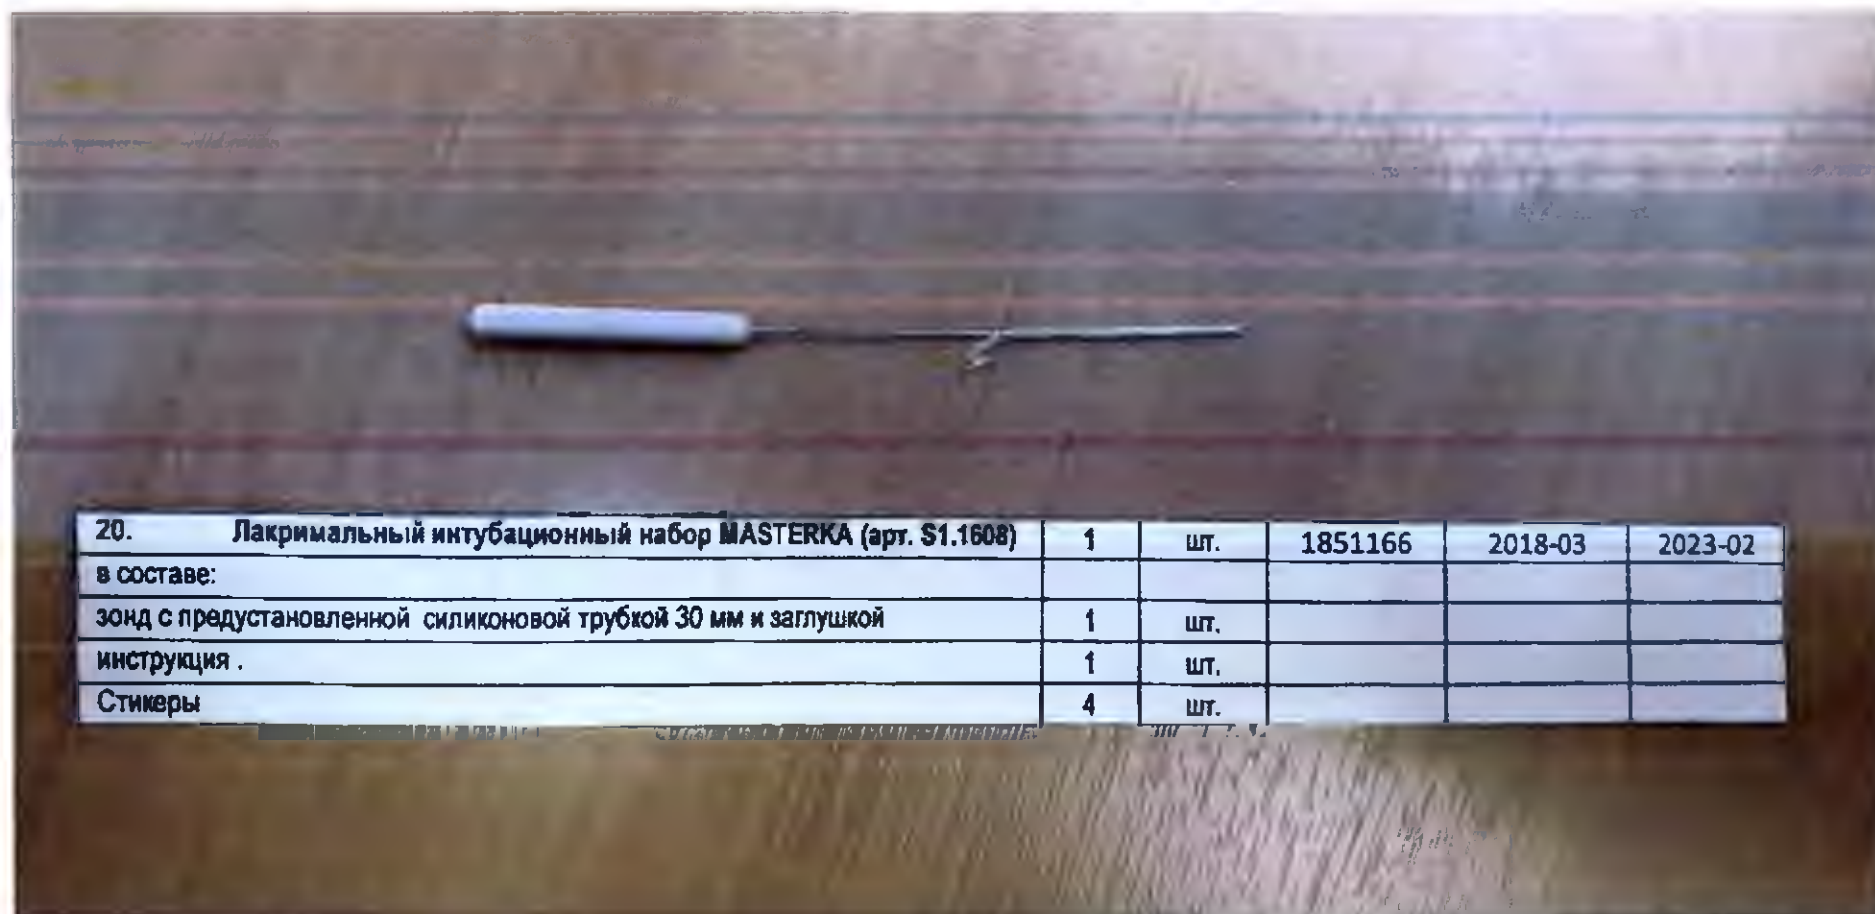


Рисунок 148 – Лакримальный интубационный набор MASTERKA, арт. S1.1608



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



21.	Паспортный интрузионный набор МАСТЕРКА (арт. S1.1609)	1	шт.	1850367	2018-02	2023-01
в состав:						
зона с предустановленной симметричной трубкой 35 мм в запястьи		1	шт.			
инструкция		1	шт.			
стерильность		4	шт.			

Рисунок 149 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1609

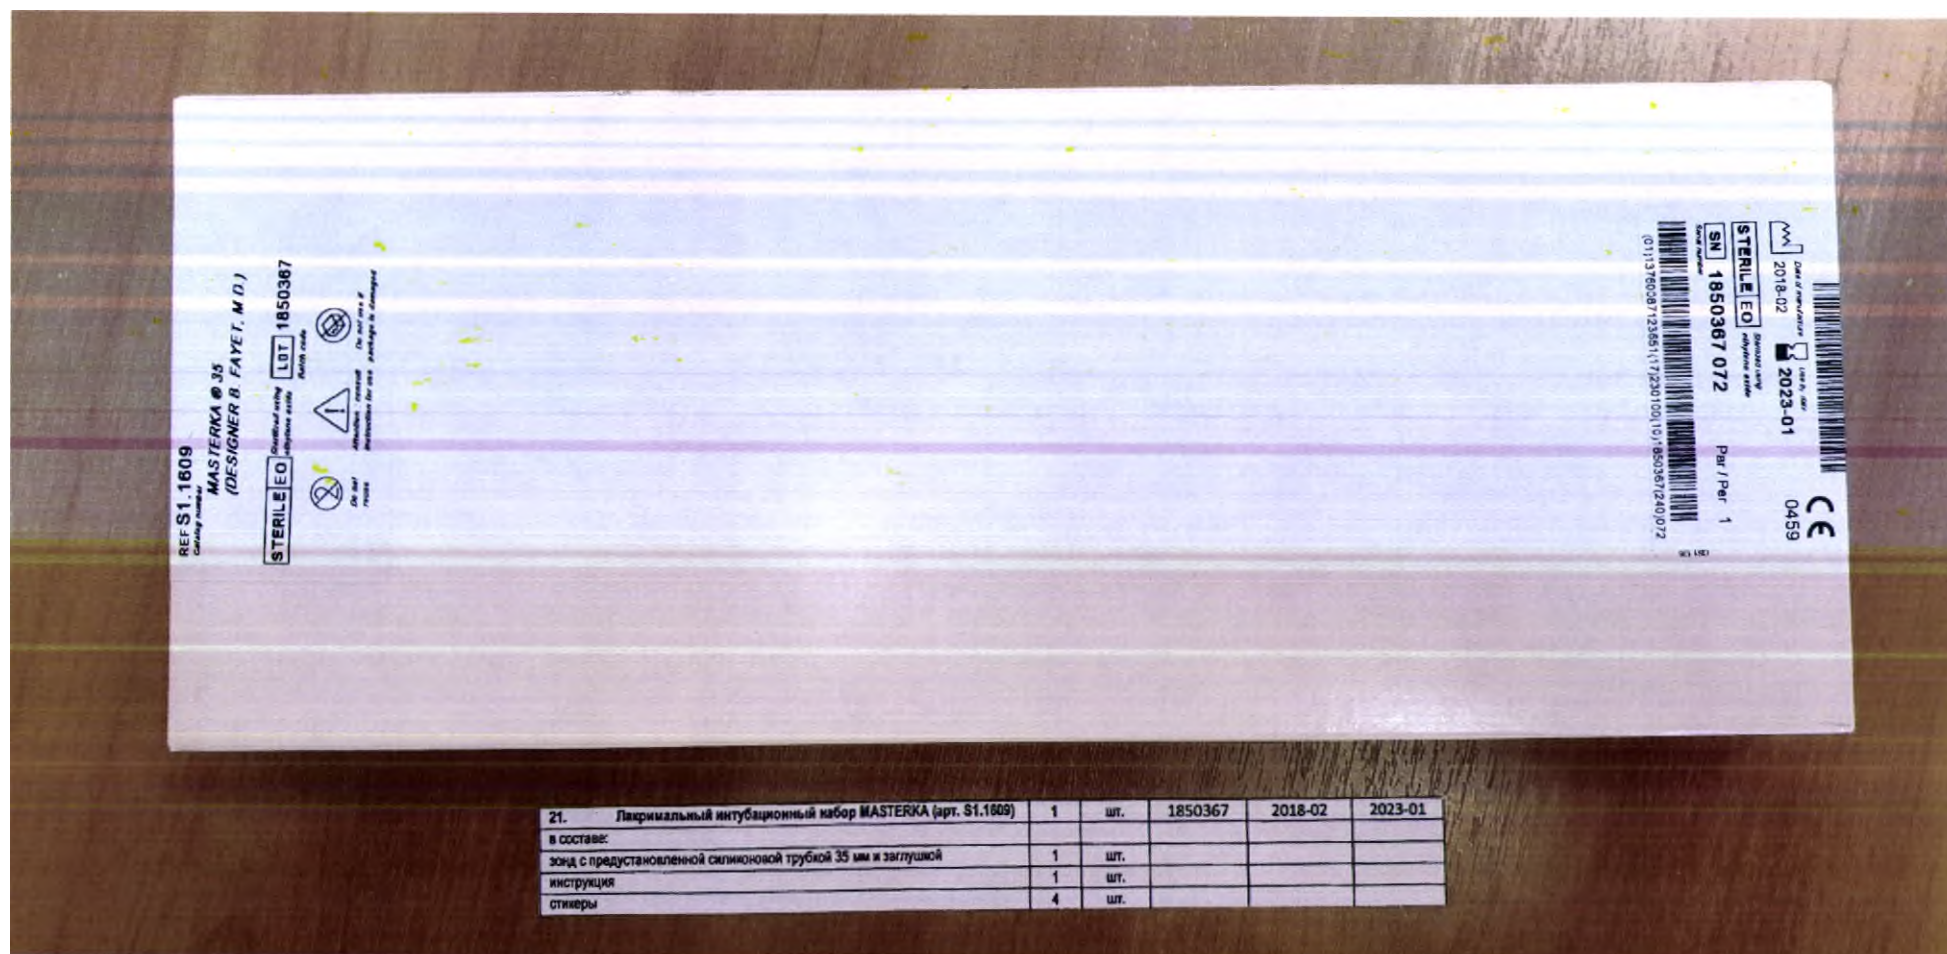


Рисунок 150 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1609

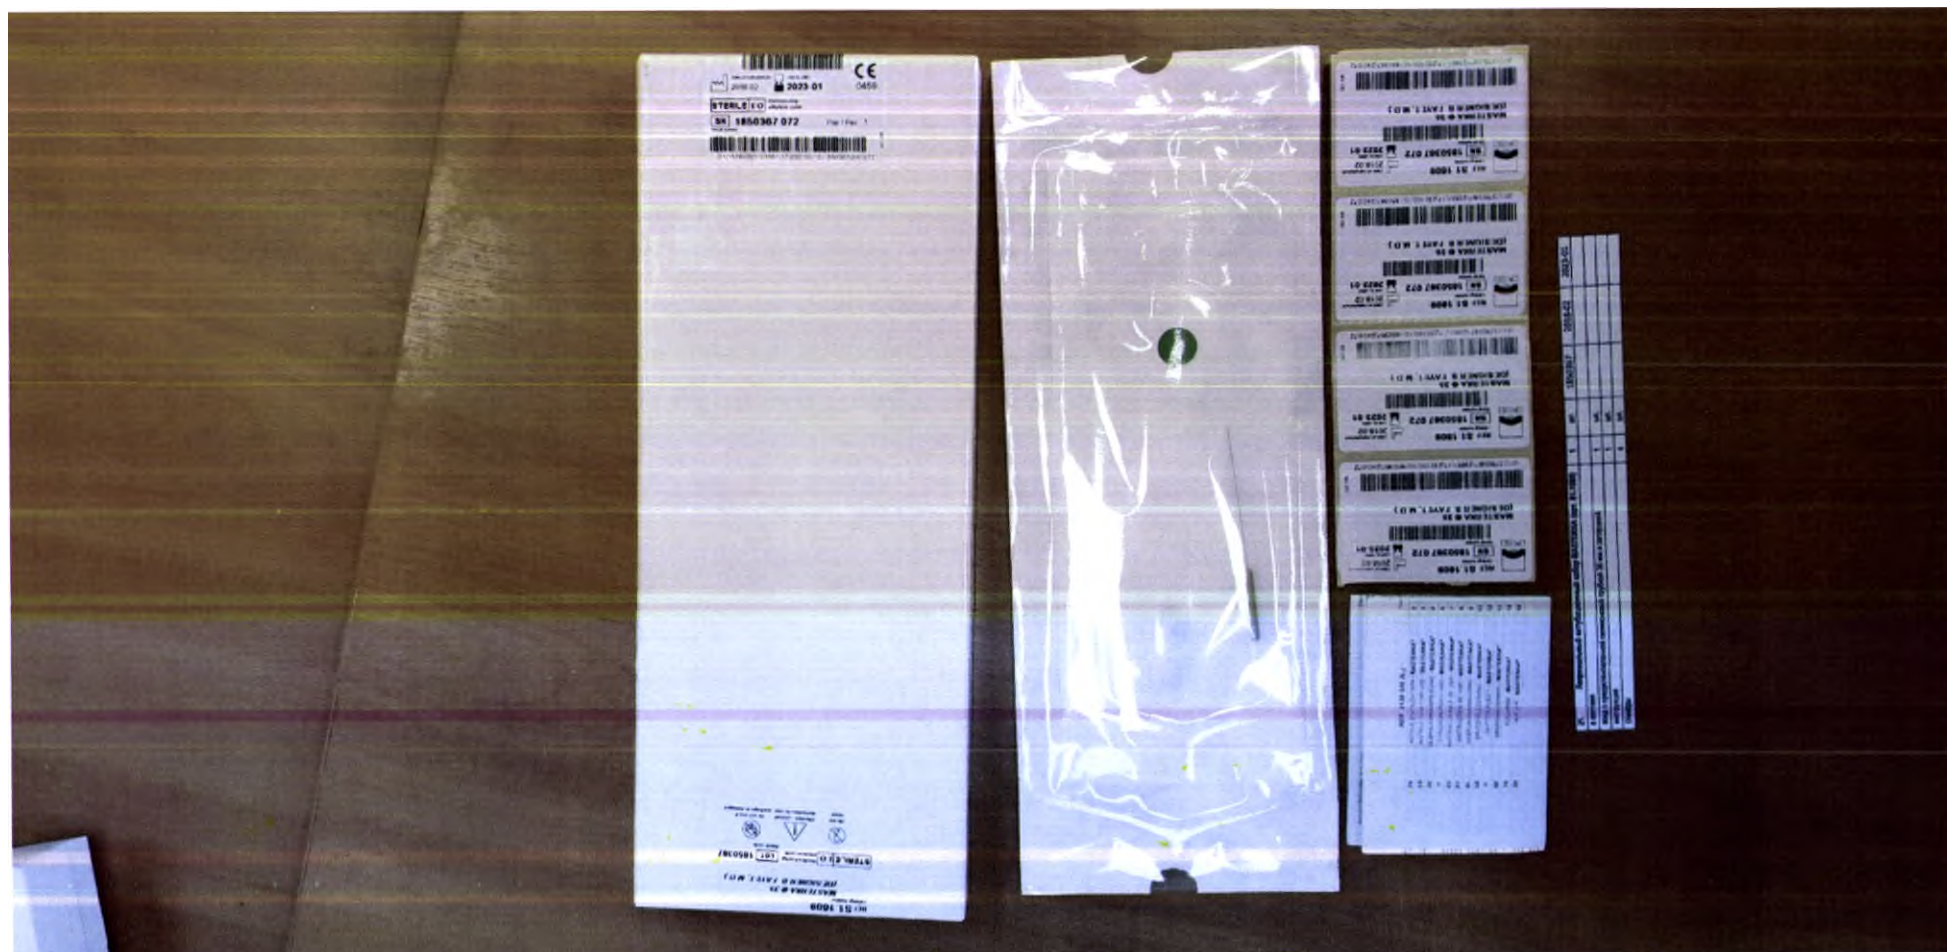


Рисунок 151 – Комплектность арт. S1.1609



21.	Пакримальный интубационный набор MASTERKA (арт. S1.1609)	1	шт.	1850367	2018-02	2023-01
в составе:						
	зонд с предустановленной силиконовой трубкой 35 мм и заглушкой	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	4	шт.			

Рисунок 152 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1609

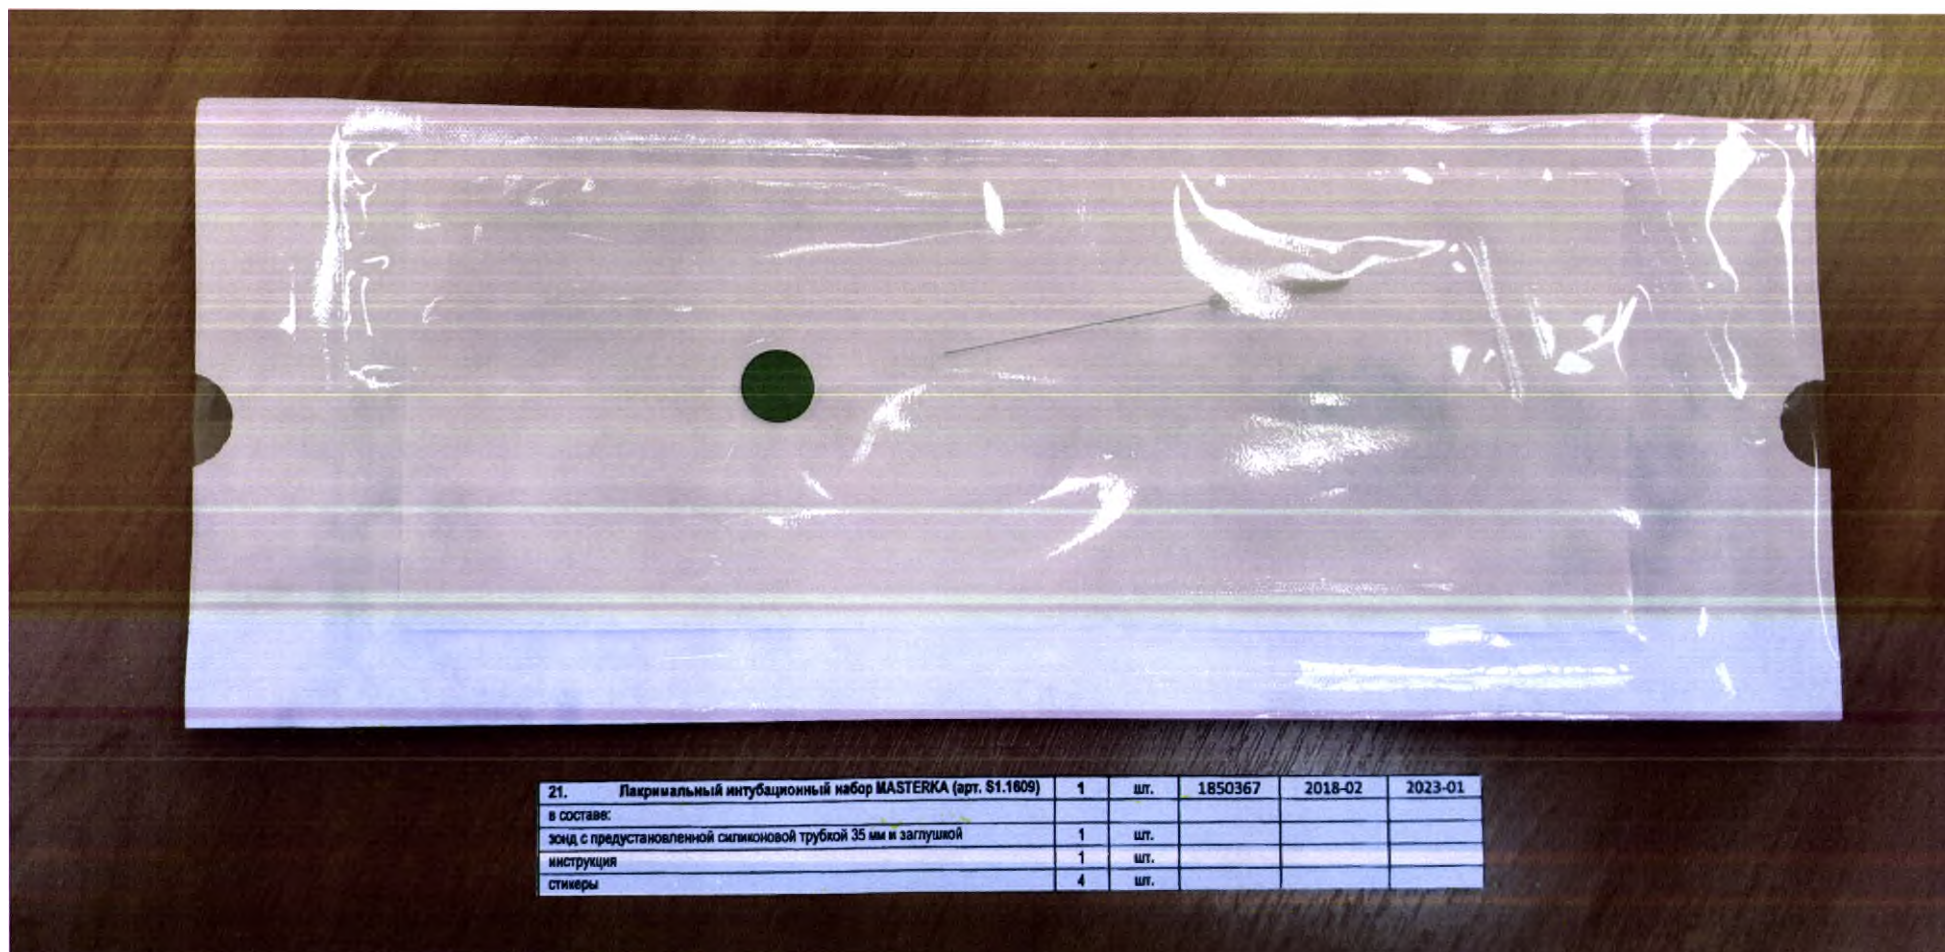


Рисунок 153 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1609

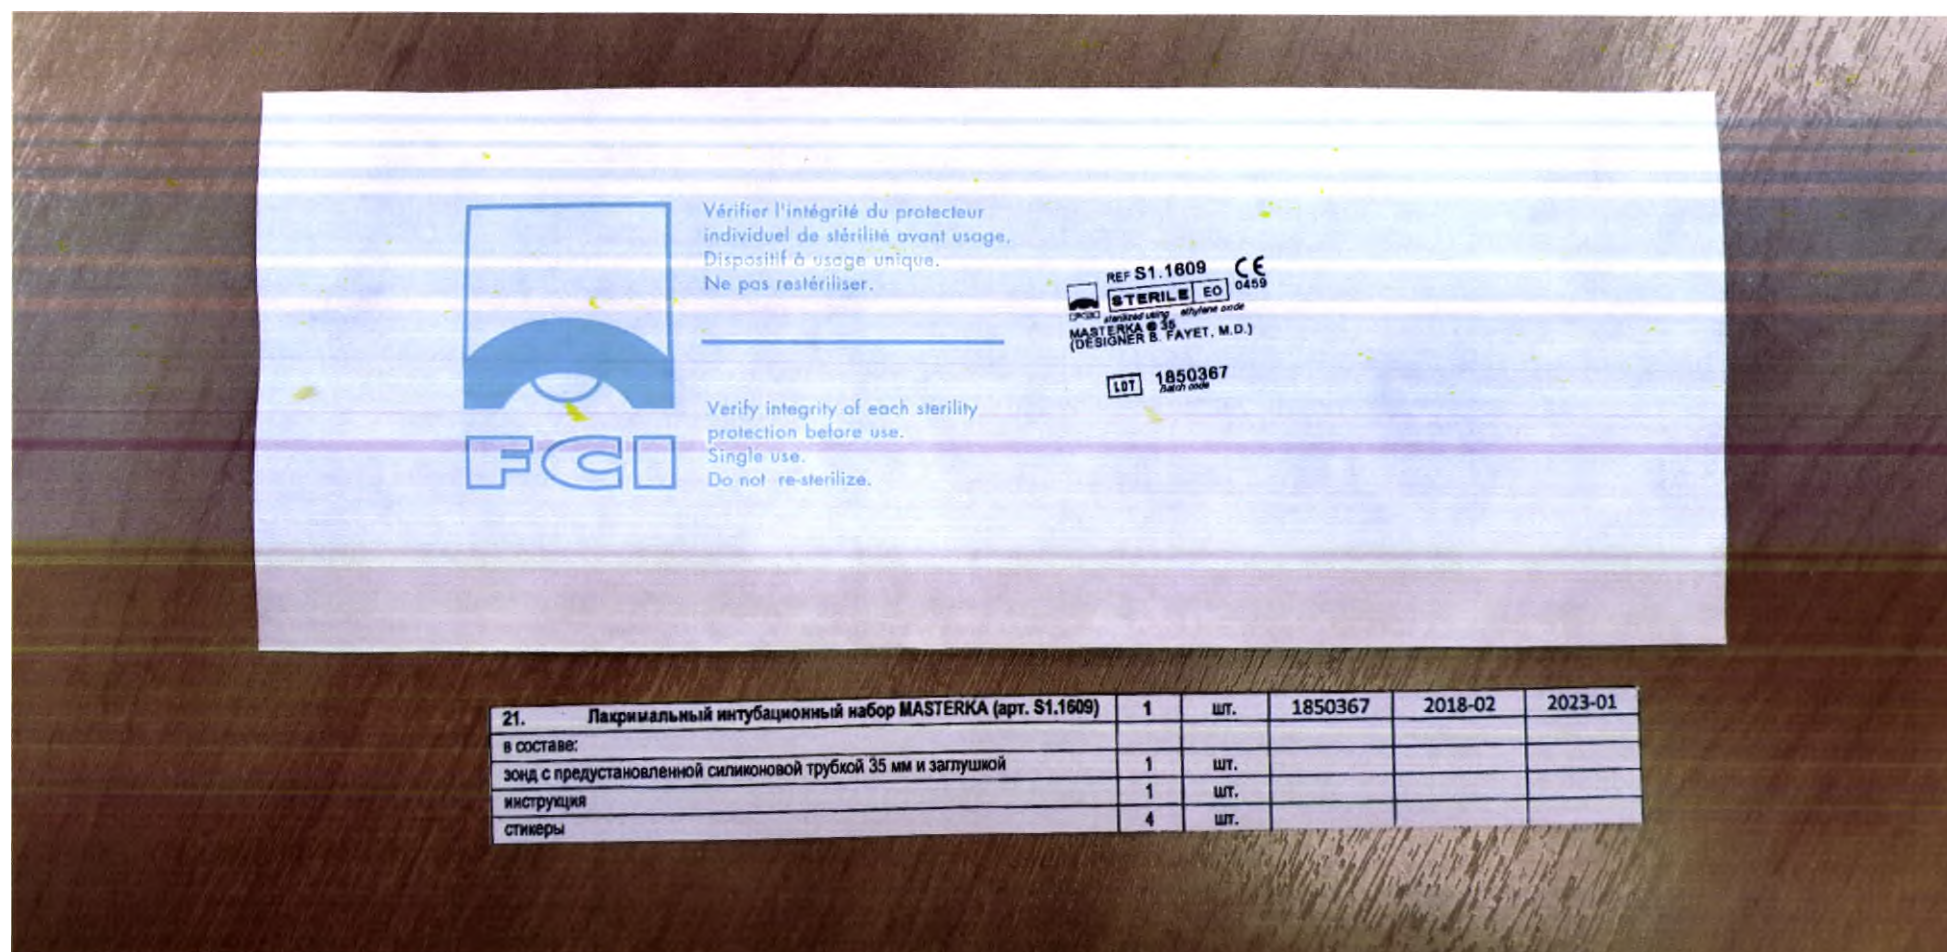


Рисунок 154 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1609

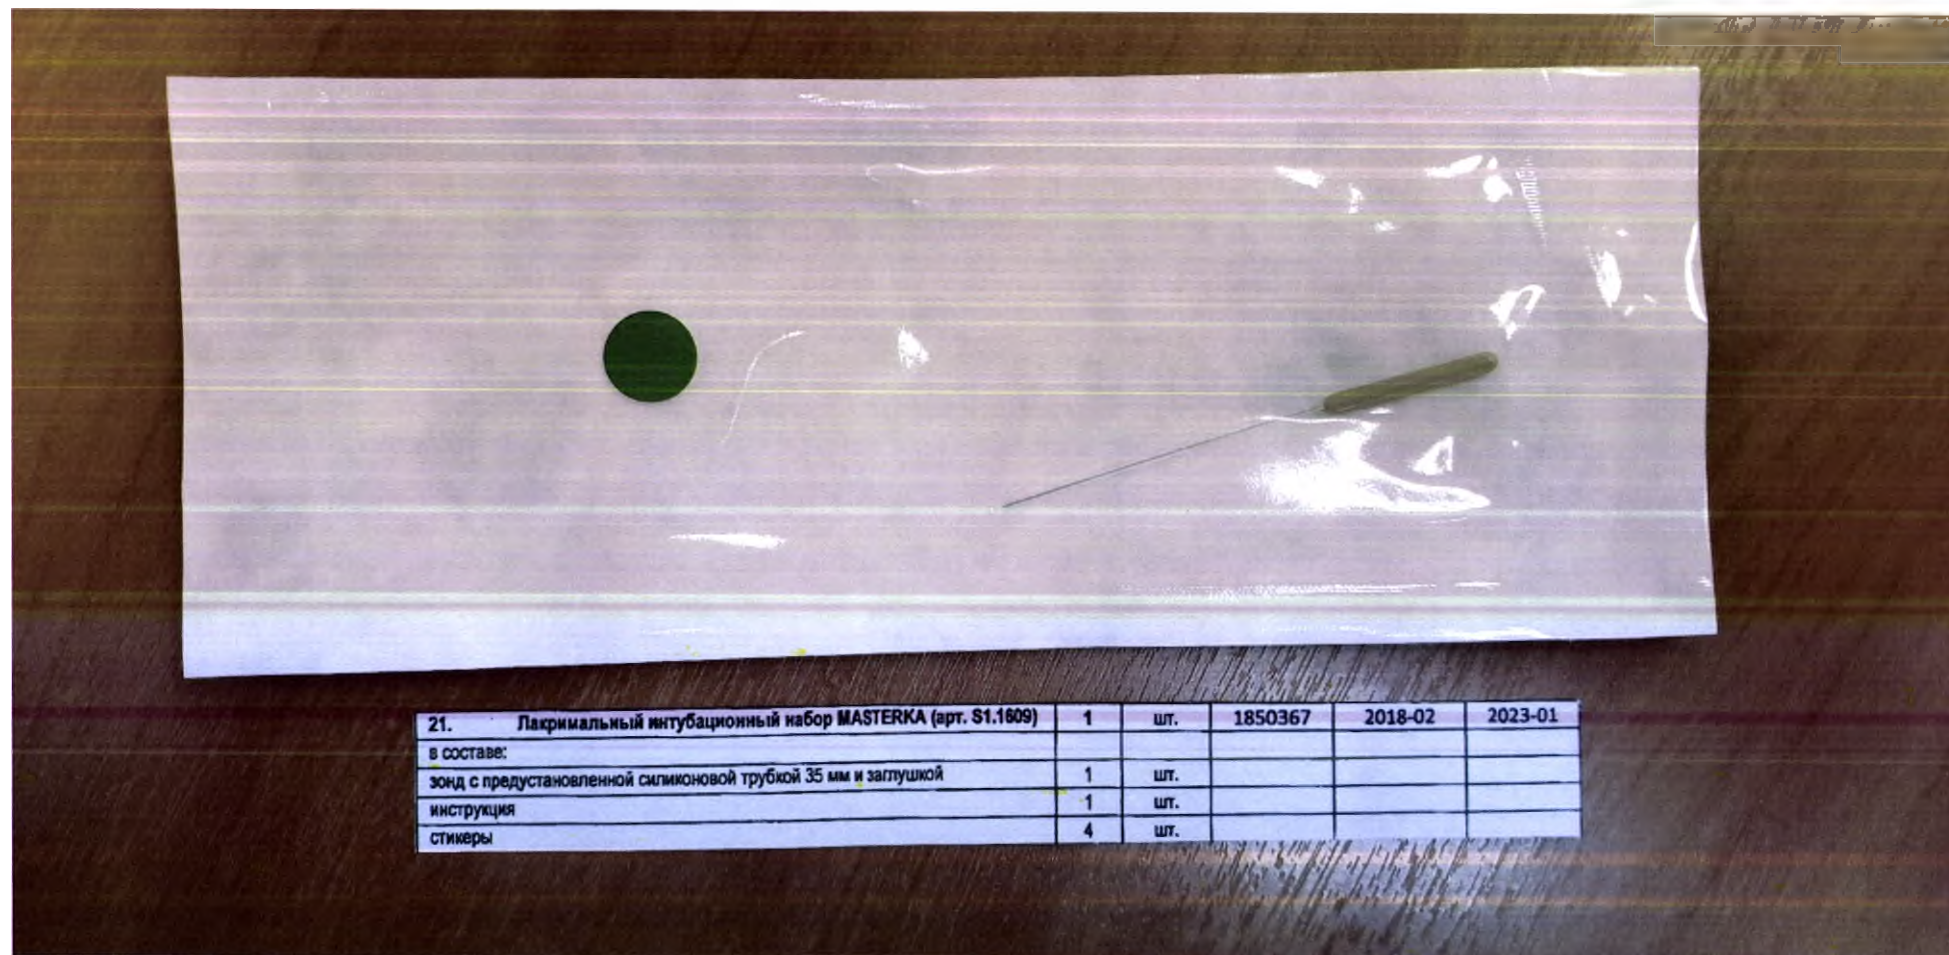


Рисунок 155 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1609

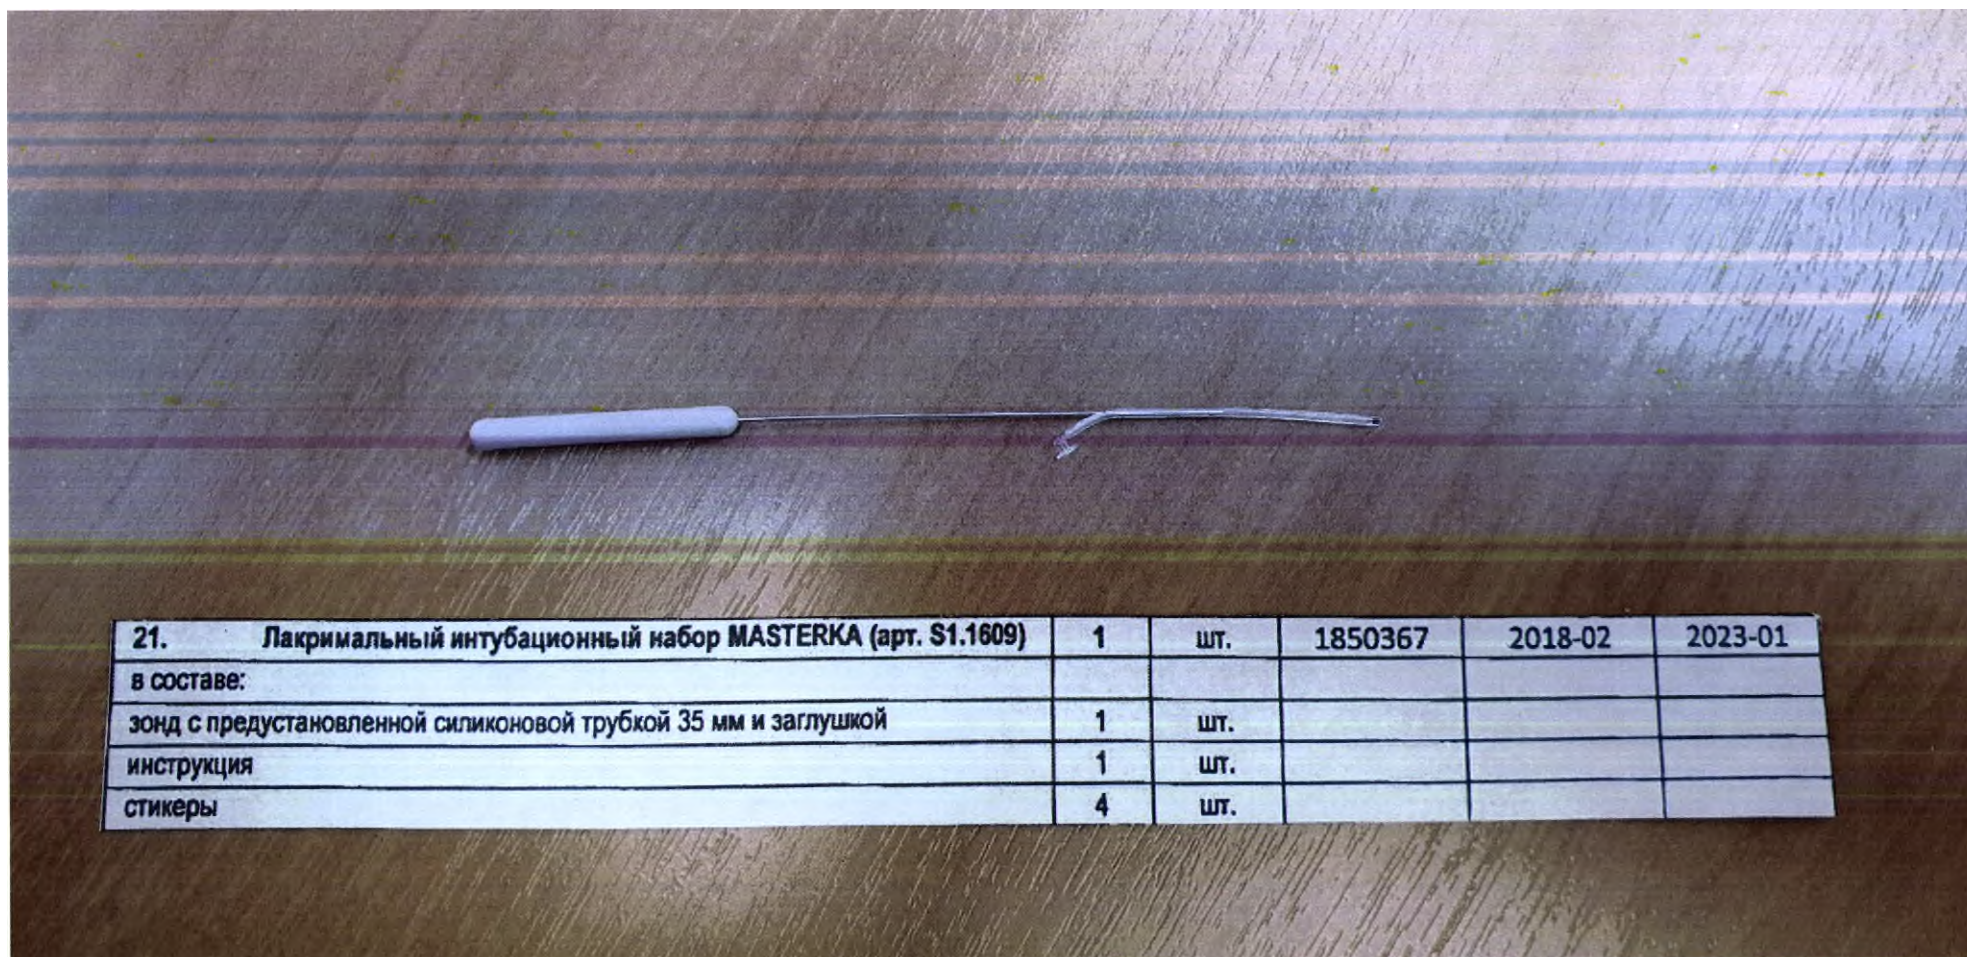


Рисунок 156 – Лакримальный интубационный набор MASTERKA, арт. S1.1609

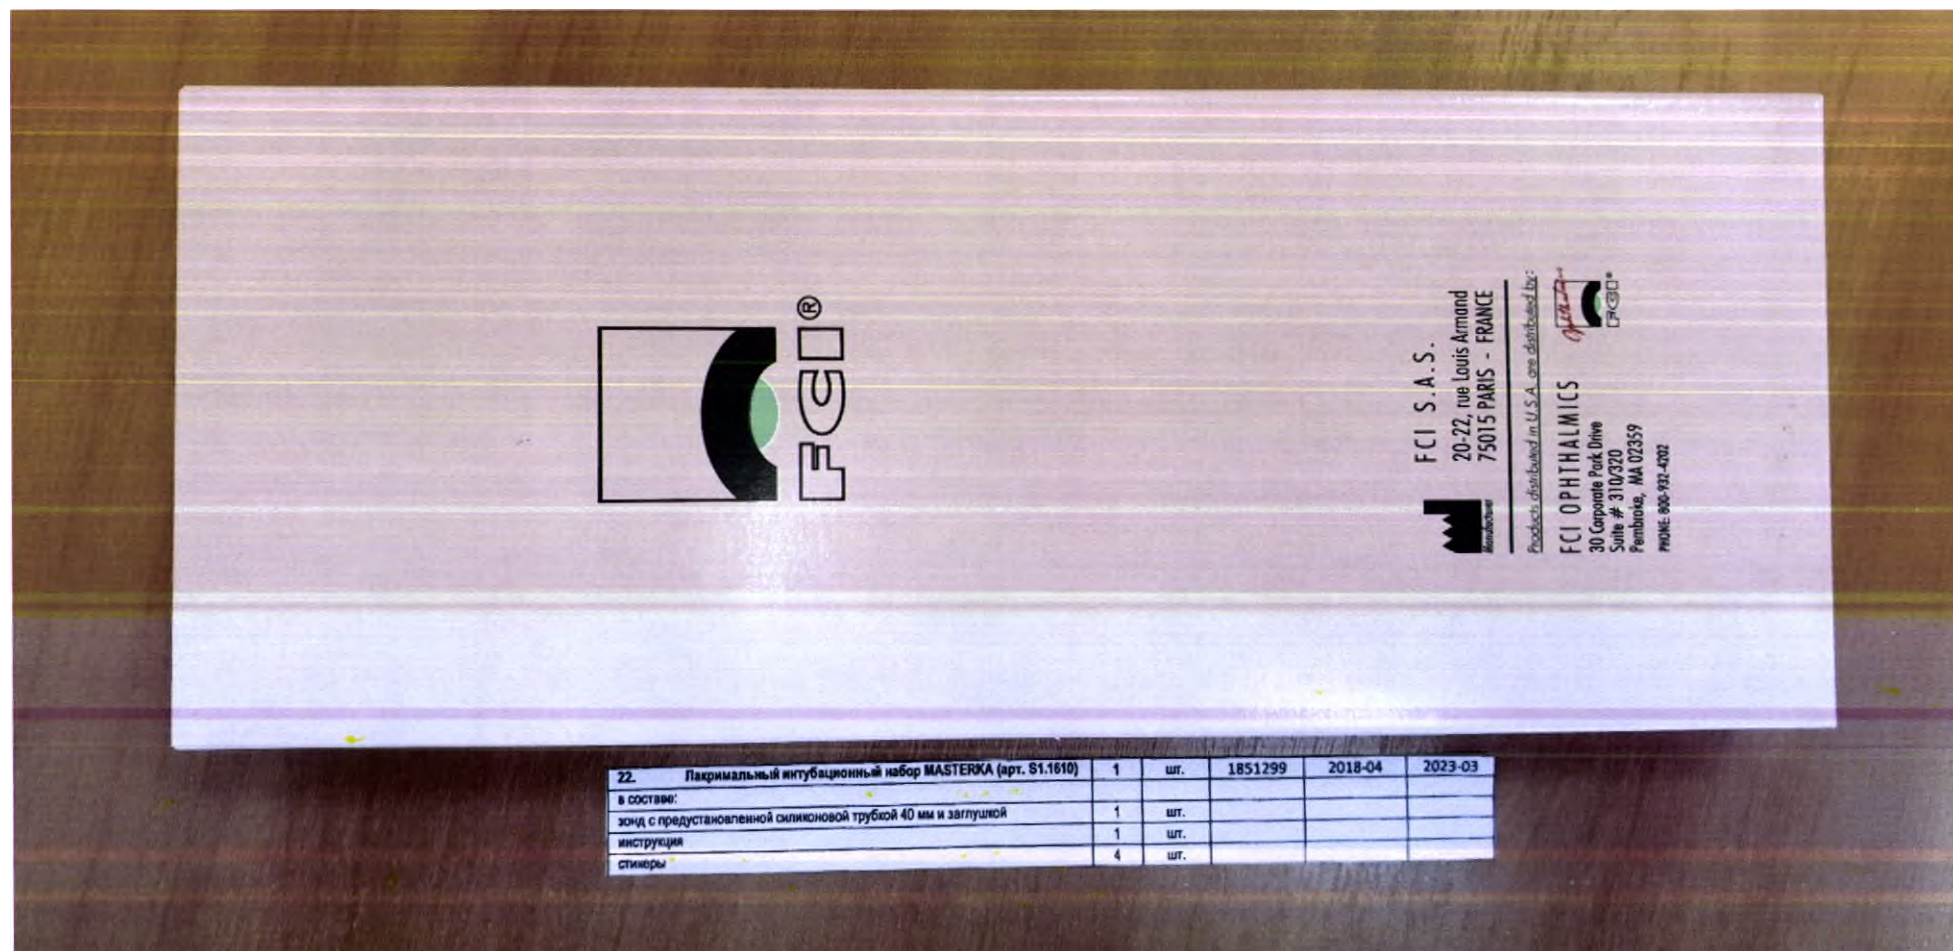


Рисунок 157 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1610

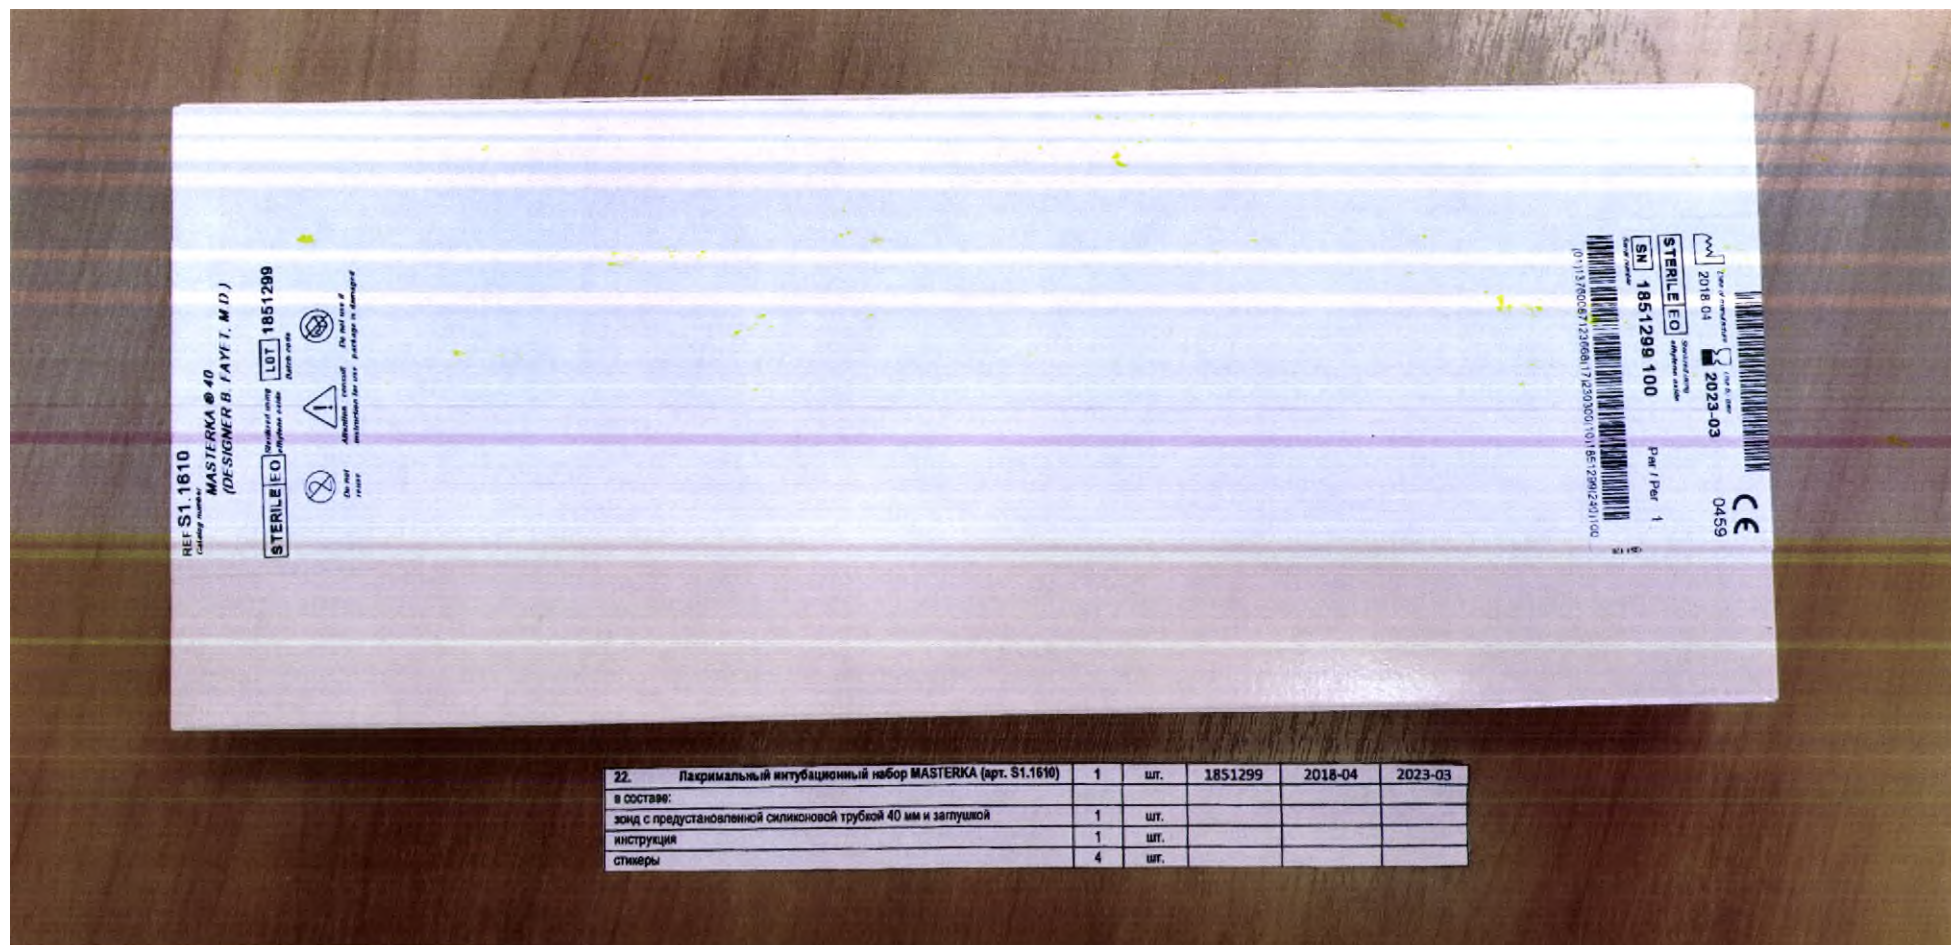


Рисунок 158 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1610



22.	Лакримальный катетеризационный набор MASTERKA (арт. S1.1610)	1	шт.	1851299	2018-04	2023-03
в составе:						
конд с предустановленной силиконовой трубкой 40 мм и заглушкой		1	шт.			
инструкция		1	шт.			
стикеры		4	шт.			

Рисунок 160 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1610


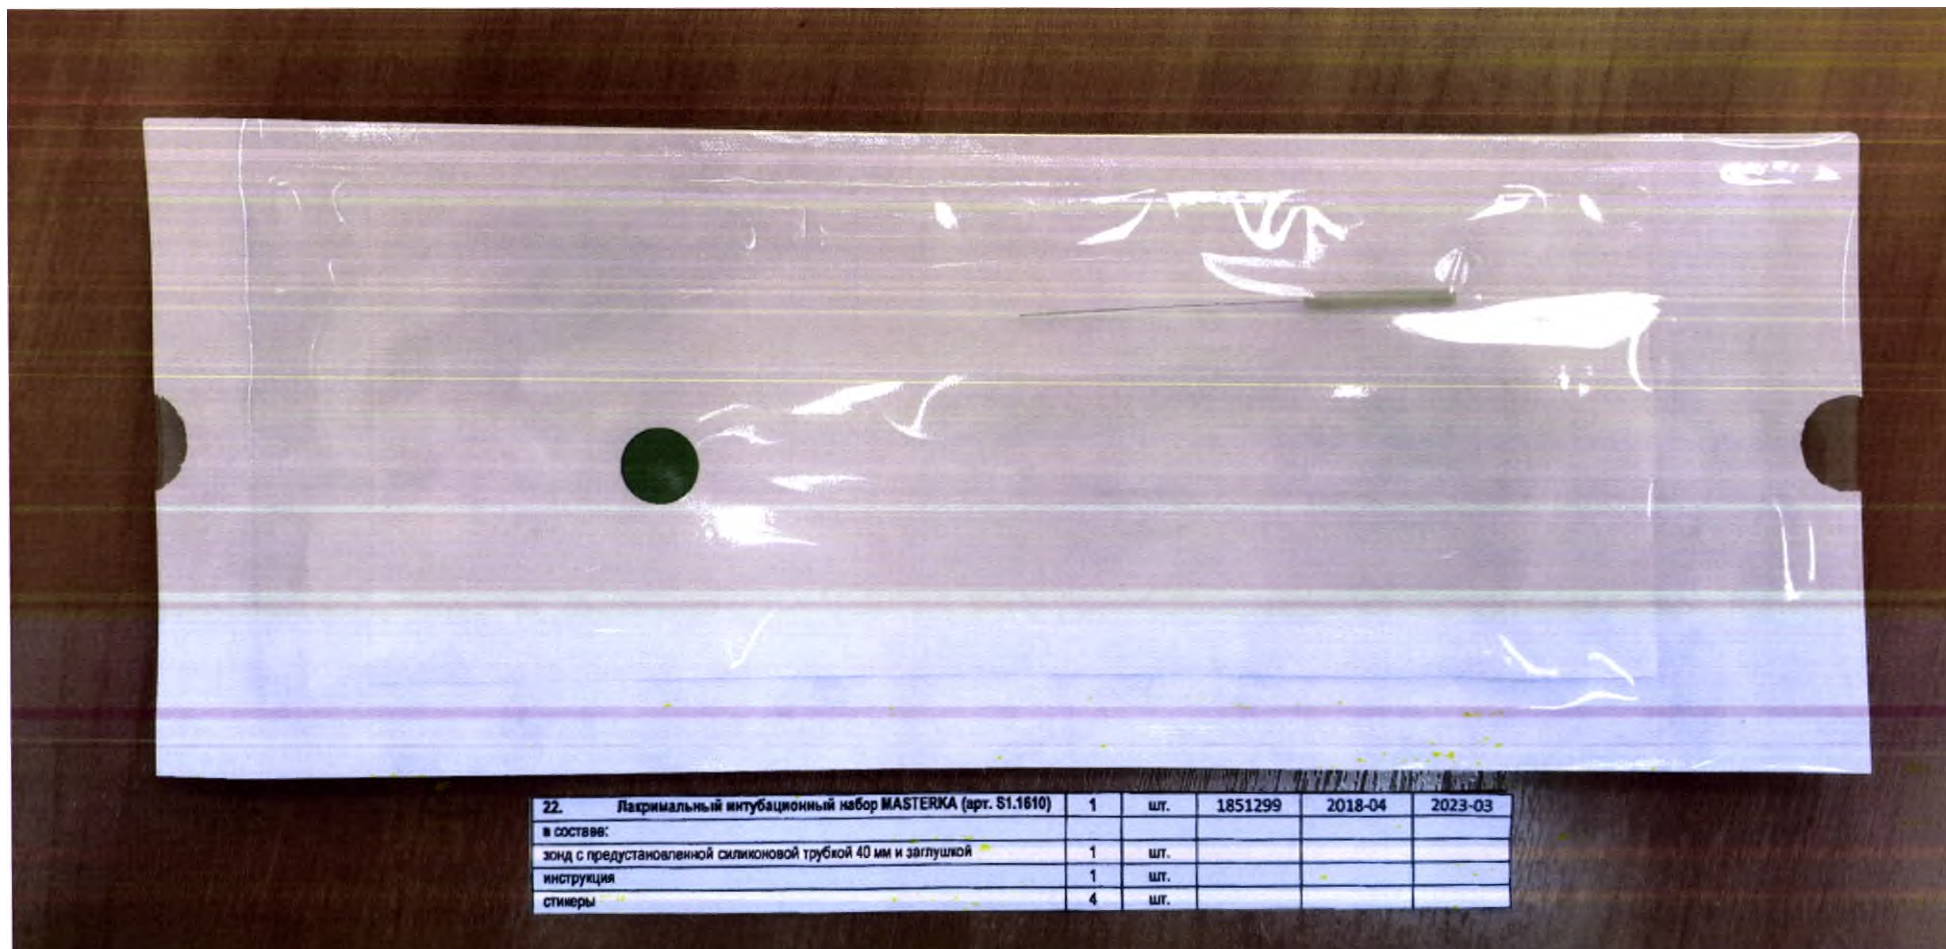


Рисунок 161 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1610

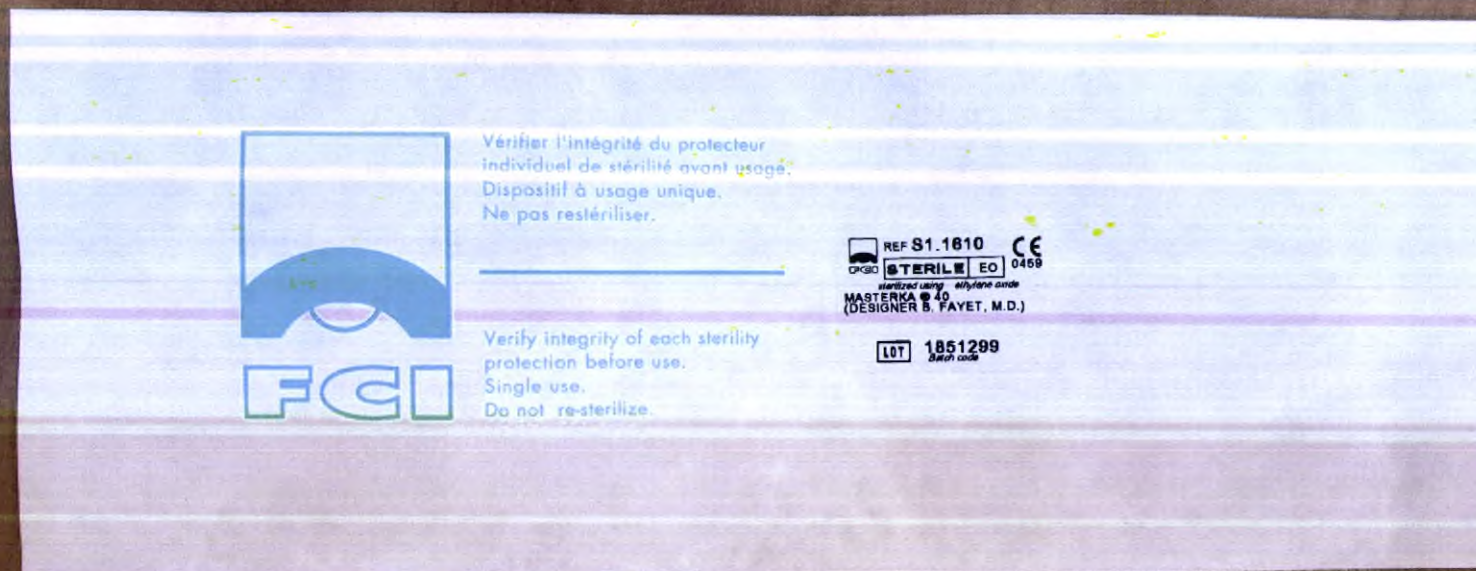

22.	Лакримальный интубационный набор MASTERKA (арт. S1.1610)	1	шт.	1851299	2018-04	2023-03
в составе:						
	зонд с предустановленной силиконовой трубкой 40 мм и заглушкой	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	4	шт.			

Рисунок 162 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1610

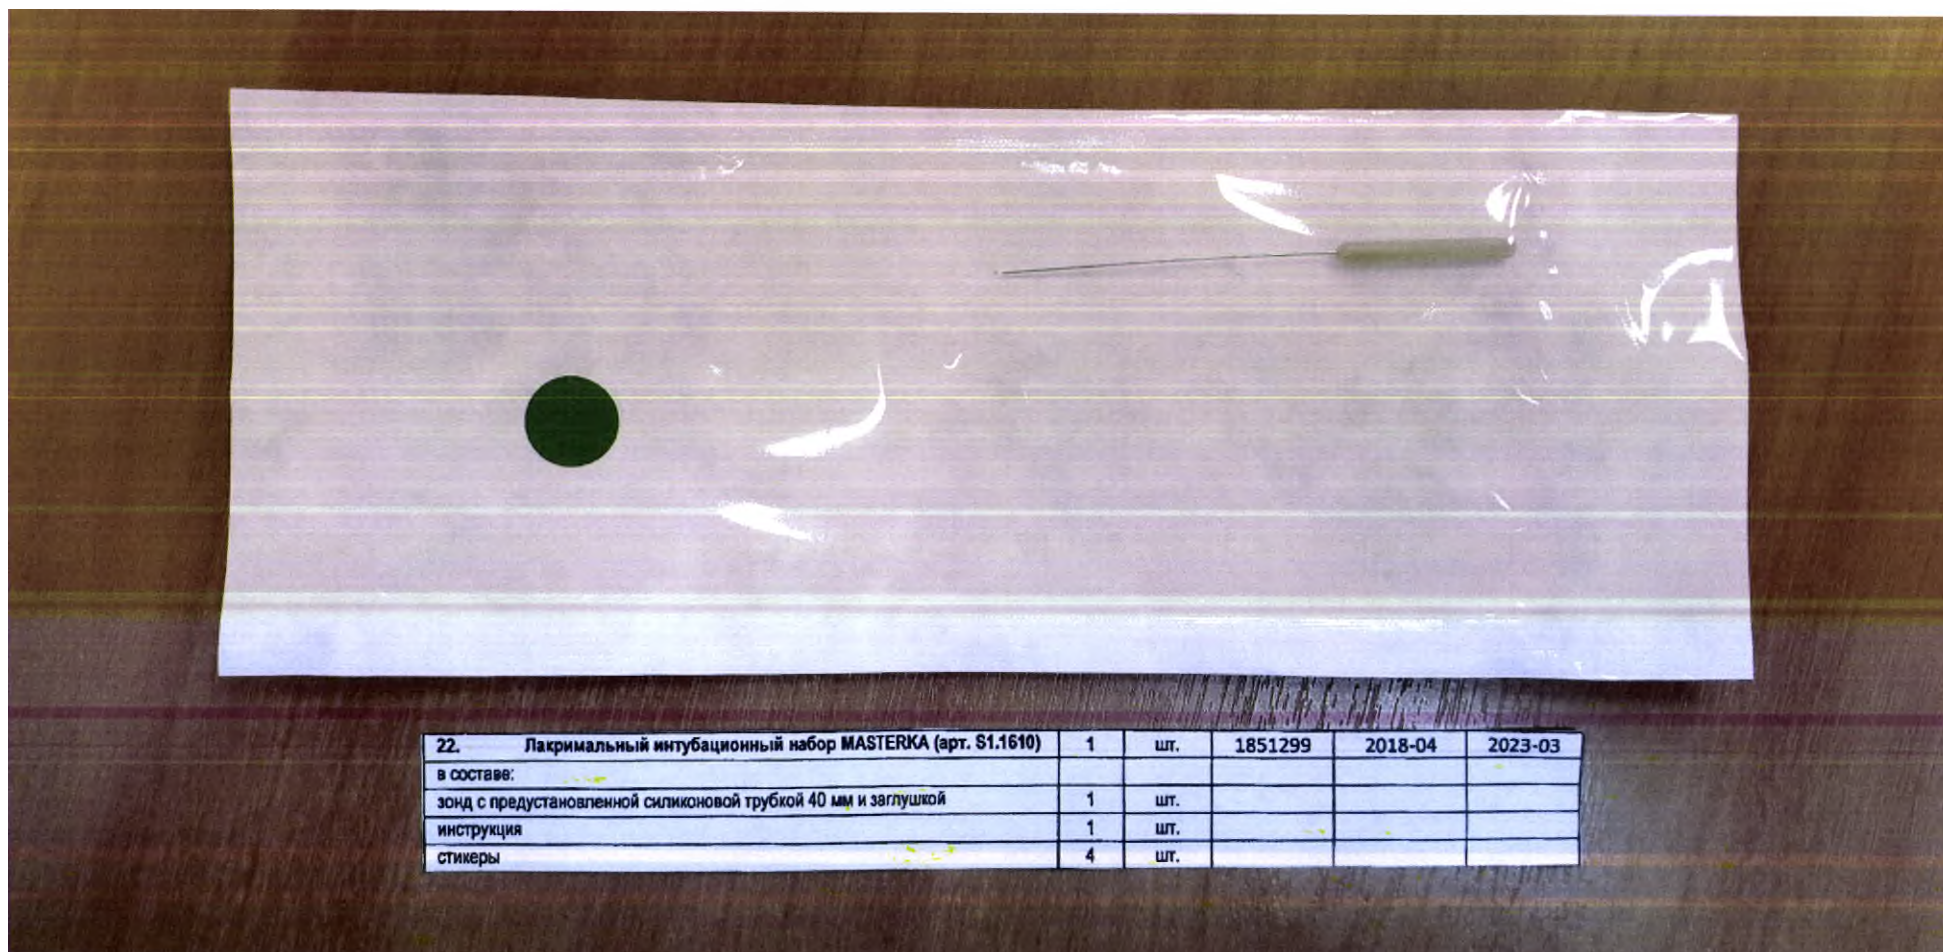


Рисунок 163 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1610

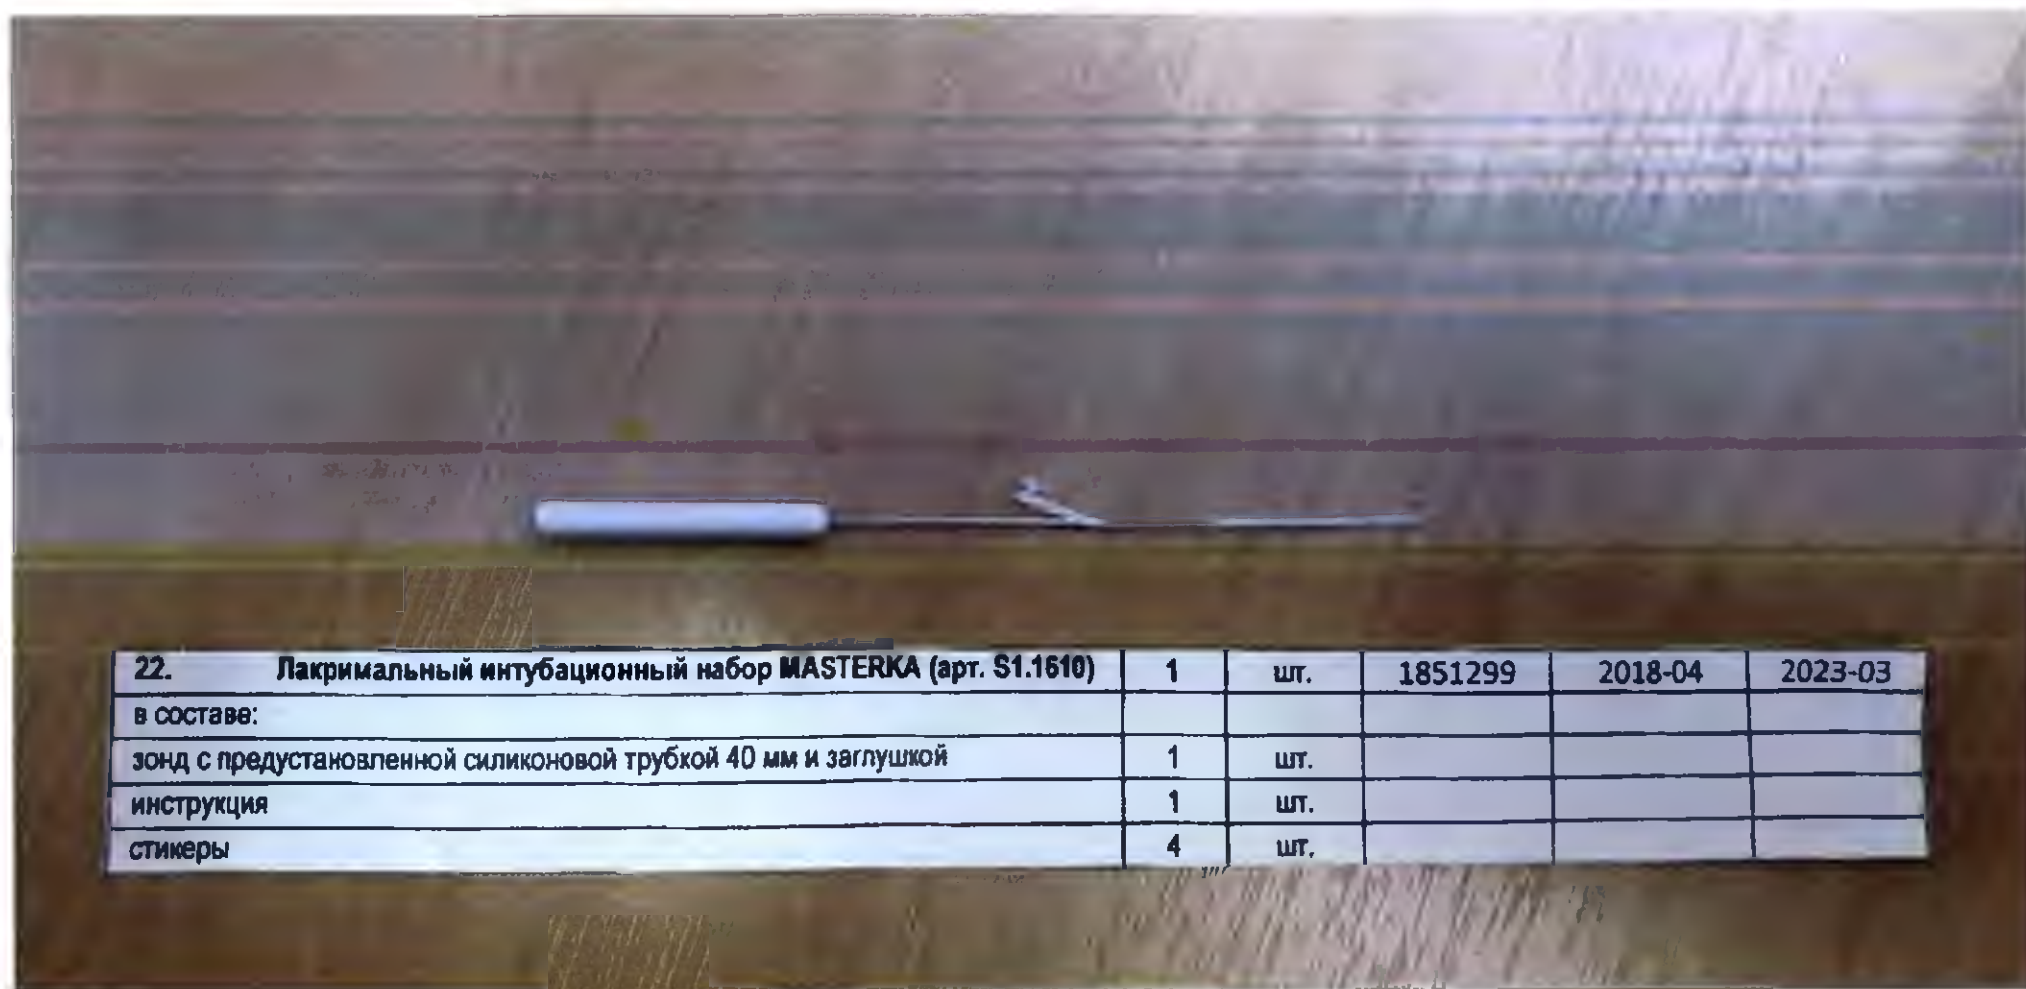


Рисунок 164 – Лакримальный интубационный набор MASTERKA, арт. S1.1610

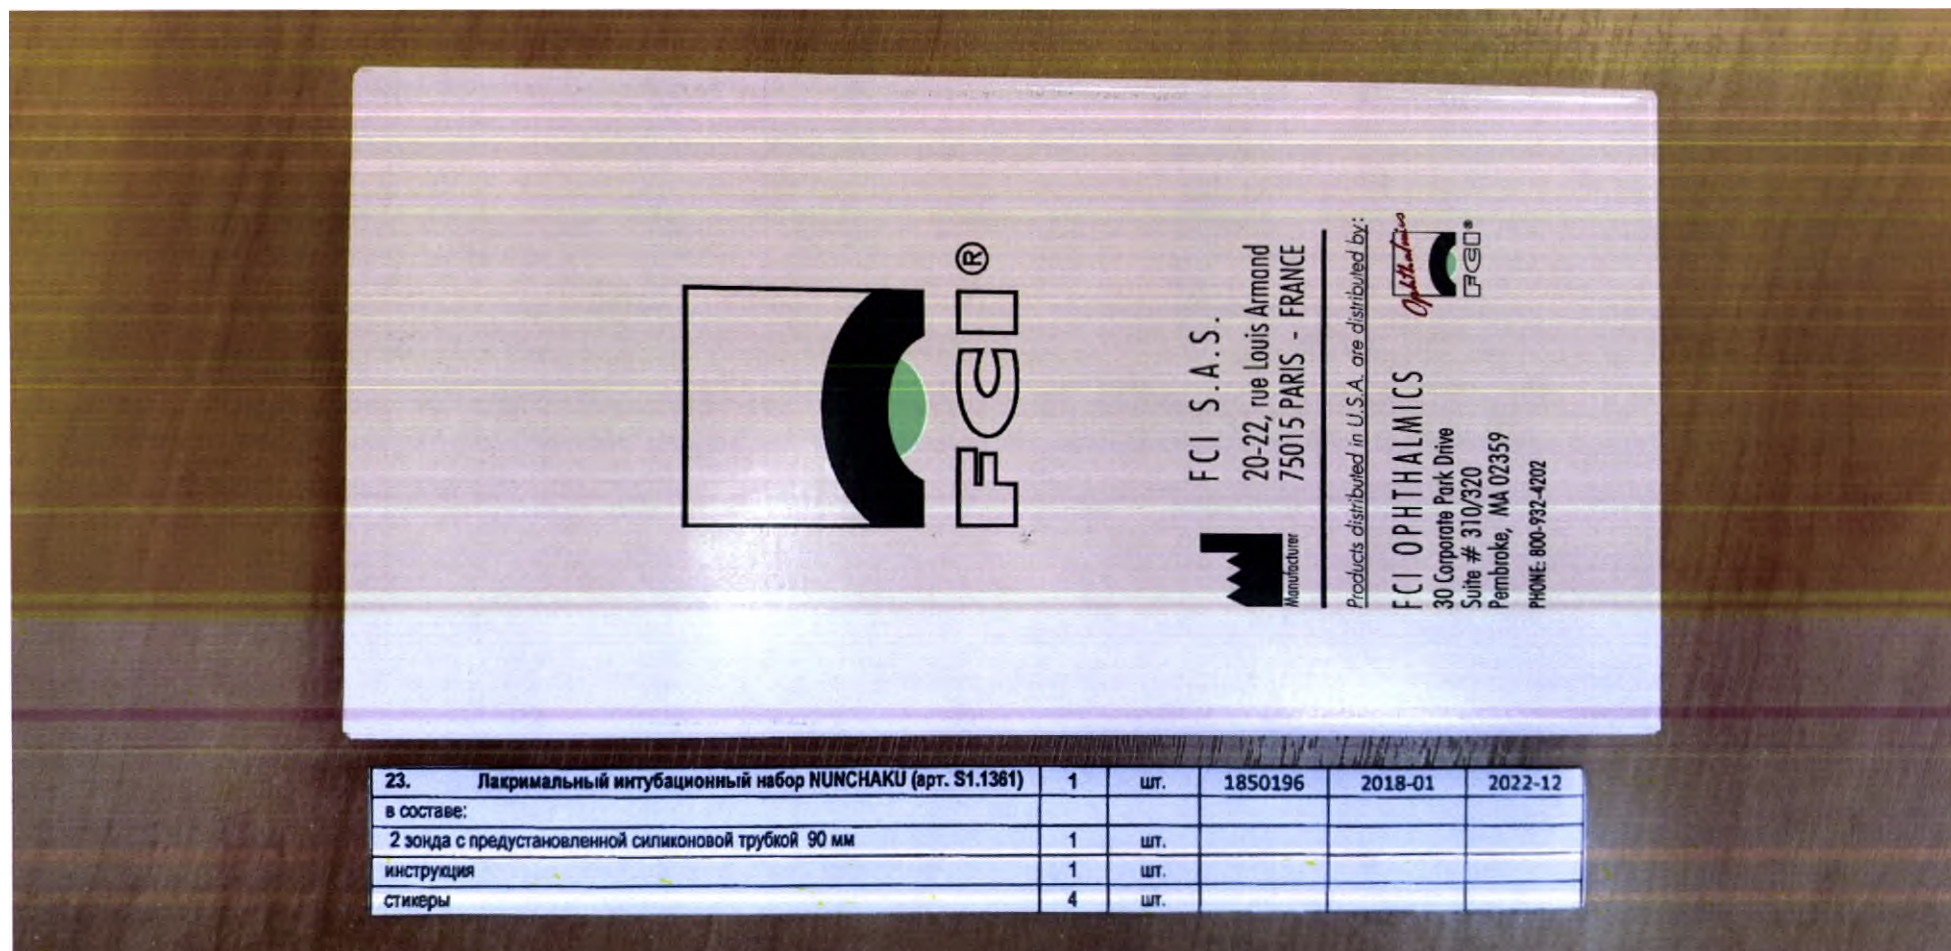


Рисунок 165 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1361


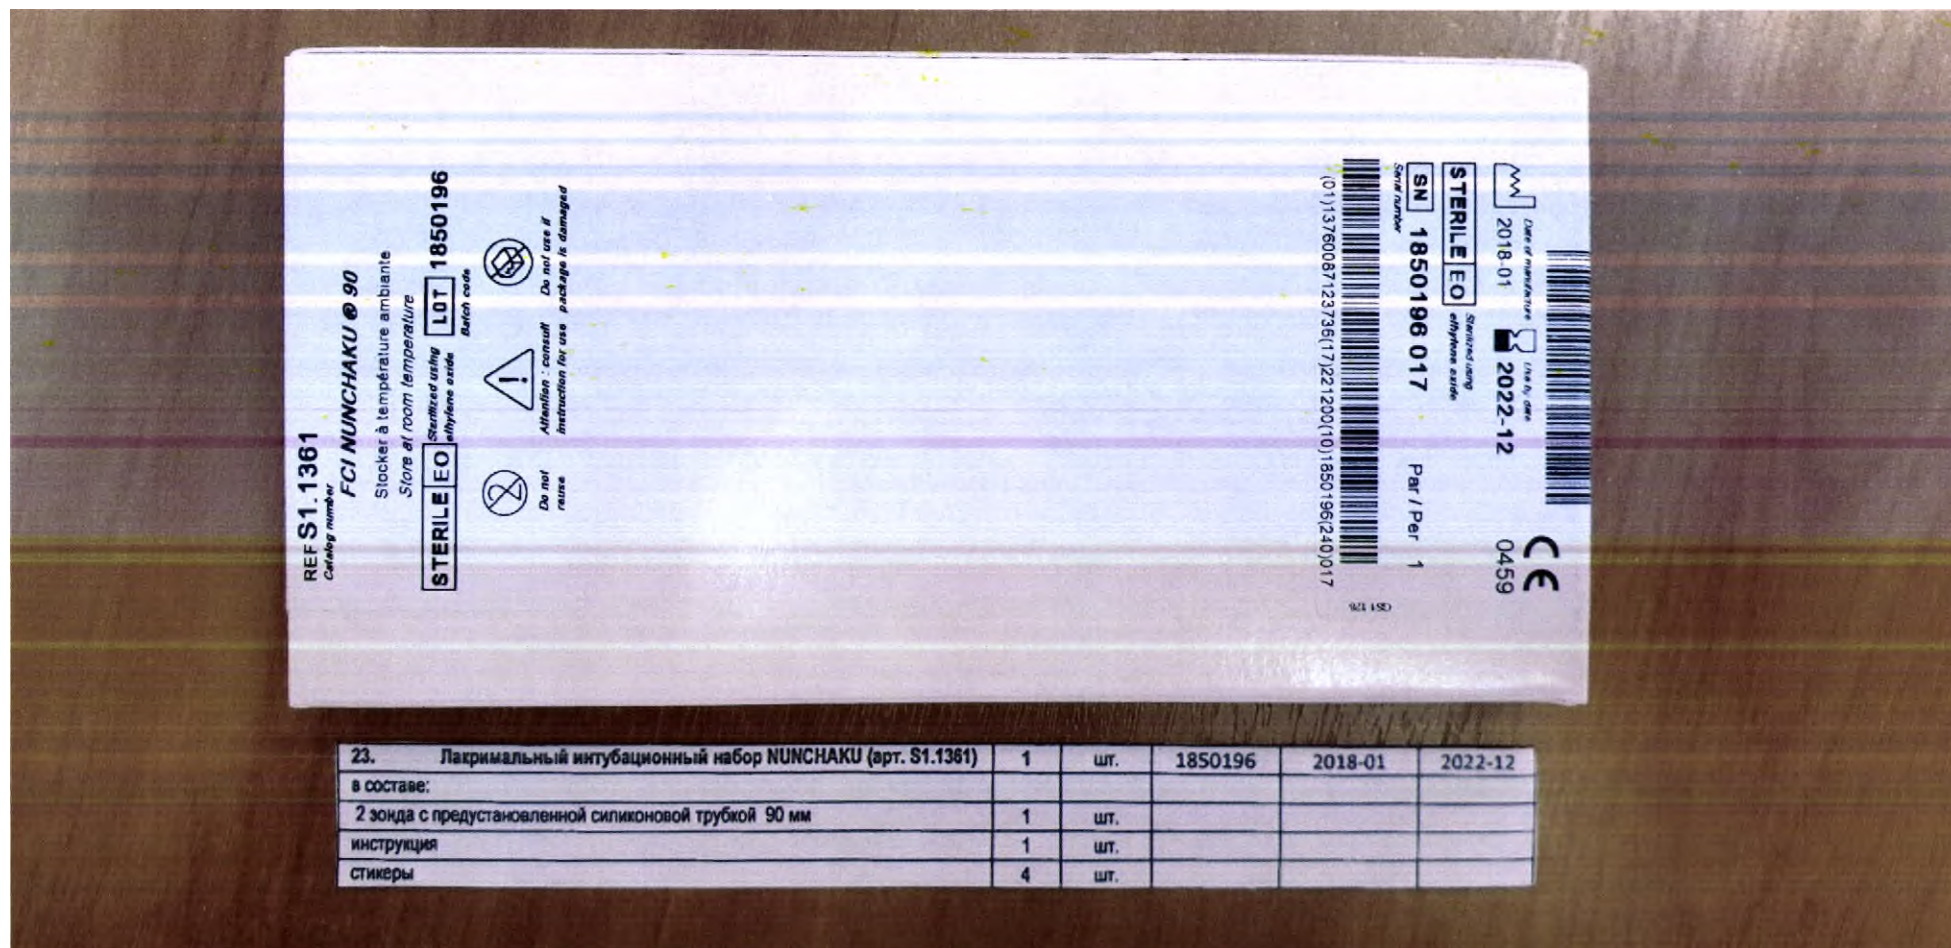


Рисунок 166 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1361



Рисунок 167 – Комплектность арт. S1.1361

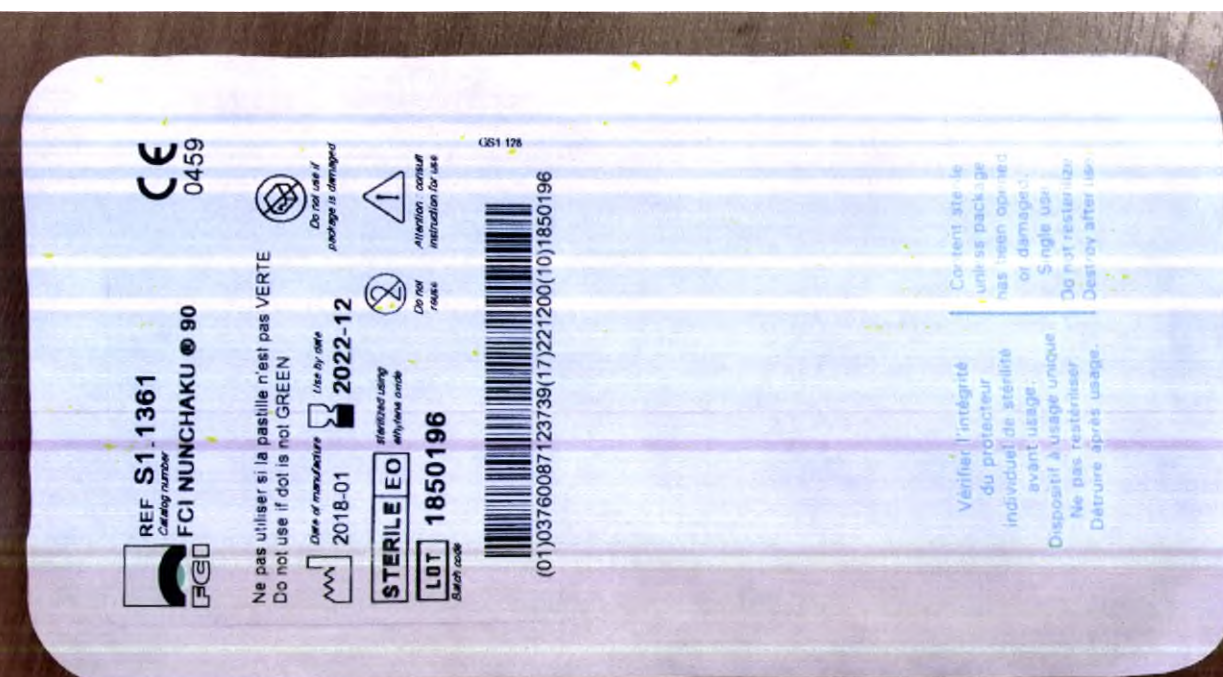

23.	Лакримальный интубационный набор NUNCHAKU (арт. S1.1361)	1	шт.	1850196	2018-01	2022-12
в составе:						
	2 зонда с предустановленной силиконовой трубкой 90 мм	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	4	шт.			

Рисунок 168 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1361

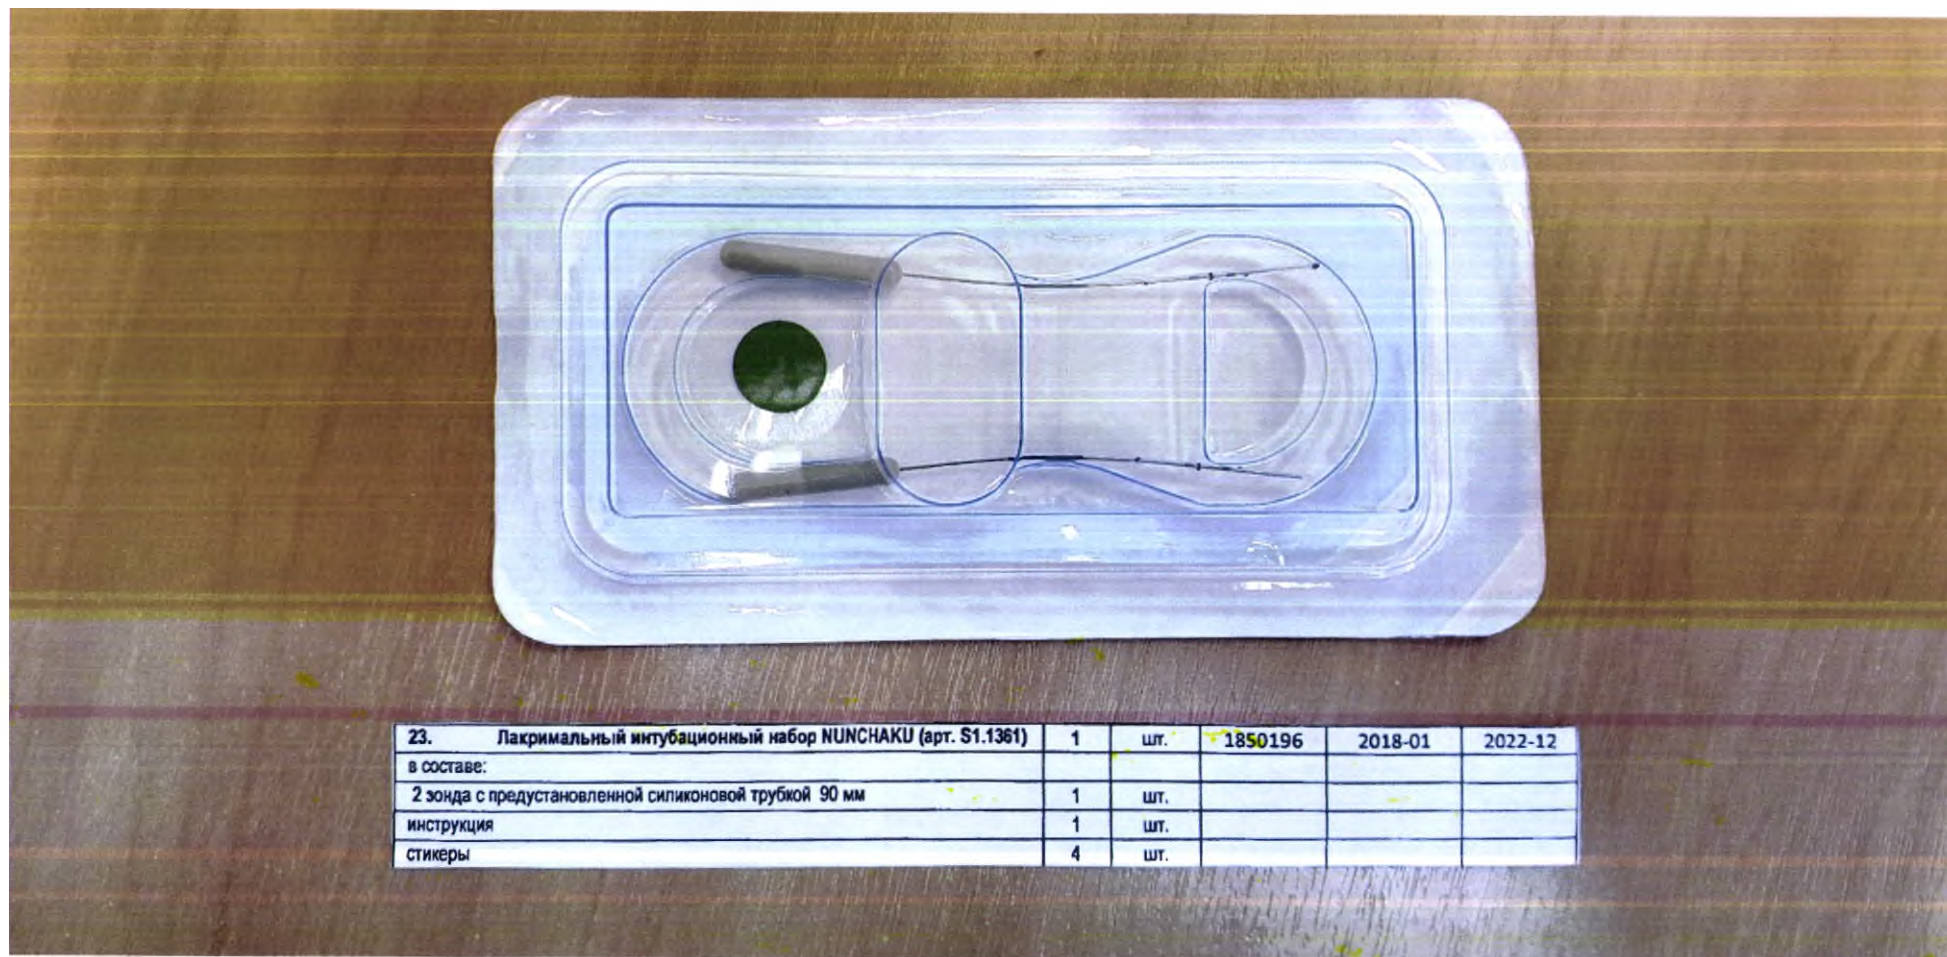


Рисунок 169 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1361

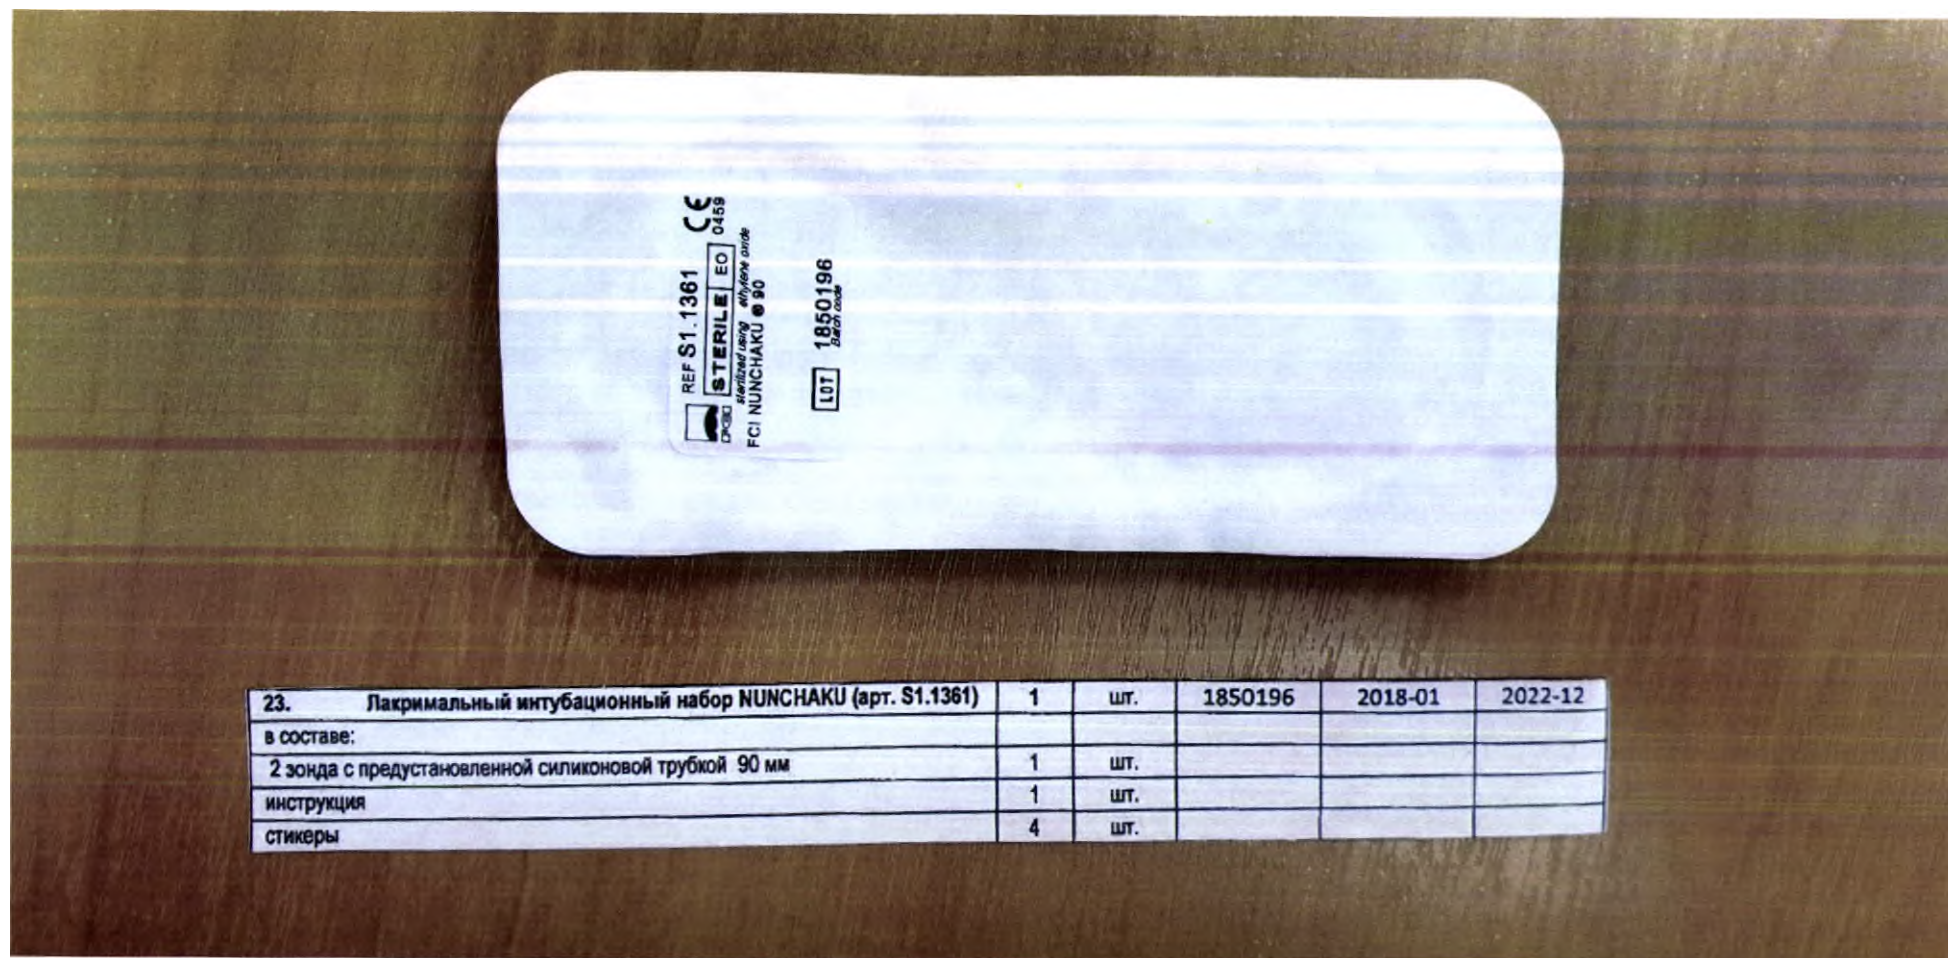


Рисунок 170 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1361

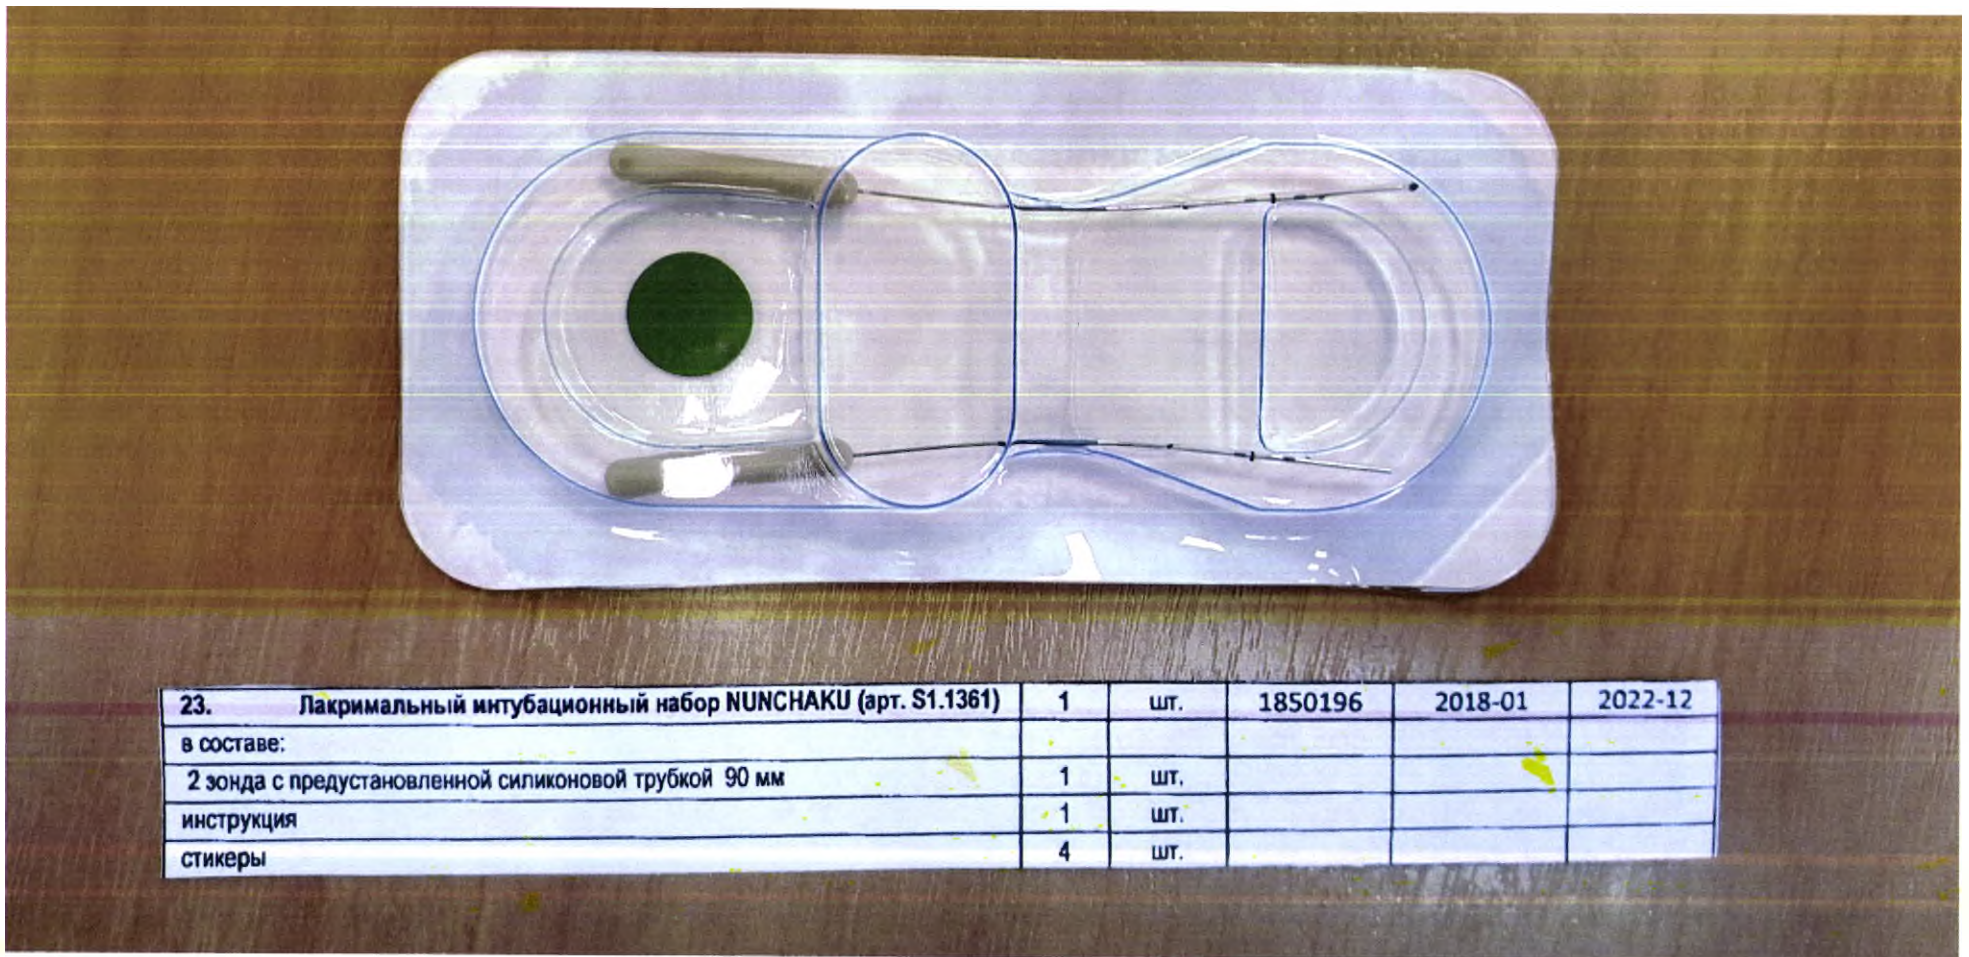


Рисунок 171 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1361

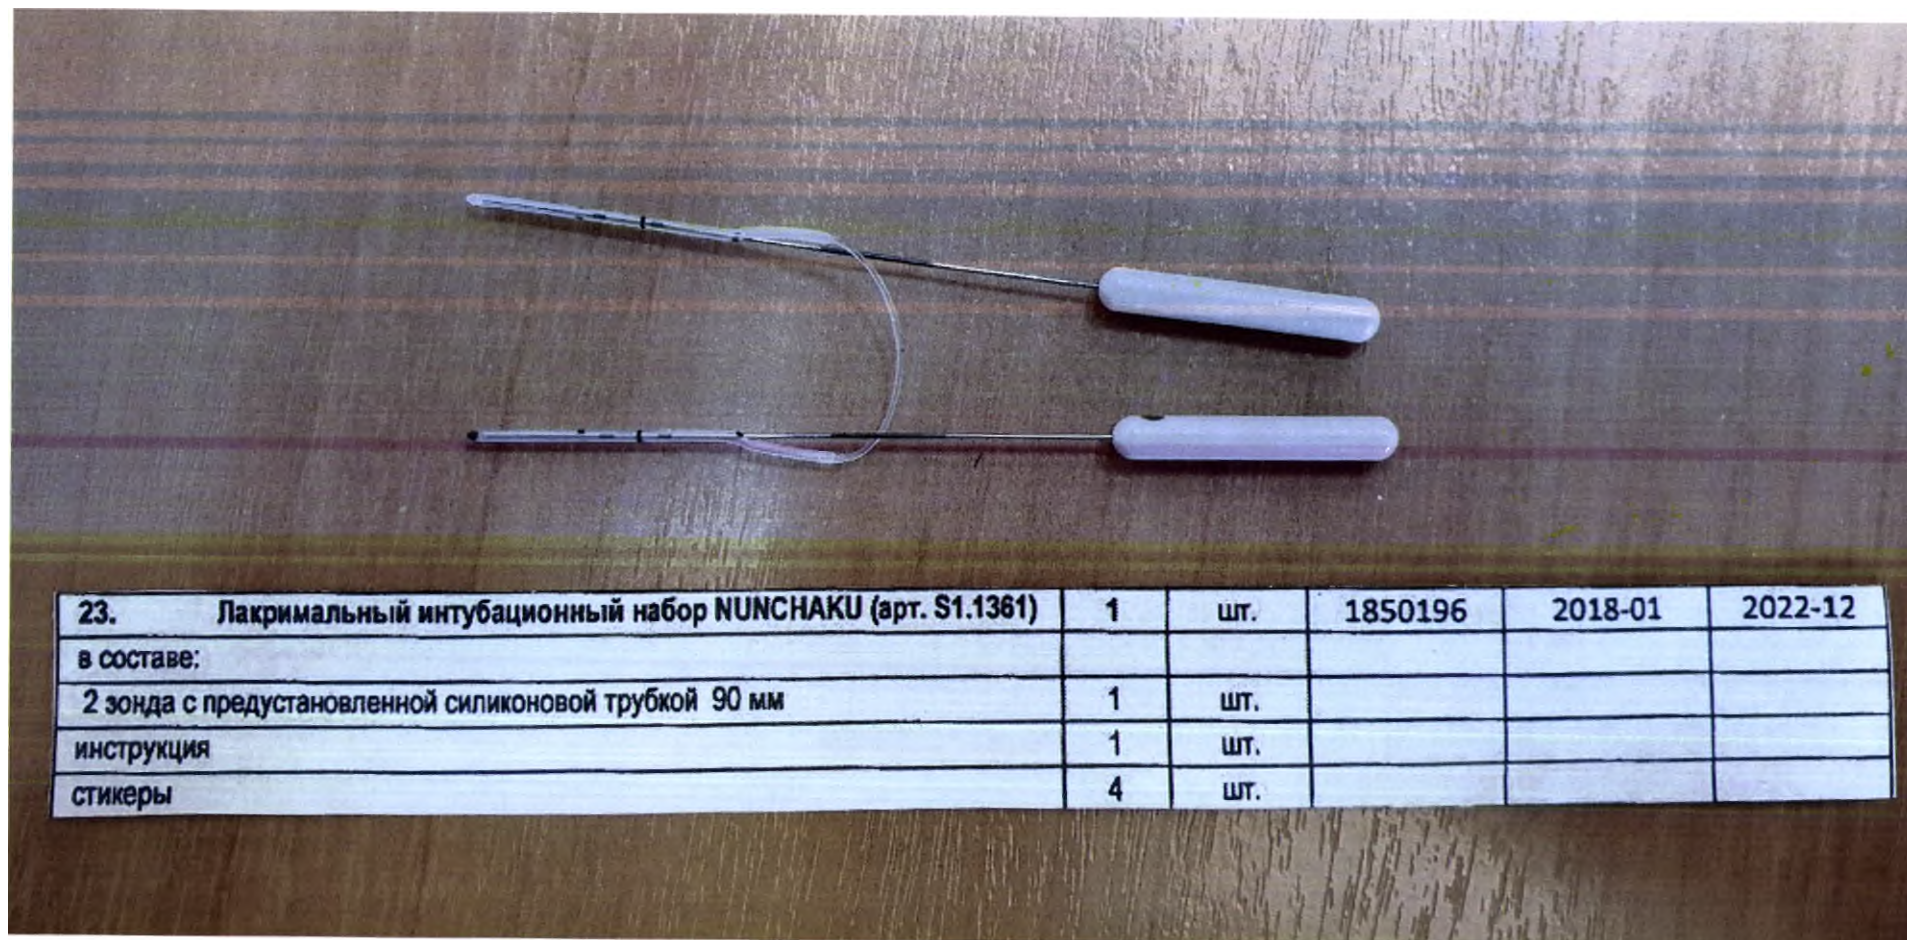


Рисунок 172 – Лакримальный интубационный набор NUNCHAKU, арт. S1.1361



FCI S.A.S.
20-22, rue Louis Armand
75015 PARIS - FRANCE

Products distributed in U.S.A. are distributed by:

FCI OPHTHALMICS
30 Corporate Park Drive
Suite # 310/320
Pembroke, MA 02359
PHONE: 800-932-4202



24.	Пакетный набор инструментов (арт. S1.1371)	1	шт.	1851886	2018-05	2023-04
в составе:						
2	зонда с предустановленной силиконовой губкой 105 мм	1	шт.			
инструкция		1	шт.			
стикеры		4	шт.			

Рисунок 173 – Потребительская упаковка (вид спереди) арт. S1.1371



Рисунок 174 – Потребительская упаковка (вид сзади) арт. S1.1371



Рисунок 175 – Комплектность арт. S1.1371


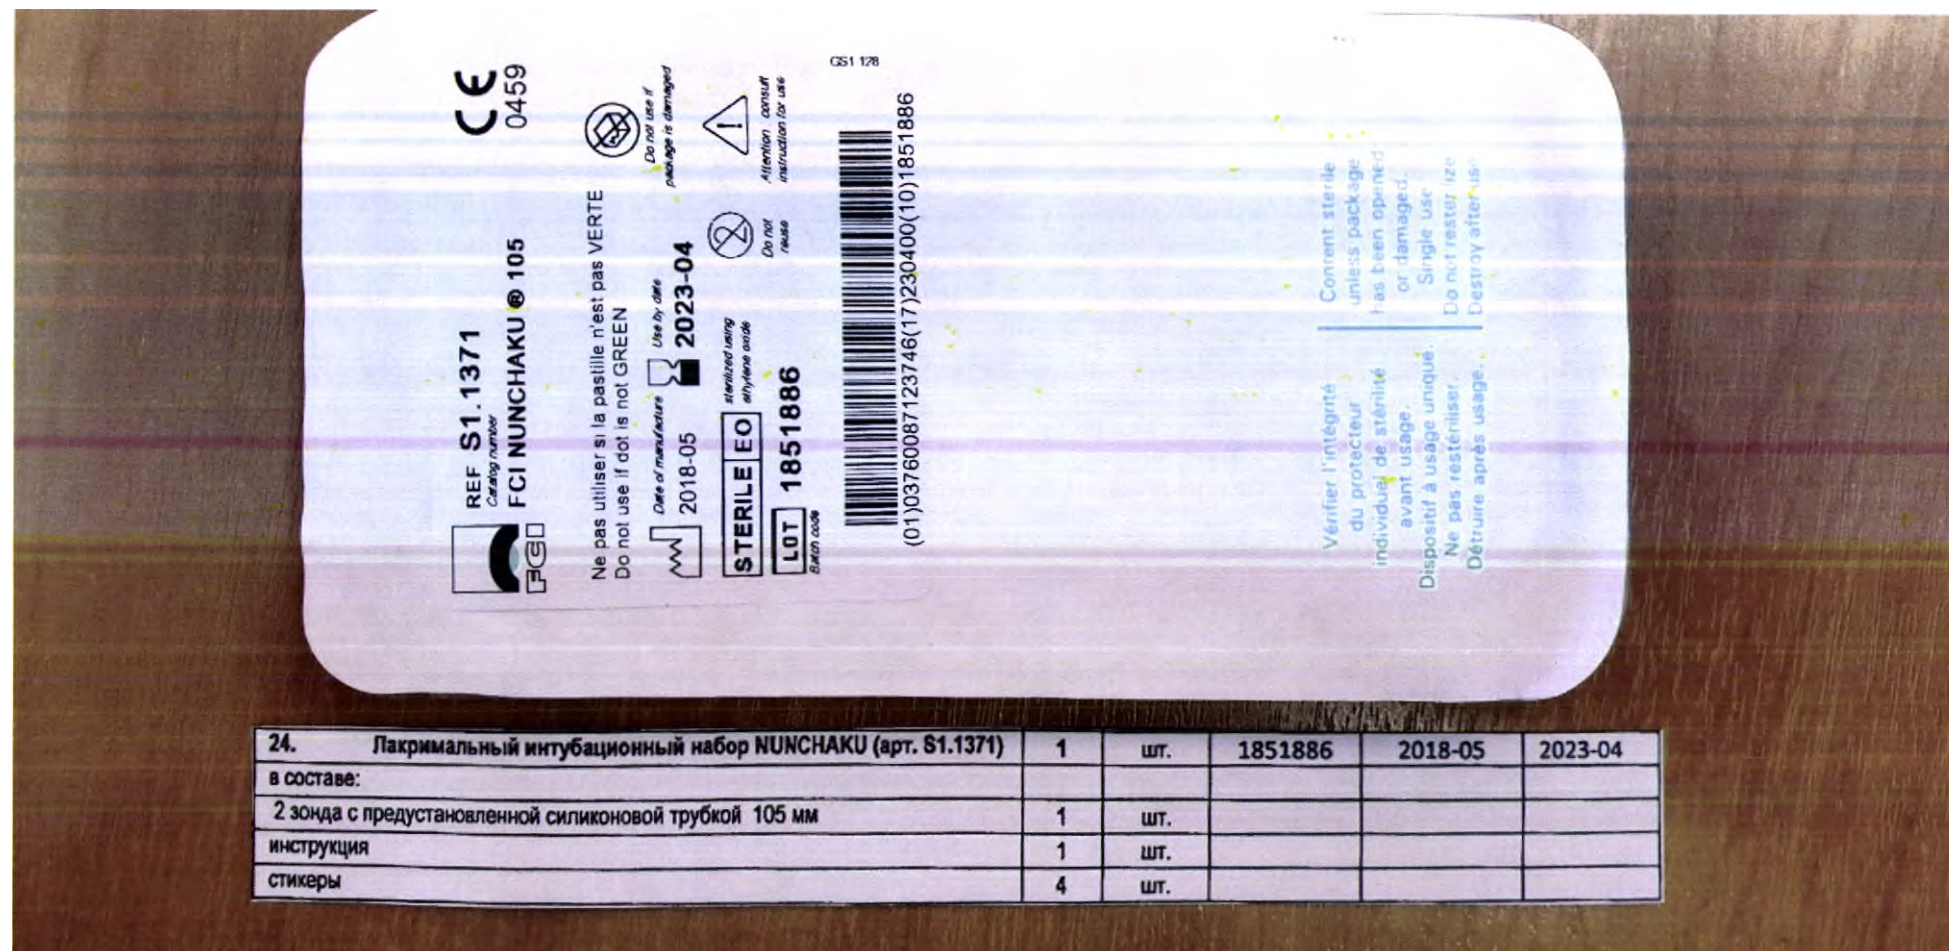


Рисунок 176 – Индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1371



Рисунок 177 – Индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1371

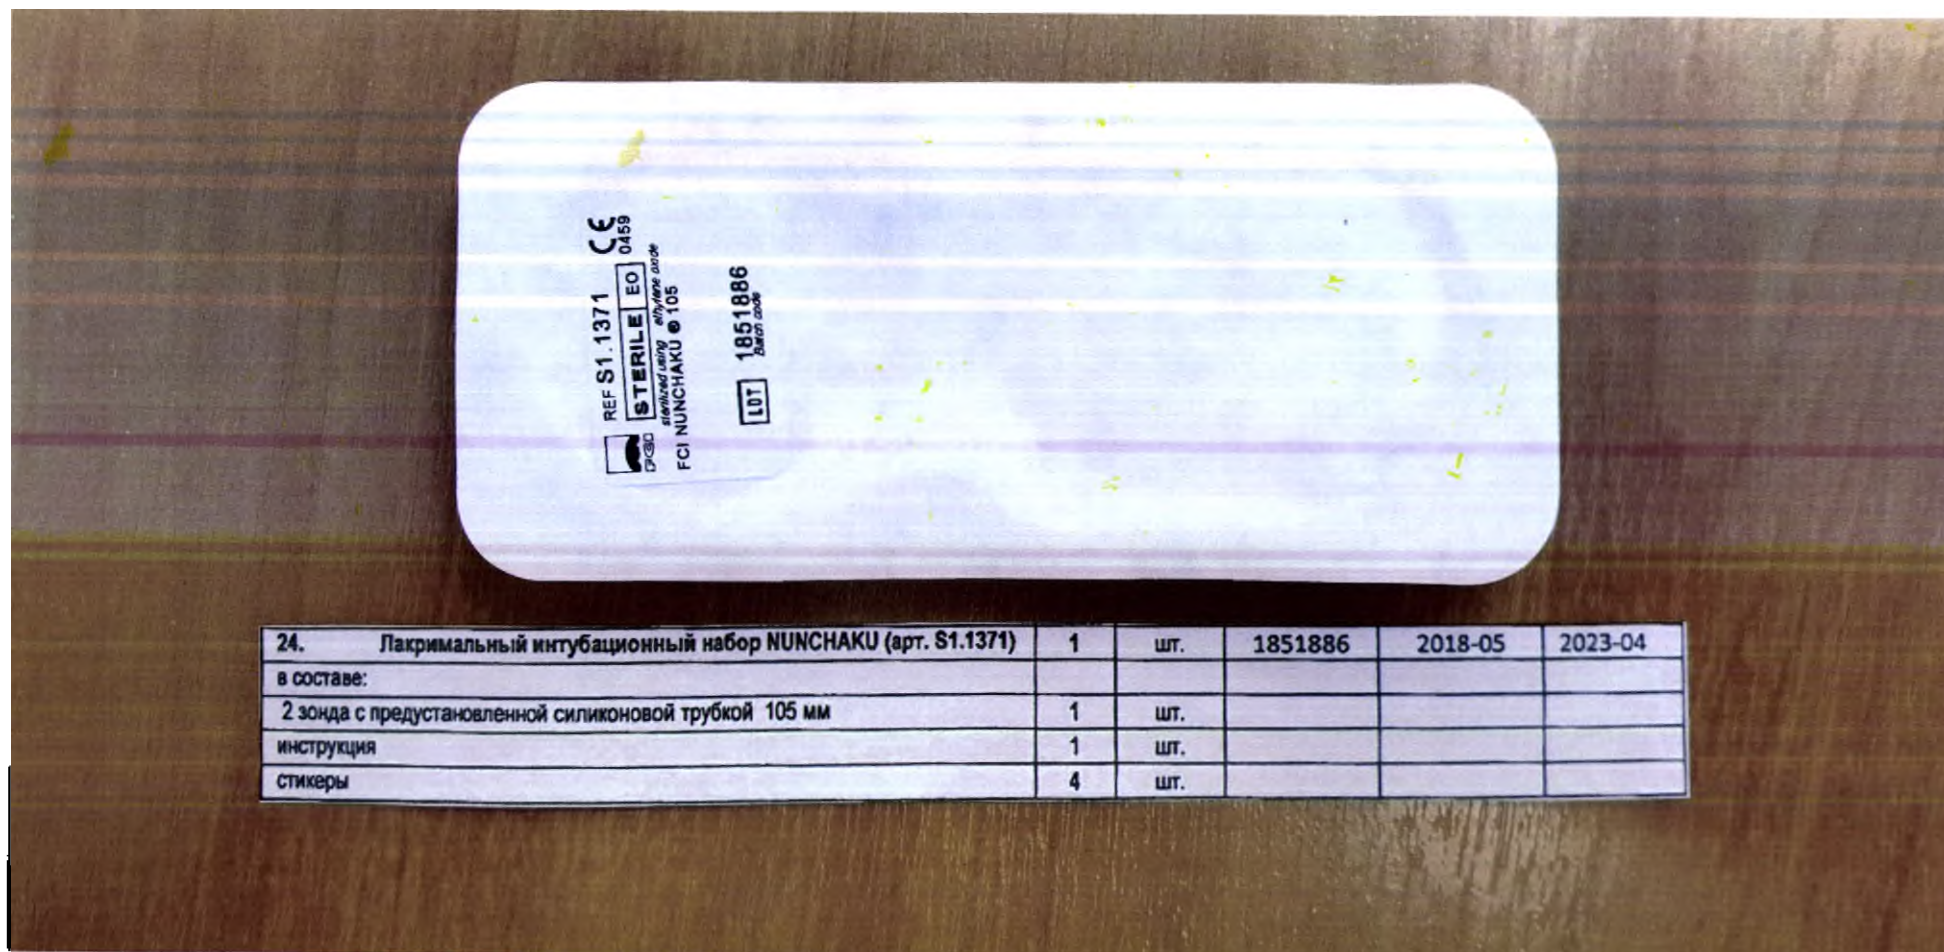

24.	Лакримальный интубационный набор NUNCHAKU (арт. S1.1371)	1	шт.	1851886	2018-05	2023-04
	в составе:					
	2 зонда с предустановленной силиконовой трубкой 105 мм	1	шт.			
	инструкция	1	шт.			
	стикеры	4	шт.			

Рисунок 178 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид сзади) арт. S1.1371

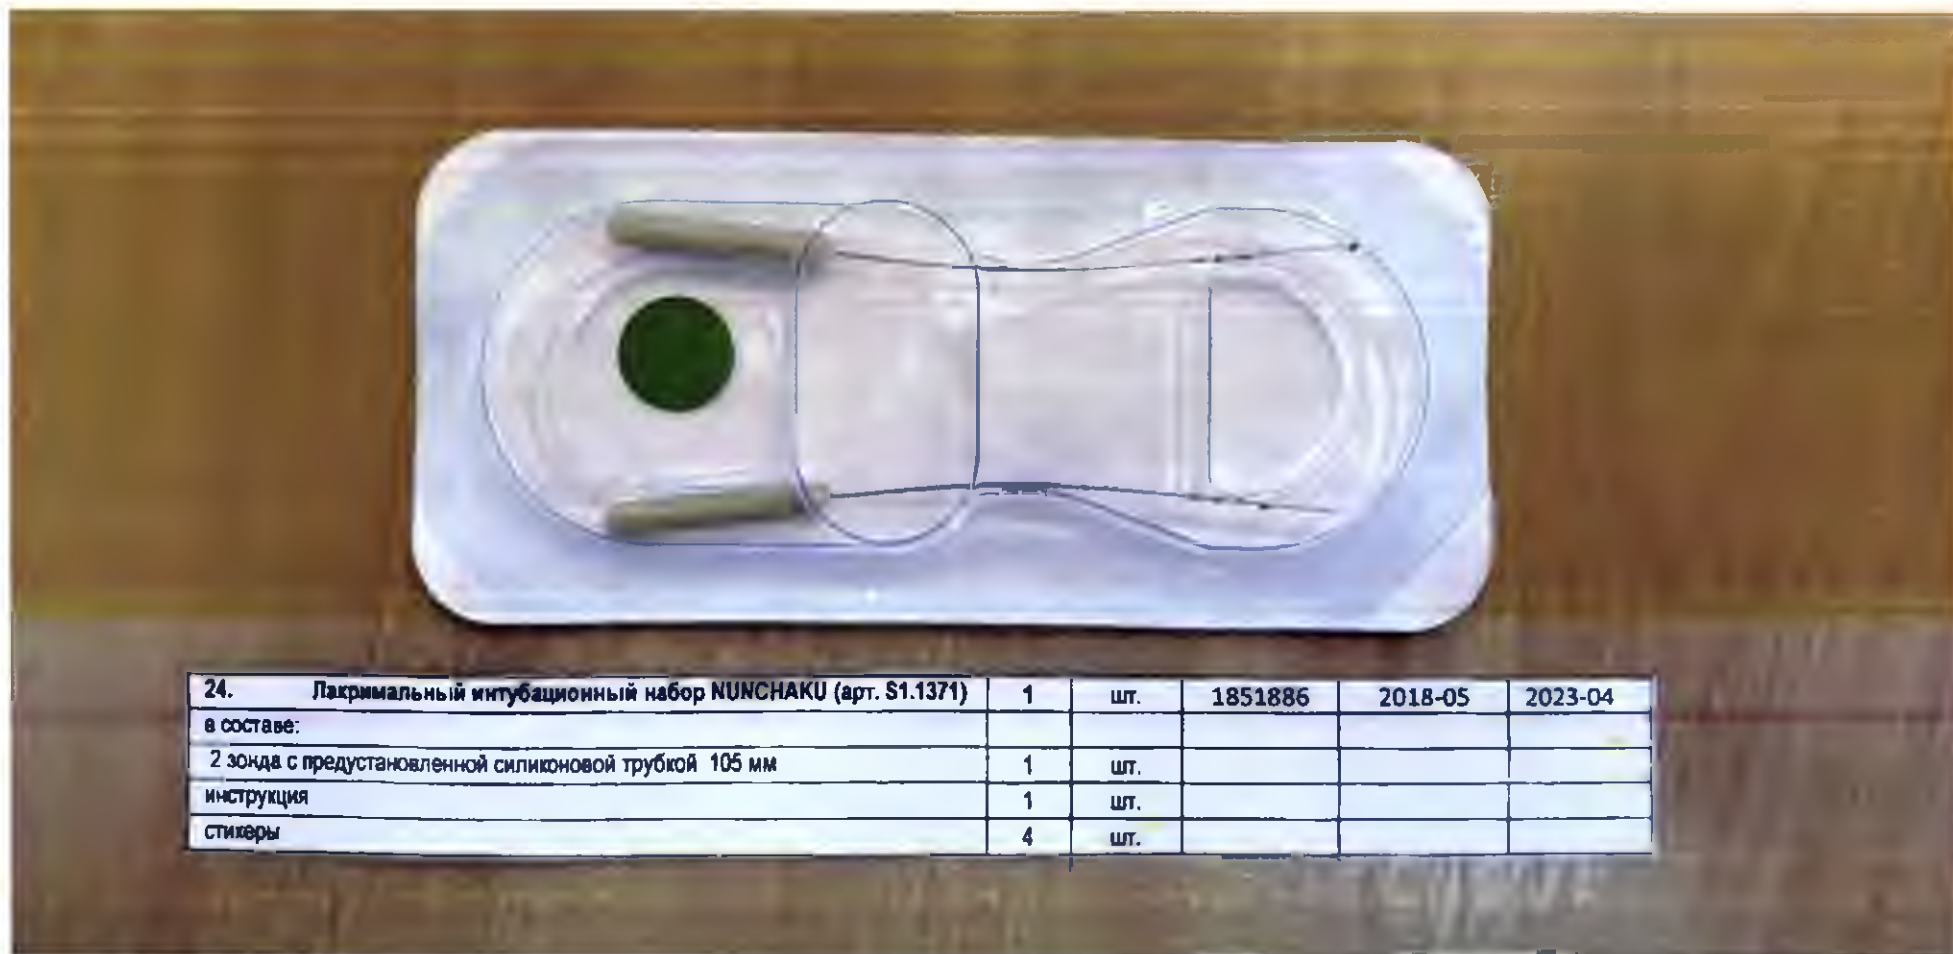


Рисунок 179 – Внутренняя индивидуальная упаковка (вид спереди) арт. S1.1371

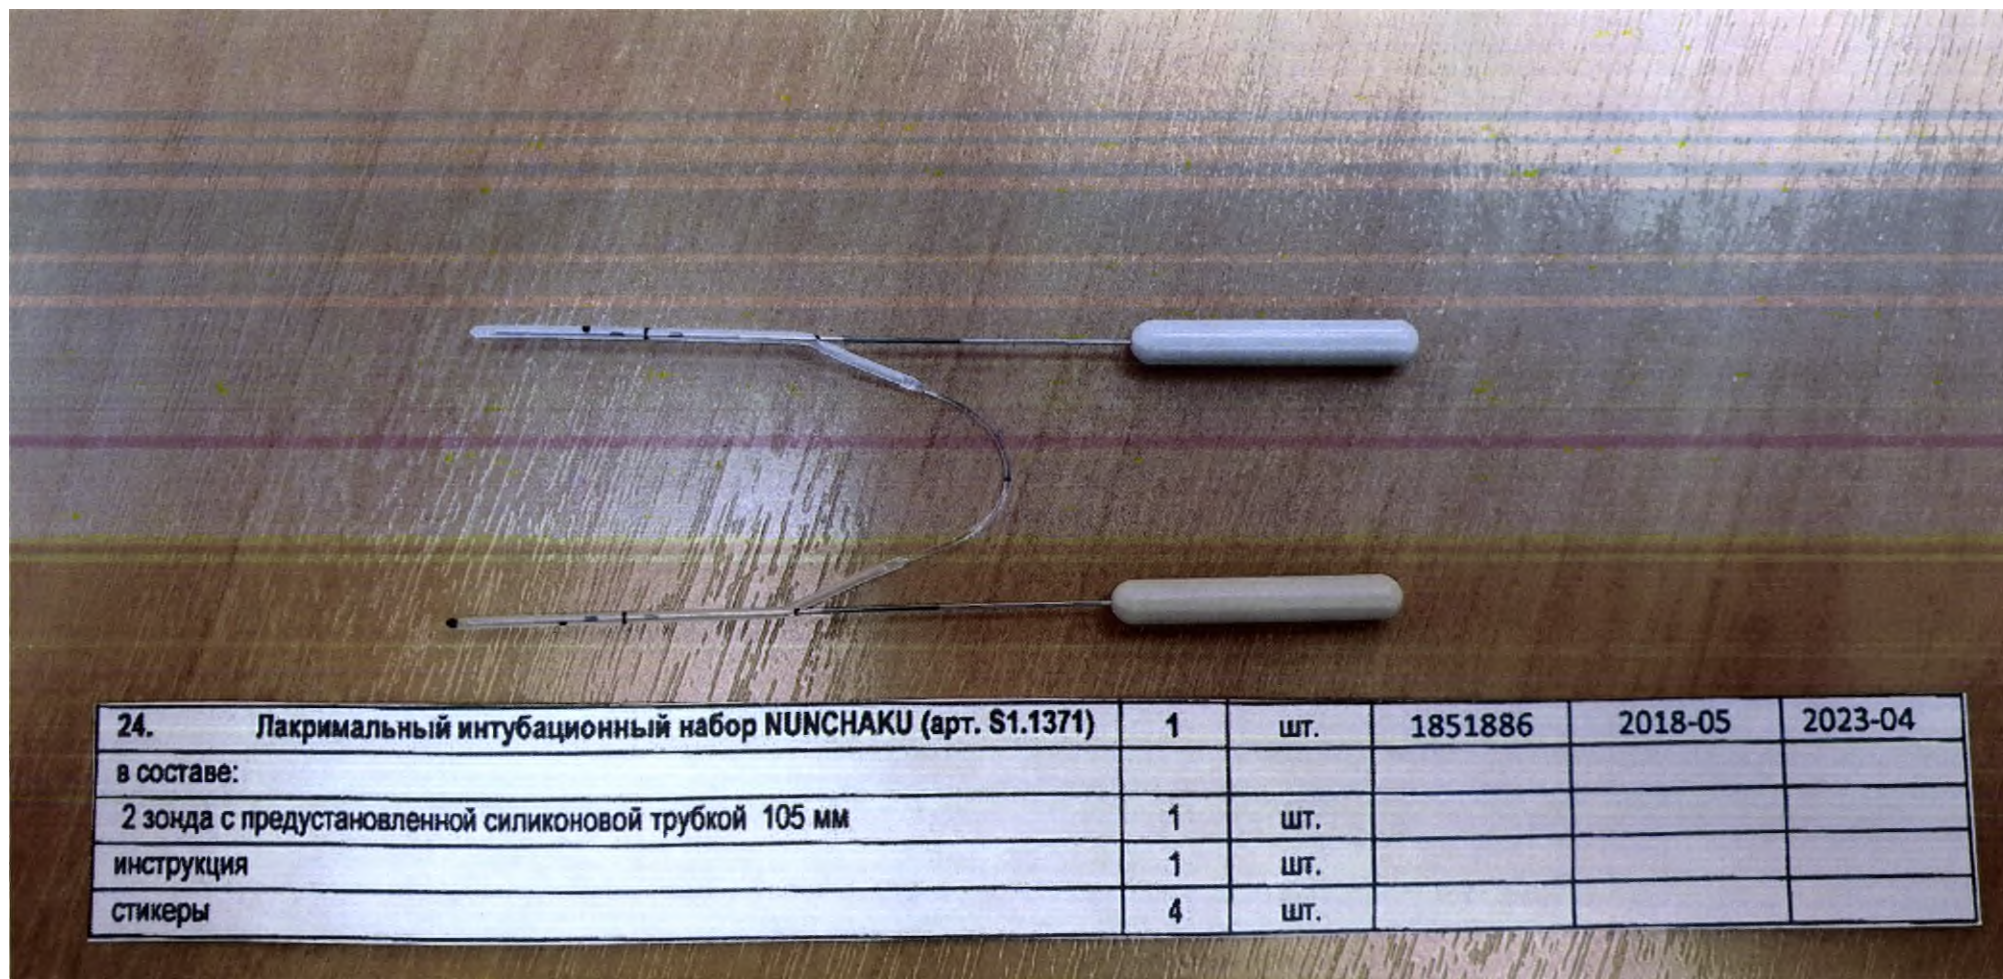


Рисунок 180 – Лакримальный интубационный набор NUNCHAKU, арт. S1.1371

Индивидуальная упаковка состоит из внутренней и внешней.

На внутреннюю индивидуальную упаковку нанесена следующая информация:

- информация о производителе;
- наименование изделия;
- номер по каталогу;
- код партии;
- метод стерилизации;
- маркировка CE.

Наносимые на внутреннюю индивидуальную упаковку графические символы:



номер по каталогу



код партии



– стерилизация оксидом этилена



– знак CE

Зеленая точка на внутренней индивидуальной упаковке указывает на то, что изделие было стерилизовано оксидом этилена.

На внешнюю индивидуальную упаковку изделия (индивидуальная упаковка) нанесена следующая информация:

- информация о производителе;
- наименование изделия;
- номер по каталогу;
- код партии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- метод стерилизации;
- указания по эксплуатации;
- маркировка CE.

Наносимые на внешнюю индивидуальную упаковку графические символы:



номер по каталогу

LOT

— код партии



дата изготовления



· использовать до ...

STERILE EO

— стерилизация оксидом этилена



— не использовать при повреждении упаковки



— запрет на повторное применение



— Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

CE
0459

- знак CE

На потребительскую упаковку изделия нанесена следующая информация:

- информация о производителе;
- наименование изделия;
- номер по каталогу;
- код партии;
- серийный номер;
- дата изготовления;
- срок годности;
- количество изделий в упаковке;
- метод стерилизации;
- указания по эксплуатации;
- маркировка СЕ.

Наносимые графические символы:



– изготовитель



– номер по каталогу



– код партии



– серийный номер



– дата изготовления



– использовать до ...



– стерилизация оксидом этилена



– не использовать при повреждении упаковки



– запрет на повторное применение



– Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



– знак СЕ

Прошито, пронумеровано

девятисот три

(93) лист (а/ов)

Скреплено печатью.

М.И. Смирнов

