


Фотографические изображения медицинского изделия и макет маркировки

«Реагенты диагностические in vitro HemosIL и расходные материалы для коагулометрических анализаторов ACL»

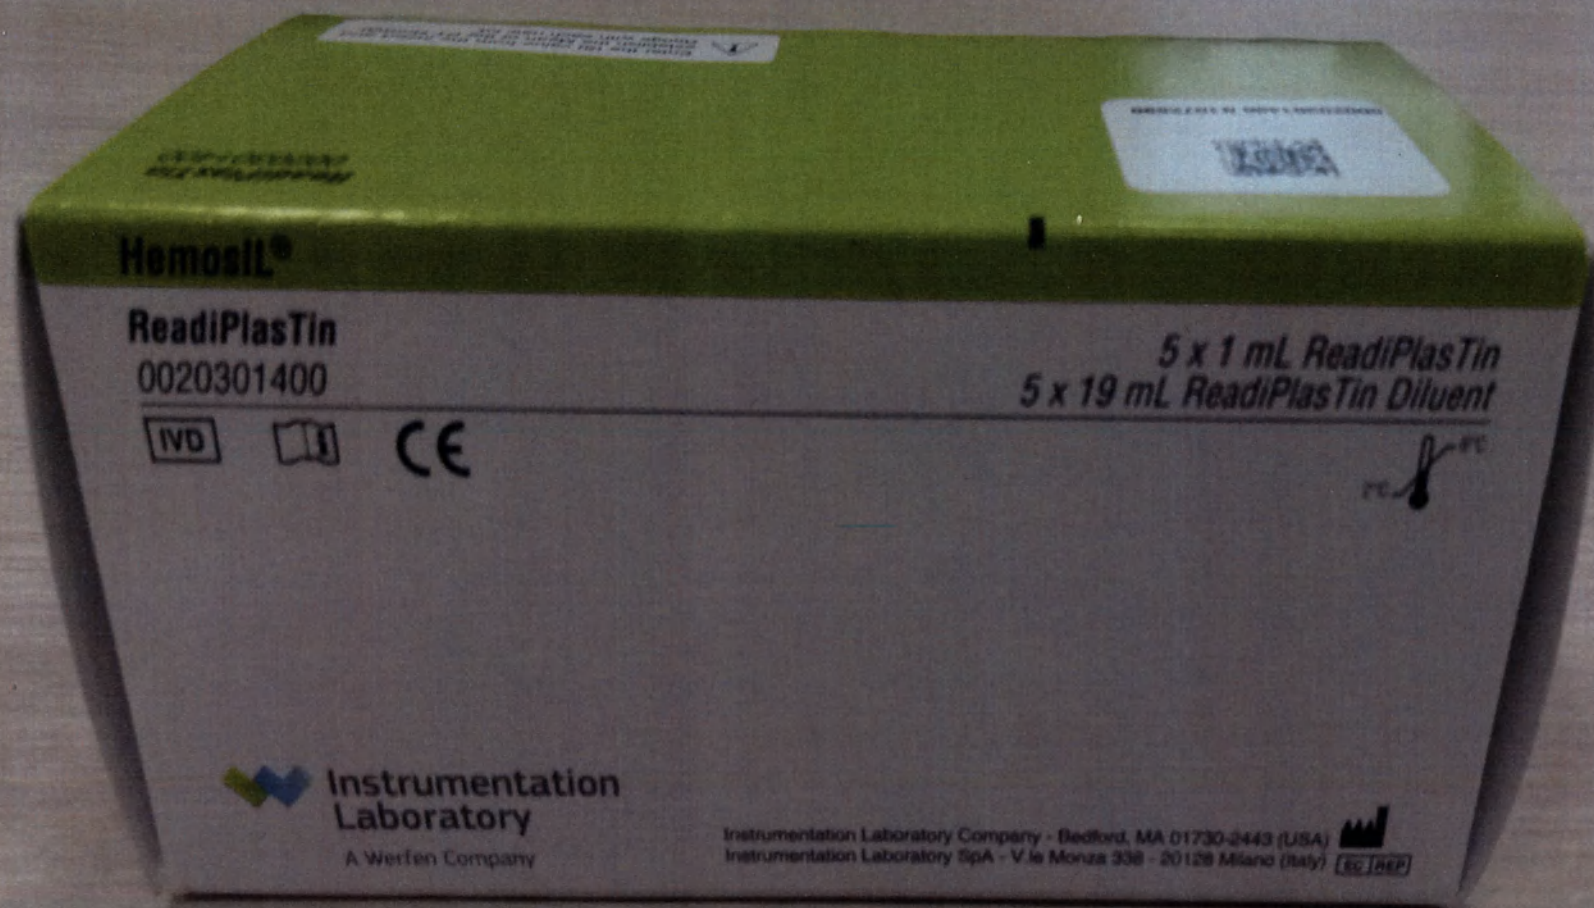


HemosIL®
ReadiPlasTin
0020301400

LOT N1072890
2019-10-31



(01)08428950632887
(17)191031
(10)N1072890

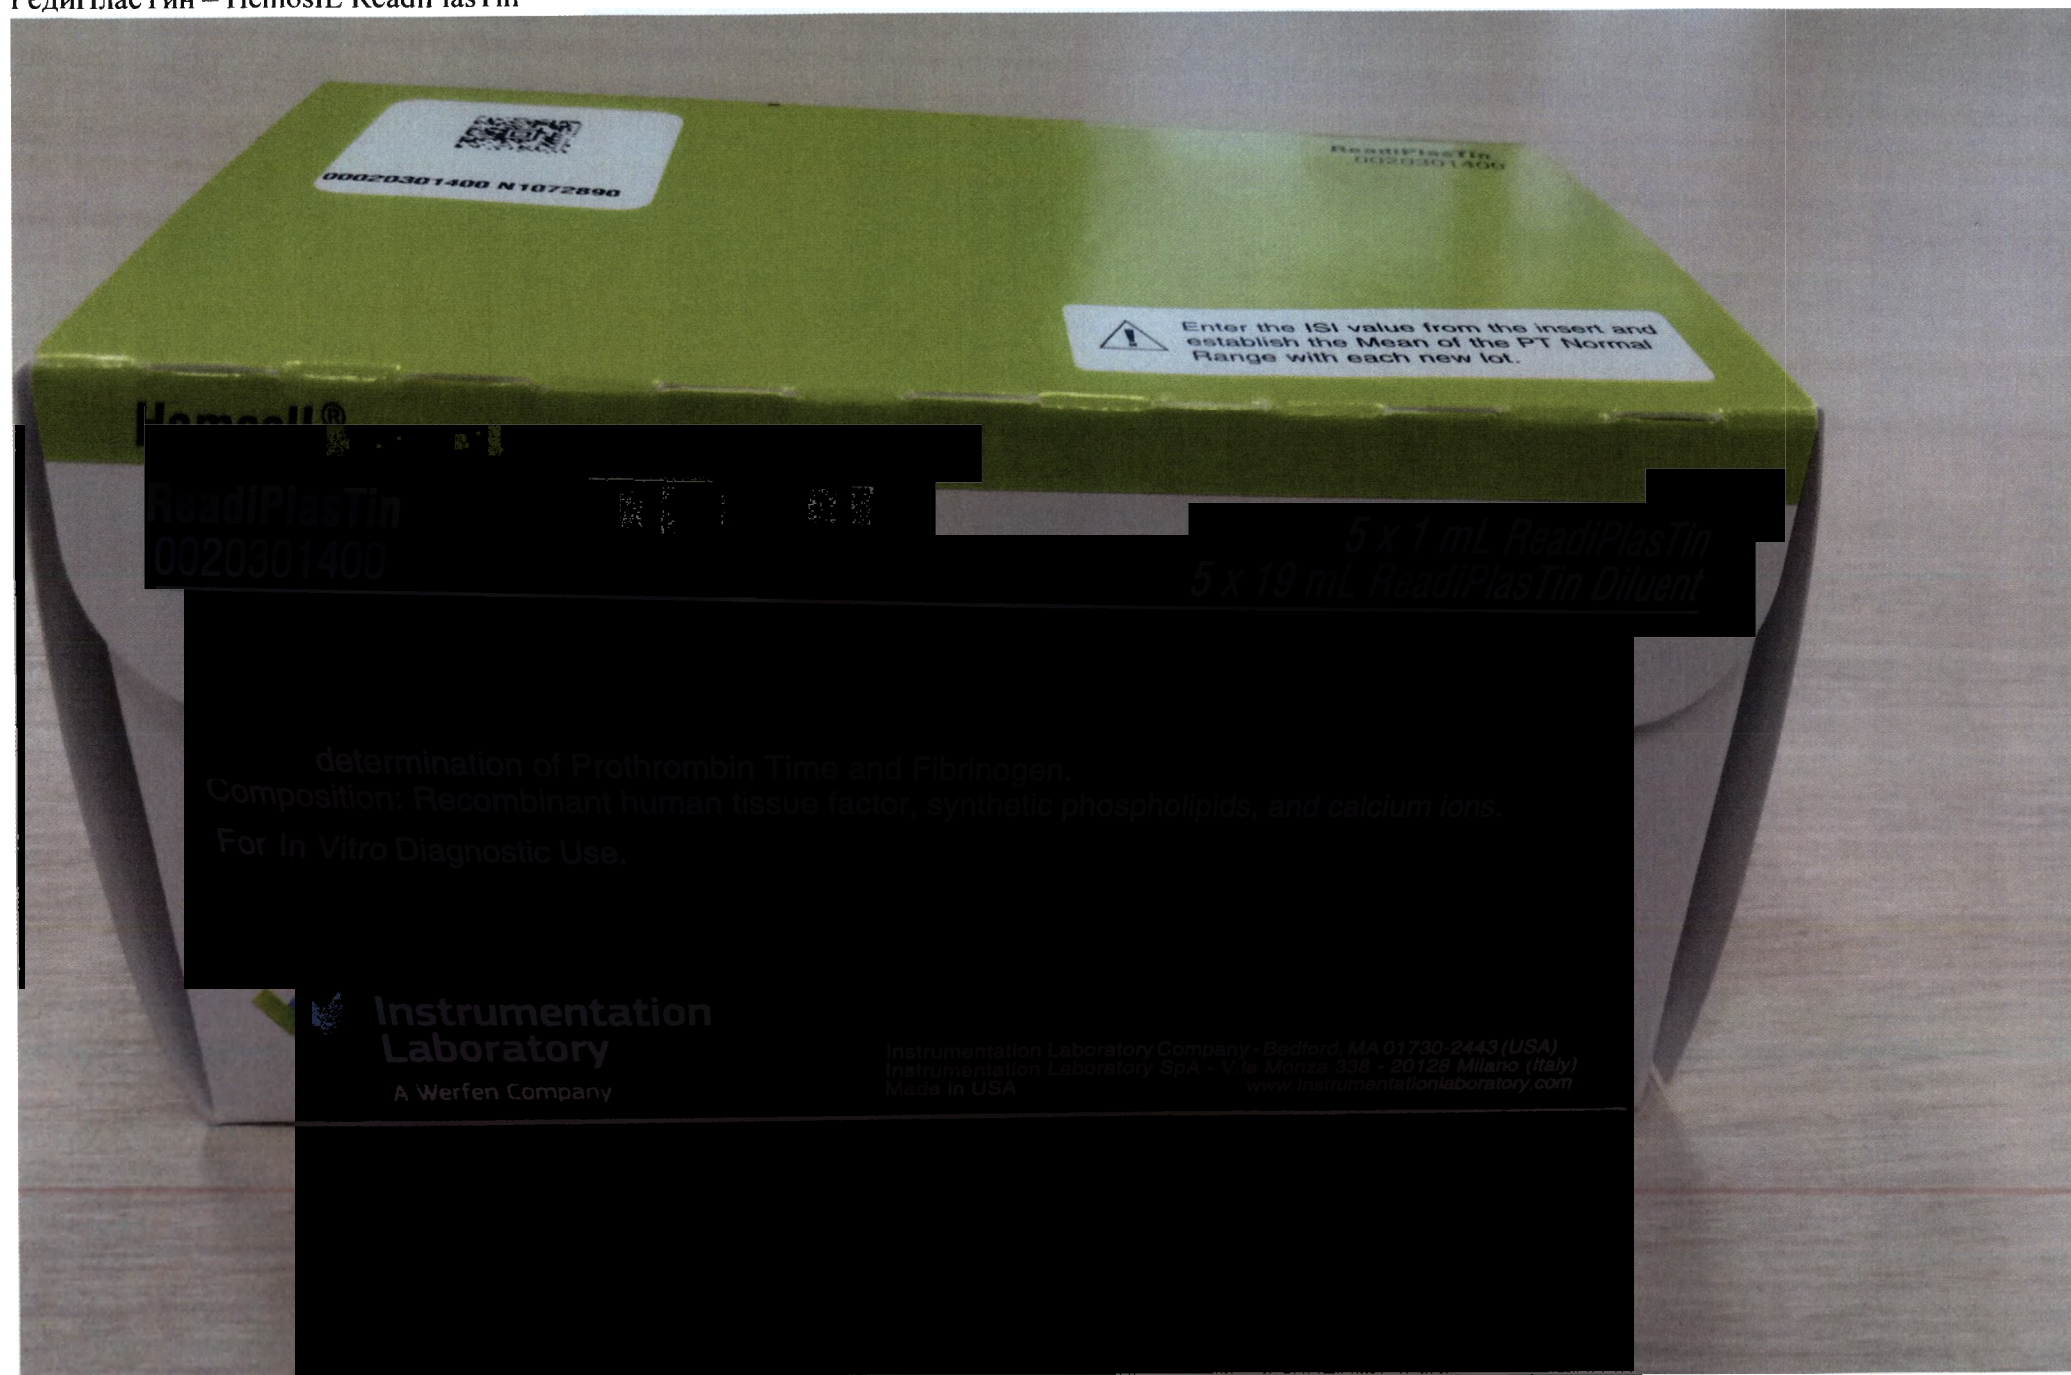

HemosIL®
ReadiPlasTin
0020301400

LOT

N1072890
SEQ02595
2019-10



00020301400 N1072890

ReadiPlasTin
0020301400



Enter the ISI value from the insert and
establish the Mean of the PT Normal
Range with each new lot.


РедиПласТин – HemosIL ReadiPlasTin



РедиПласТин – HemosIL ReadiPlasTin



РедиПласТин – HemosIL ReadiPlasTin

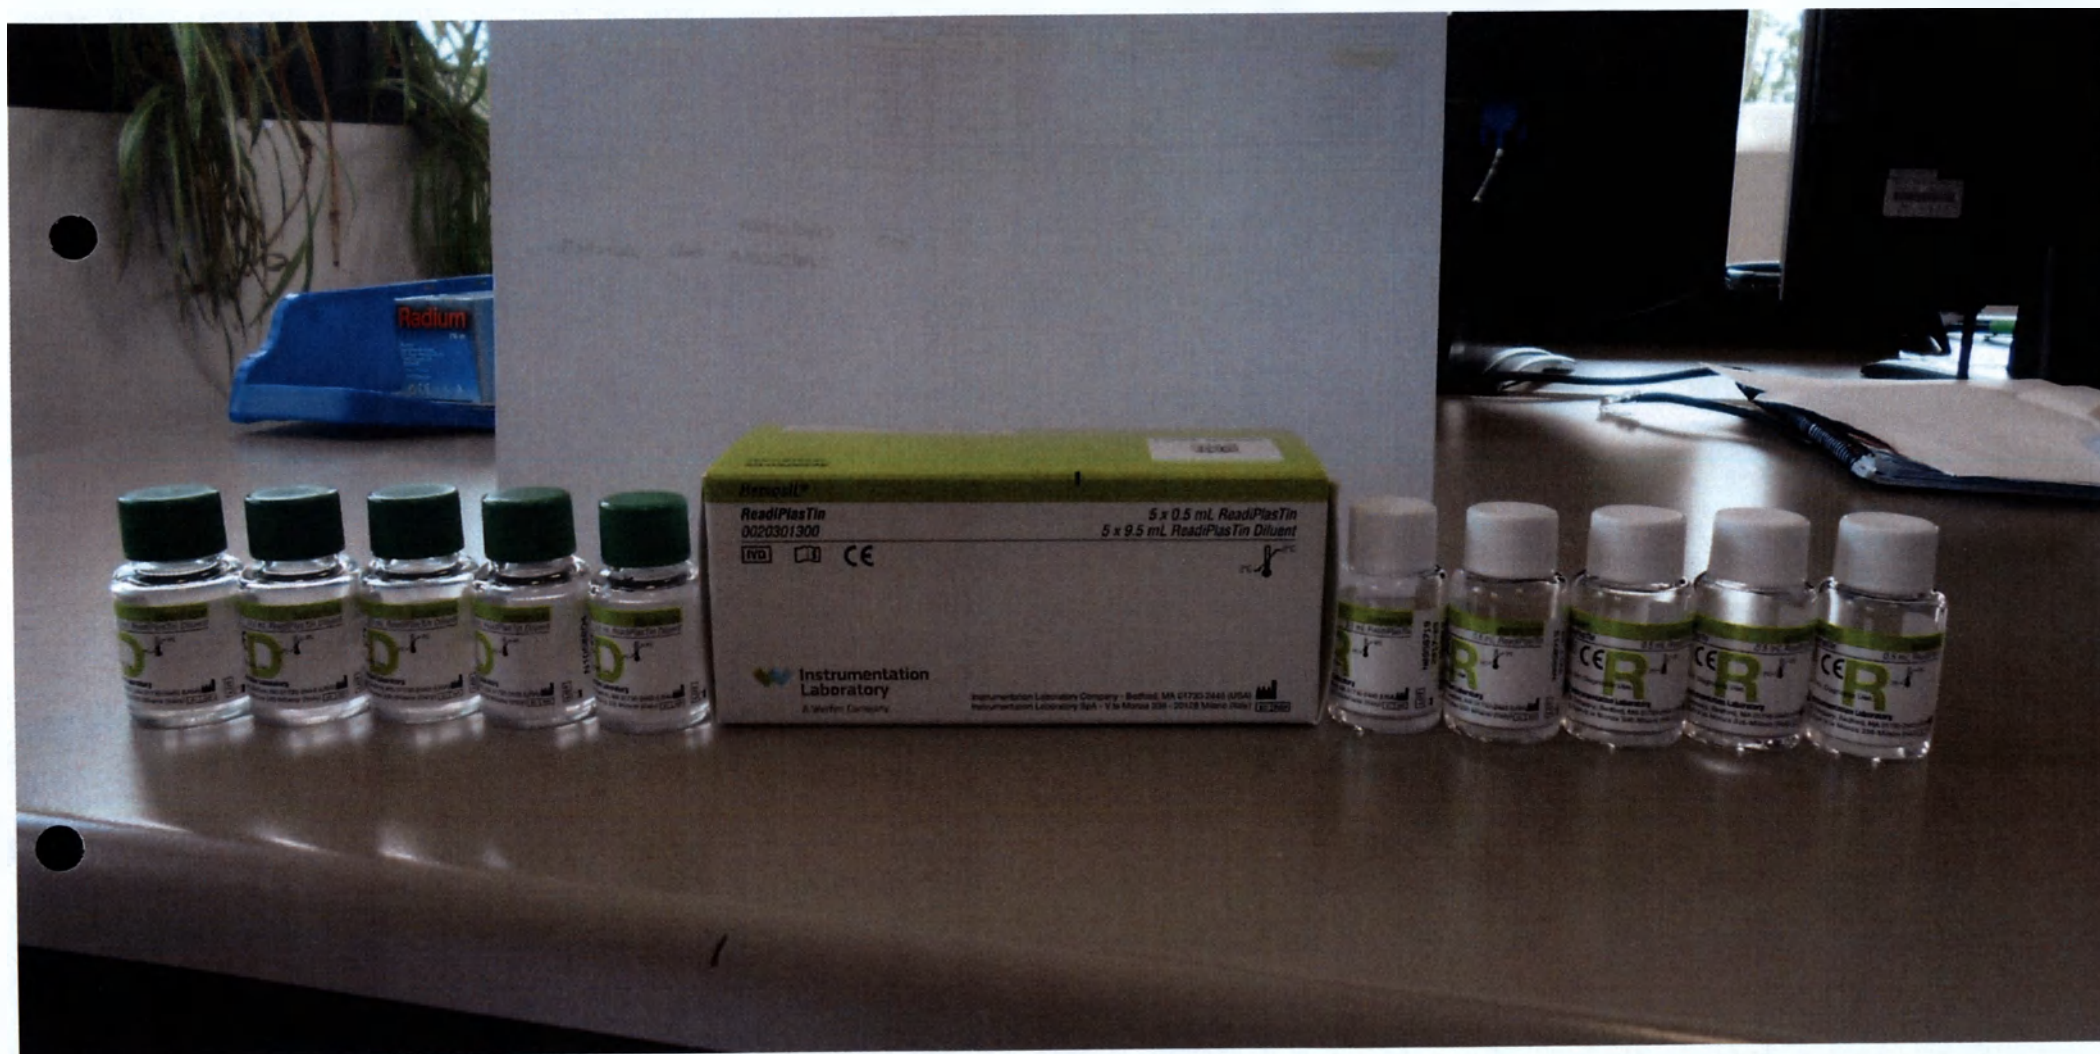

РекомбиПласТин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlasTin 2G

HemosIL®

RecombiPlasTin 2G

0020002950

5 x 8 mL RecombiPlasTin 2G (RTF)
5 x 8 mL RecombiPlasTin 2G Diluent (RTF Diluent)

For the determination of Prothrombin Time and Fibrinogen.
Composition: Recombinant human tissue factor, synthetic phospholipids,
calcium ions and 0.17% of sodium azide.

For *In Vitro* Diagnostic Use. 体外診断用医薬品




Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA


www.ilwww.com




РекомбиПласТин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlasTin 2G

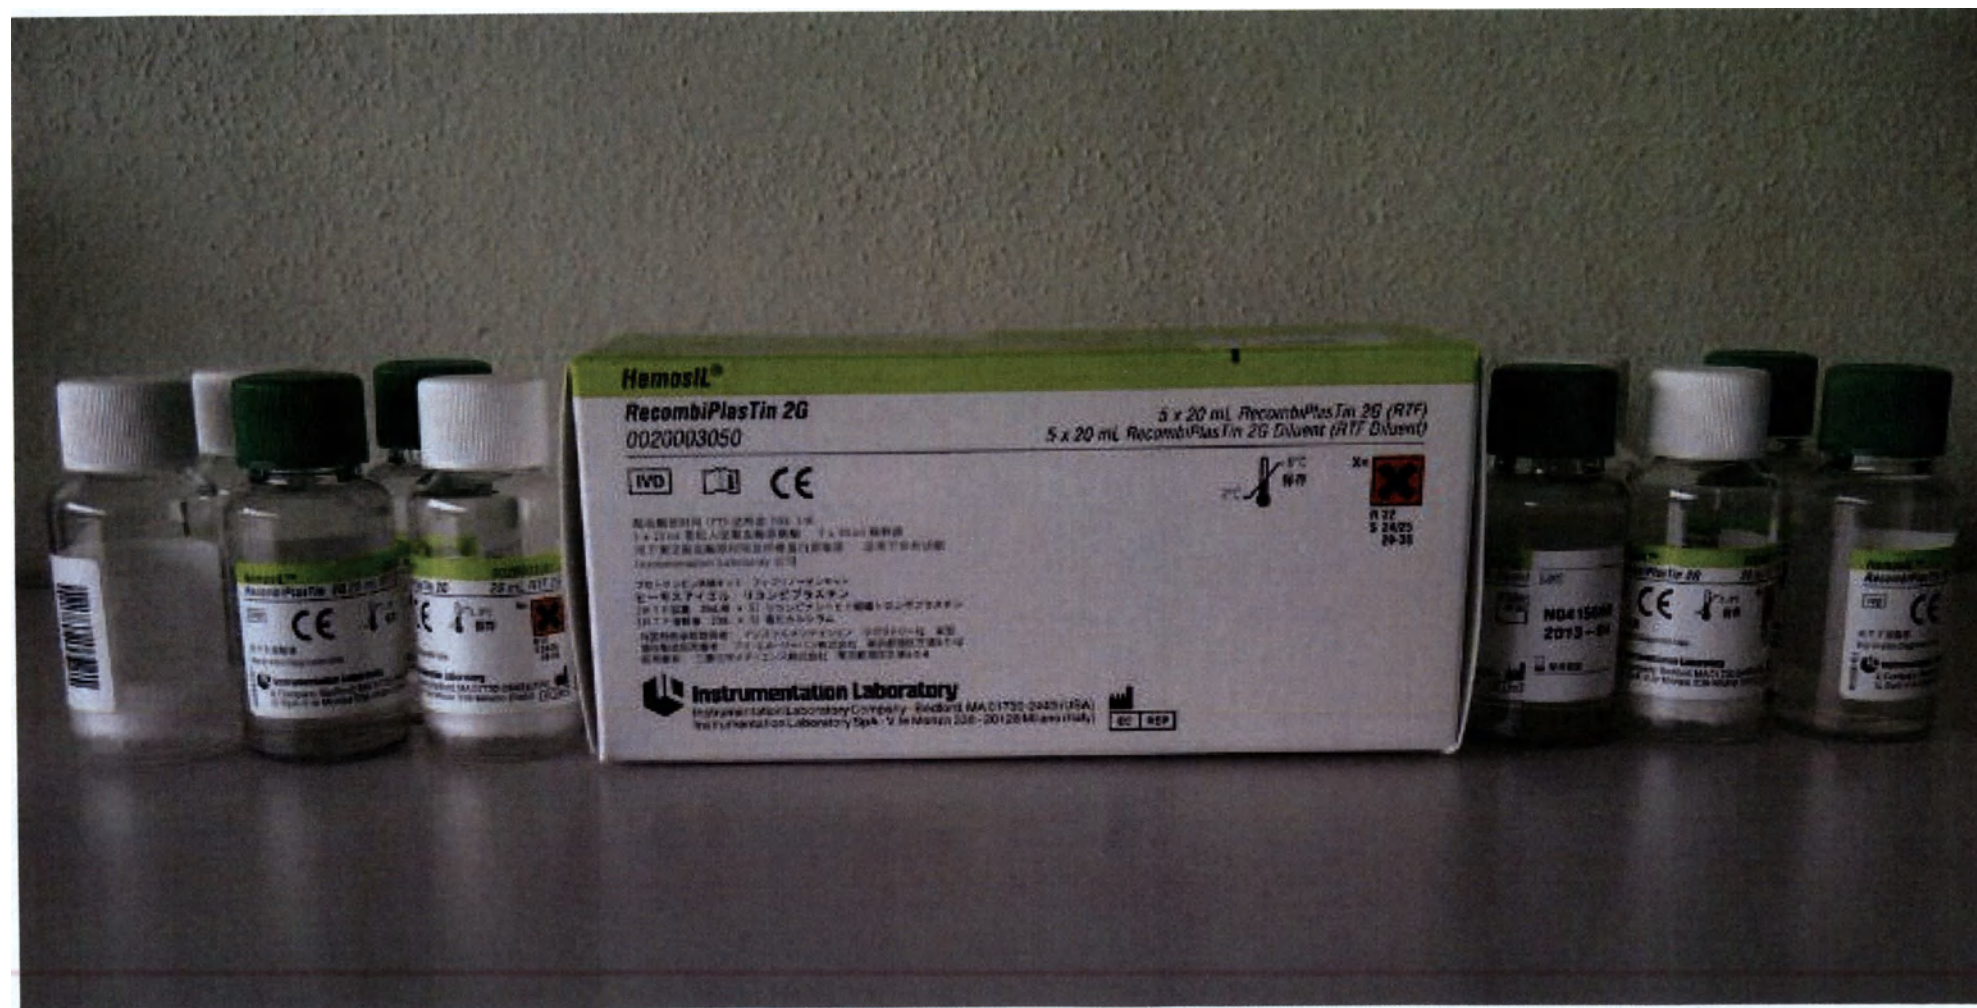


Протромбин-фибриноген (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL PT-Fibrinogen

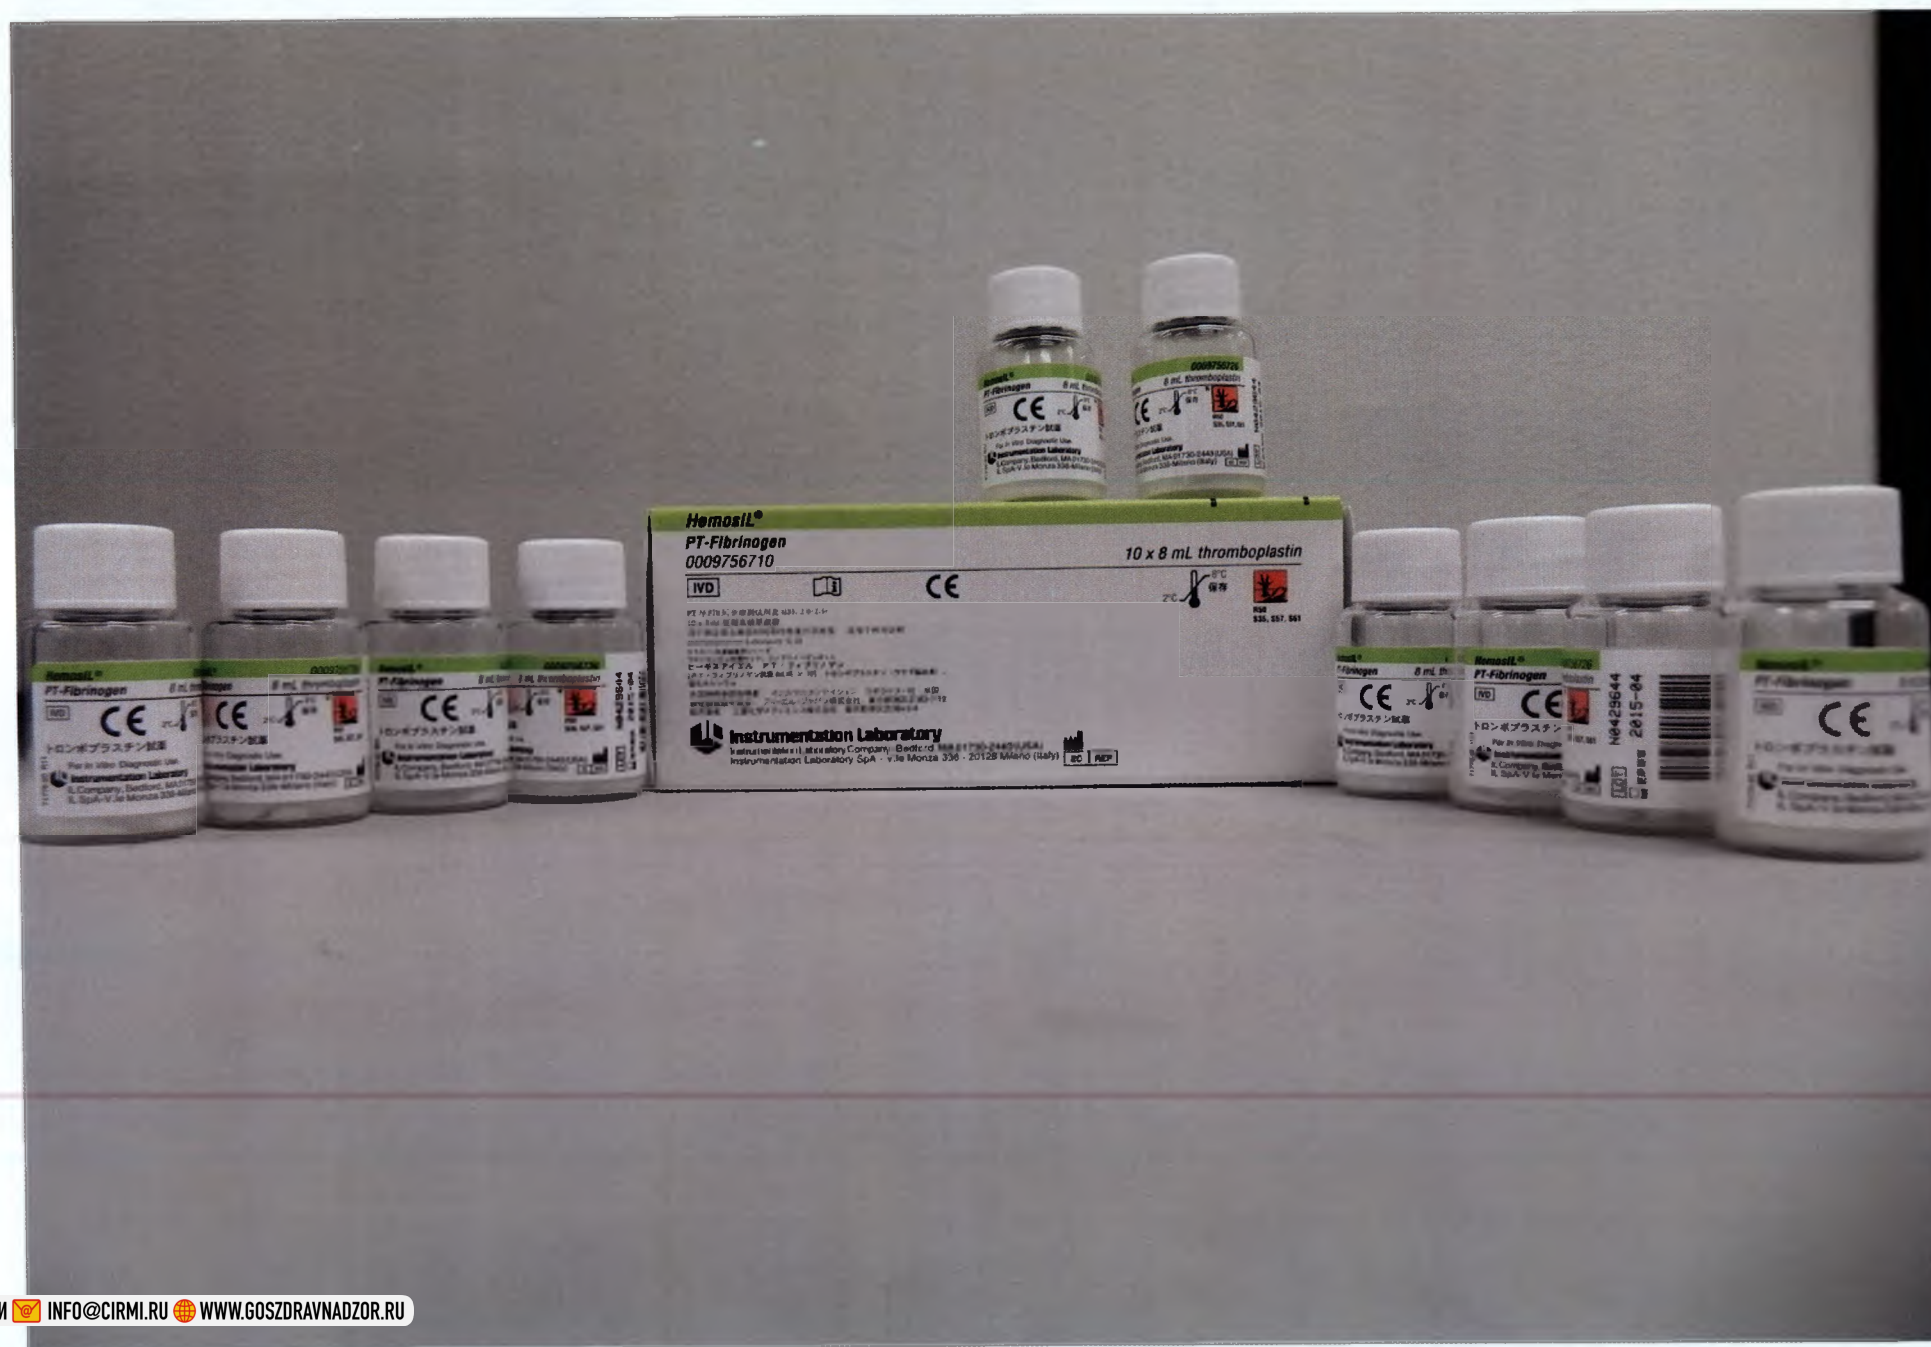

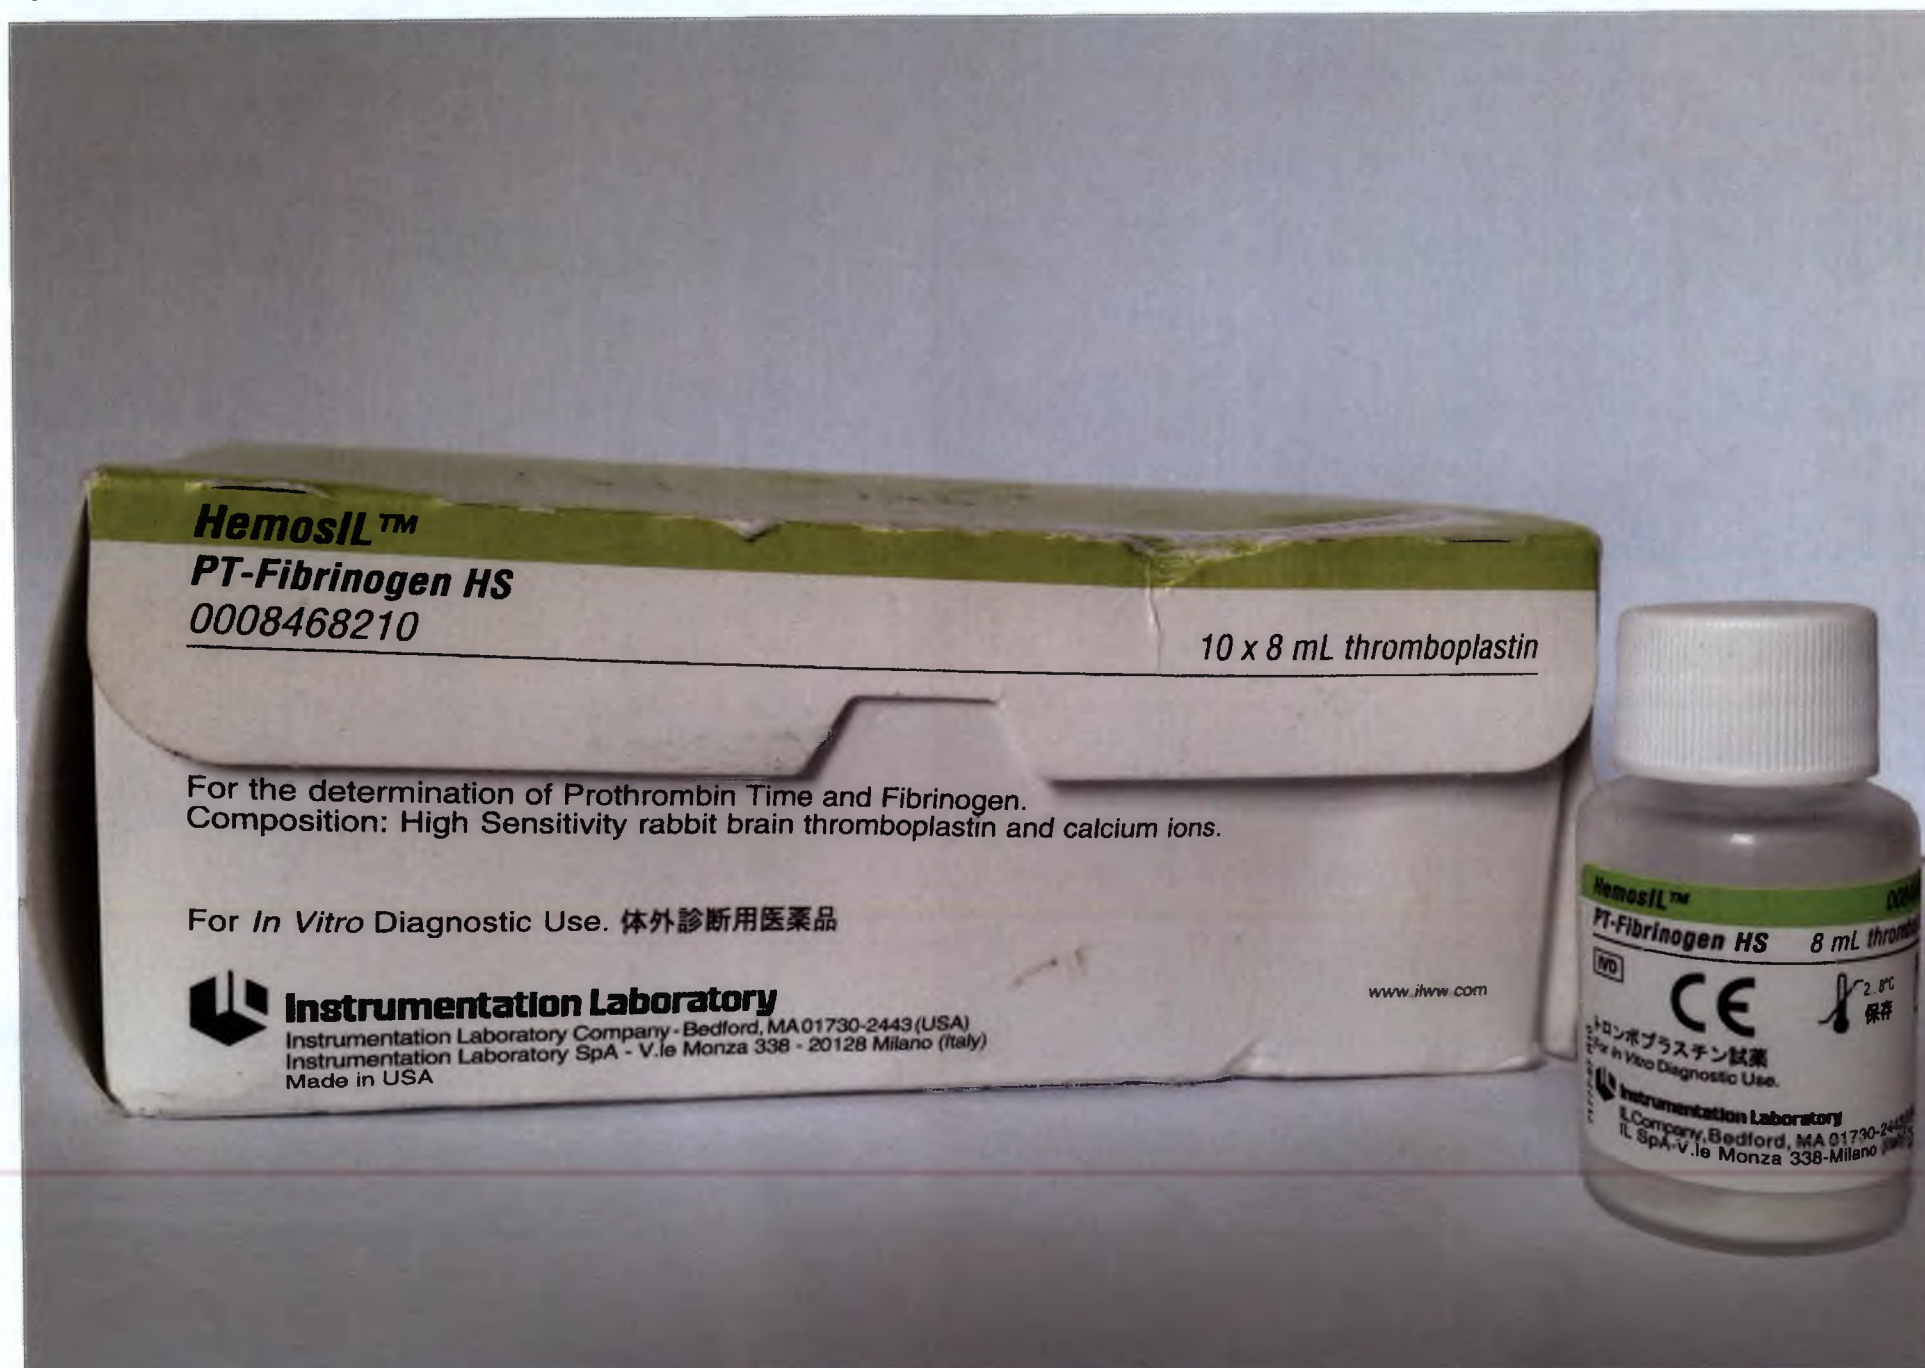

Протромбин-фибриноген высокочувствительный плюс - HemosIL PT Fibrinogen HS Plus

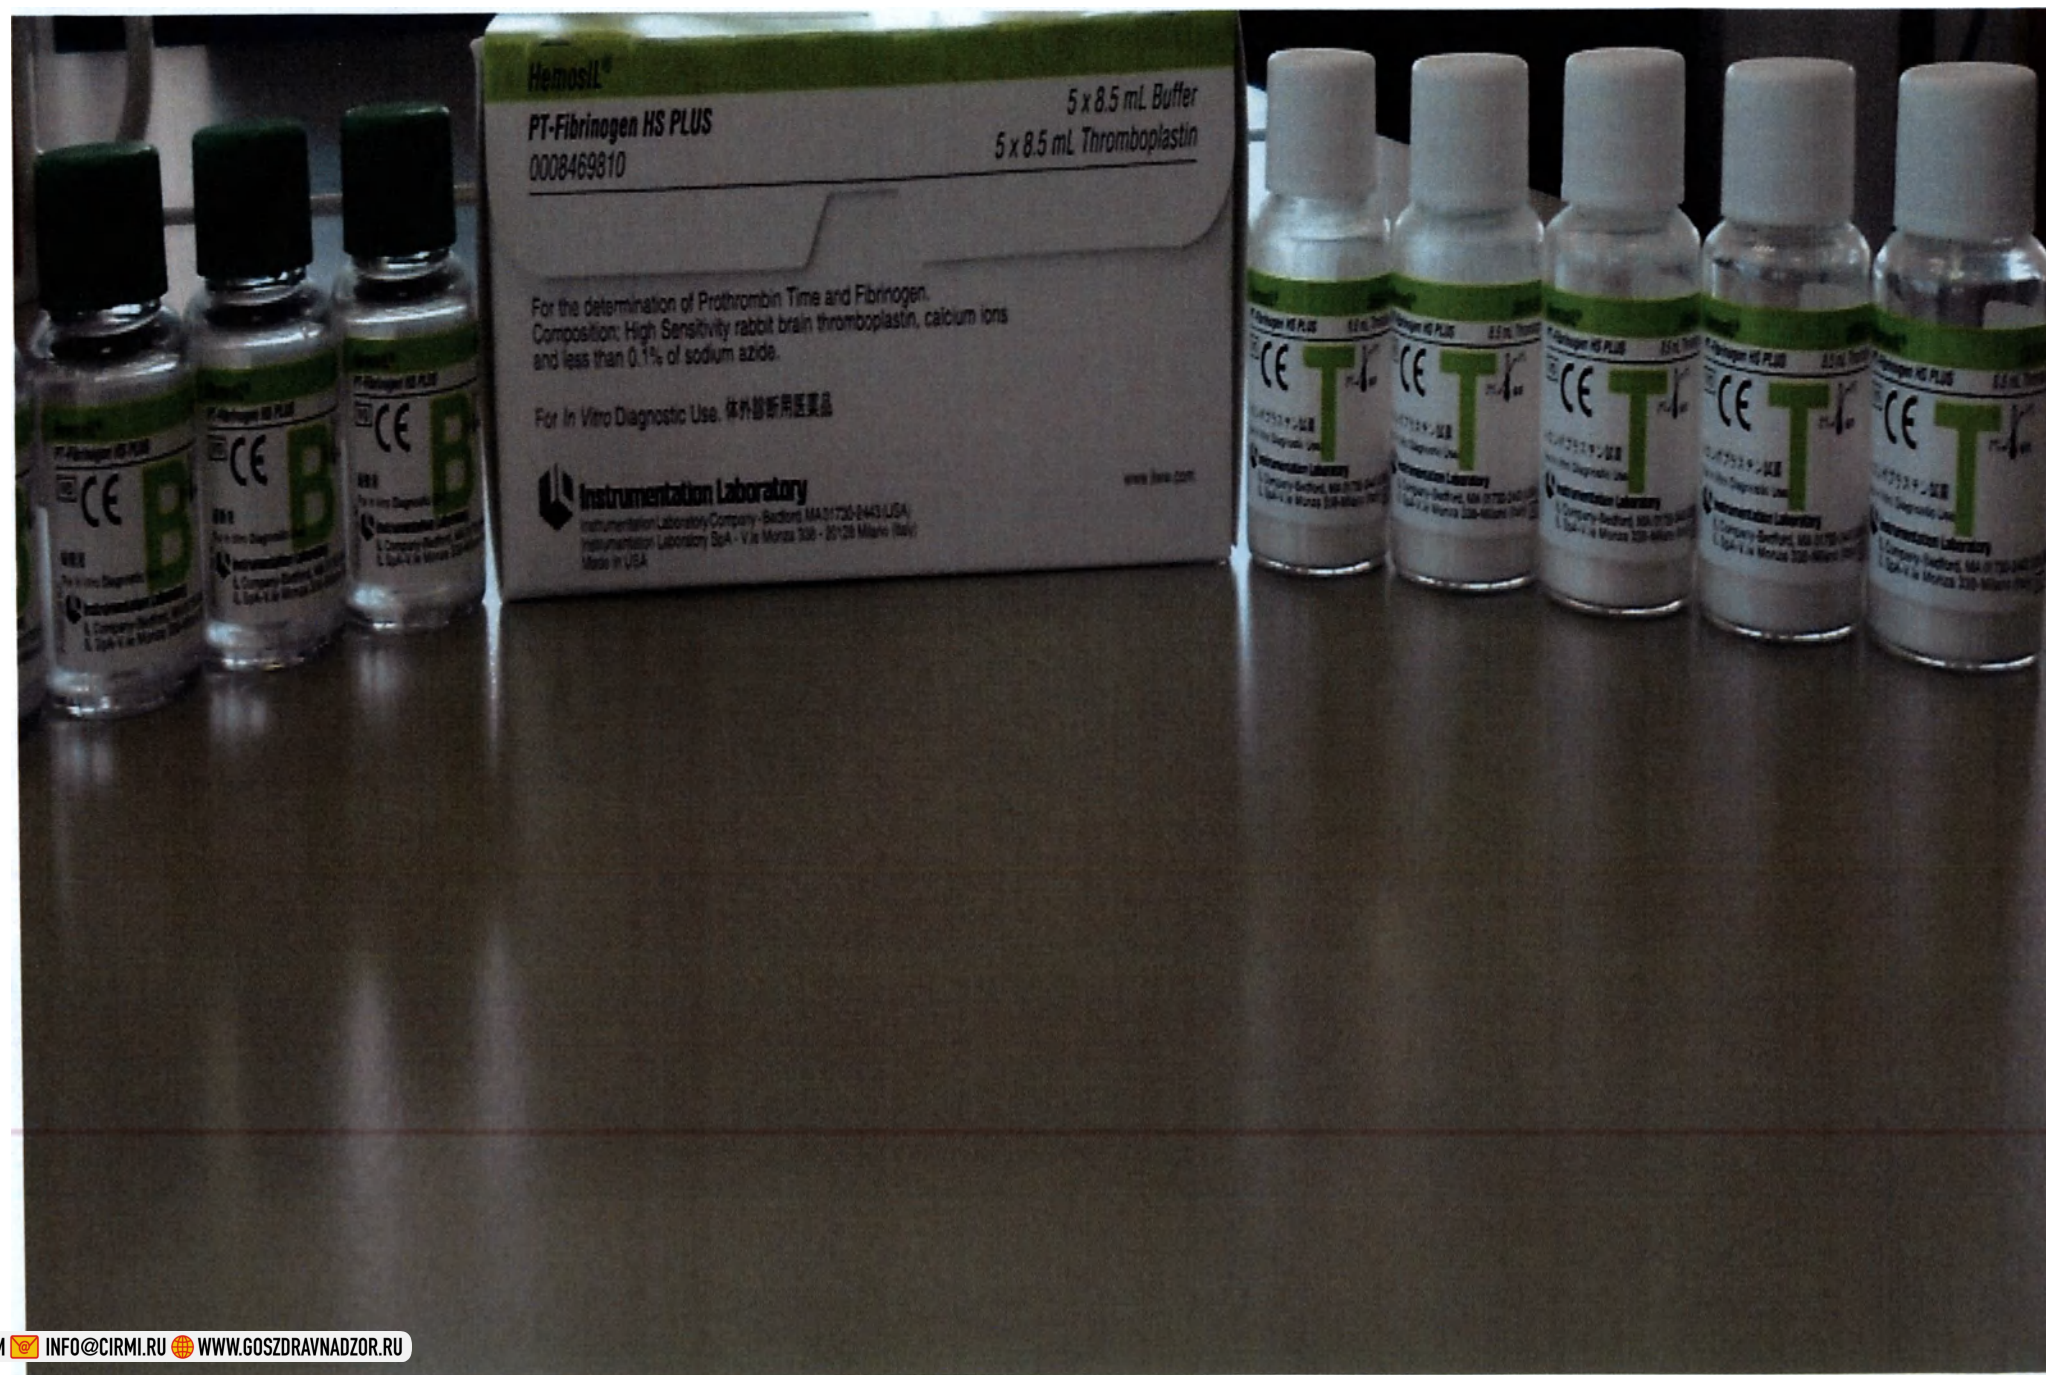

HemosIL®

PT-Fibrinogen Recombinant

0020005000

10 x 8 mL thromboplastin

For the determination of Prothrombin Time and Fibrinogen.
Composition: Recombinant rabbit tissue factor, synthetic phospholipids
and calcium ions.


For *In Vitro* Diagnostic Use. 体外診断用医薬品



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

www.ilwww.com

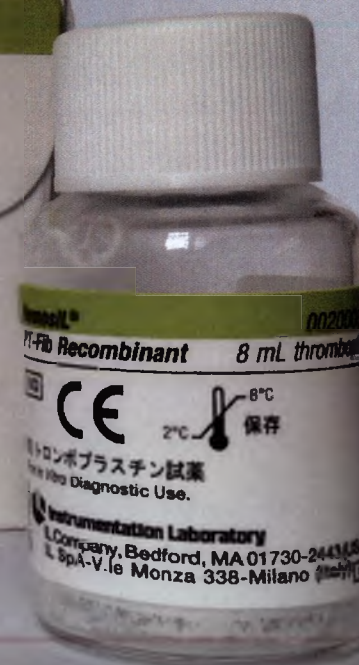

Гепатокомплекс- HemosIL Hepatocomplex



HemosIL®

Pro-IL-Complex

0009758810

5 x 3 mL Bovine plasma
5 x 7 mL Bovine thromboplastin

For the determination of Pro-IL-Complex.

Composition: bovine brain thromboplastin, calcium ions and bovine plasma.

For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in USA

www.ilwww.com

АЧТВ SP, жидкий (АЧТВ реагент с синтетическими фосфолипидами) – HemosIL APTT-SP (liquid)



АЧТВ реагент лиофилизированный с кварцем - HemosIL APTT Lyophilized silica



HemosIL®


SynthAFax

0020007400

IVD



5 x 10 mL APTT Reagent
5 x 10 mL CaCl₂



**Instrumentation
Laboratory**

A Werfen Company

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



EC REP

СинтАСил (АЧТВ реагент) – HemosIL SynthASil



Реагент Хлорид Кальция, раствор 0.025 M - HemosIL Calcium Chloride 0.025 M




Реагент Хлорид Кальция, раствор 0.020 M - HemosIL Calcium Chloride 0.020 M



[illegible]

Тромбин QFA (5 мл) – HemosIL QFA Thrombin (5 ml)

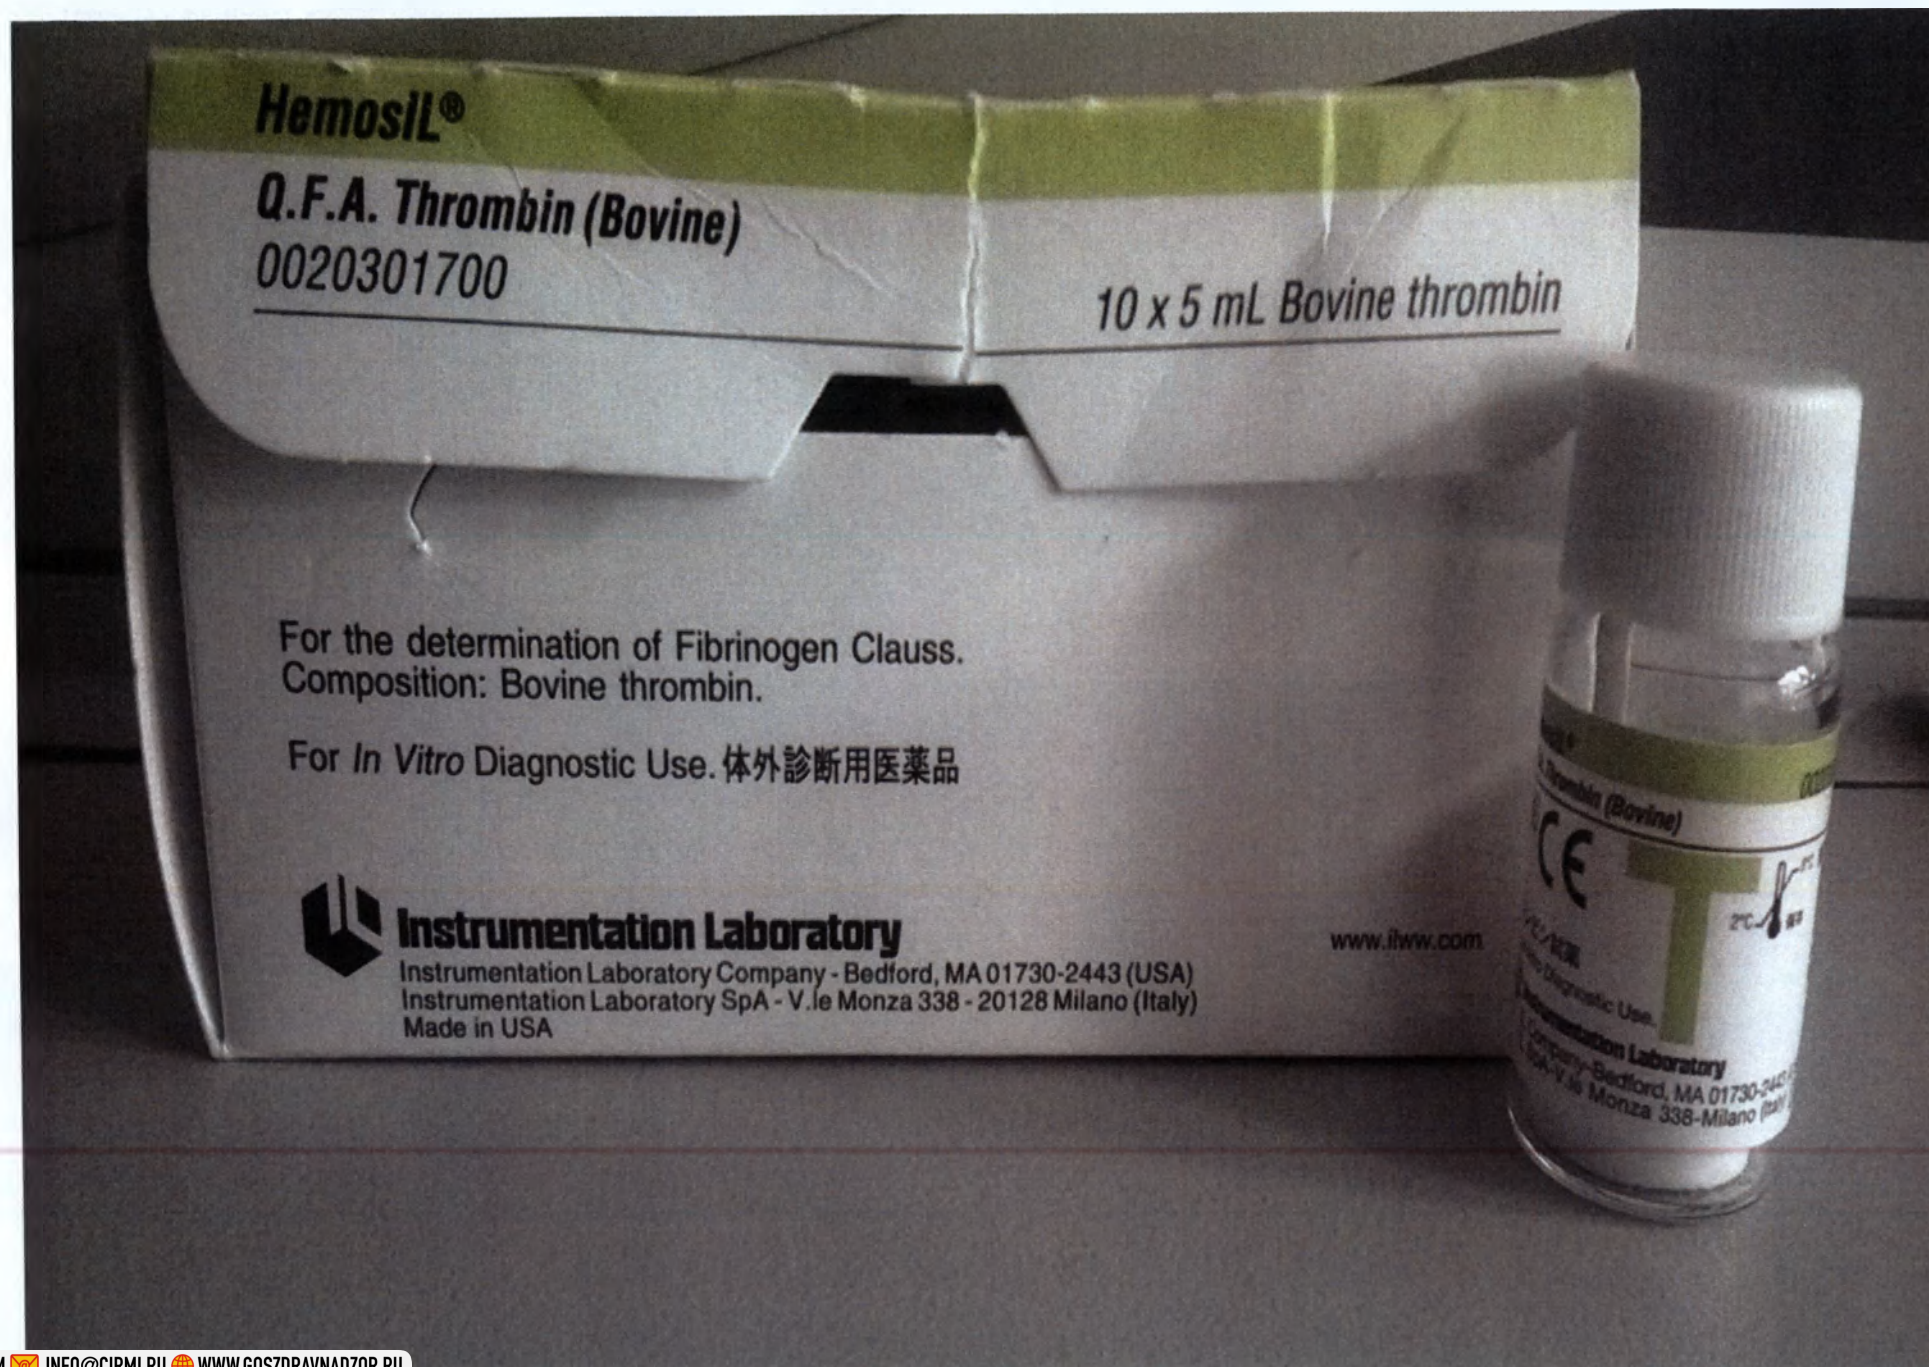


Фибриноген-С (метод Клаусса.) - HemosIL Fibrinogen-C



Фибриноген-С XL – HemosIL Fibrinogen-C XL



Фибриноген QFA, стандарт - HemosIL Fibrinogen QFA, Reference Standart

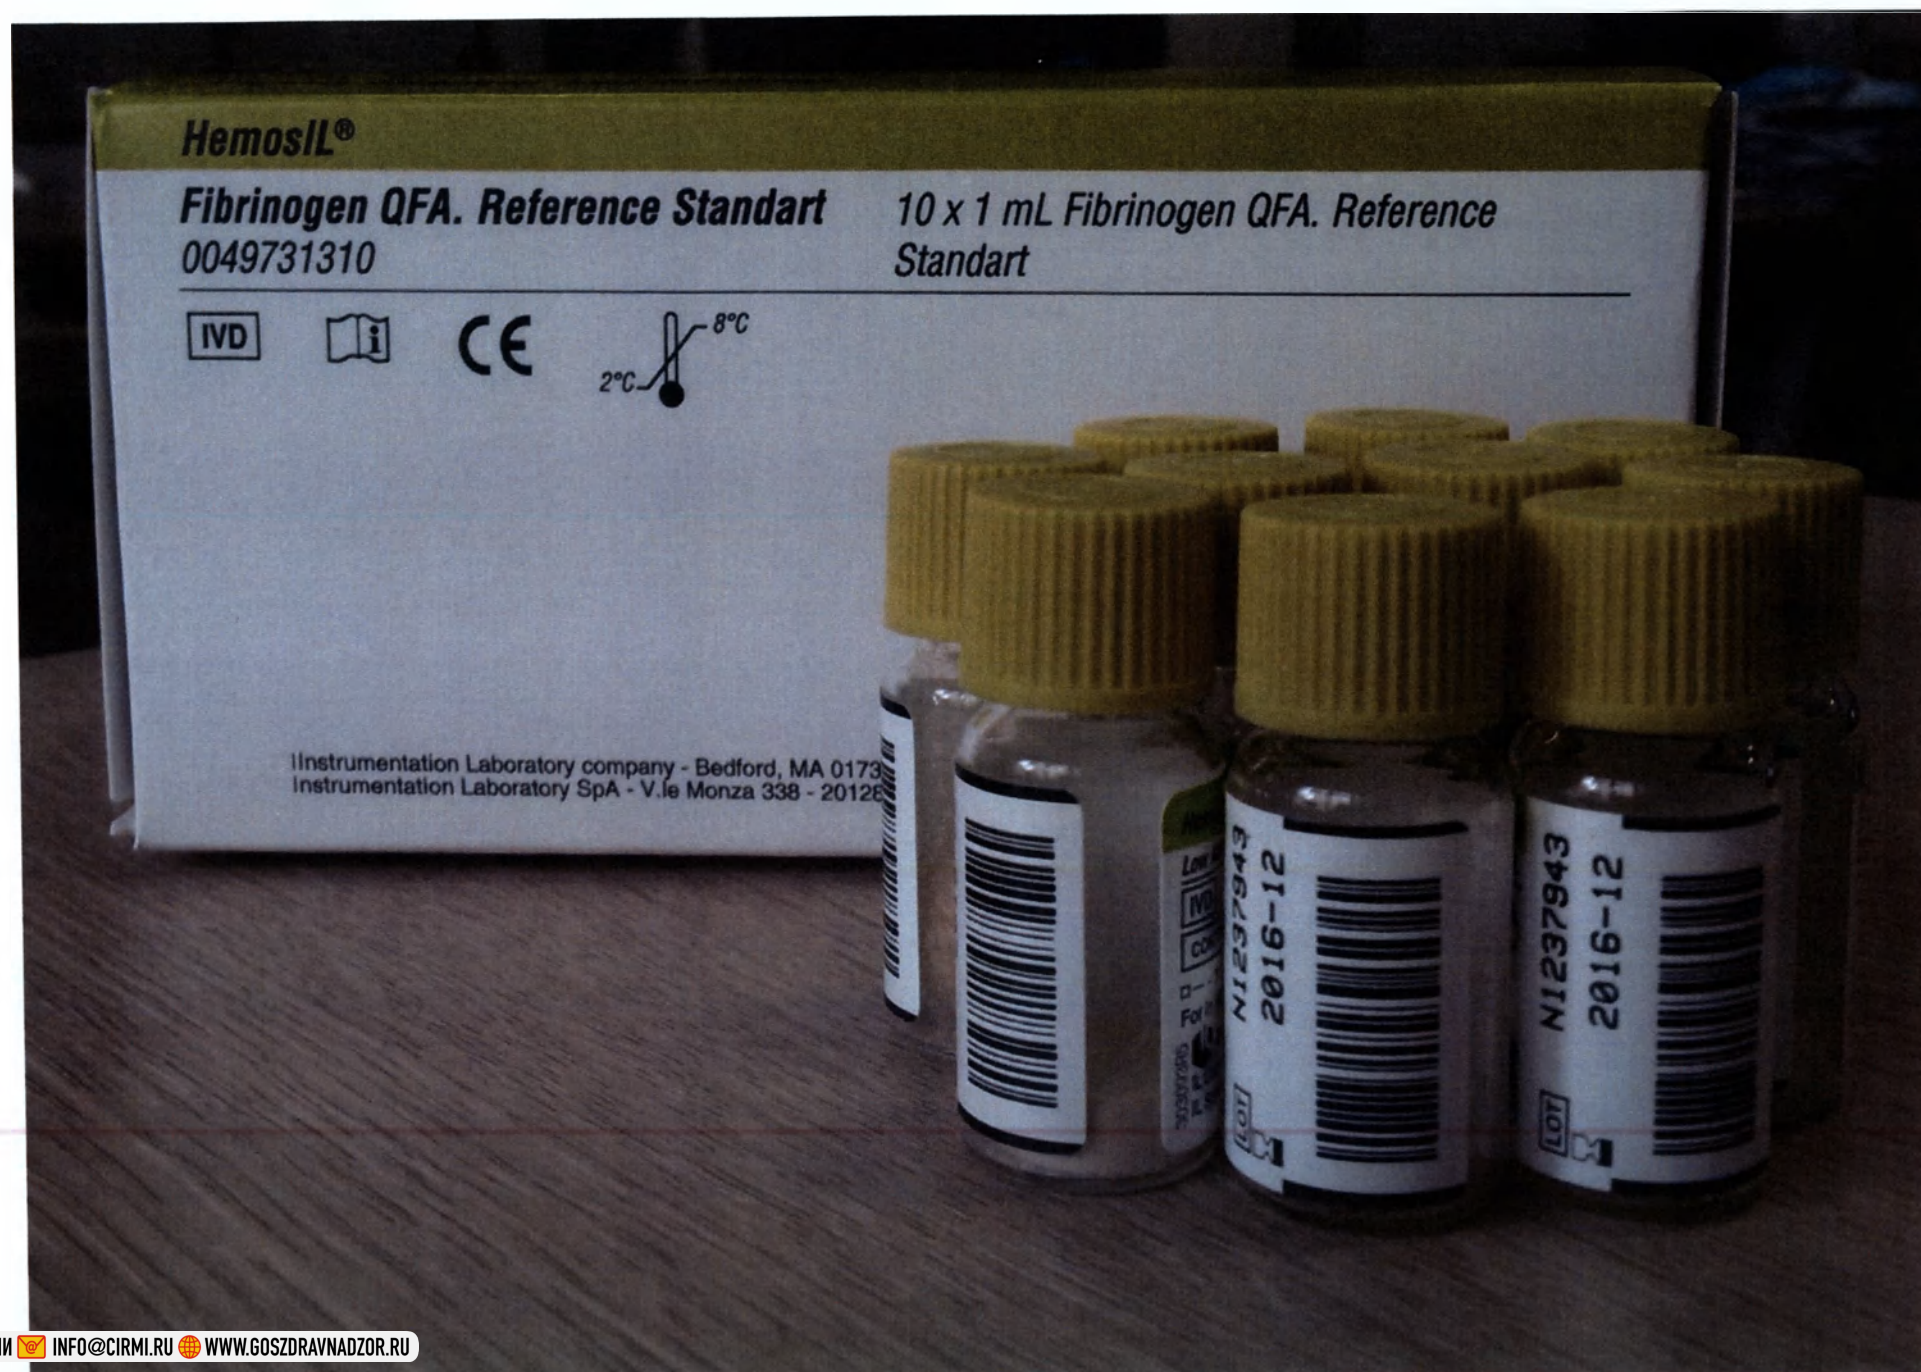

Тромбин QFA (2 мл) – HemosIL QFA Thrombin (2ml)

HemosIL®

Q.F.A. Thrombin (Bovine)

0020301800

10 x 2 mL Bovine thrombin

For the determination of Fibrinogen Clauss.
Composition: Bovine thrombin.

For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory


www.itwww.com

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

Контроль фибриногена, низкий уровень -HemosIL Low Fibrinogen Control



Антитромбин - HemosIL Antithrombin



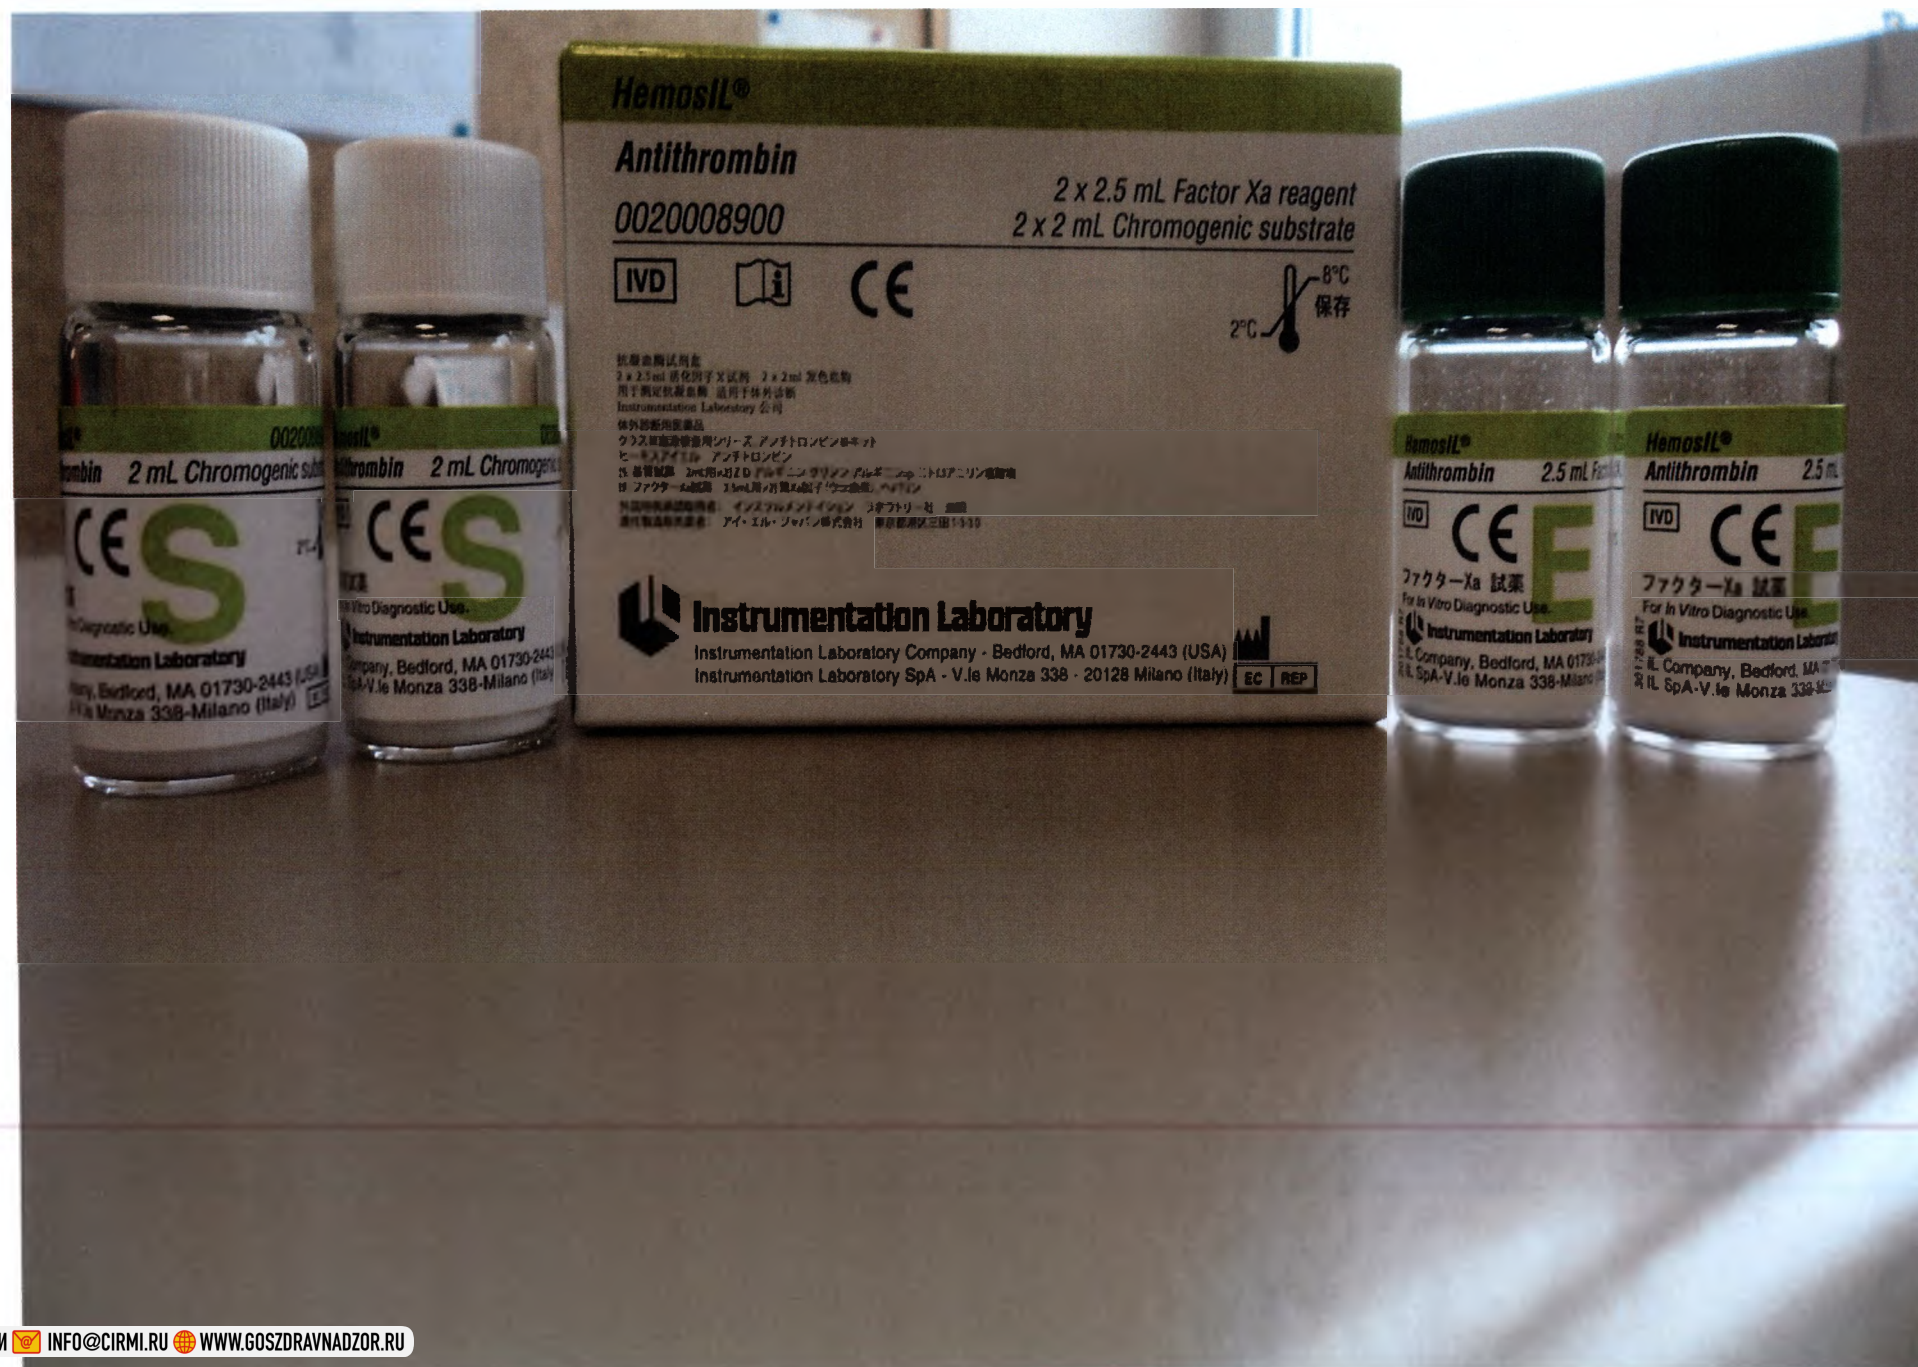


HemosIL®

Liquid Antithrombin

0020002500

4 x 4 mL Factor Xa reagent
2 x 2 mL Chromogenic substrate



体外診断用医薬品

アンチトロンビンIIIキット

ヒーモスアイエル アンチトロンビンLQ

[S:基質試薬 2mLx2] N-α-Z-D-アルギニル-グリシル-アルギニル-p-ニトロアニリン塩酸塩

[E:ファクターXa試薬 4mLx4] 第Xa因子(ウシ由来)、ヘパリン

外国特例承認取得者: インスツルメンテーション ラボラトリー社 米国

選任製造販売業者: アイ・エル・ジャパン株式会社 東京都港区三田1-3-30



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



EC REP

Liquid Antithrombin

0020300400

2 x 2 mL Factor Xa reagent
2 x 2 mL Chromogenic substrate

For the determination of Antithrombin.
Composition: Chromogenic substrate, bovine Factor Xa.


For In Vitro Diagnostic Use. 体外診断用医薬品




Instrumentation Laboratory

www.ilwww.com


Distributed by:
Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

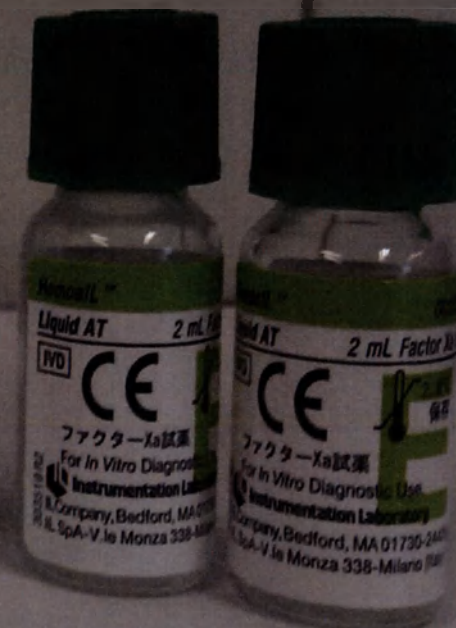


Антитромбин жидкий XL - HemosIL, Liquid Antithrombin XL

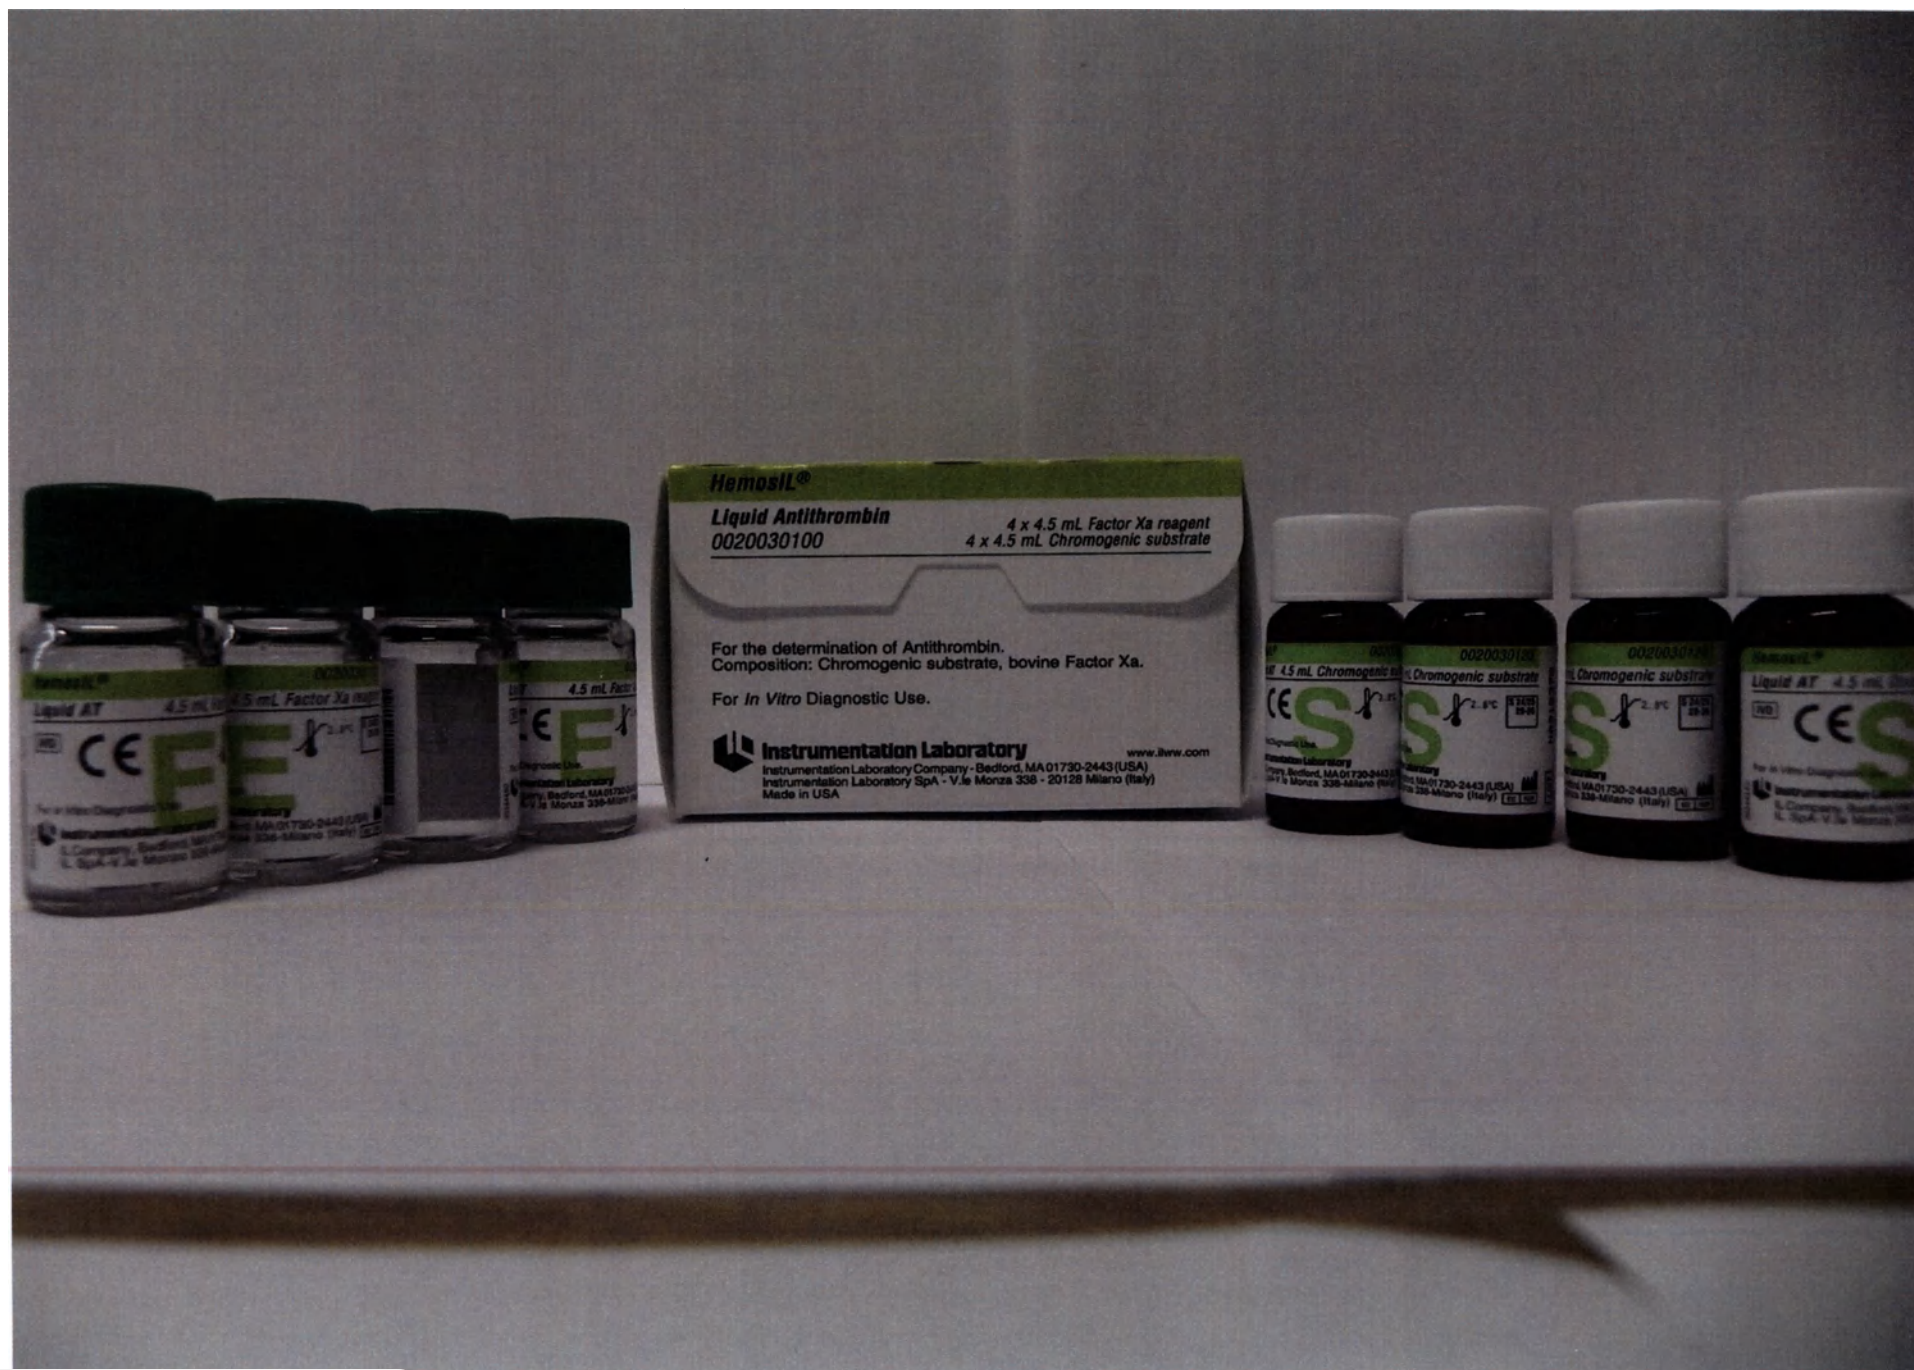


Субстрат жидкого Антитромбина- HemosIL Liquid Antithrombin Substrate

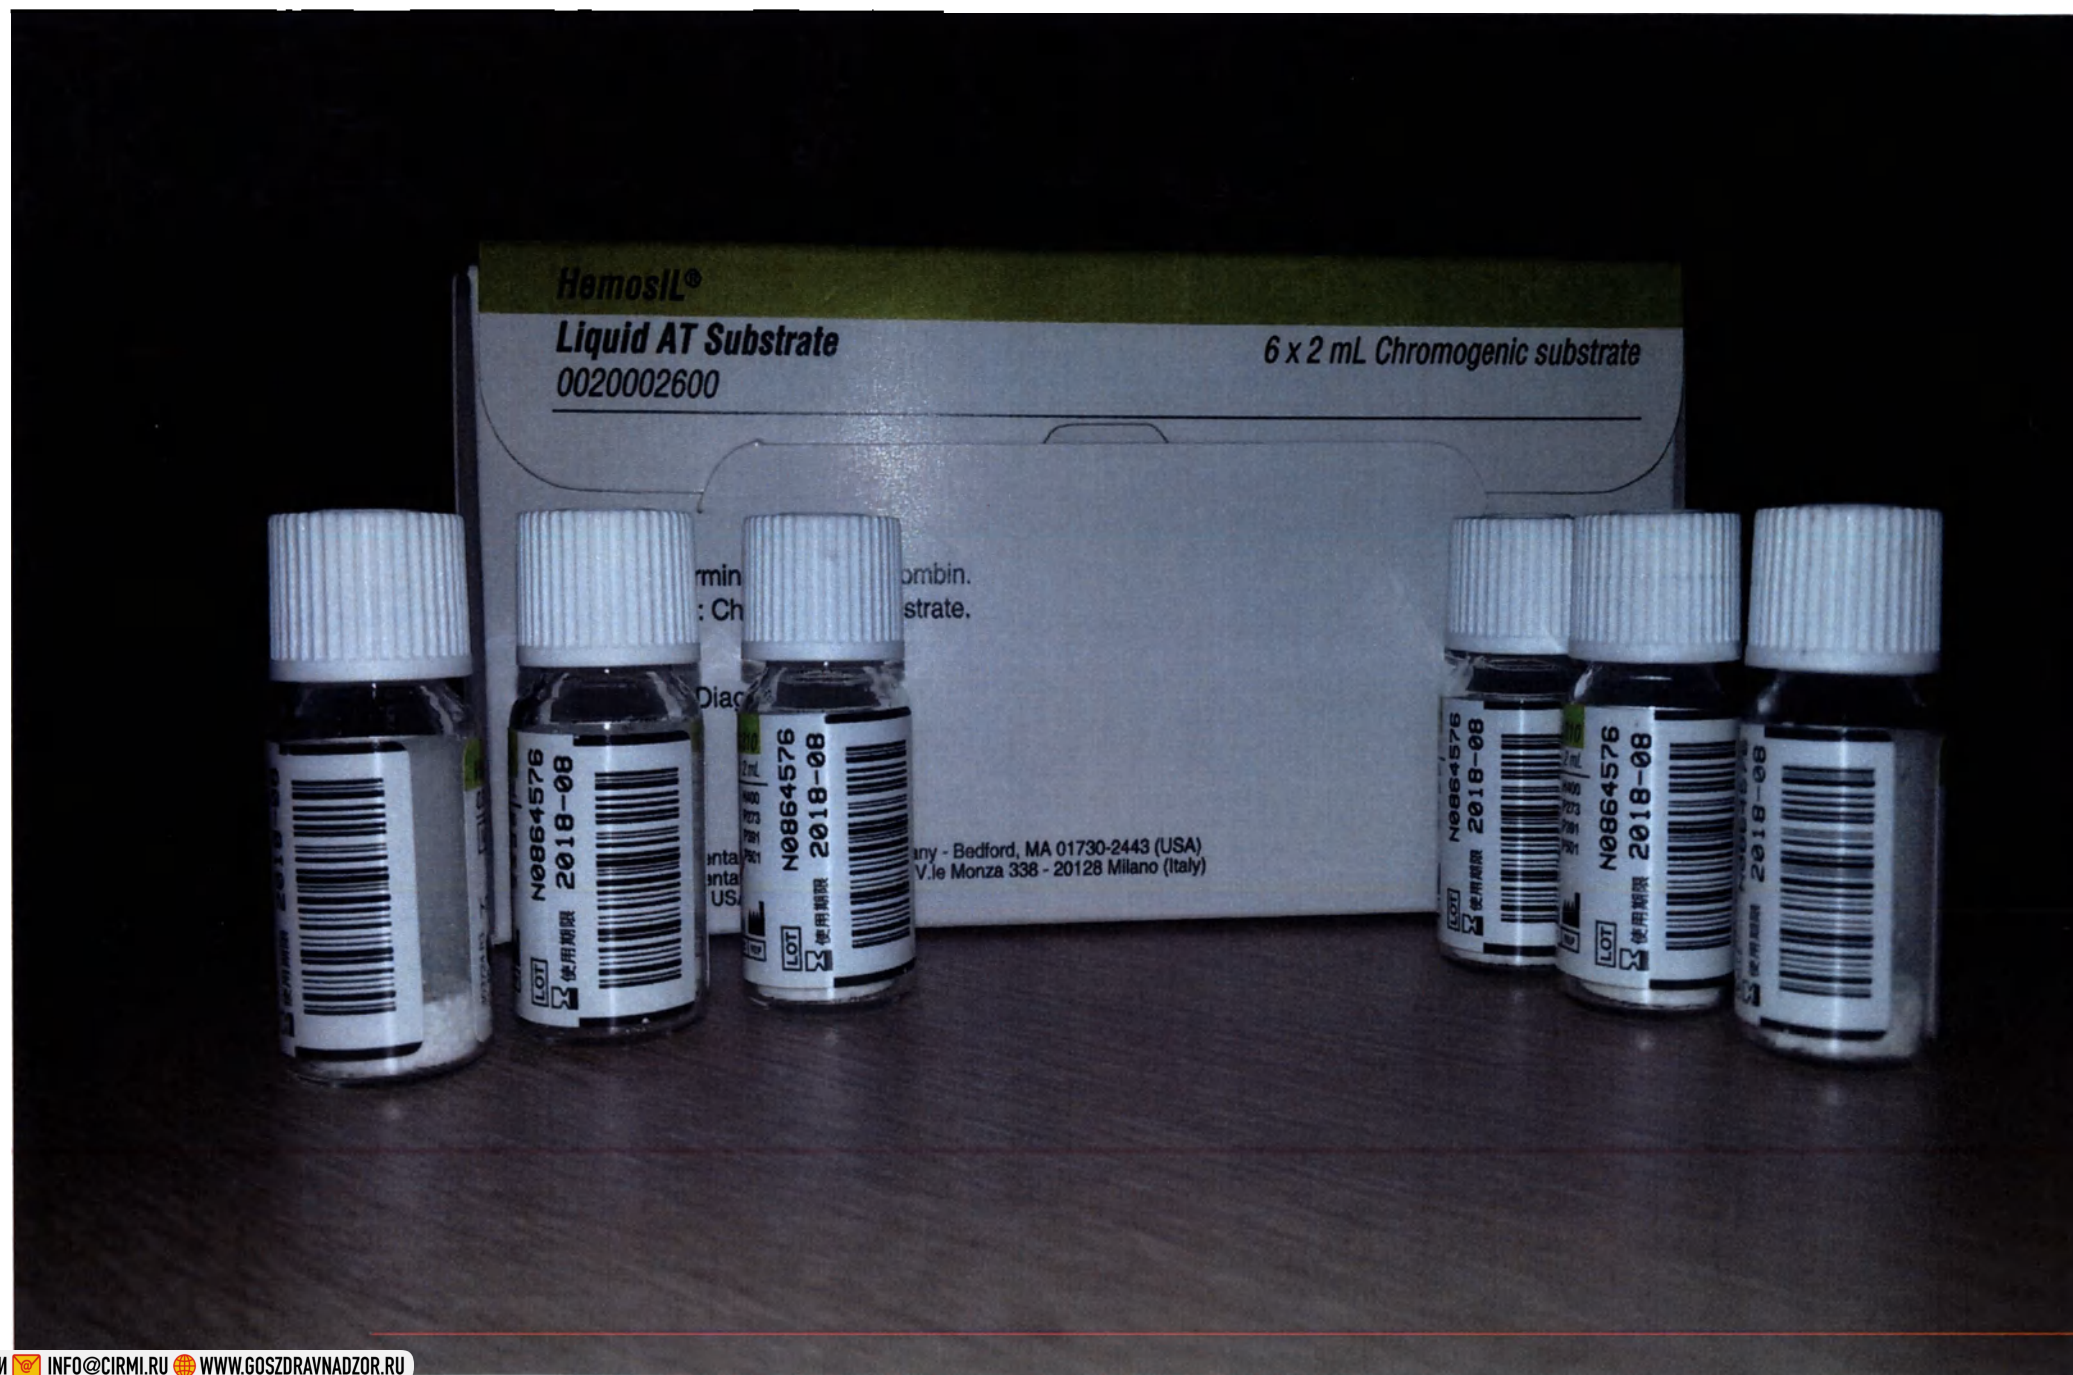


Реагент для определения прямых ингибиторов тромбина – HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay

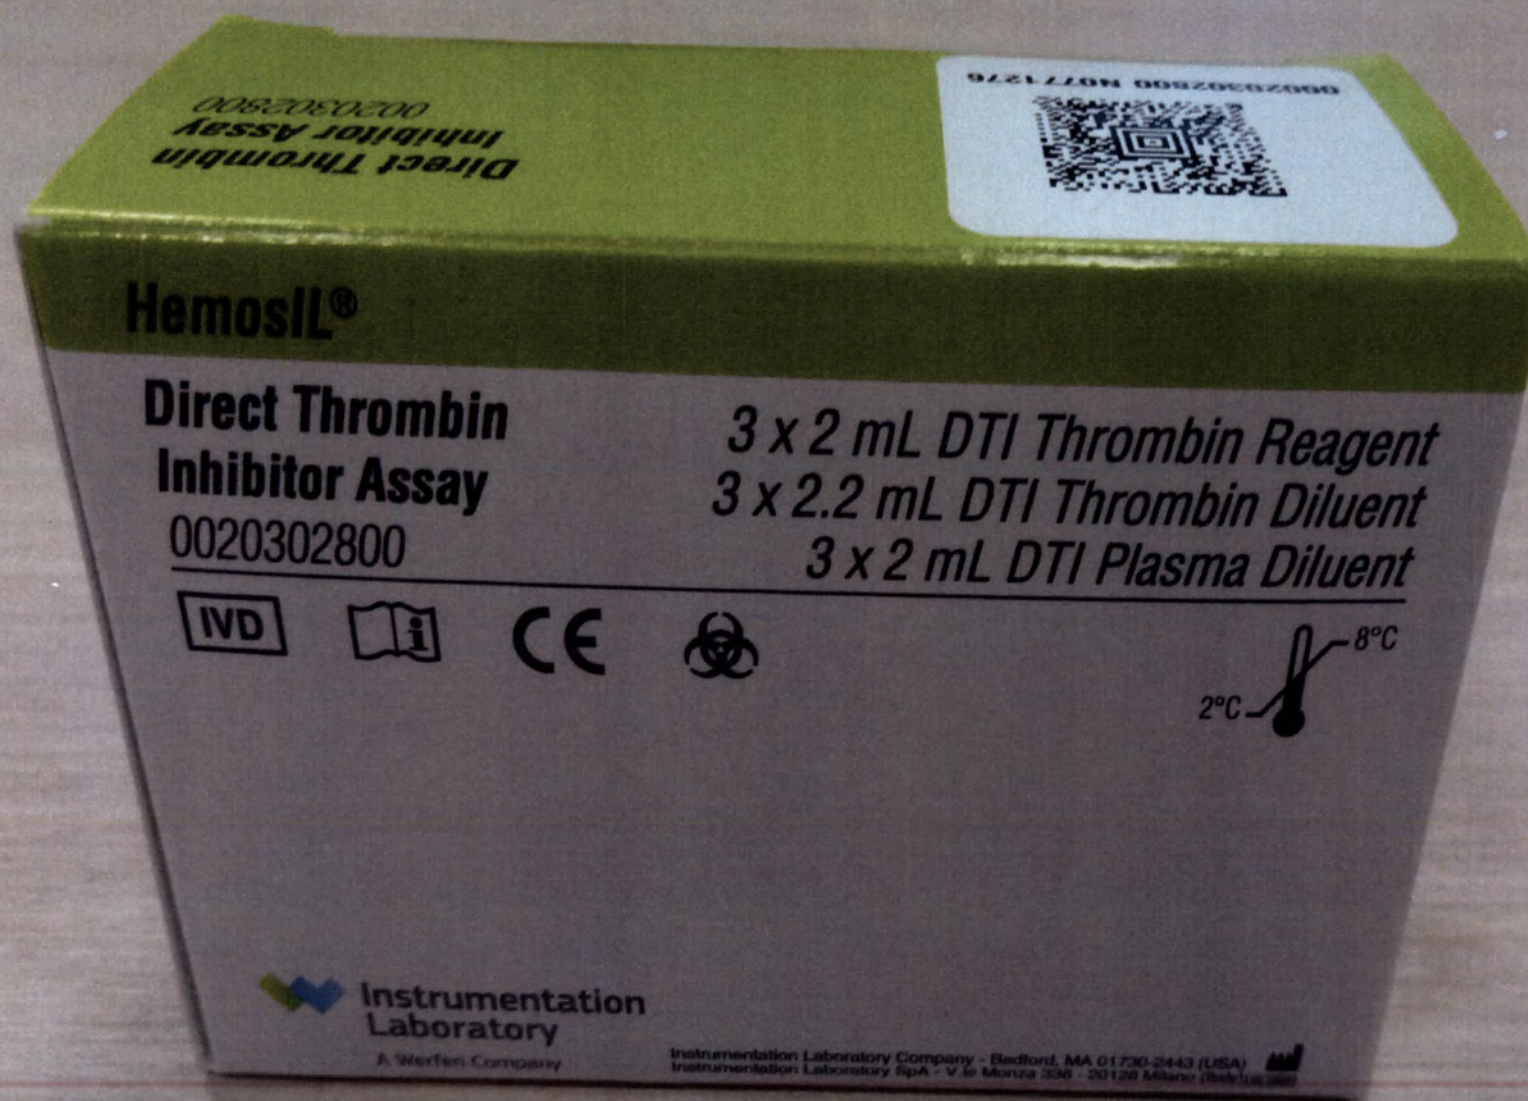



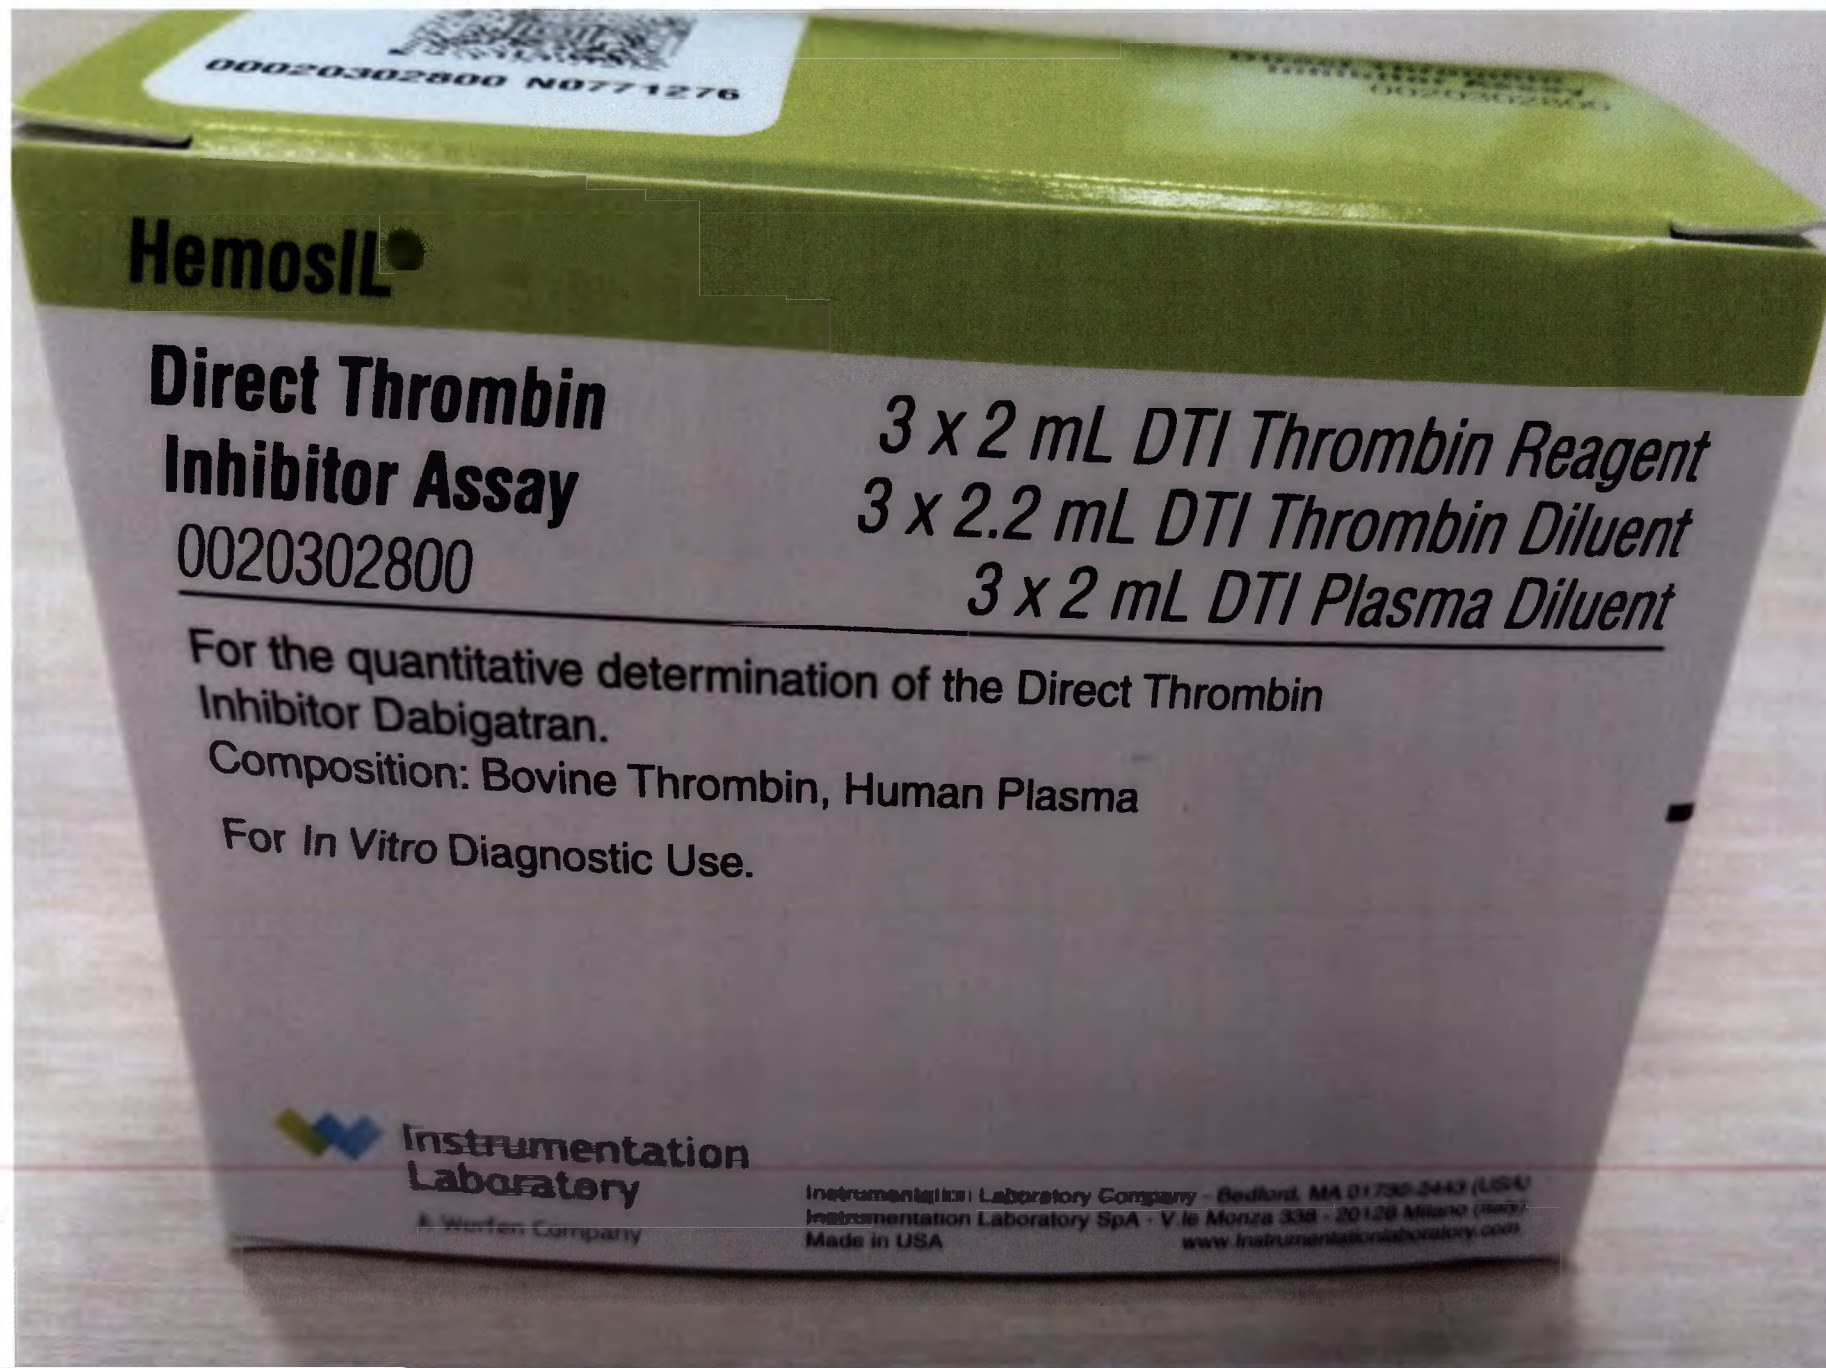

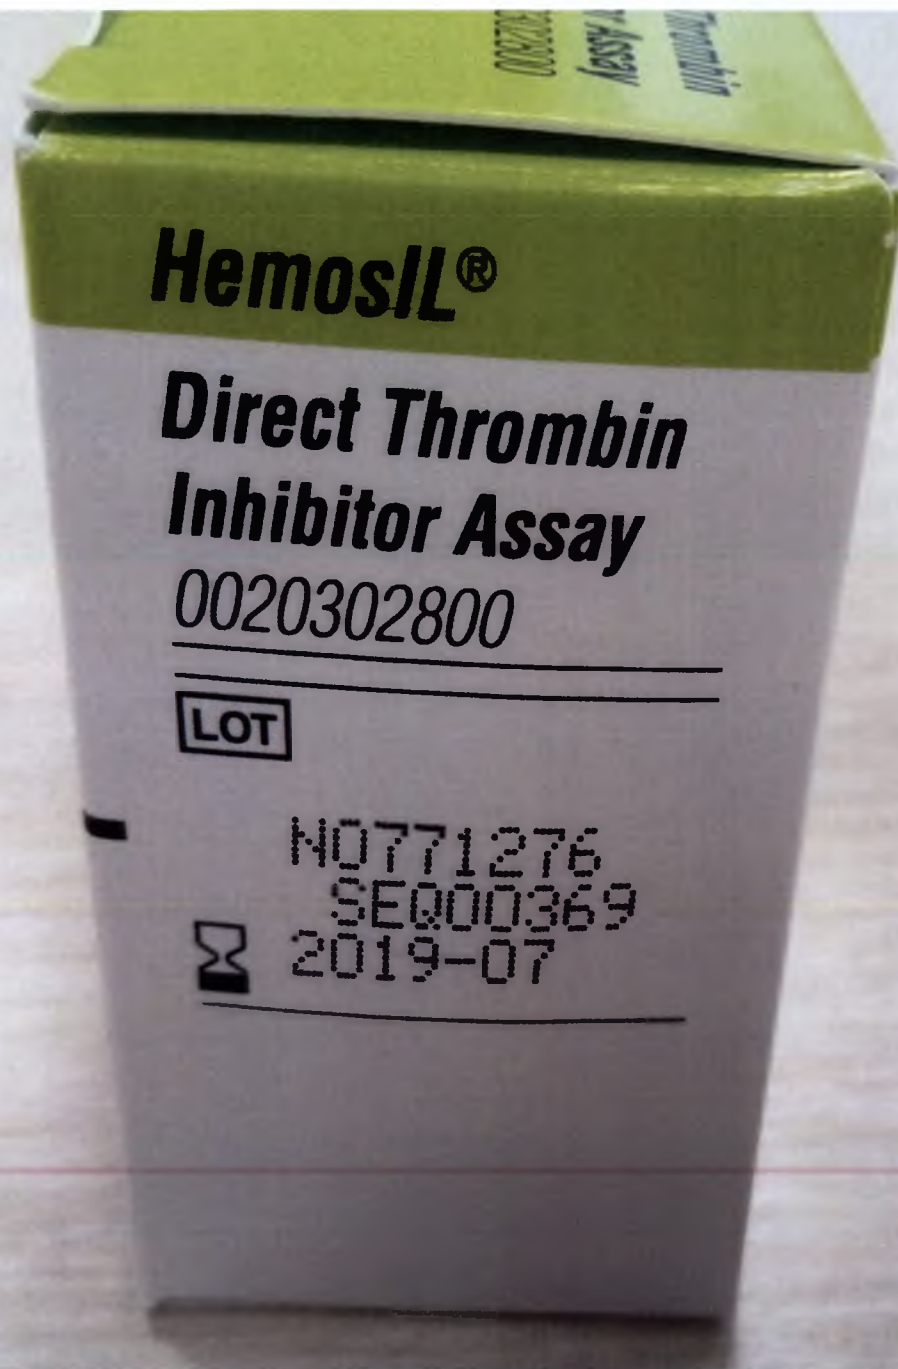

Реагент для определения прямых ингибиторов тромбина – HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay






HemosIL®

ProClot

0008468310

4 x 1.5 mL Protein C activator
2 x 1 mL Protein C control plasma
4 x 1 mL Protein C deficient plasma



蛋白C (活性) 试剂盒

4 x 1.5 mL 蛋白C激活物 2 x 1 mL 蛋白C质控血浆 4 x 1 mL 蛋白C缺乏血浆

用于实验室测定蛋白C活性 适用于体外诊断

Instrumentation Laboratory 公司

プロテインCキット

ヘモスアイエル プロテインC クロット

【プロテインC活性化剤 1.5mL用×4】プロタック (貯蔵由来) 【プロテインC欠乏血浆 1mL用×4】ヒト血浆

【プロテインCコントロール血浆 1mL×2】ヒト血浆

Category 2

外国特許承認取得者: インストルメンテーション ラボラトリー社 米国

国内製造販売業者: アイ・エル・ジャパン株式会社 東京都港区芝浦3-7-12

販売業者: 三菱化学メディエンス株式会社 東京都港区芝浦4-2-8



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



EC

REP

HemosIL[®]

ProClot diluent

0008468600

LOT

NO169978
SEQ00300
2018-01




使用期限



**Instrumentation
Laboratory**


A Marten Company

Протеин С - HemosIL Protein C

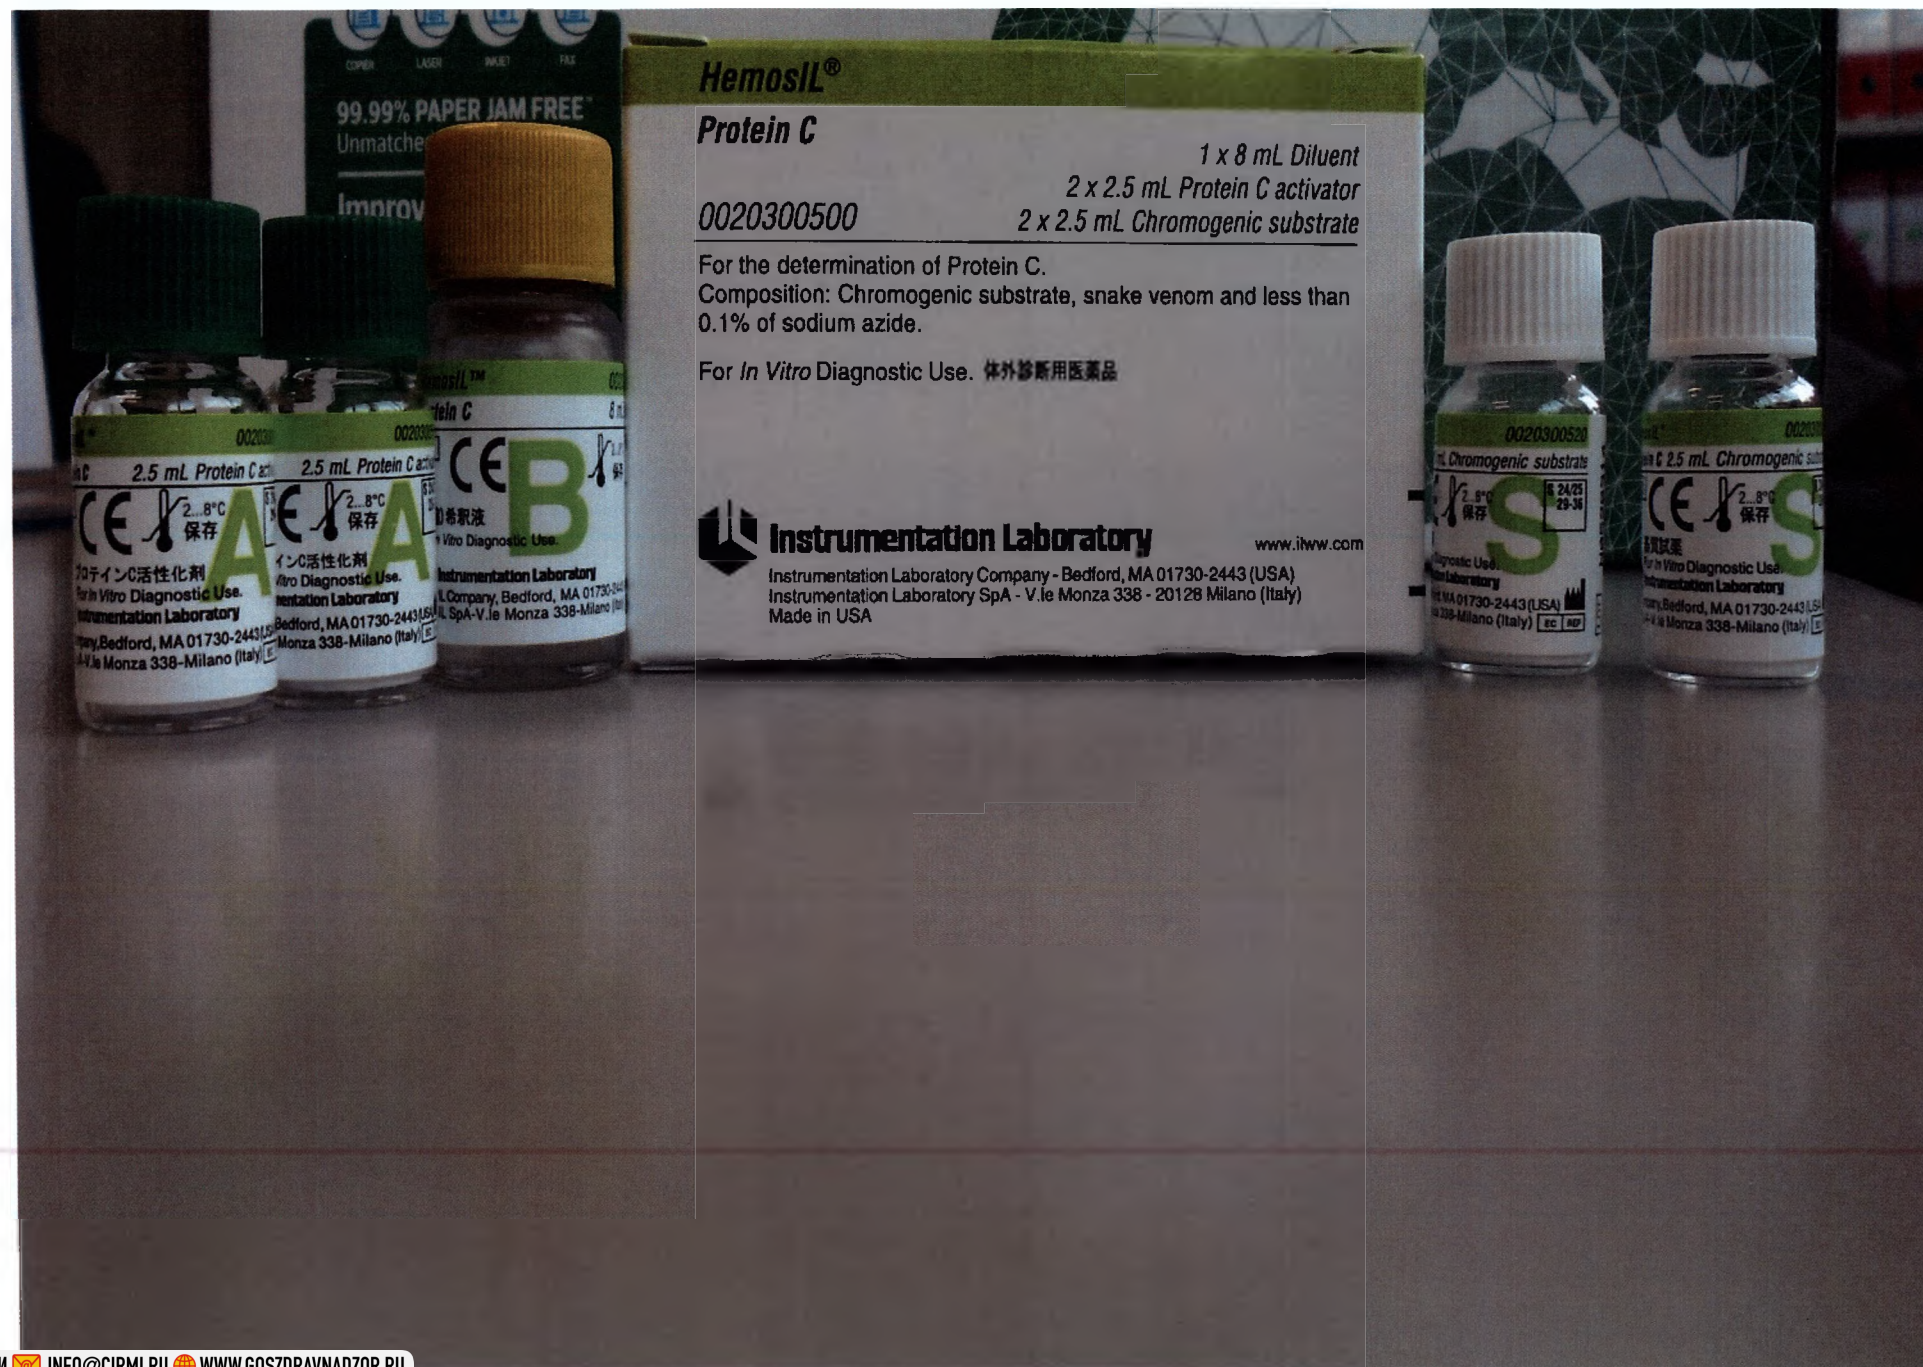





Протеин S - HemosIL Protein

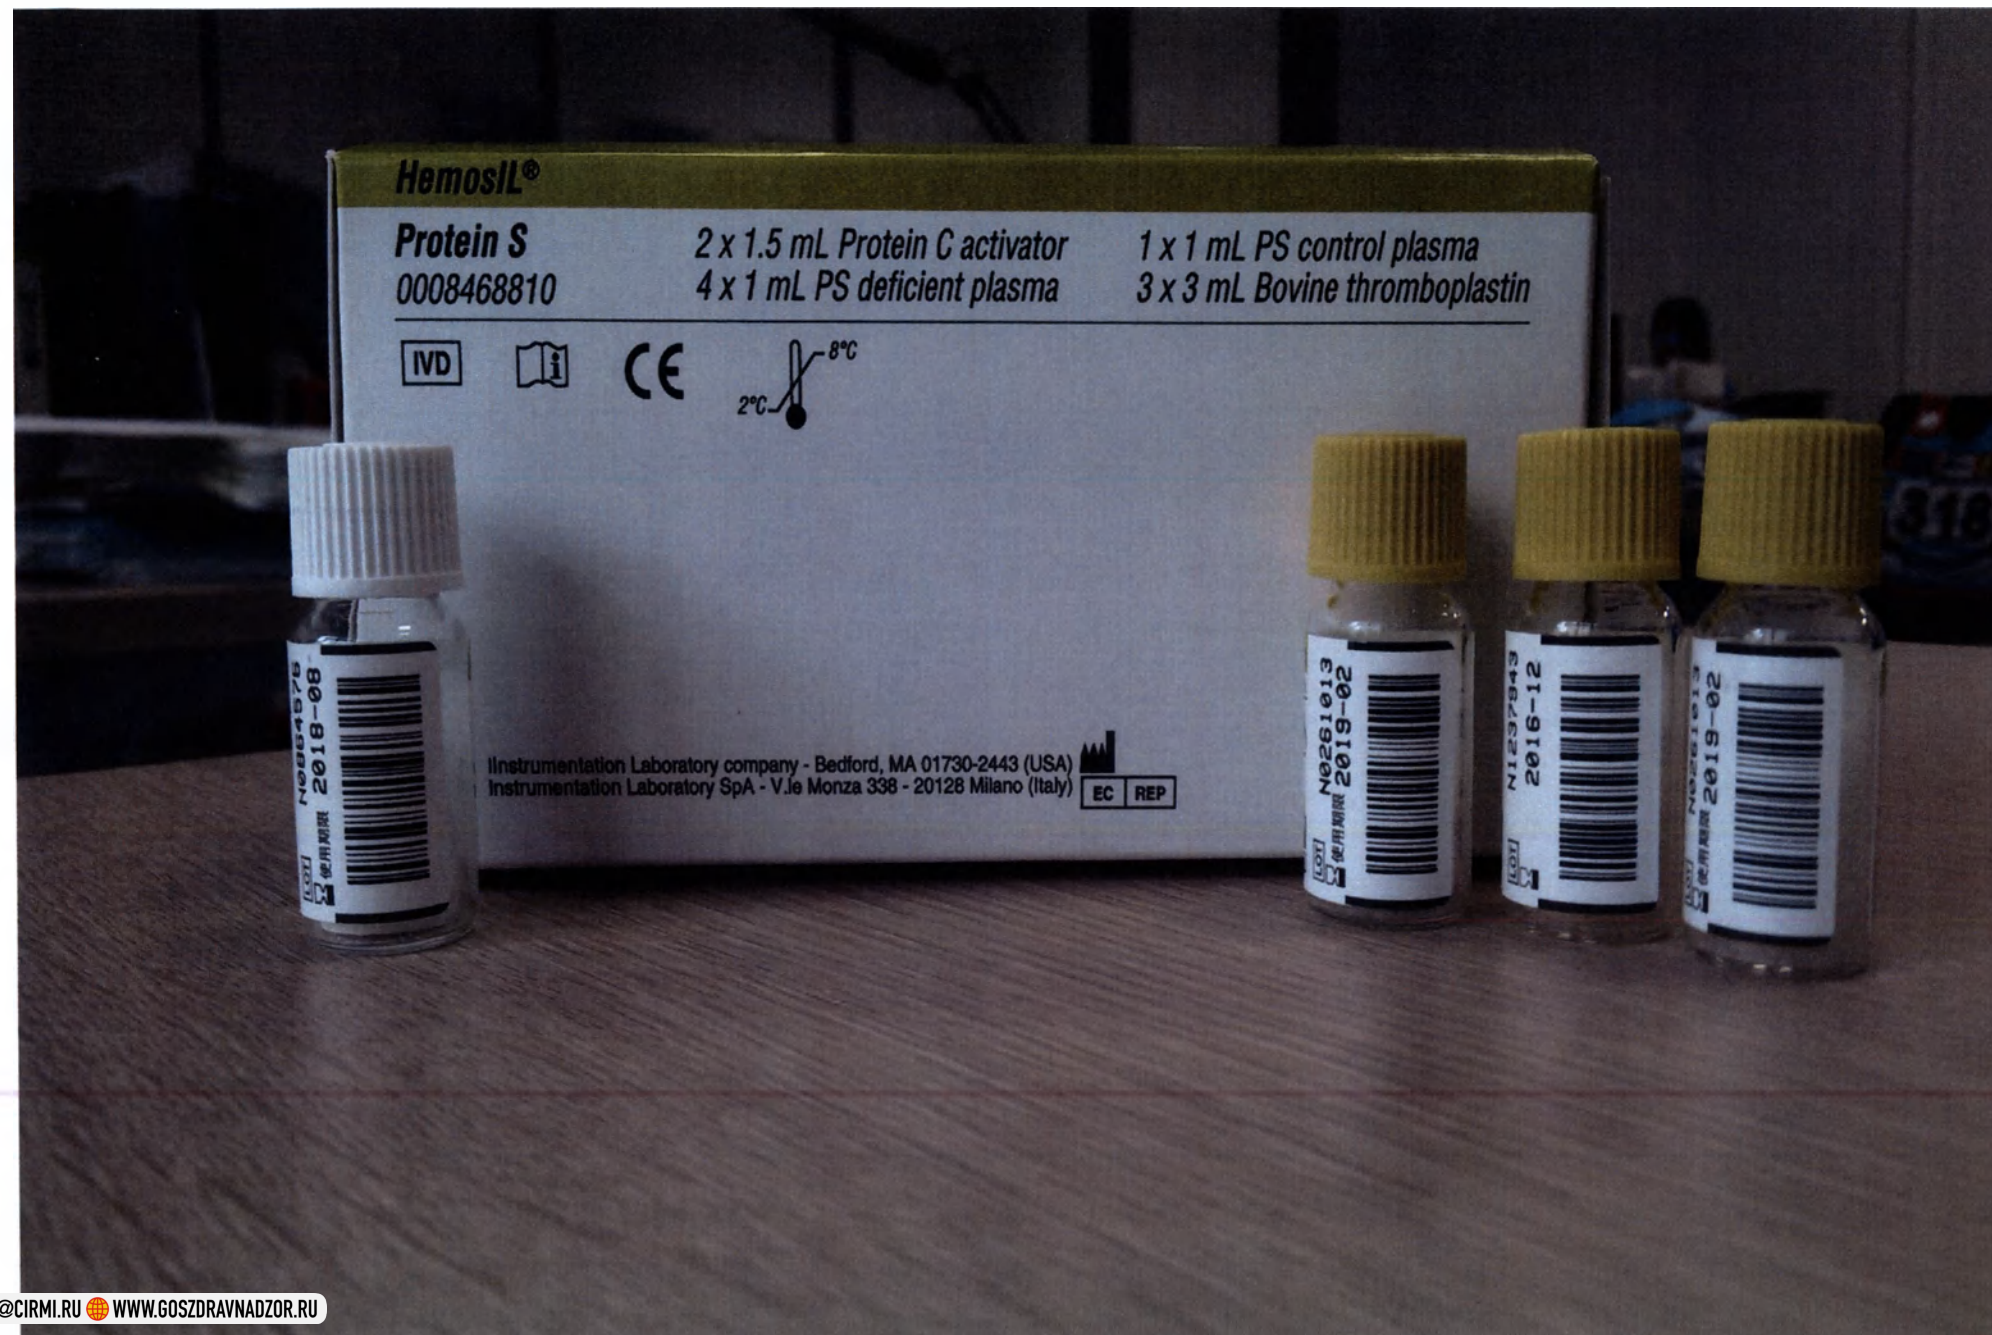

Активность протеина S– HemosIL Protein S Activity

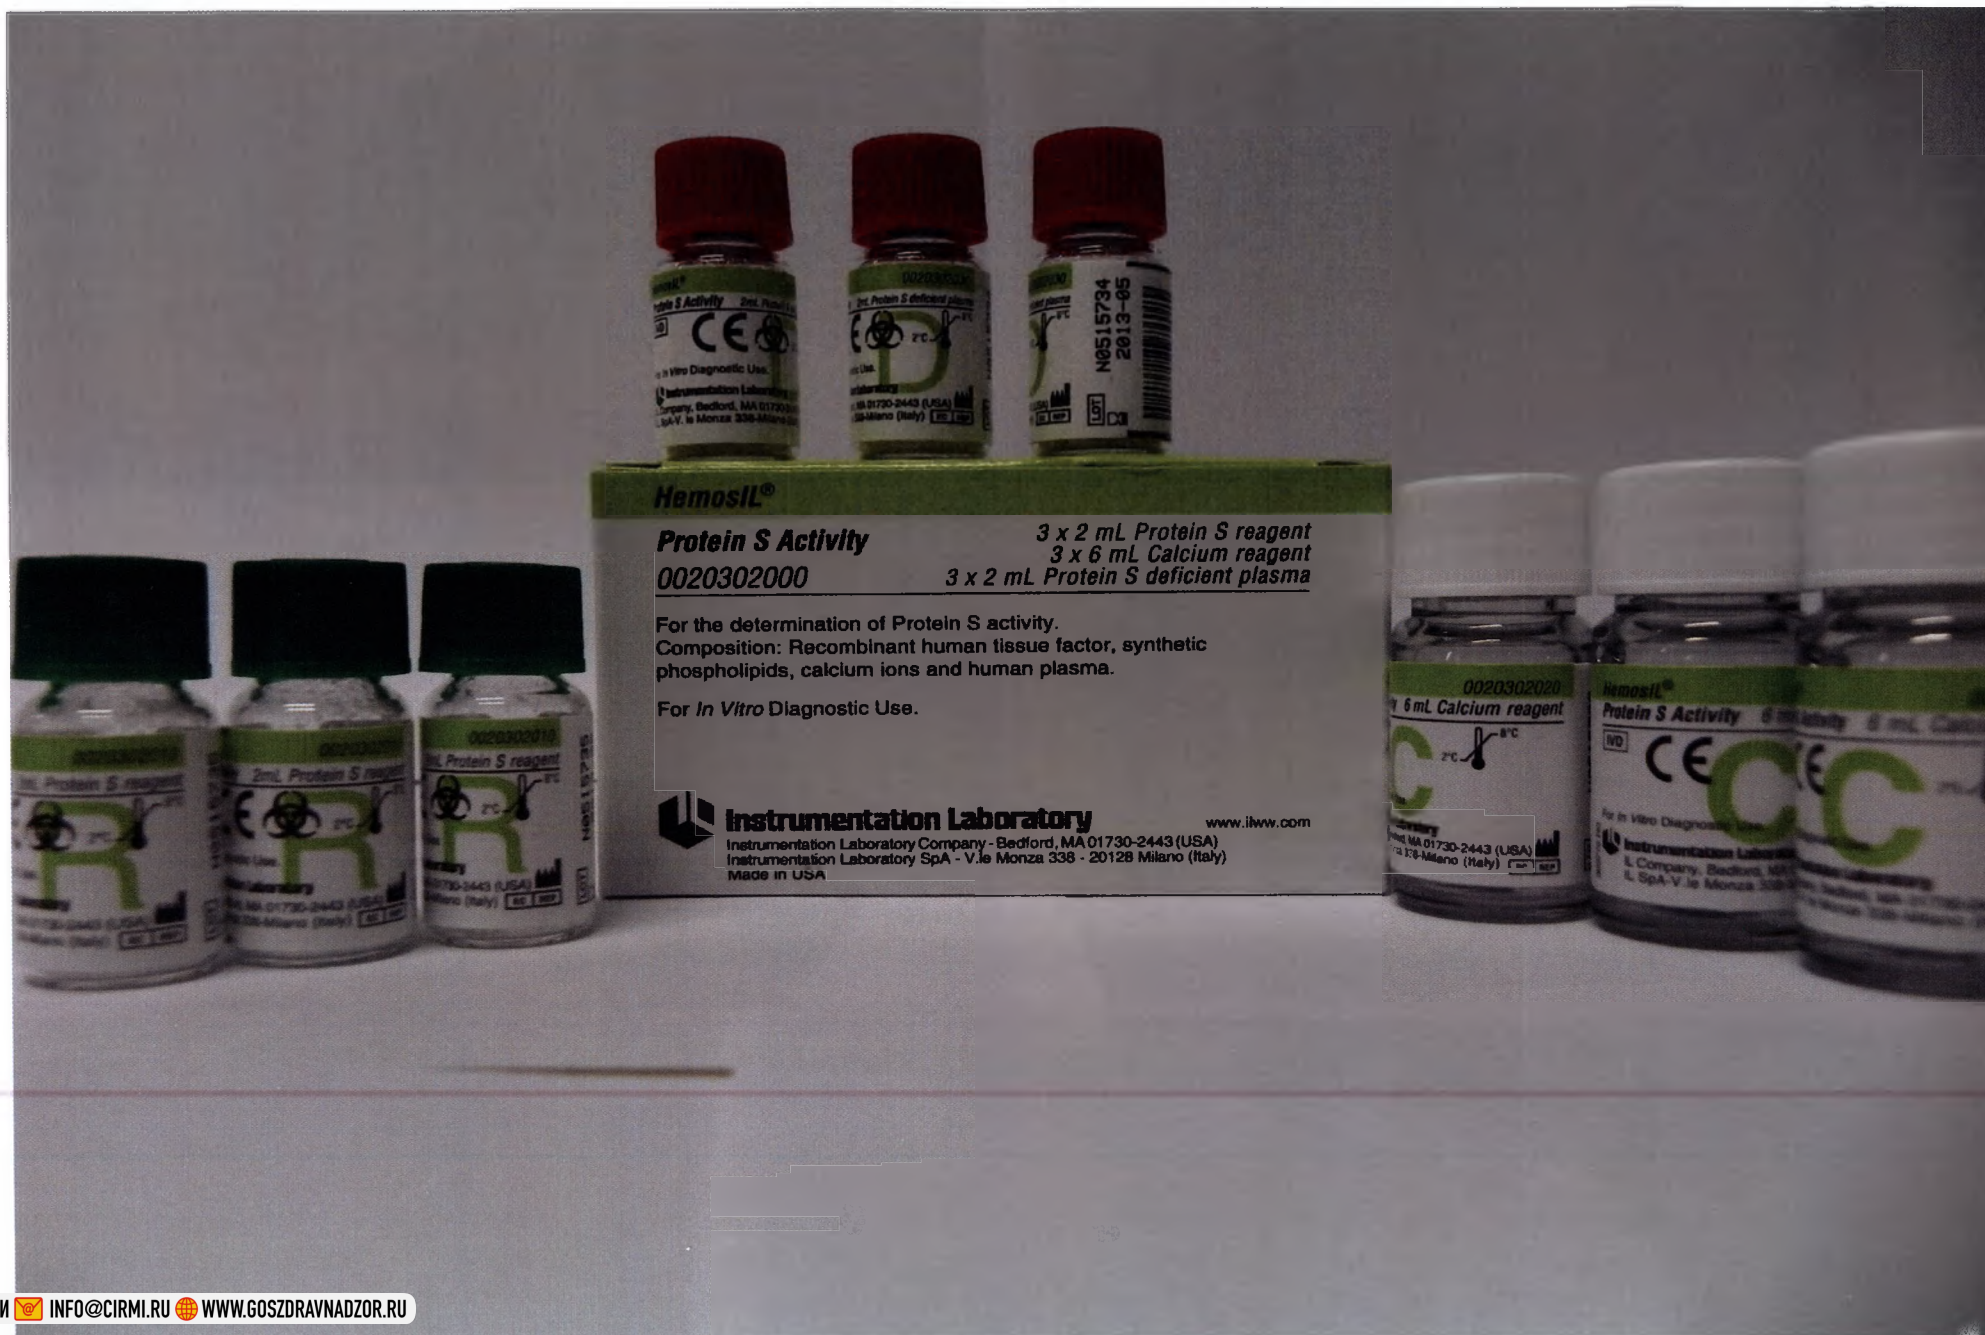

Нормальный контроль, аттестованный – HemosIL Normal Control ASSAYED

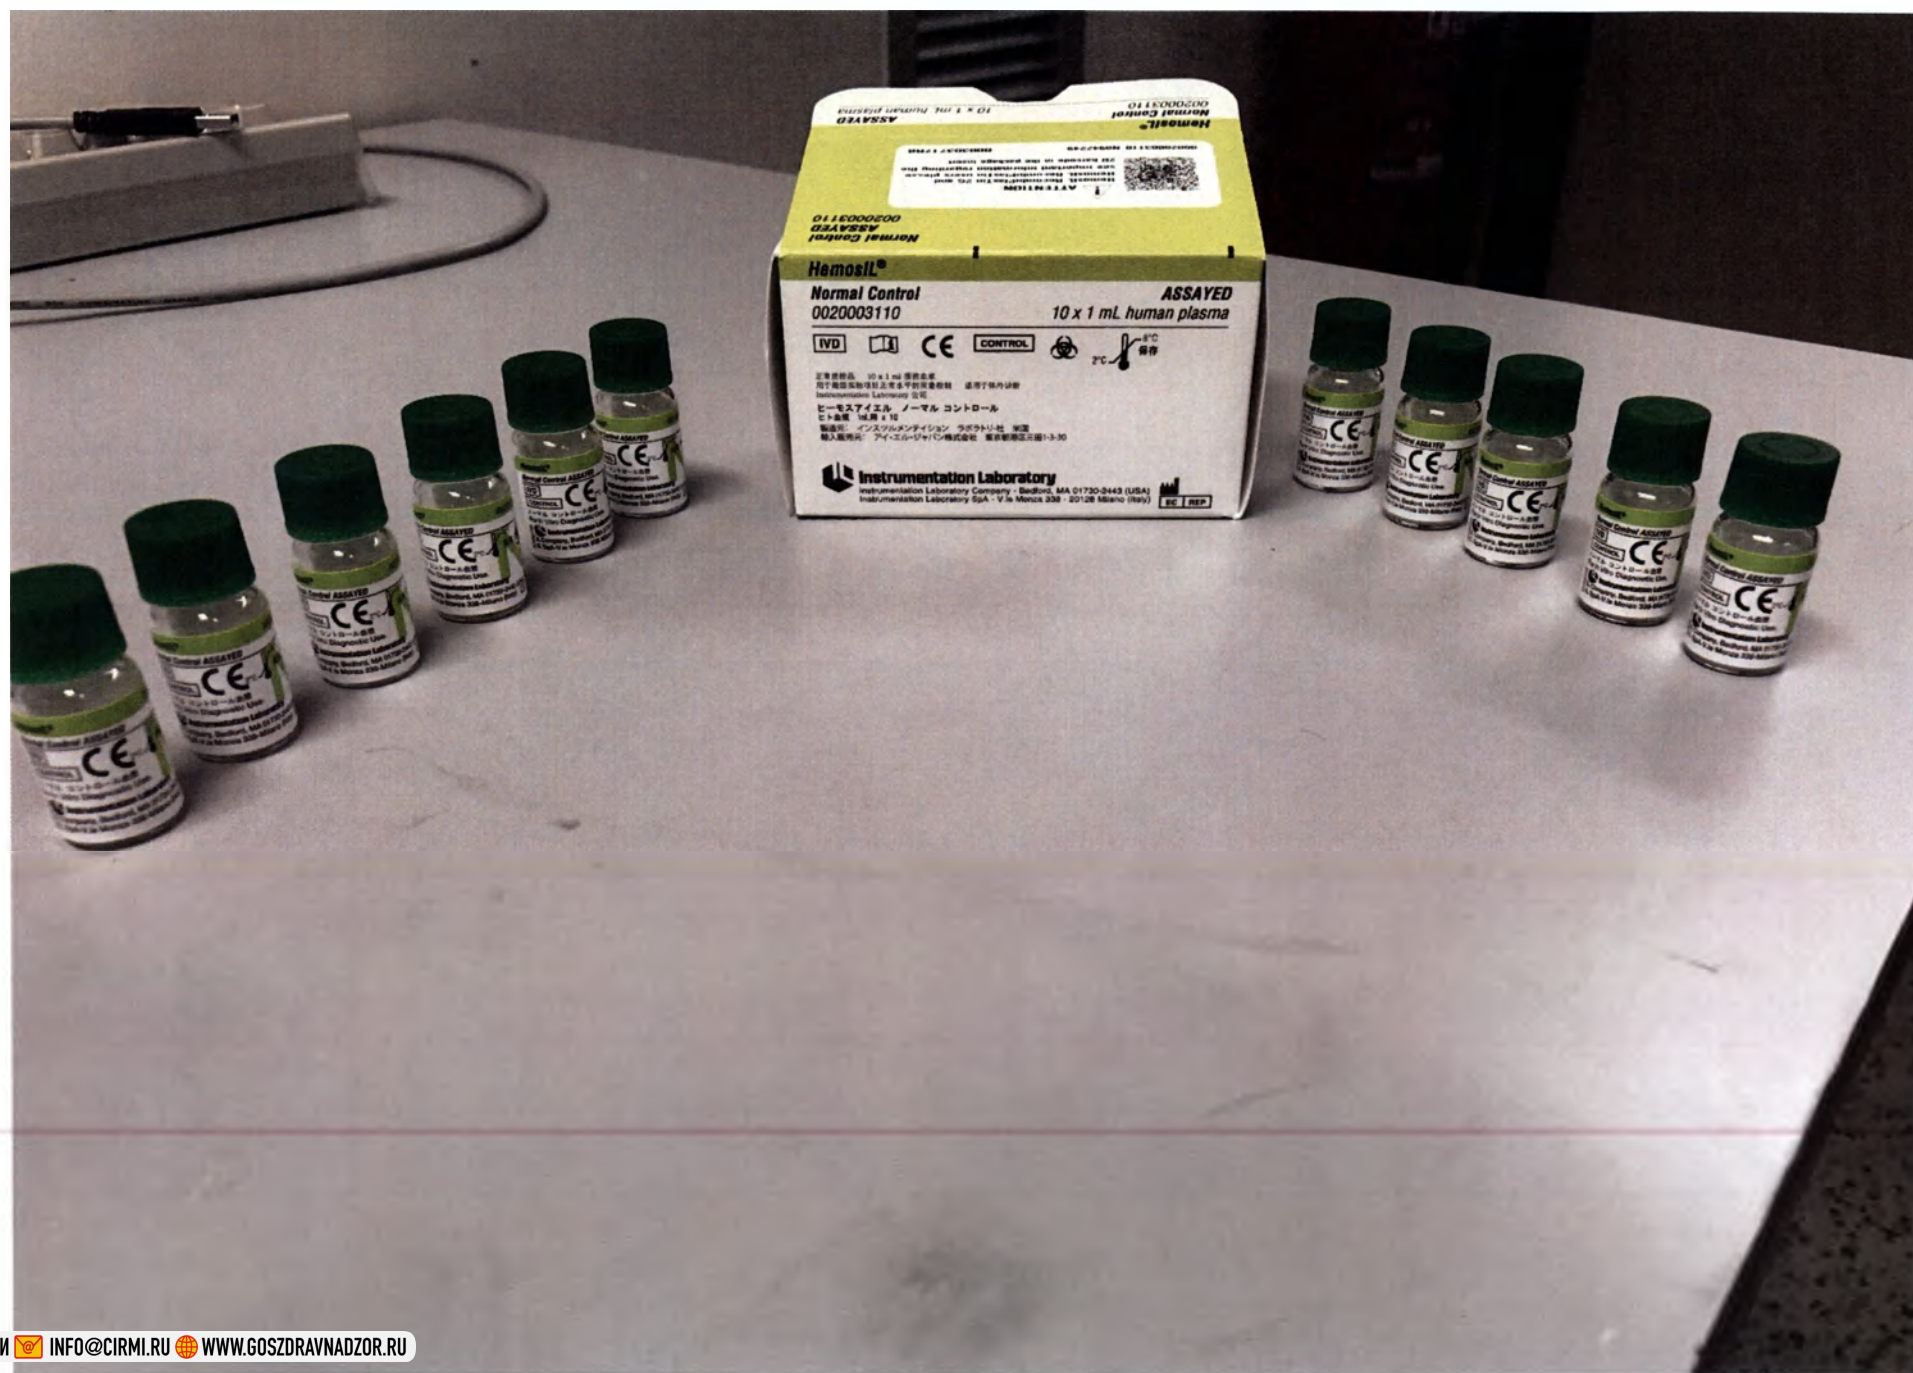


Высокий патологический контроль, аттестованный – HemosIL High Abnormal Control ASSAYED




Низкий патологический контроль, аттестованный – HemosIL Low Abnormal Control ASSAYED




Нормальный контроль, неаттестованный – HemosIL Normal Control UNASSAYED

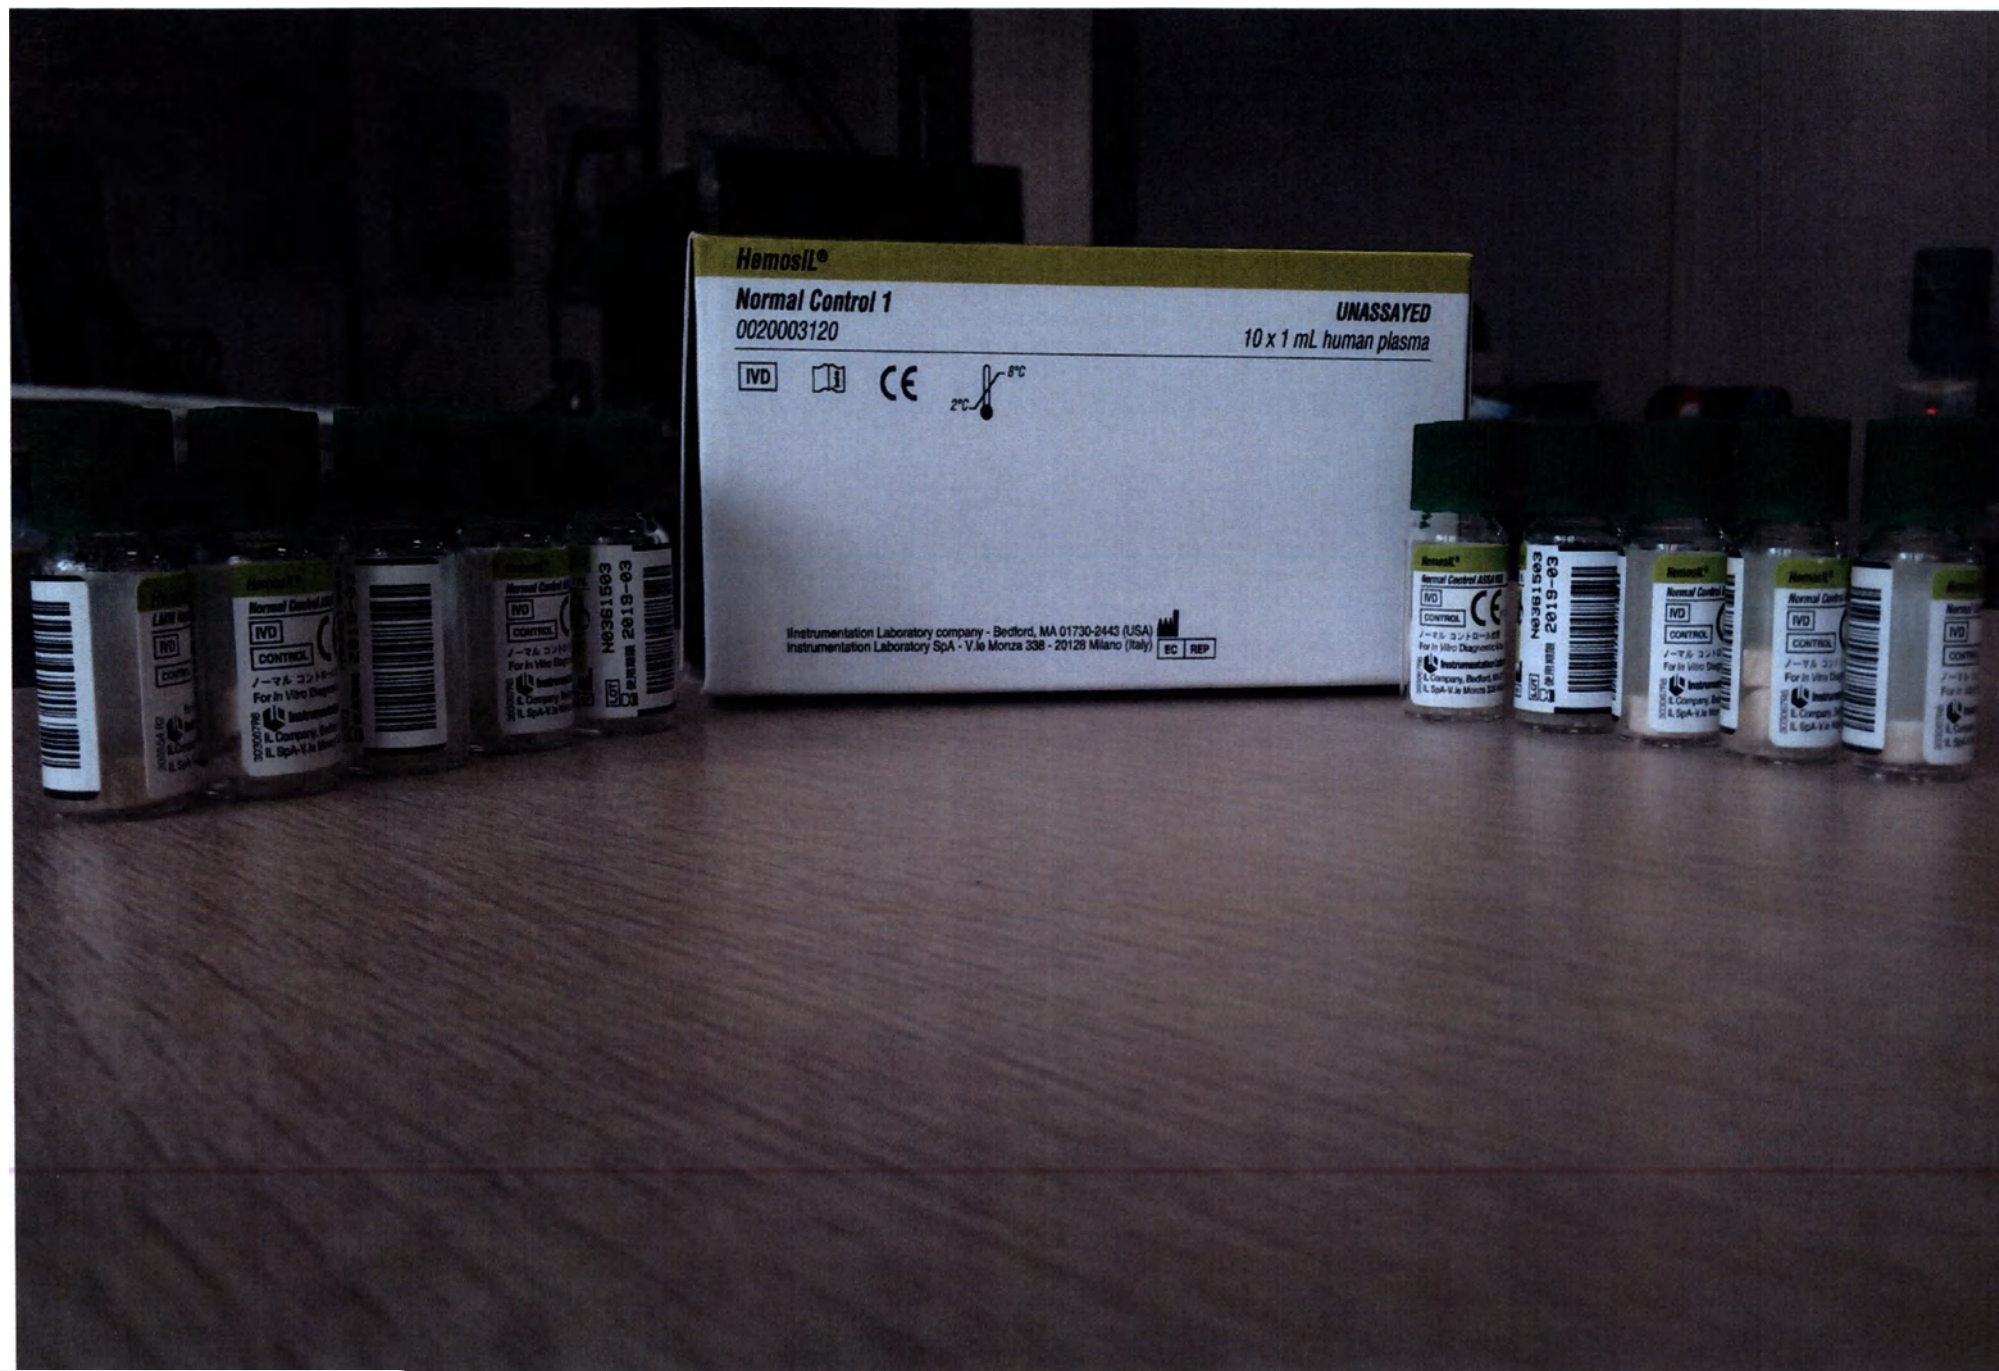


Высокий патологический контроль, неаттестованный – HemosIL High Abnormal Control UNASSAYED

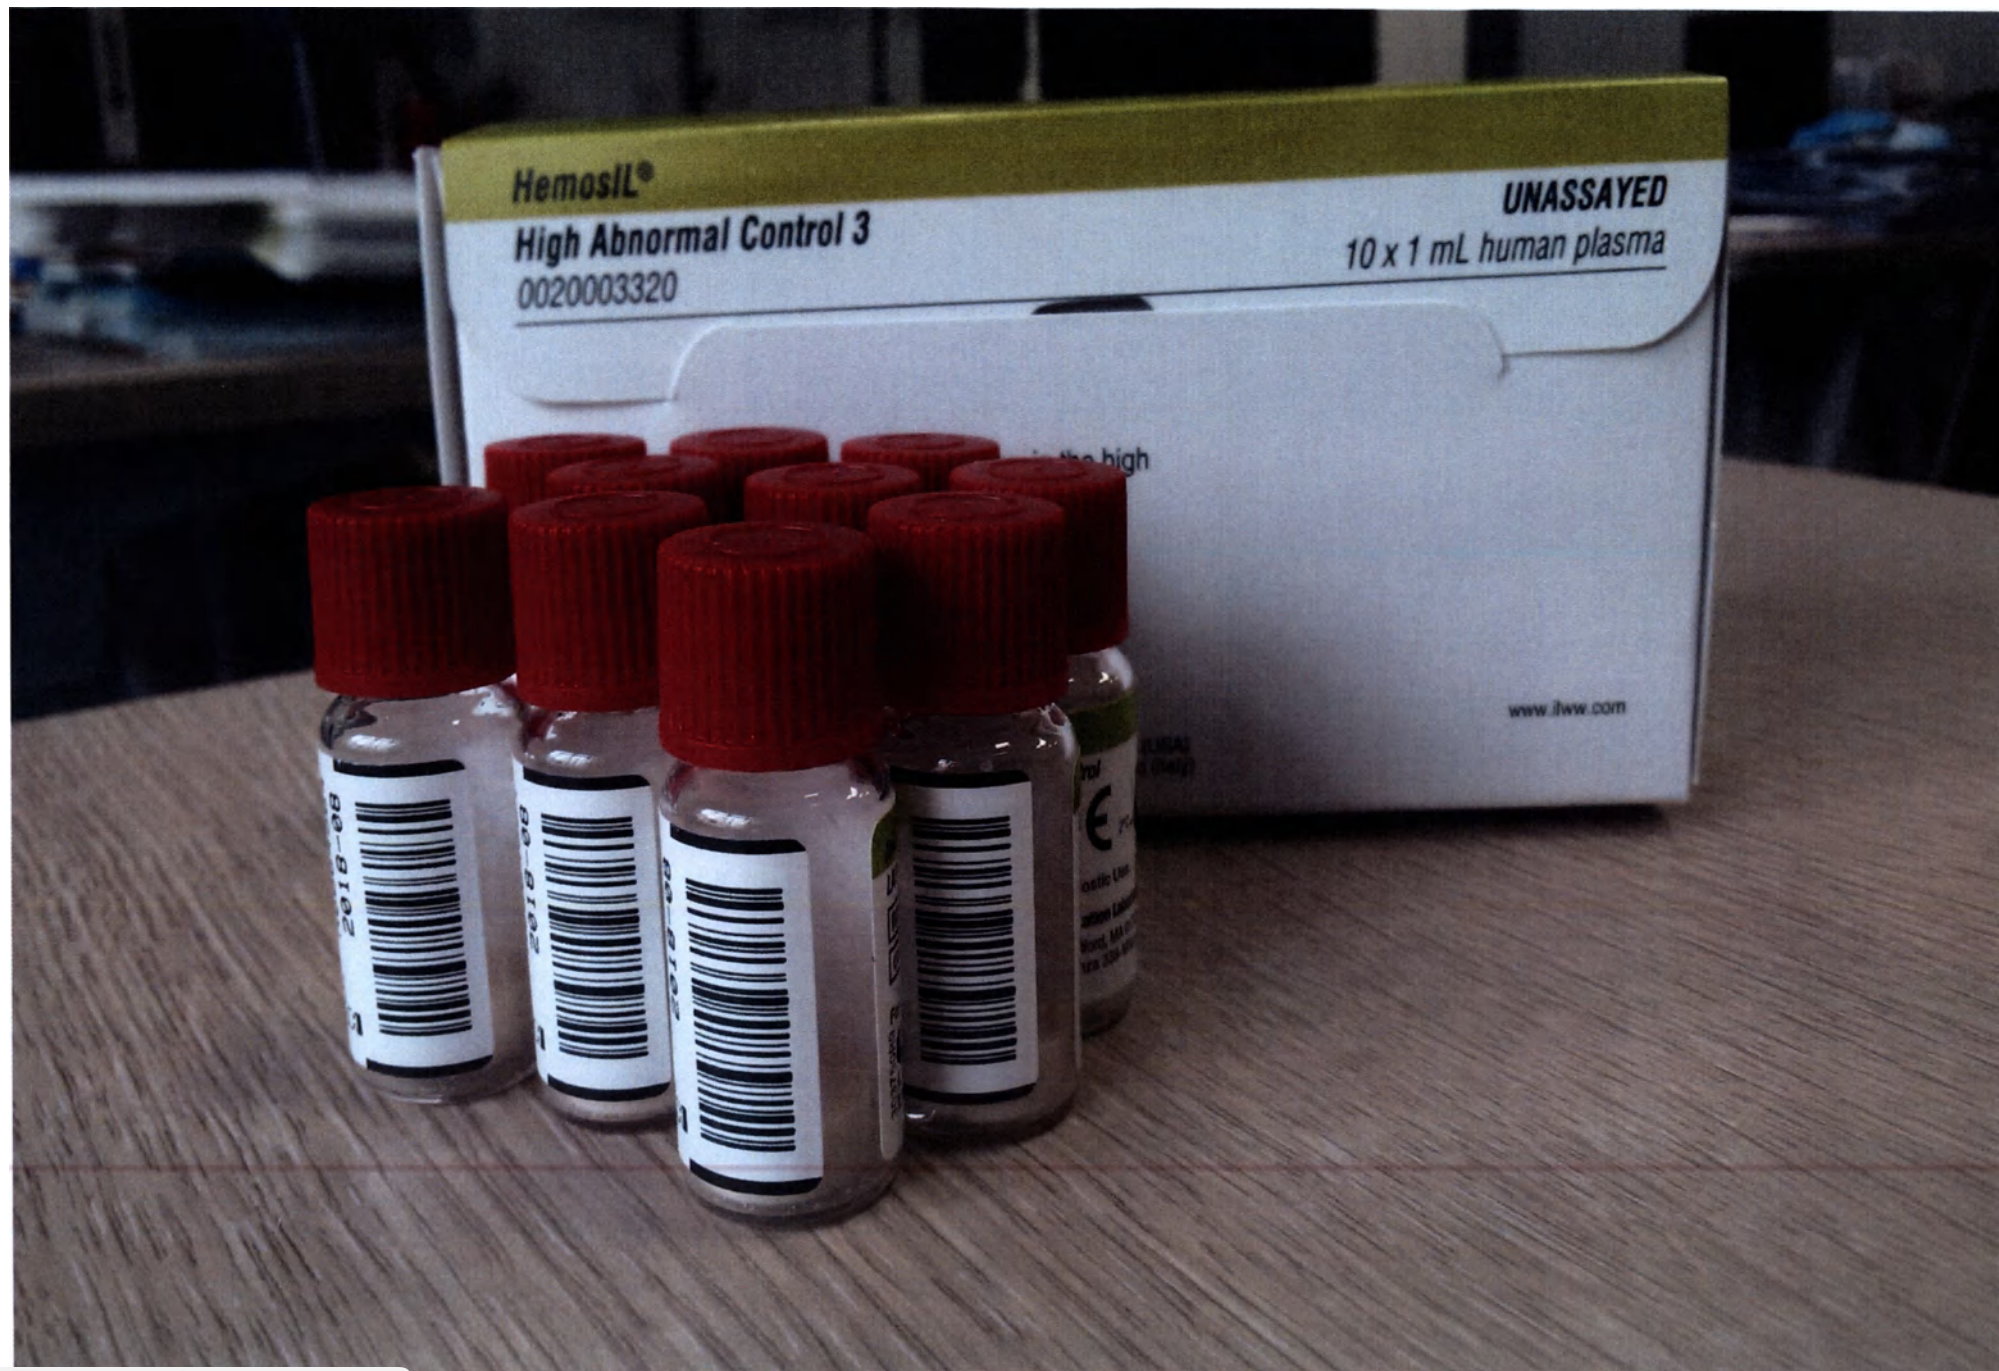


Низкий патологический контроль, неаттестованный – HemosIL Low Abnormal Control UNASSAYED

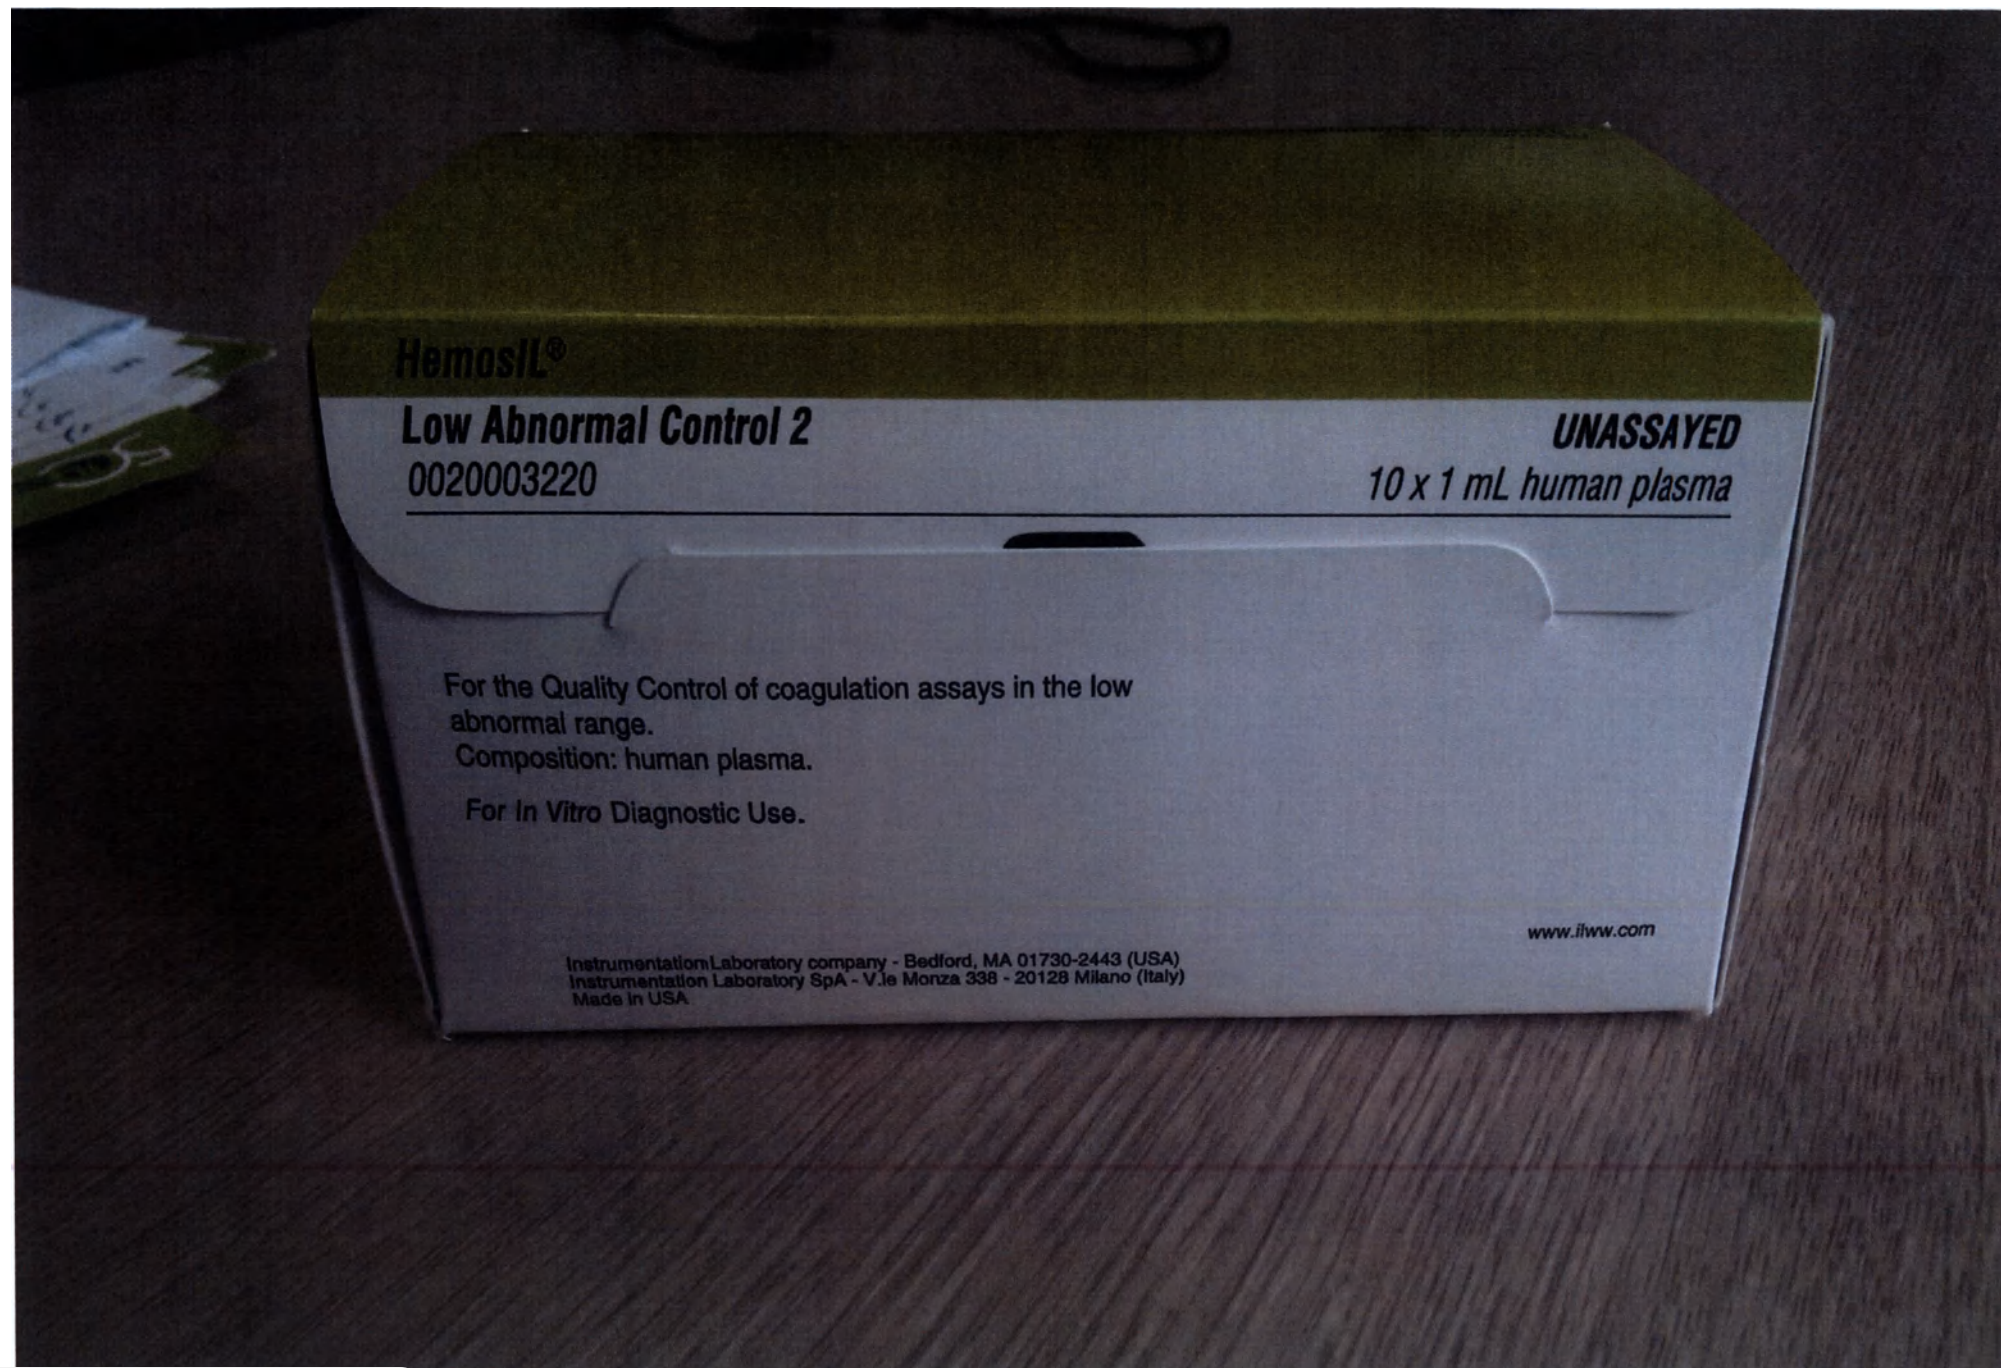

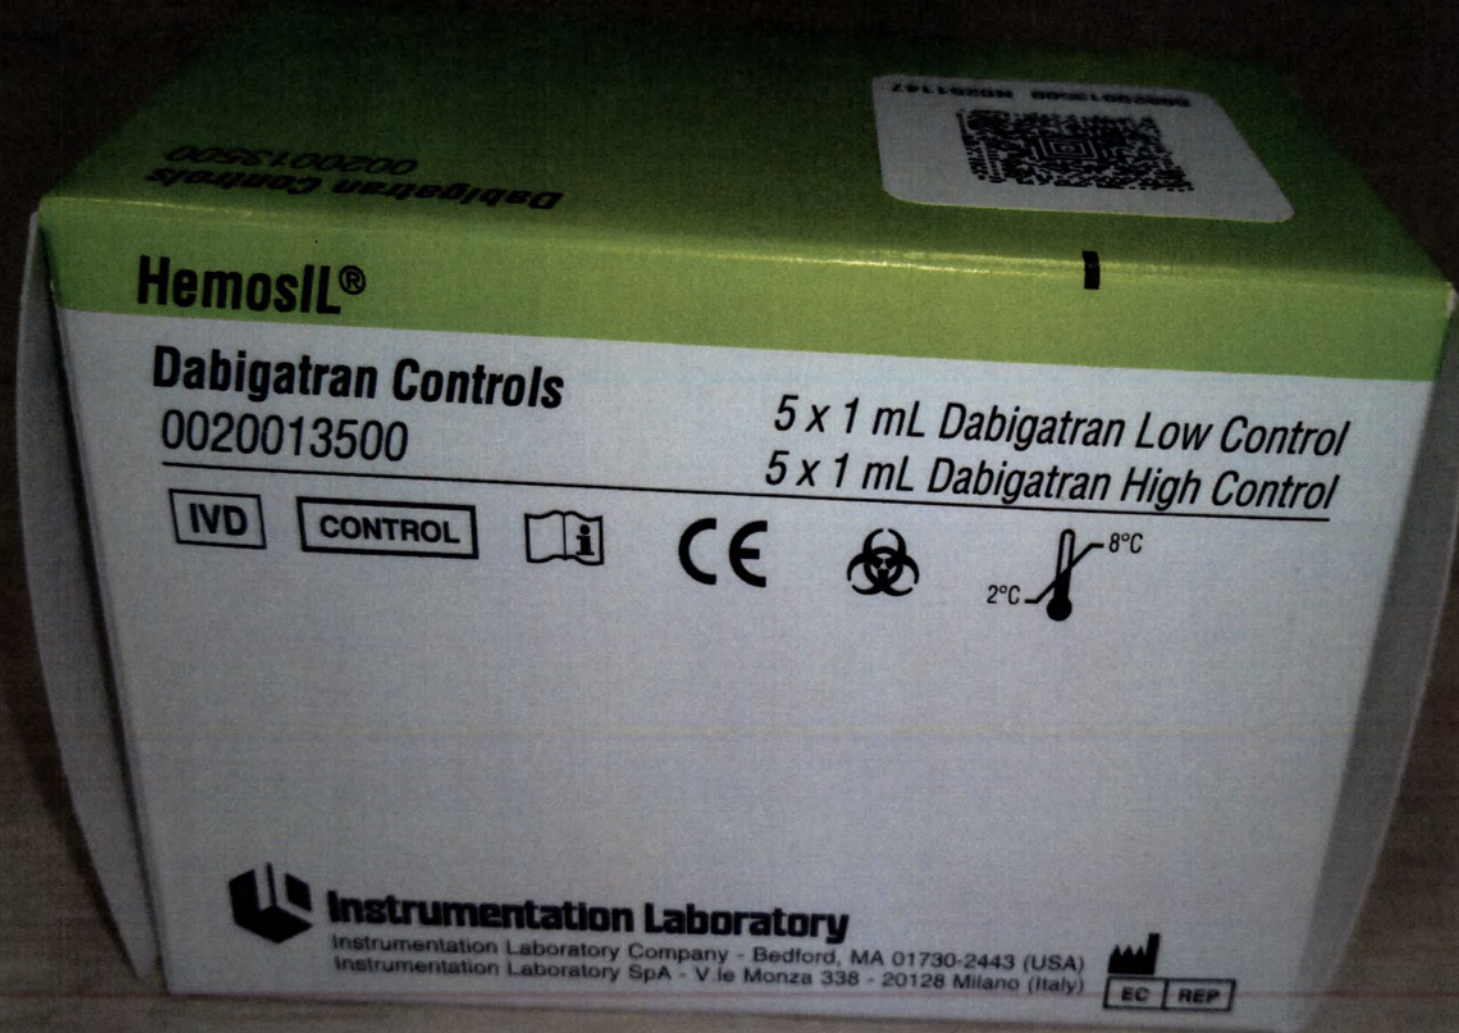




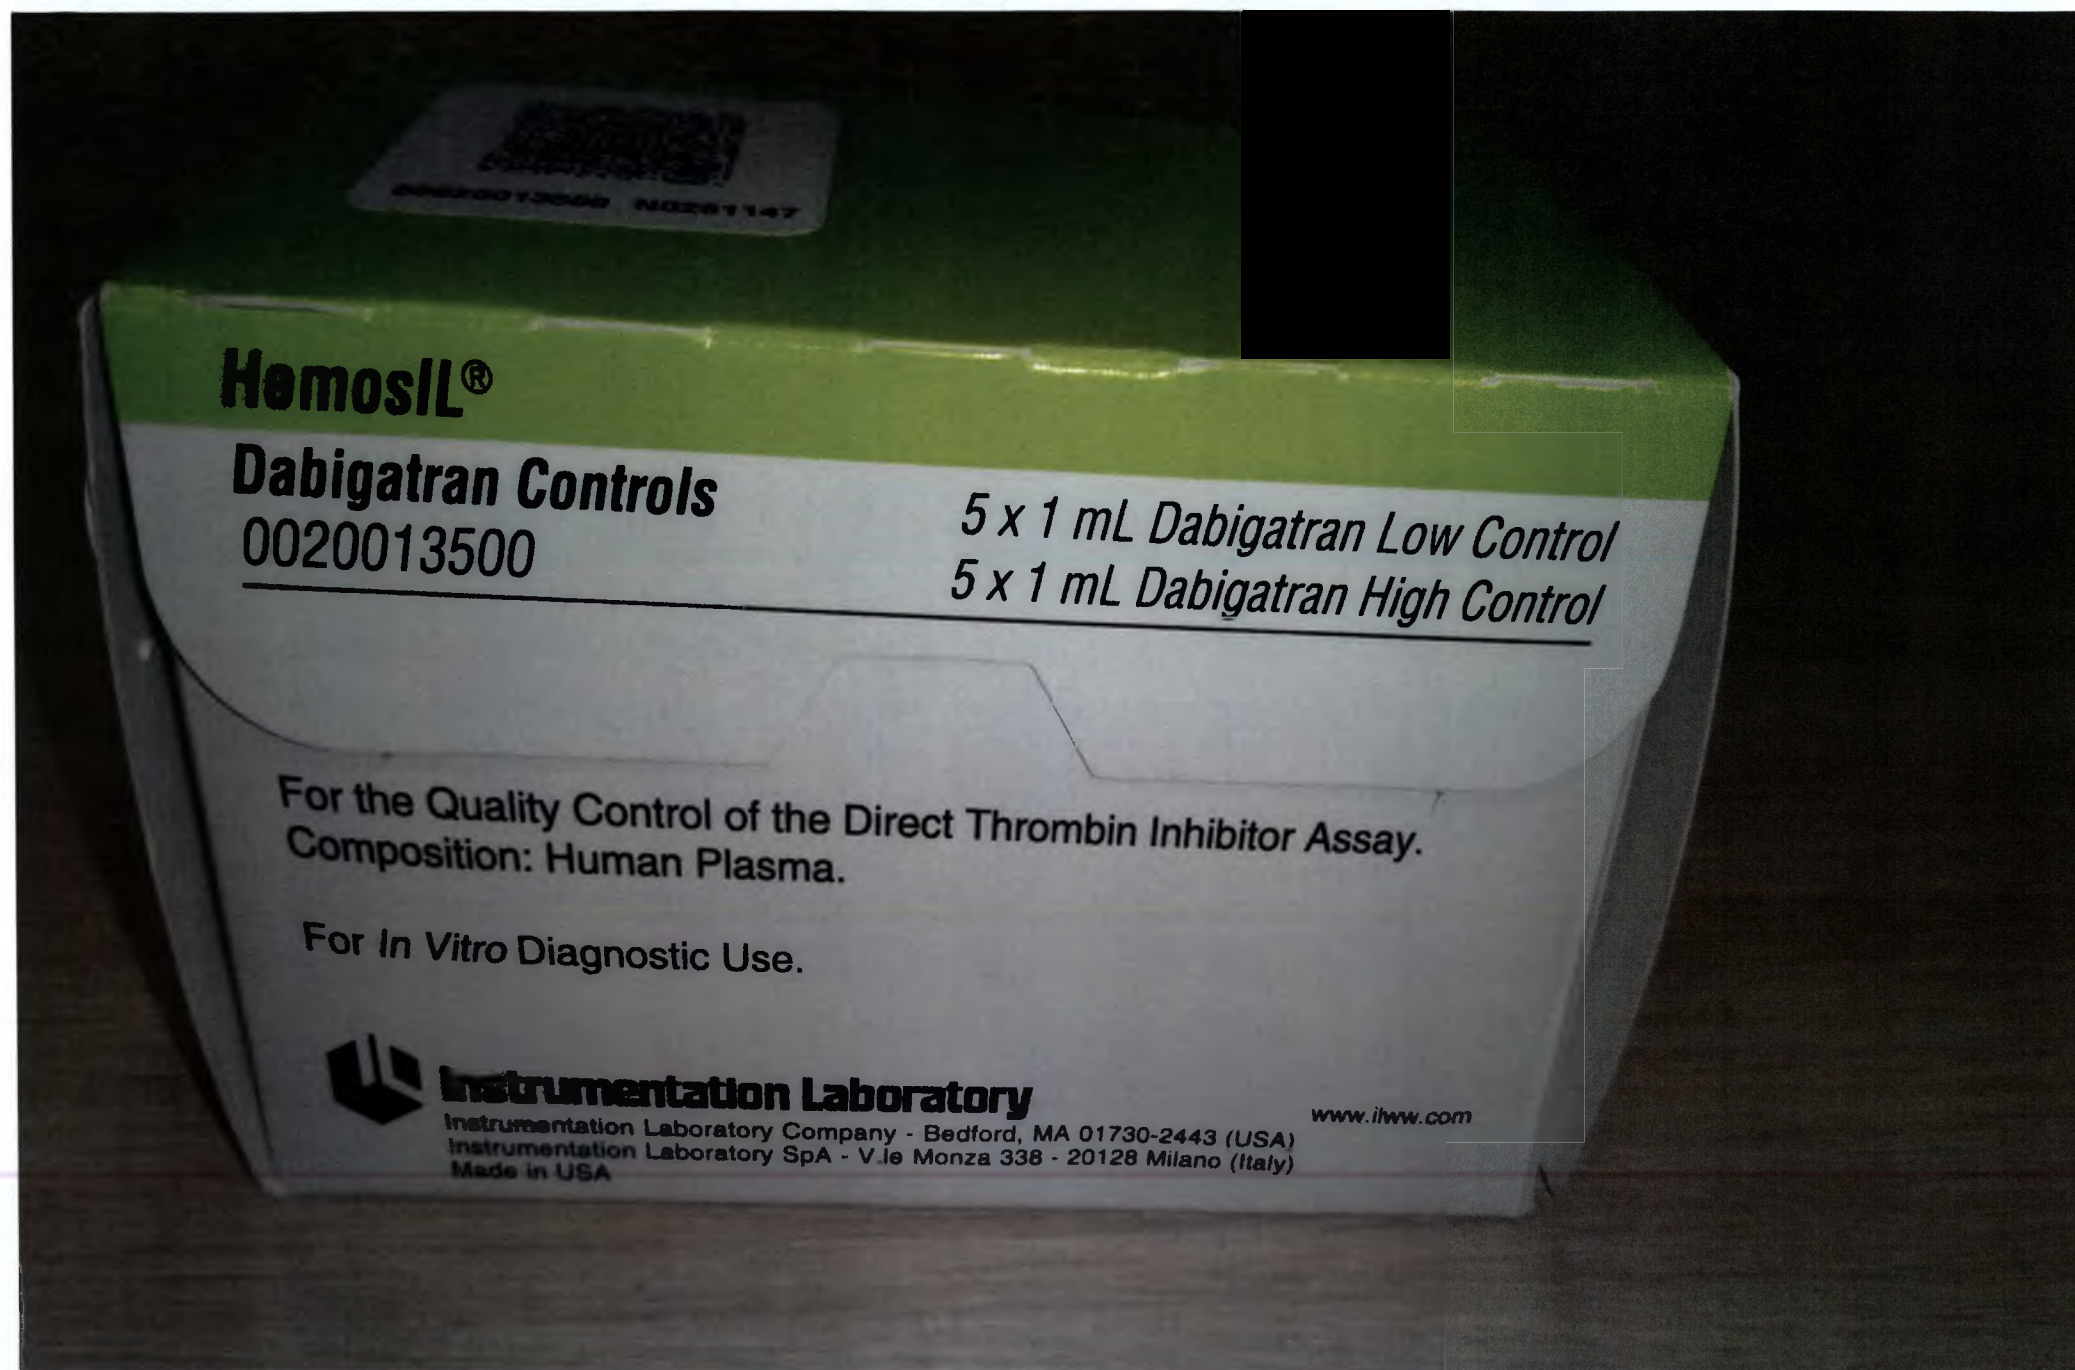





Контроли Дабигатрана – HemosIL Dabigatran Controls




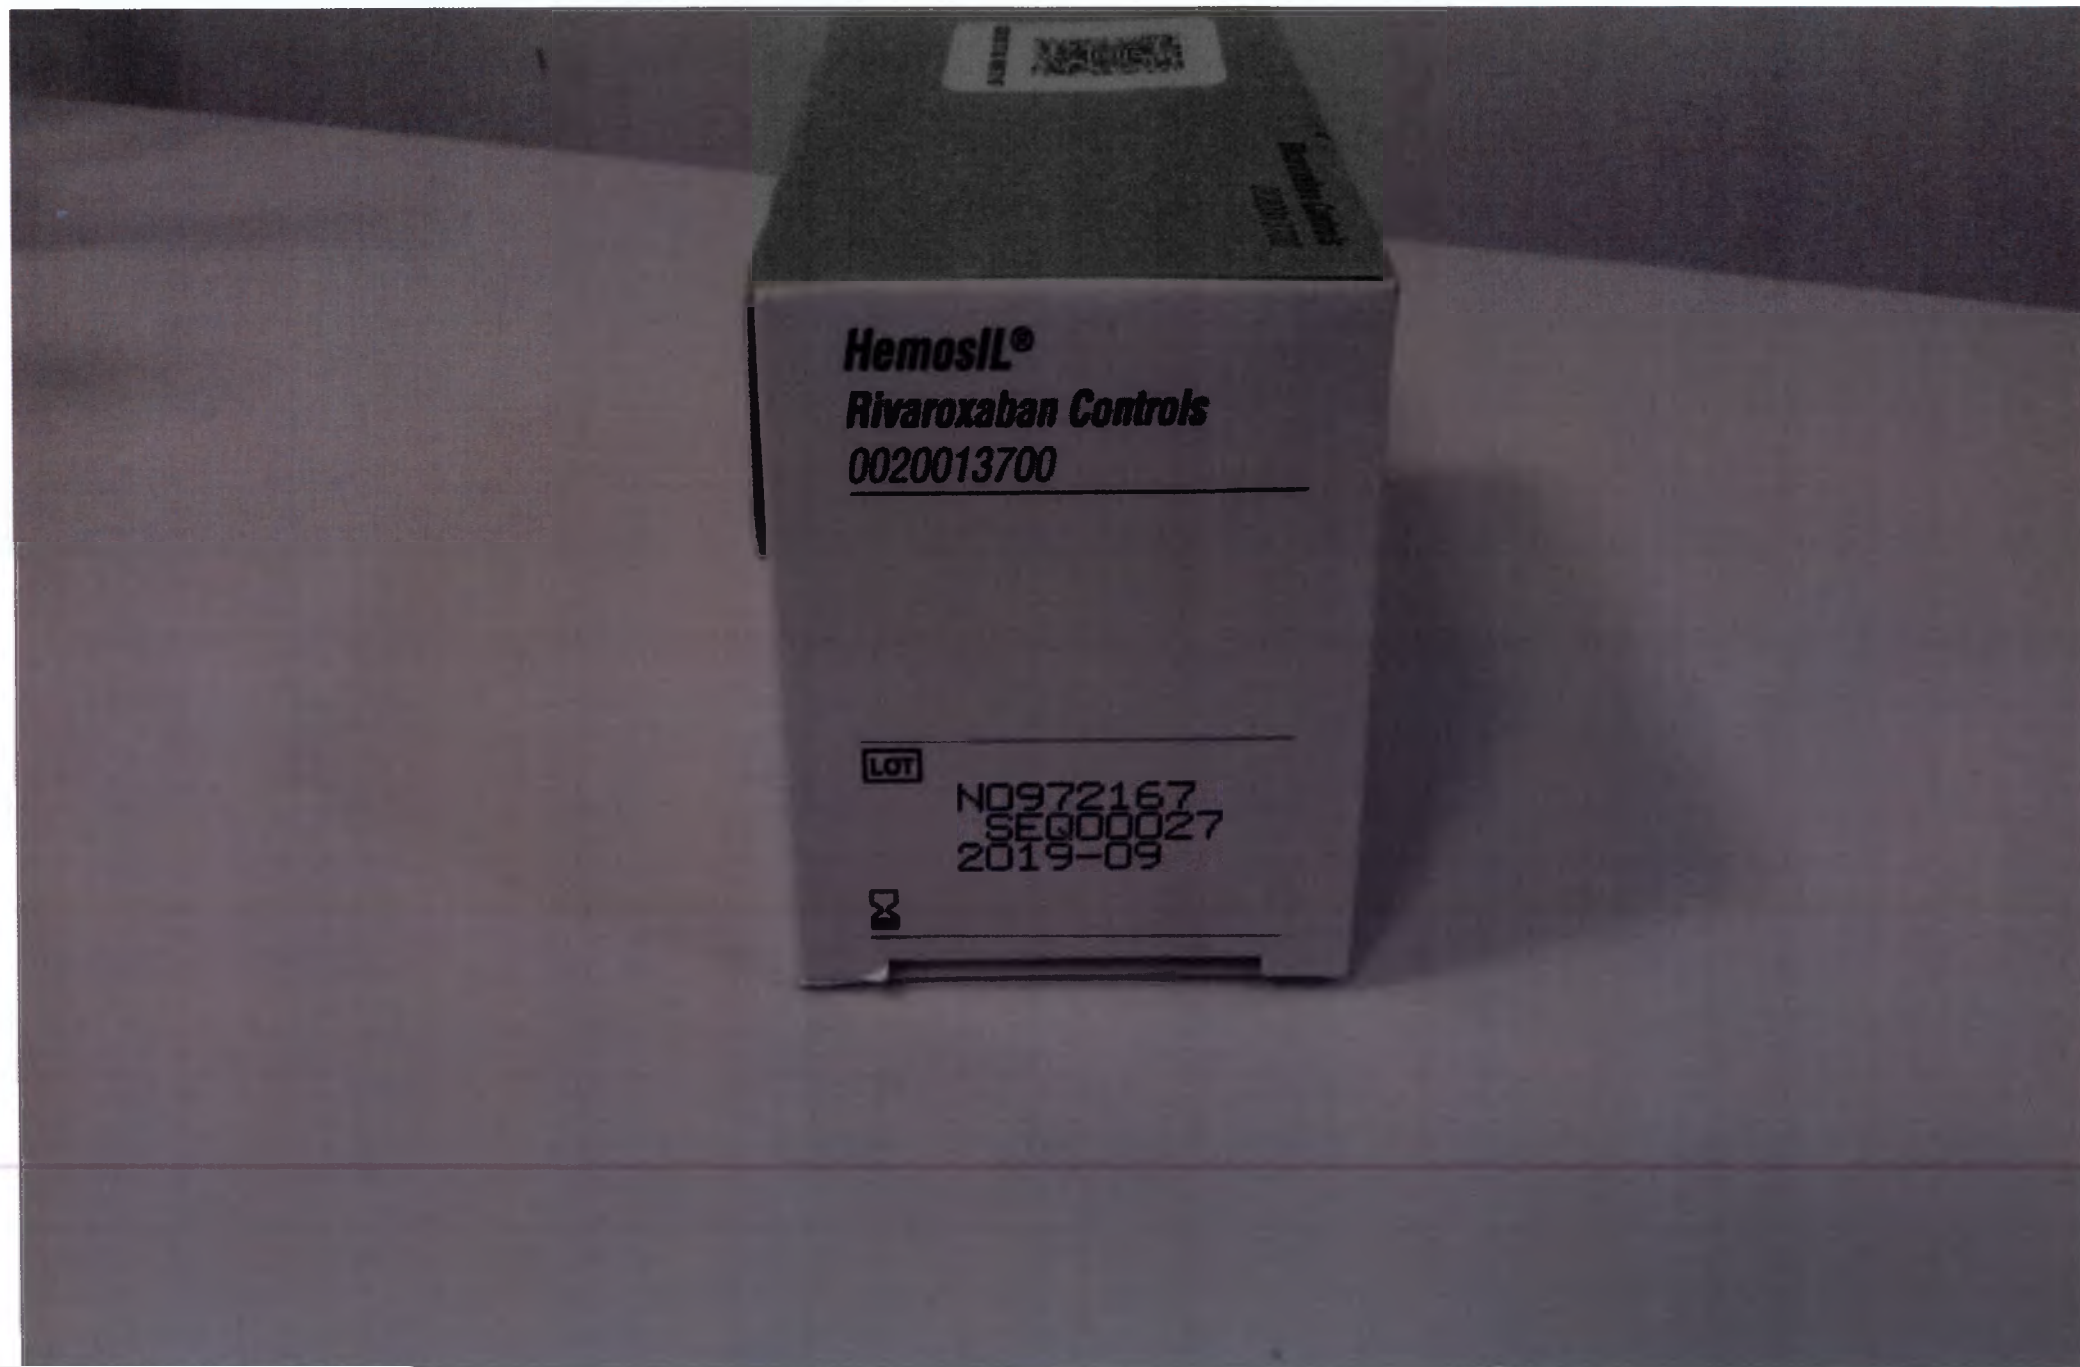



Контроли Ривароксабана – HemosIL Rivaroxaban Controls

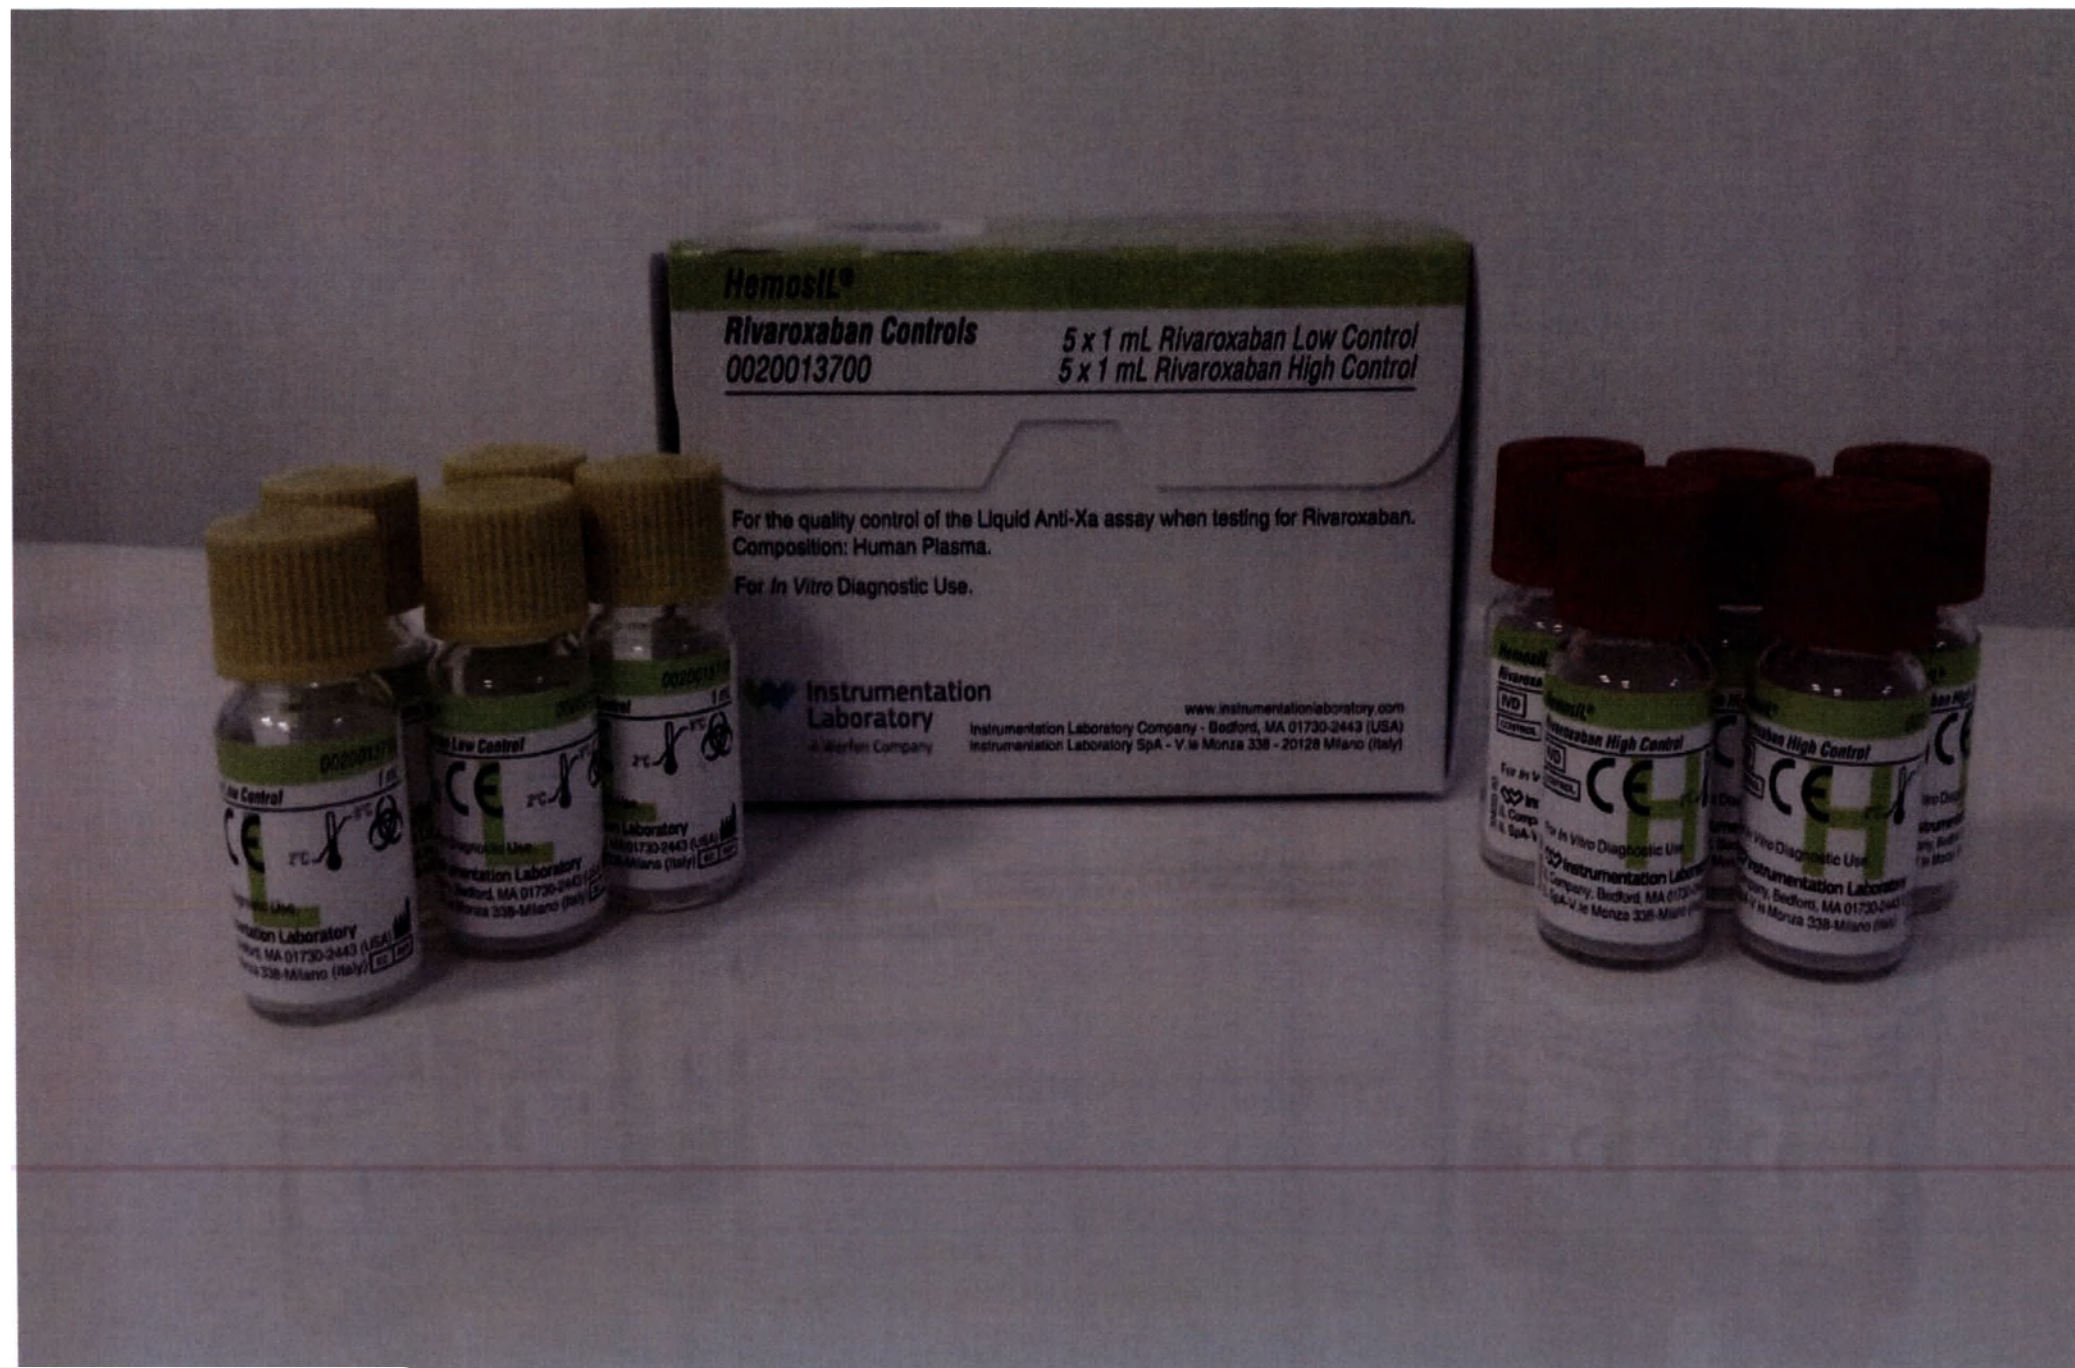

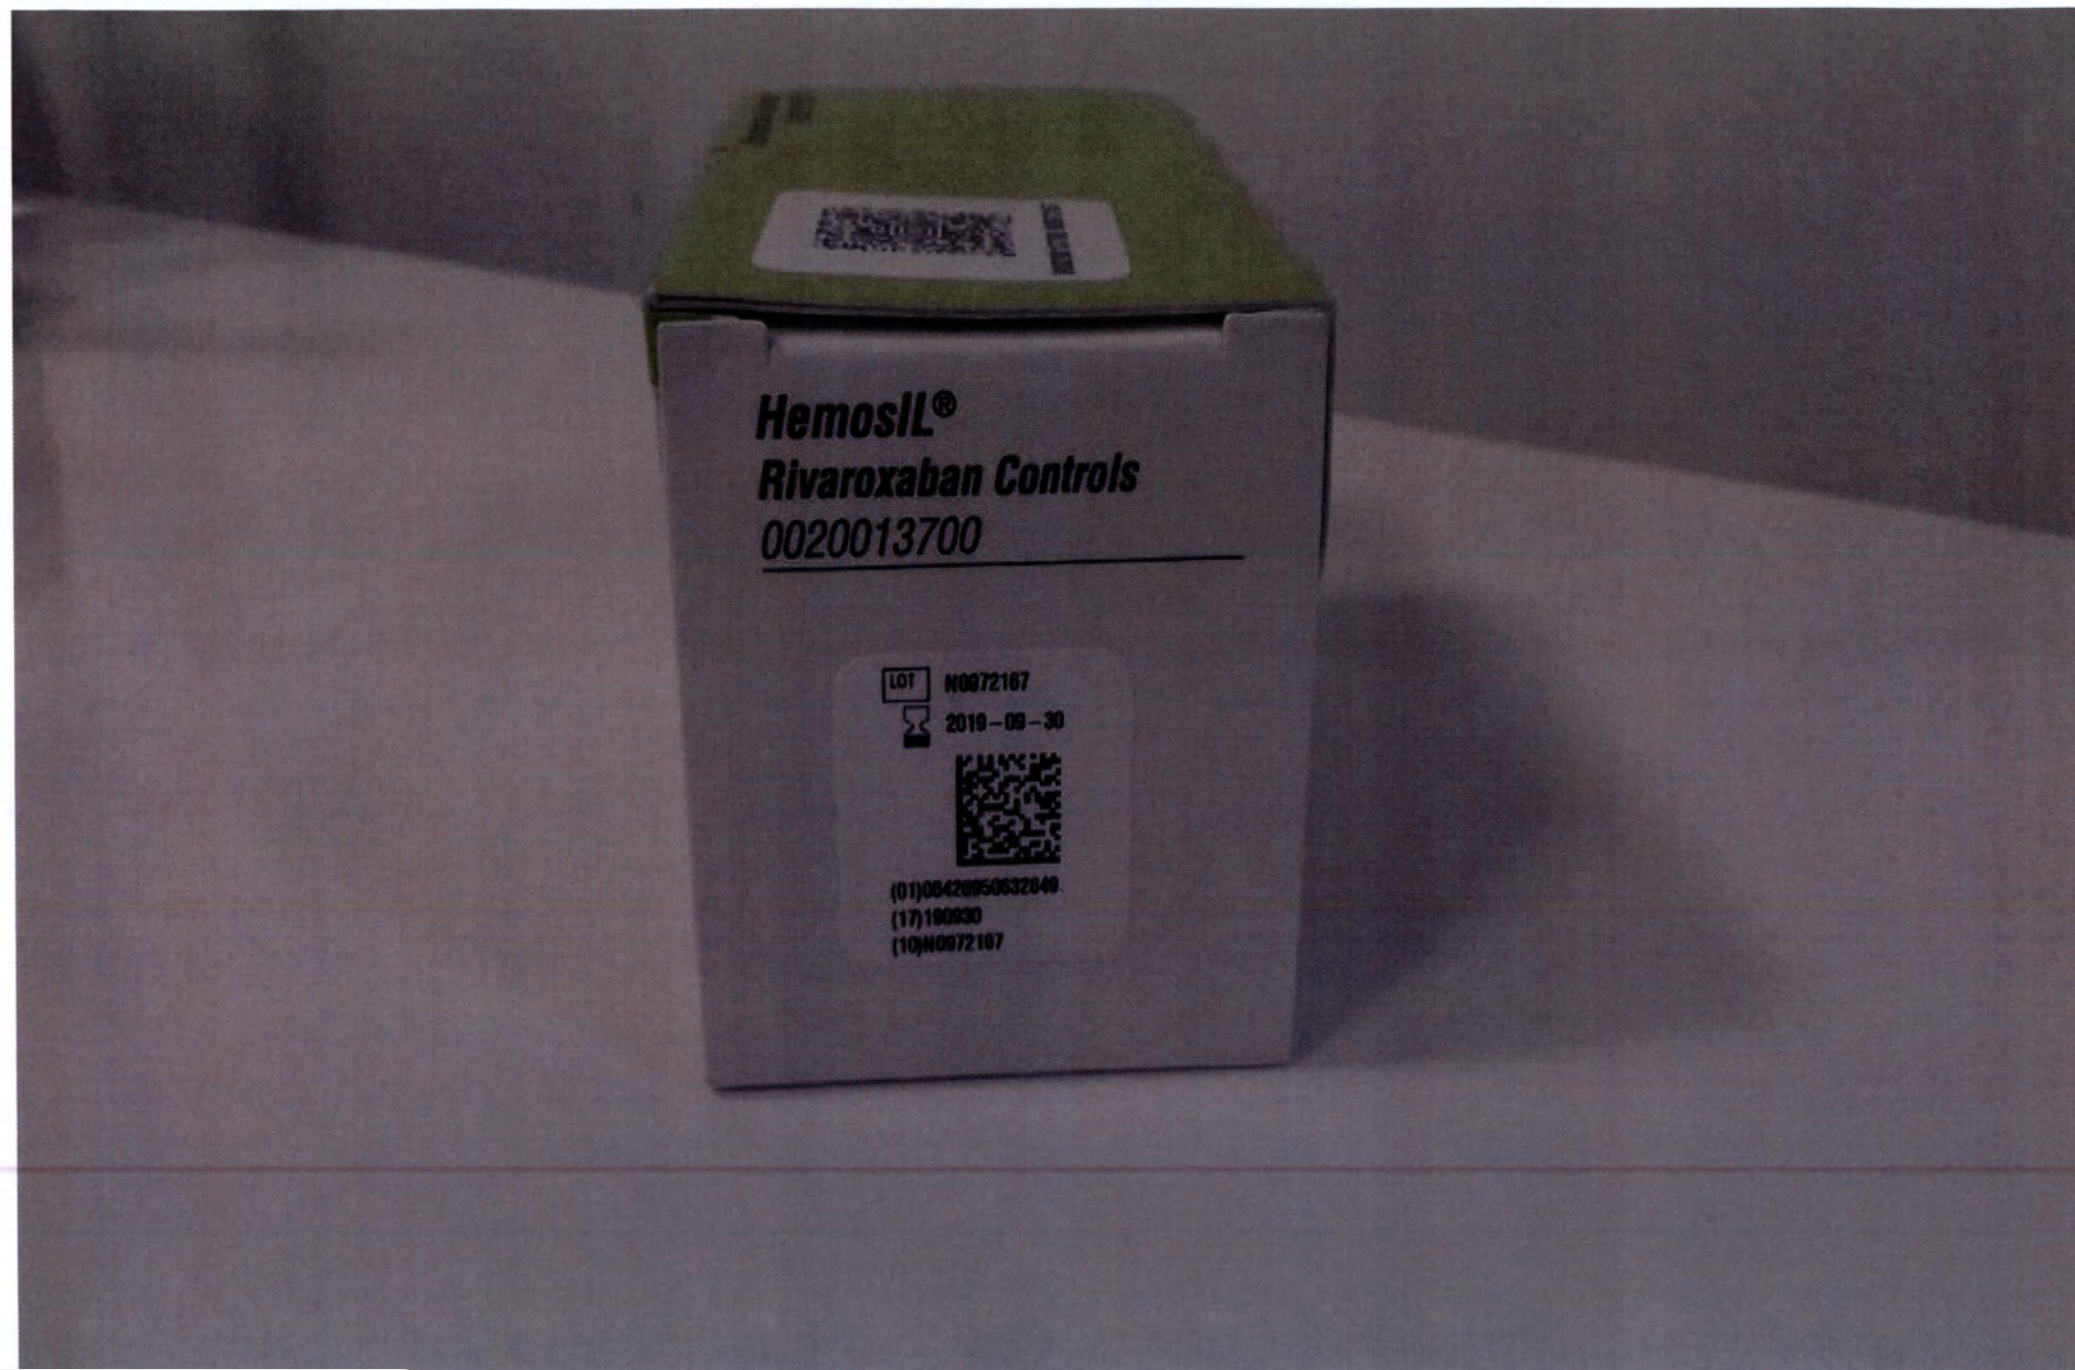


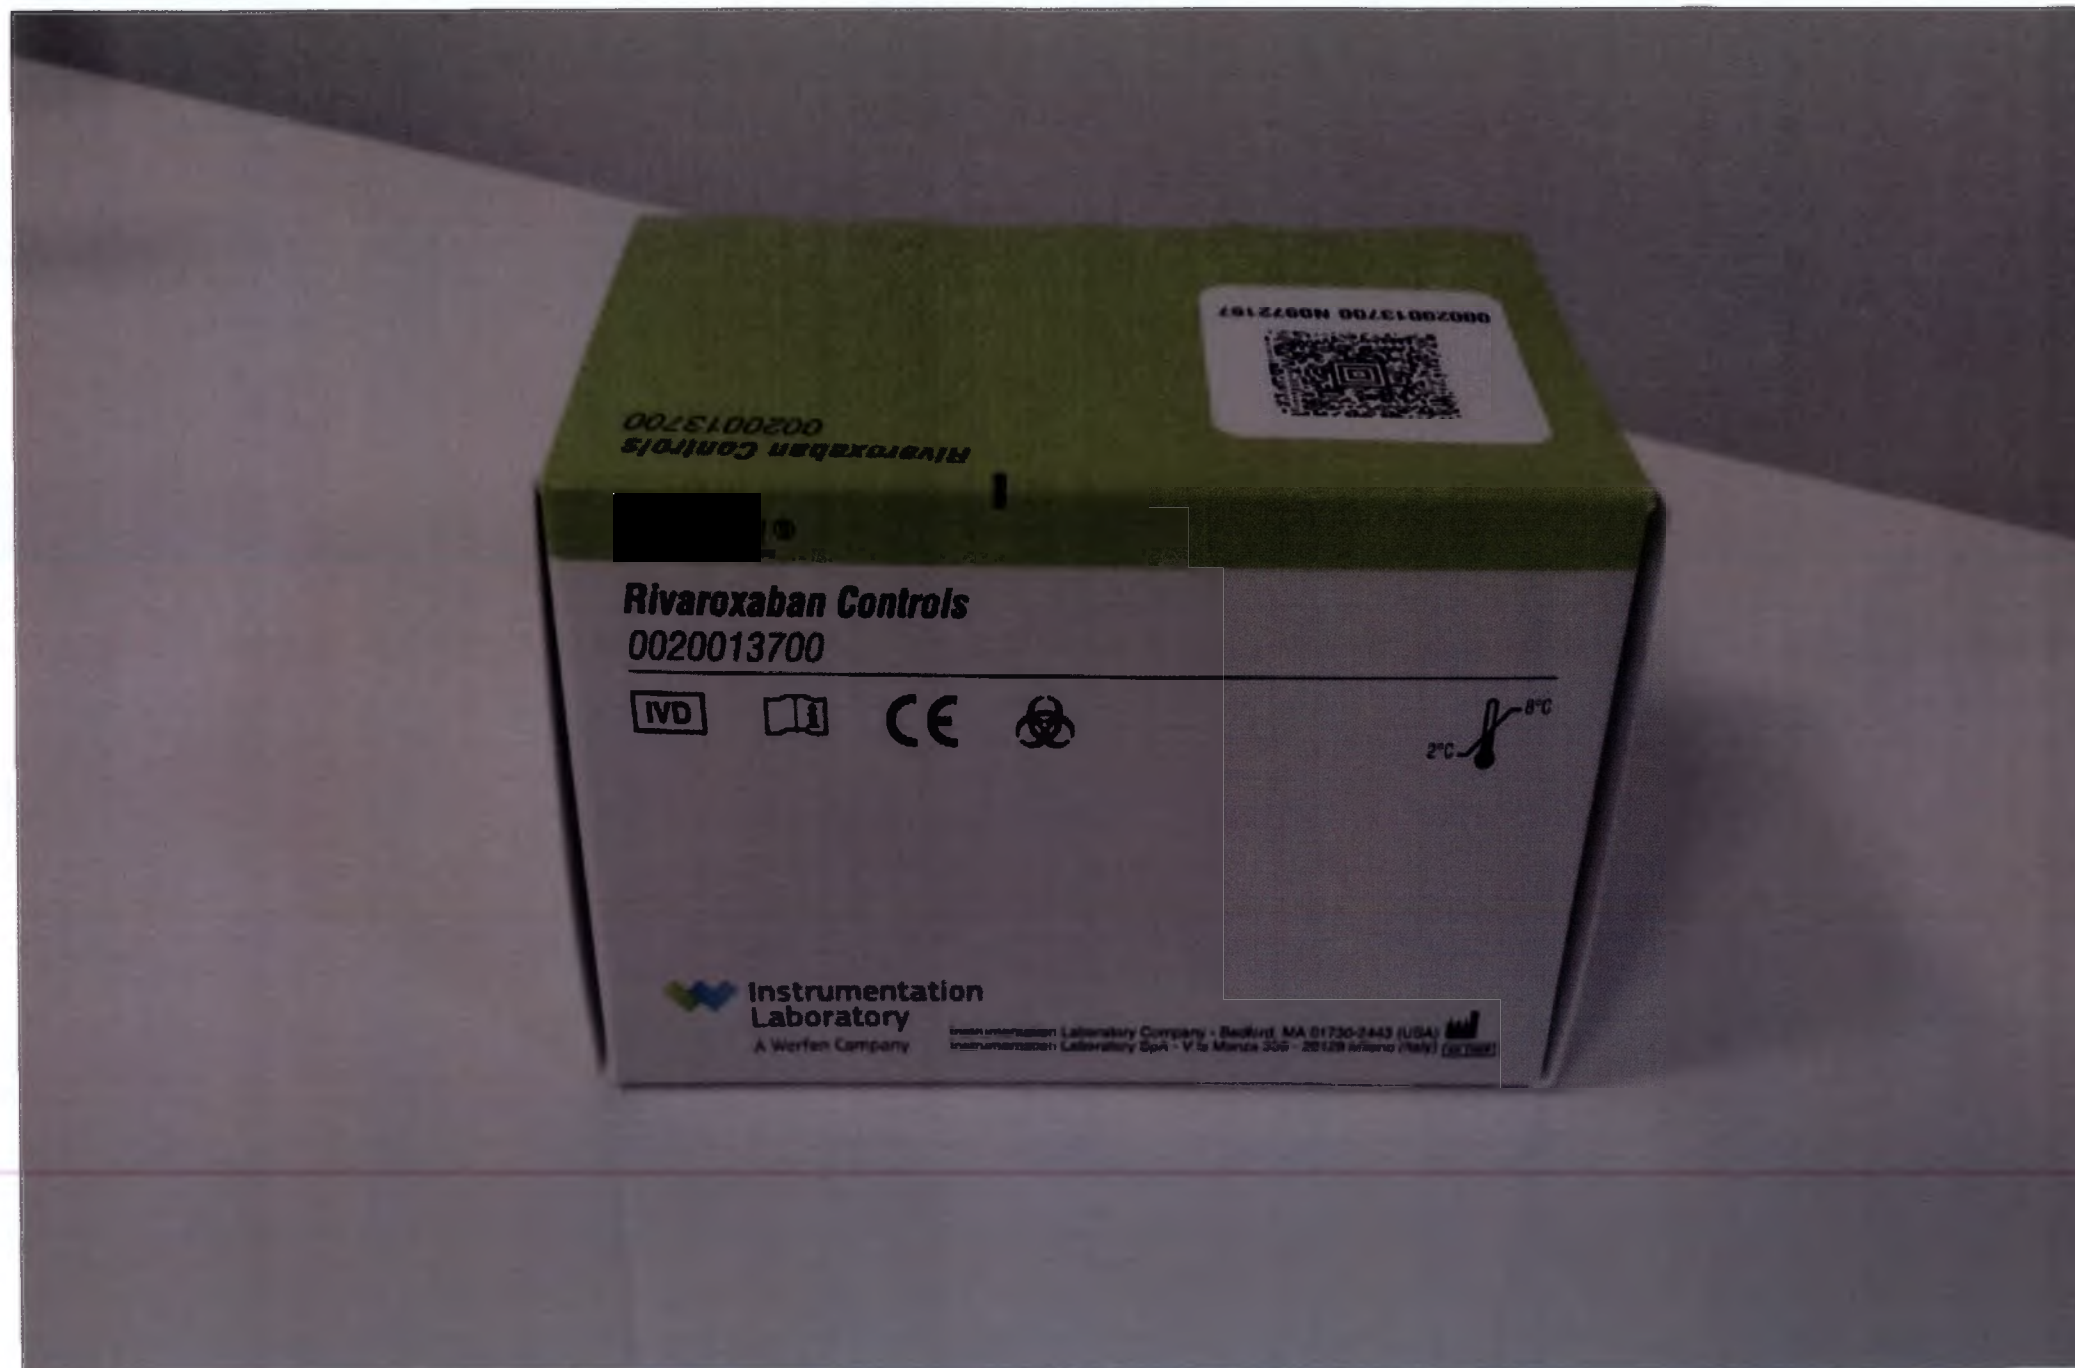

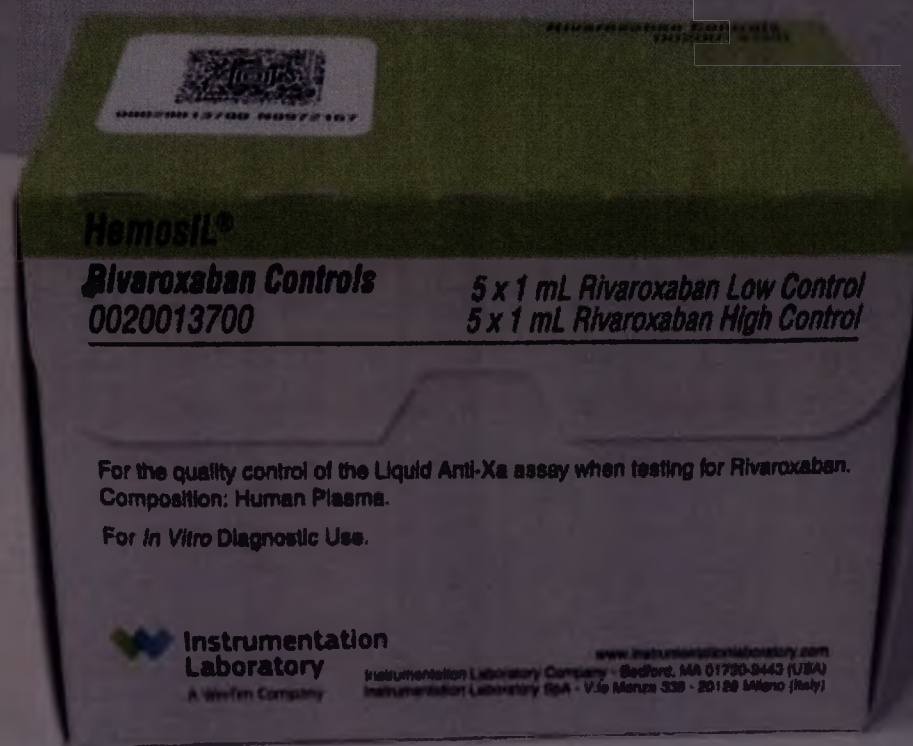

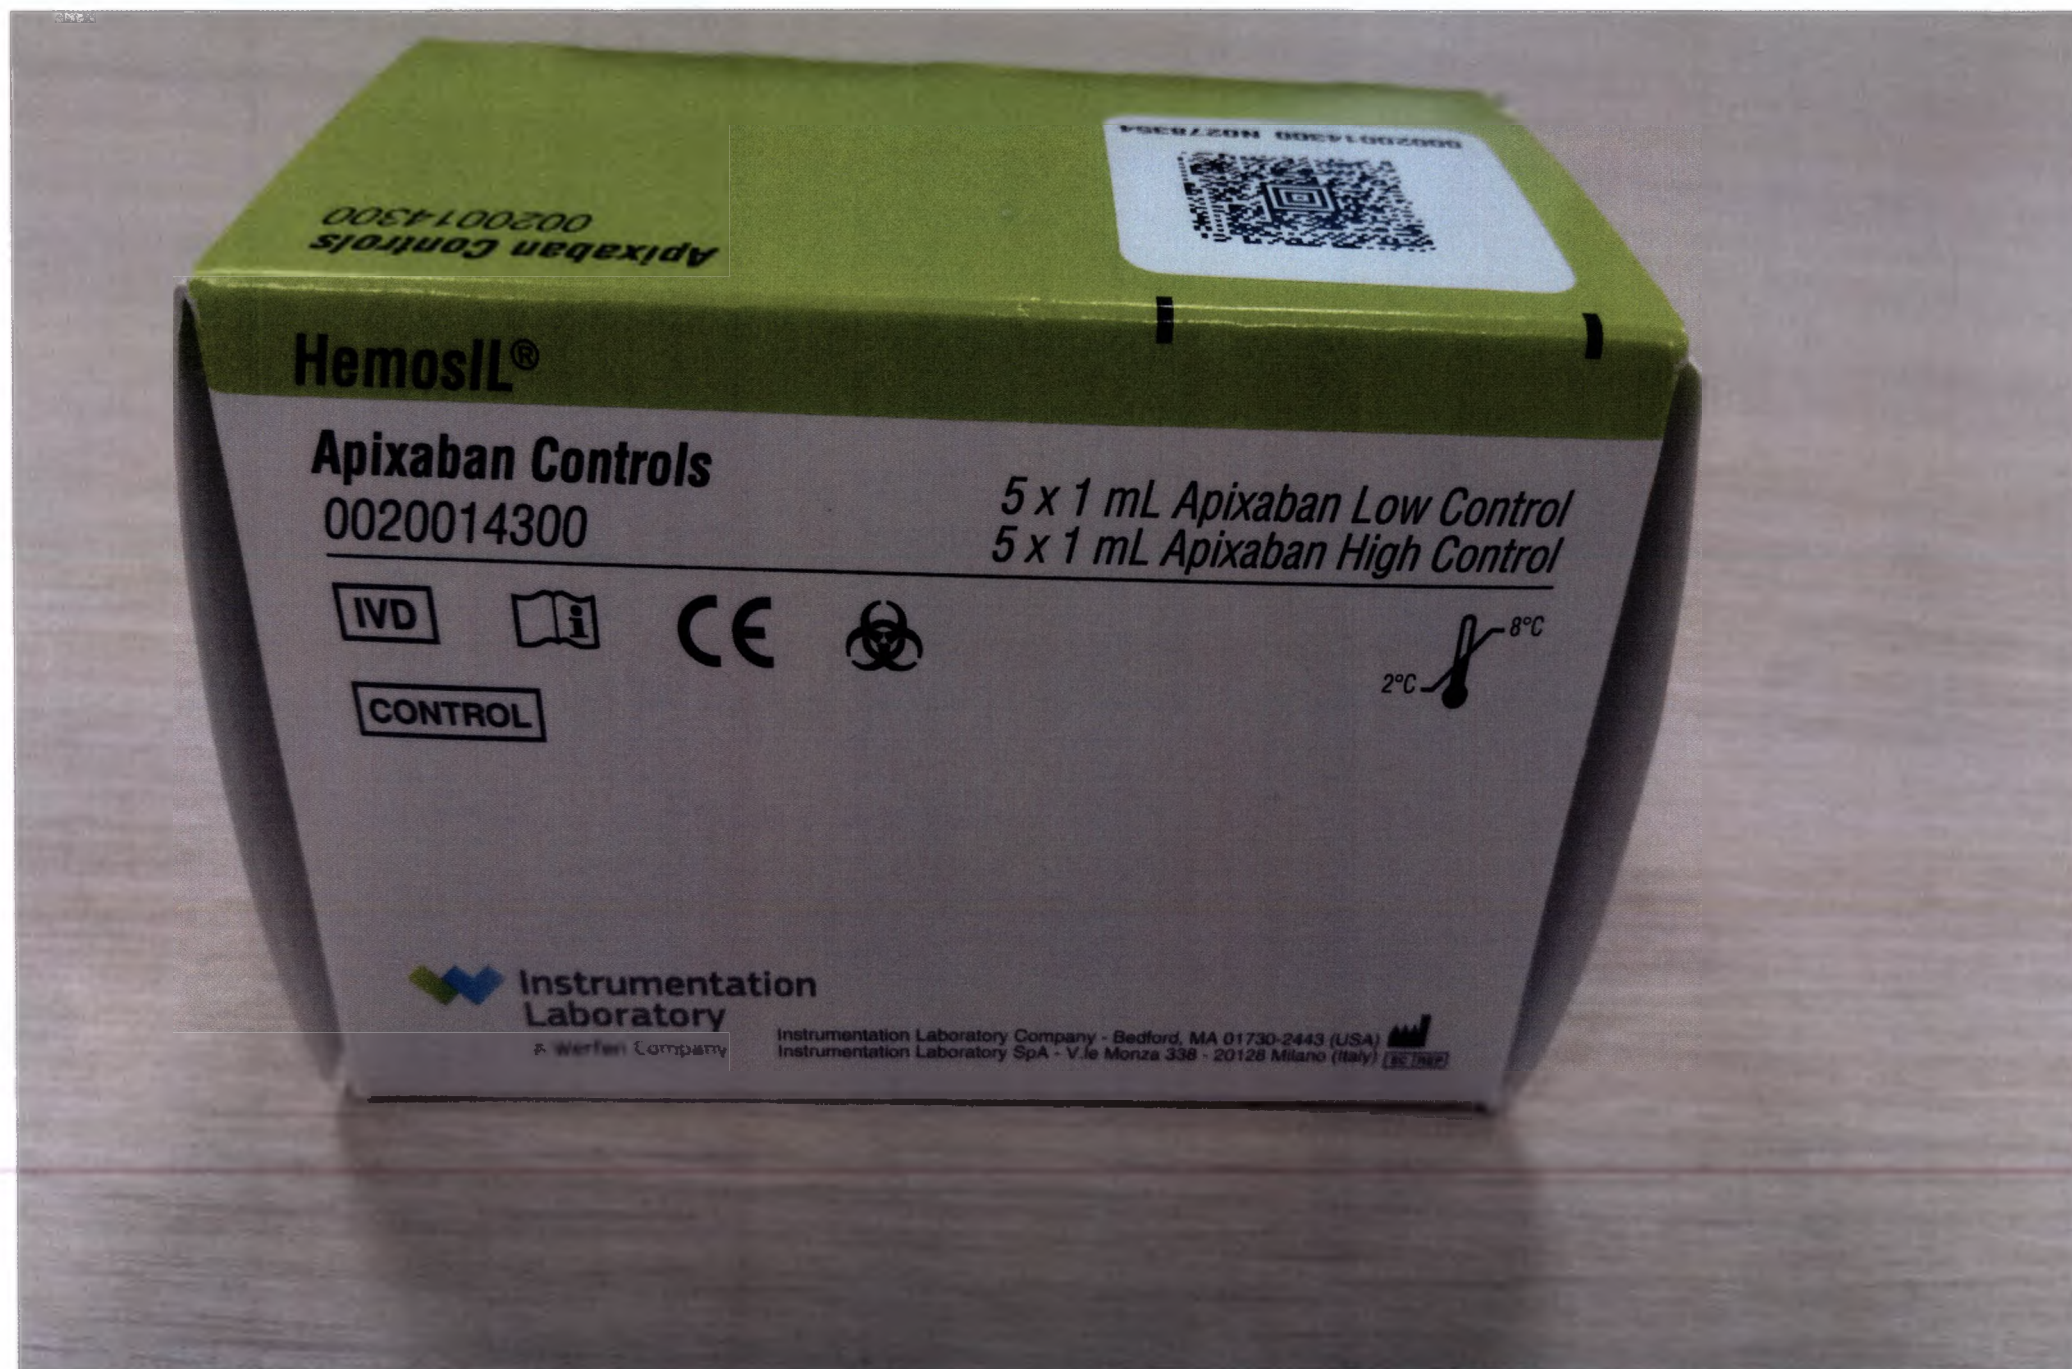



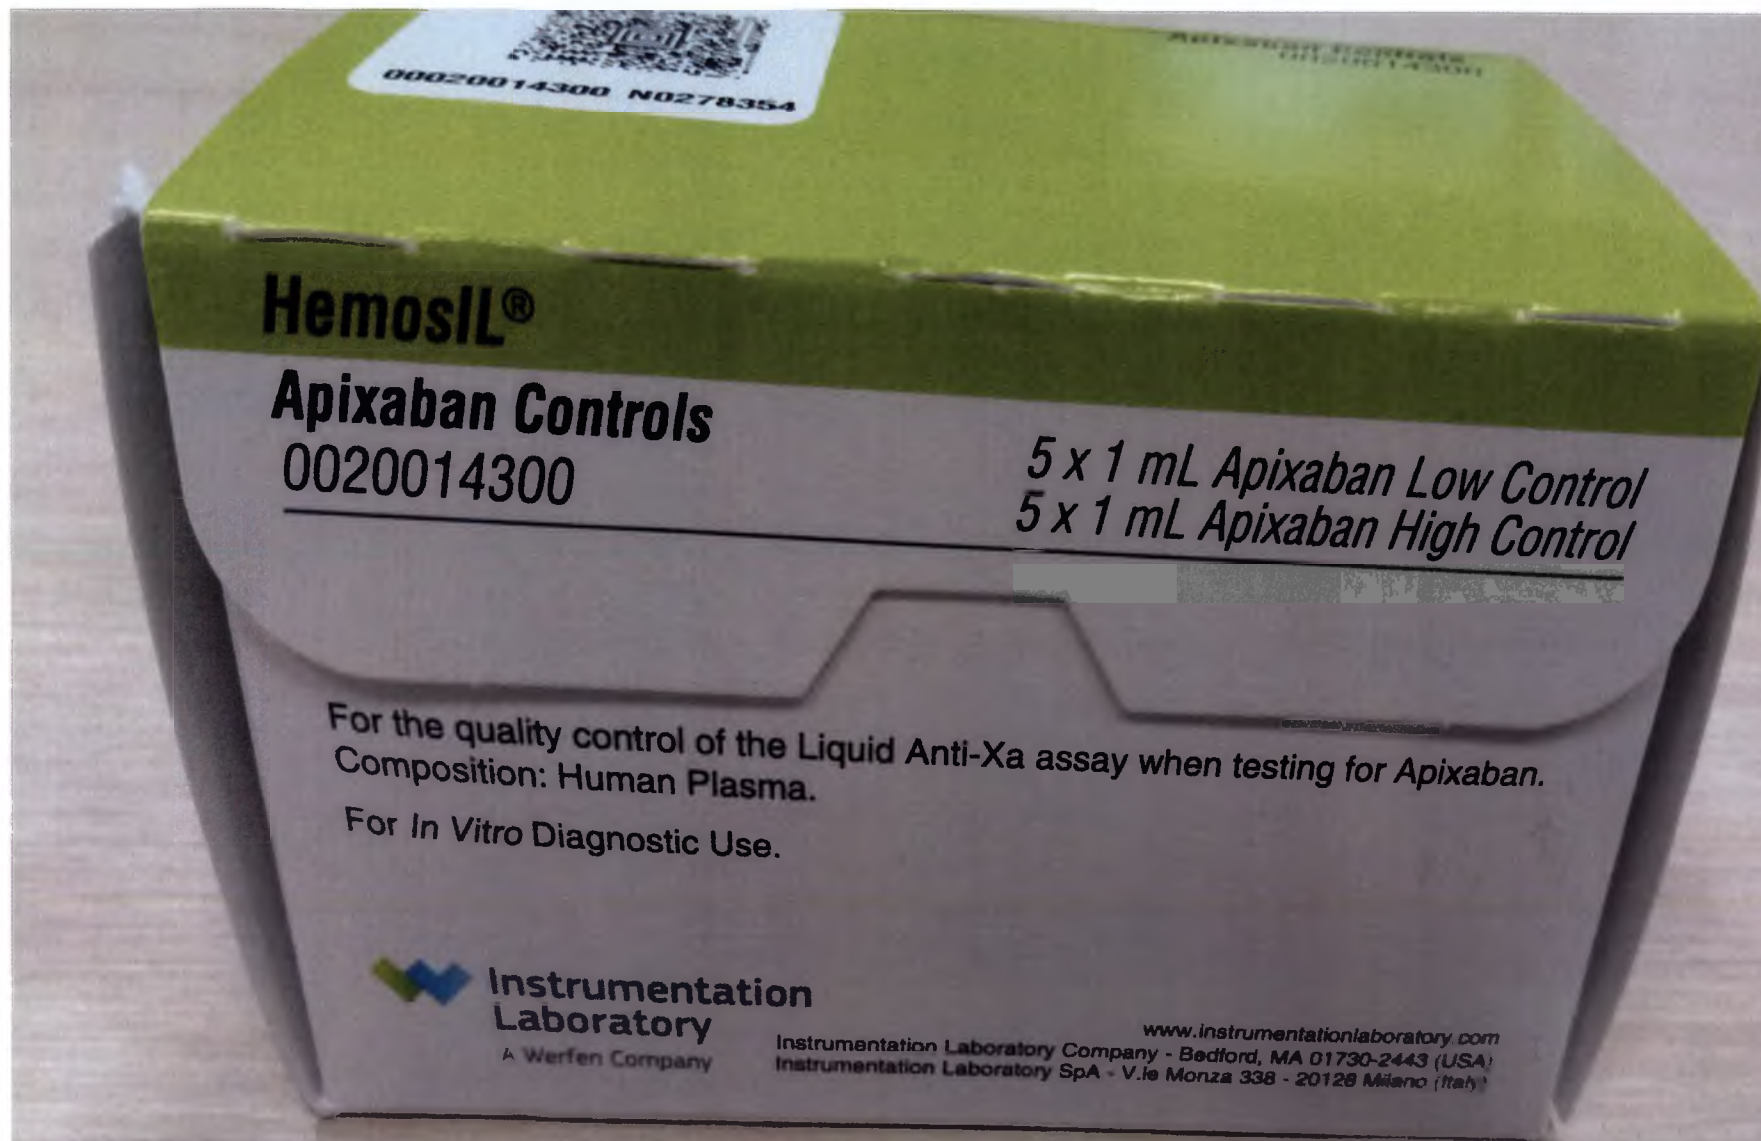

HemosIL®
Apixaban Controls
0020014300

LOT

N0278354
SEQ00123
2019-02

Контроли Апиксабана – HemosIL Apixaban Controls



Контроли Аликсабана – HemosIL Apixaban Controls






Д-Димер тест - HemosIL Dimertest





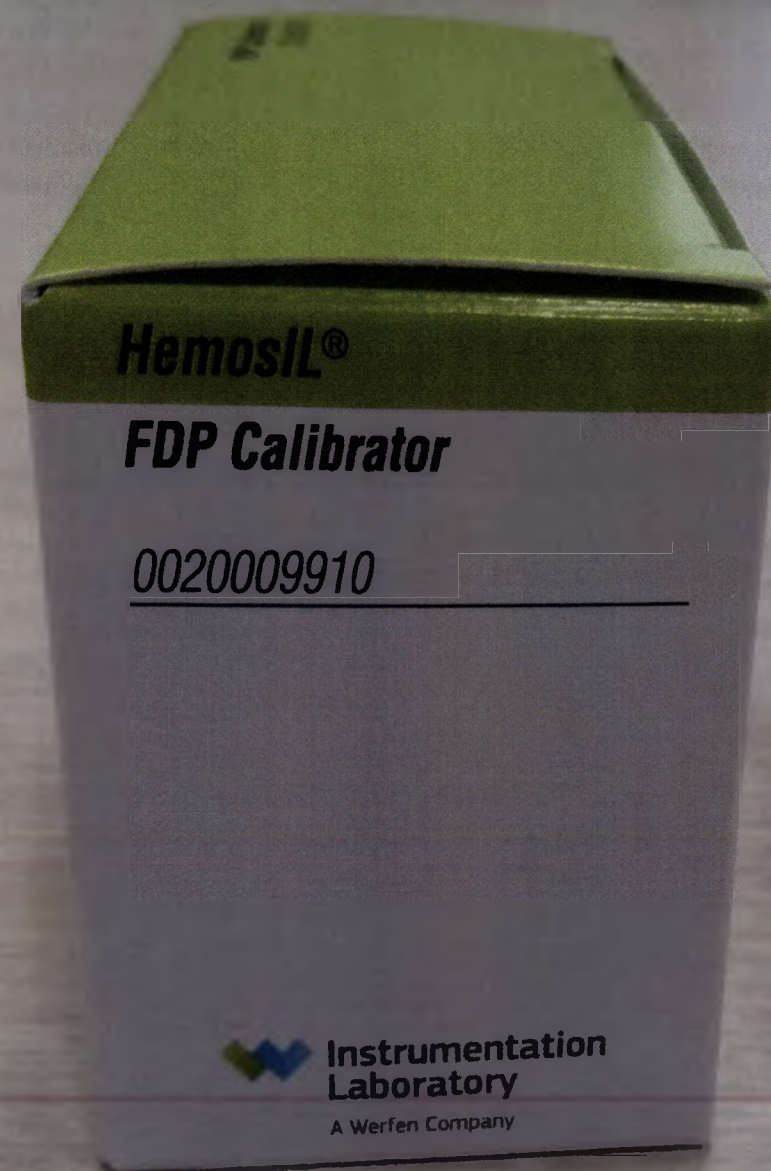

HemosIL®

FDP Calibrator

0020009910

For the calibration of FDP assay.
Composition: human FDP and preservative.
For *In Vitro* Diagnostic Use.


1 x 1 mL FDP Calibrator 1
1 x 1 mL FDP Calibrator 2
1 x 1 mL FDP Calibrator 3
1 x 1 mL FDP Calibrator 4
1 x 1 mL FDP Calibrator 5




**Instrumentation
Laboratory**

A Werfen Company

Distributed by:
Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in Spain www.instrumentationlaboratory.com

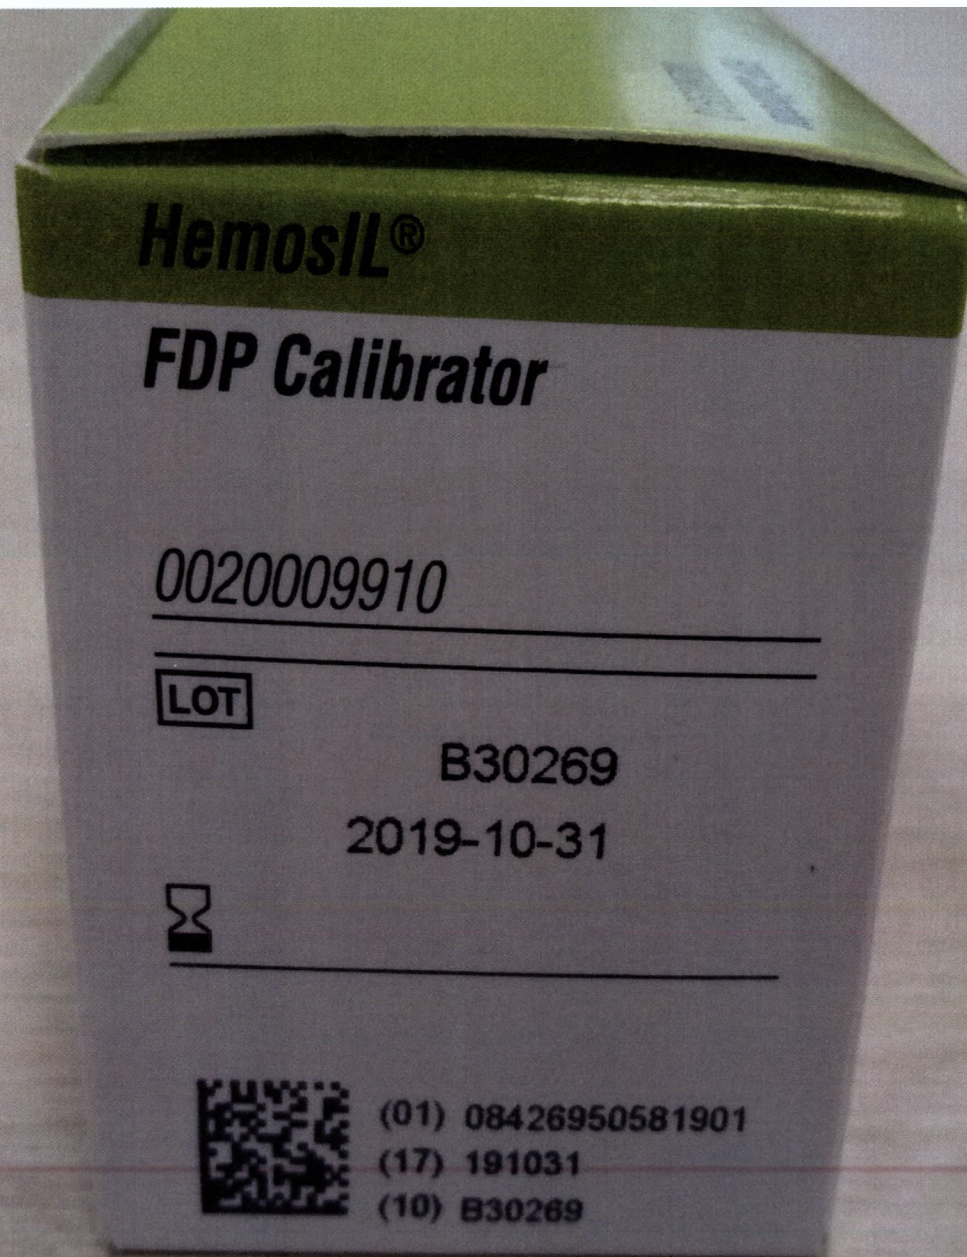


ПДФ калибратор – HemosIL FDP Calibrator

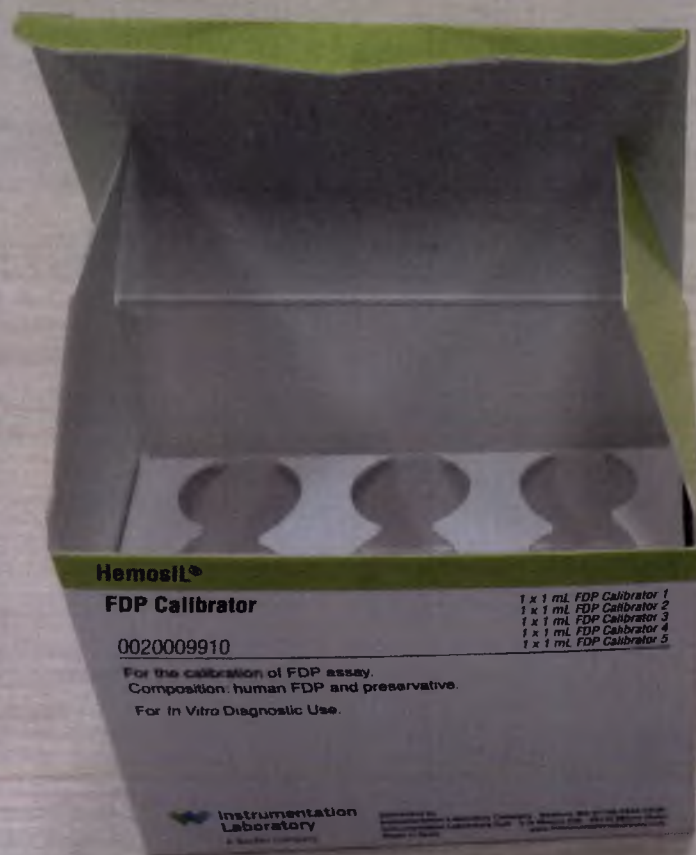





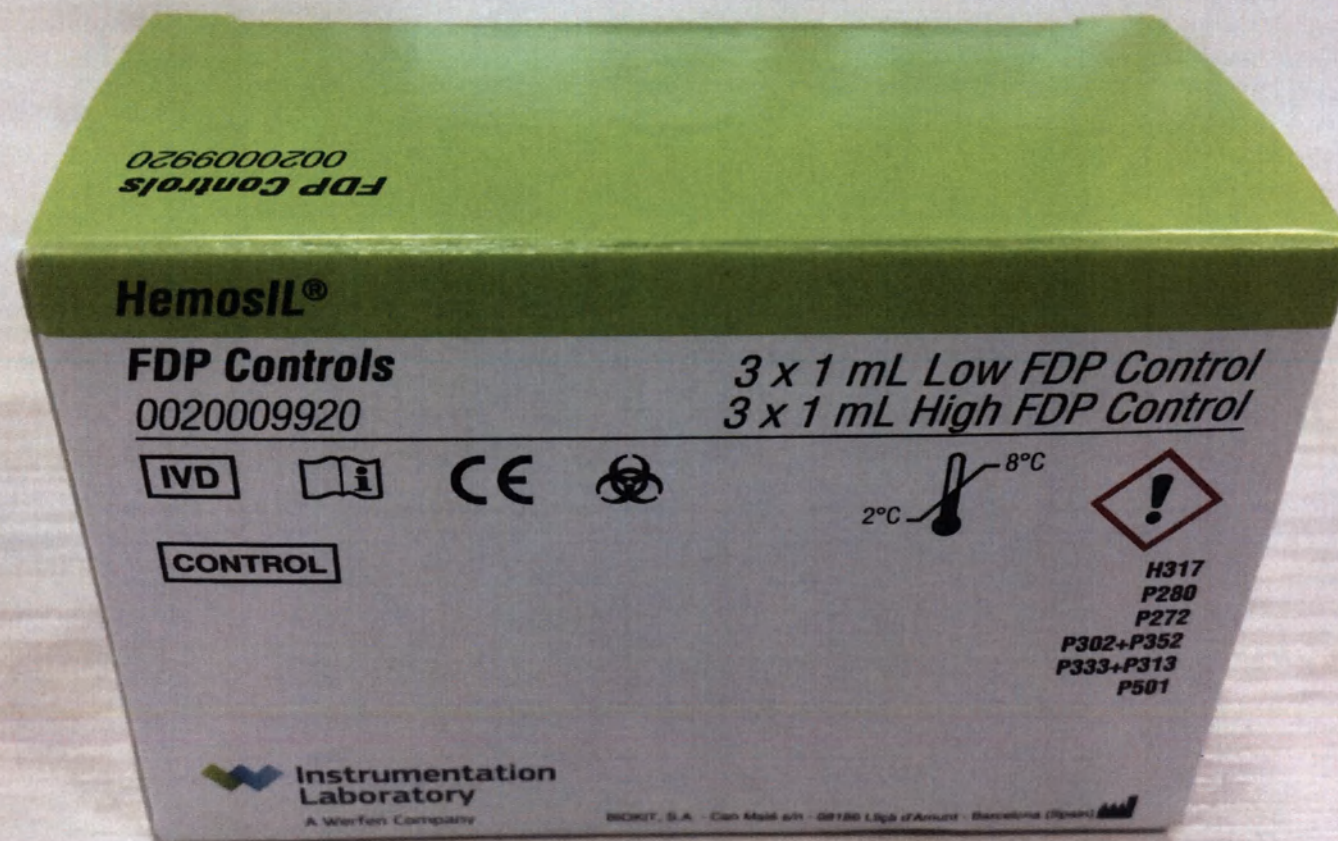




















Фактор VIII, electrochrome - HemosIL Electrochrome Factor VIII

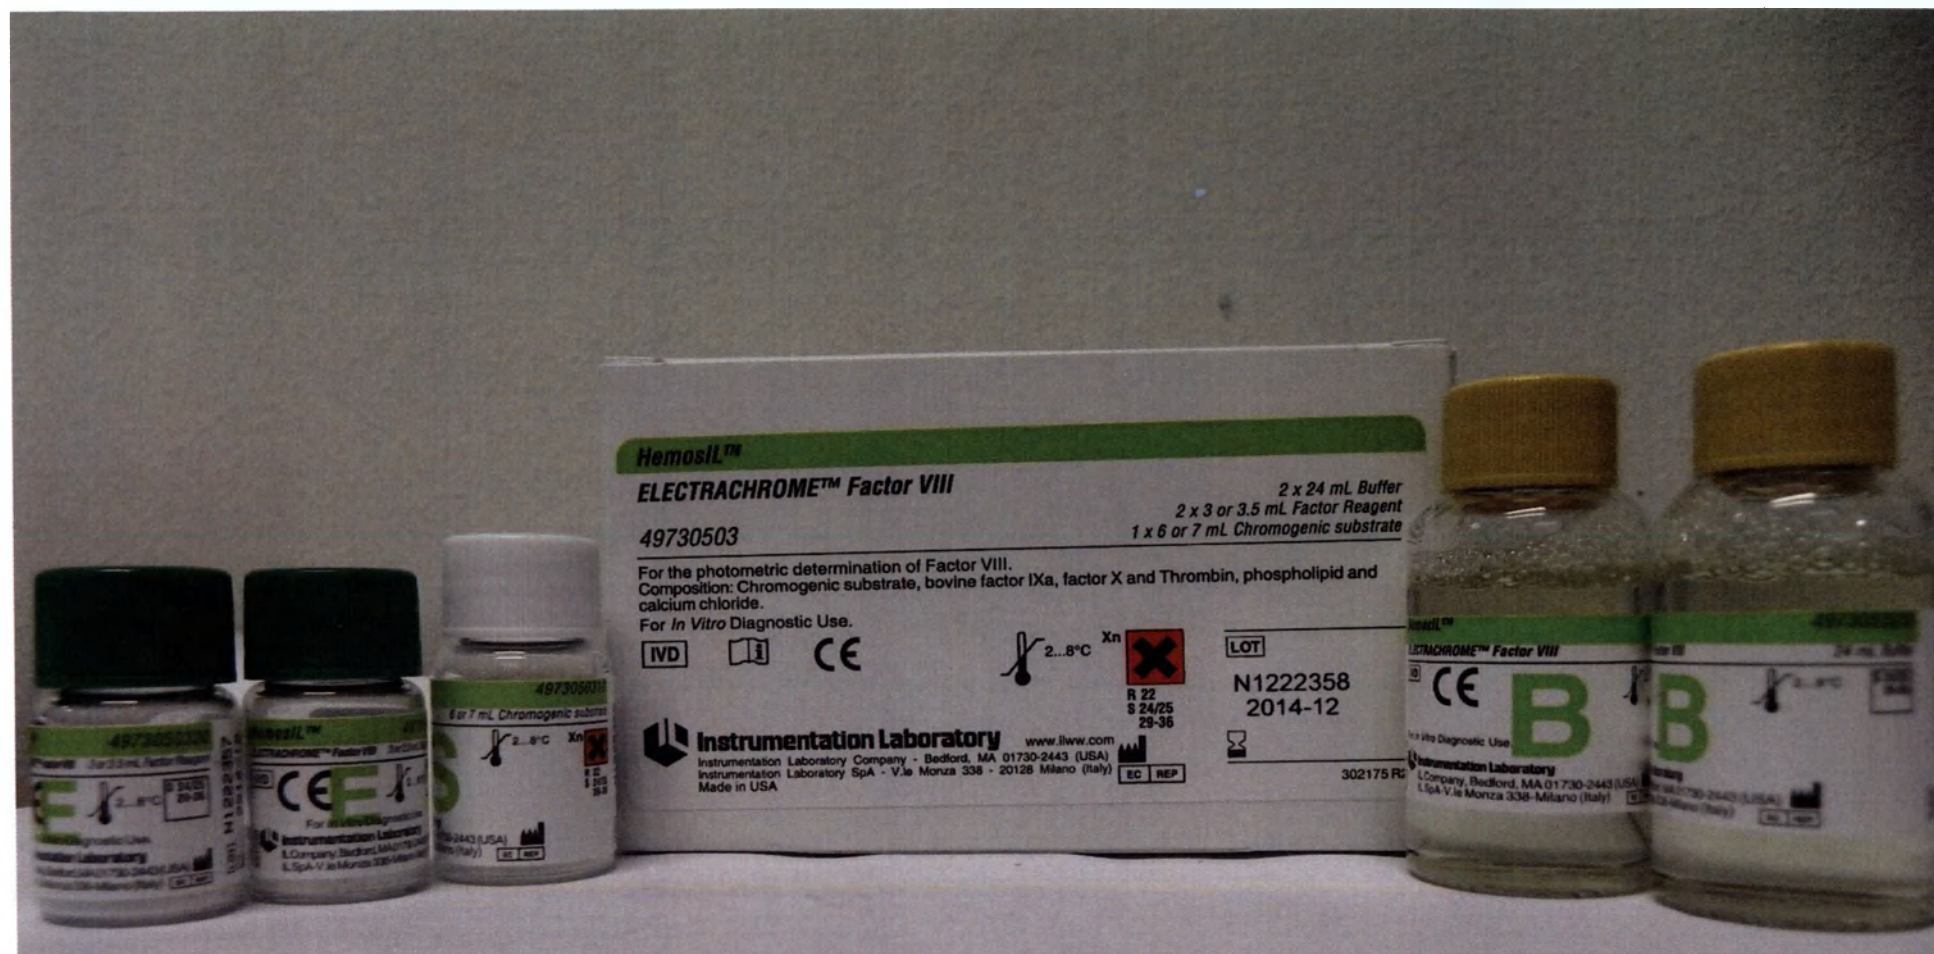

Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)

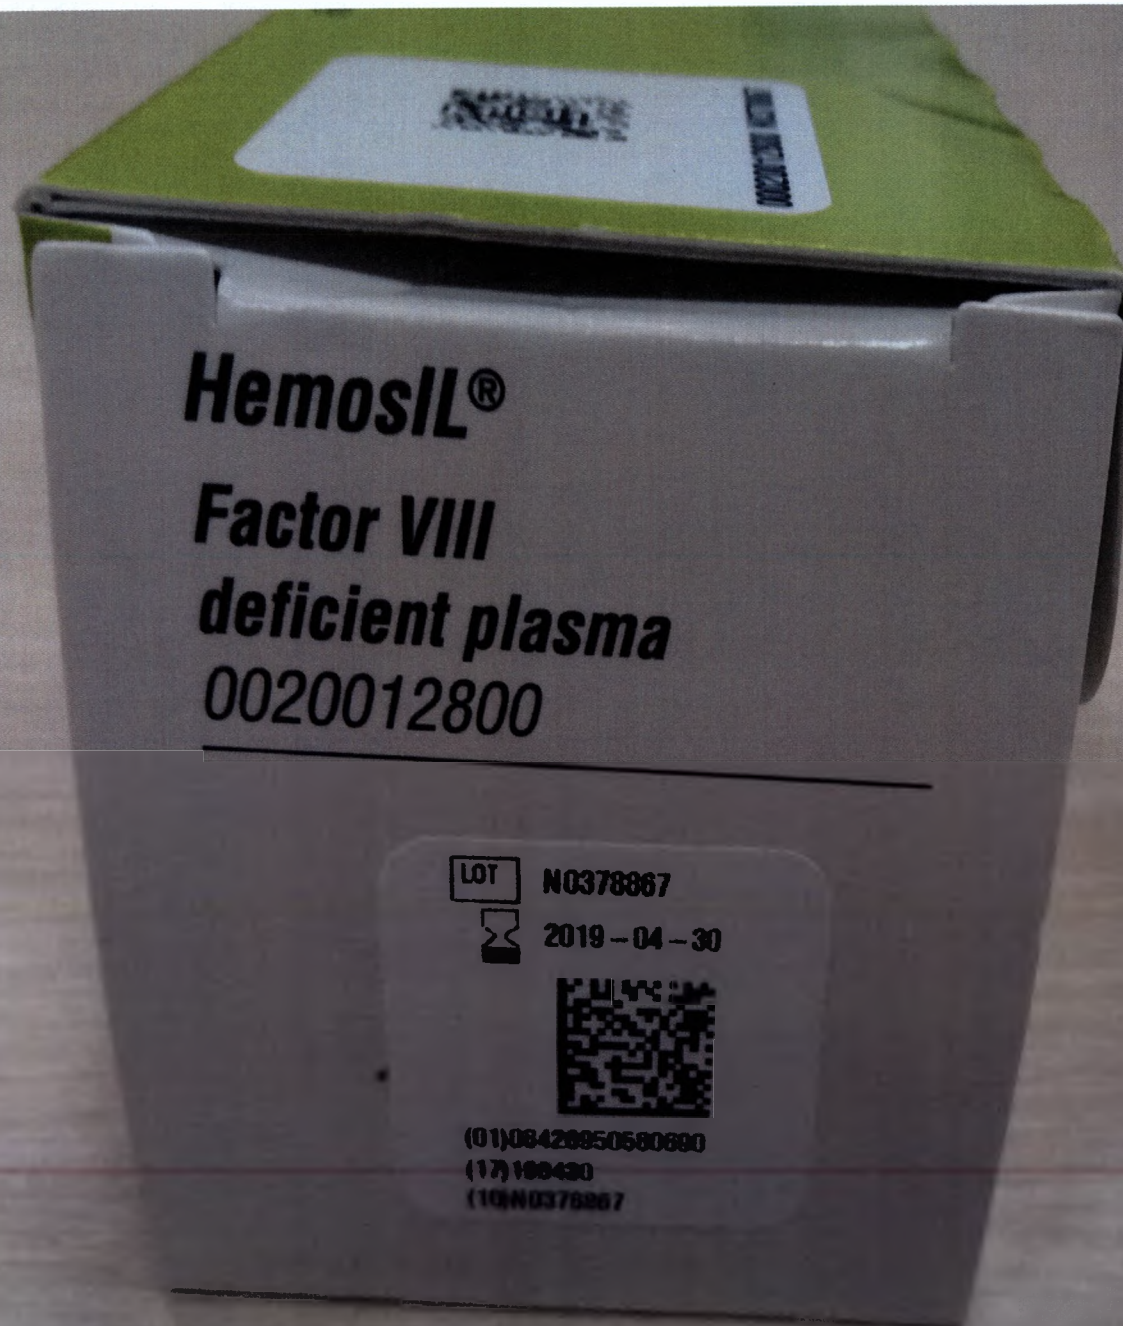

Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)

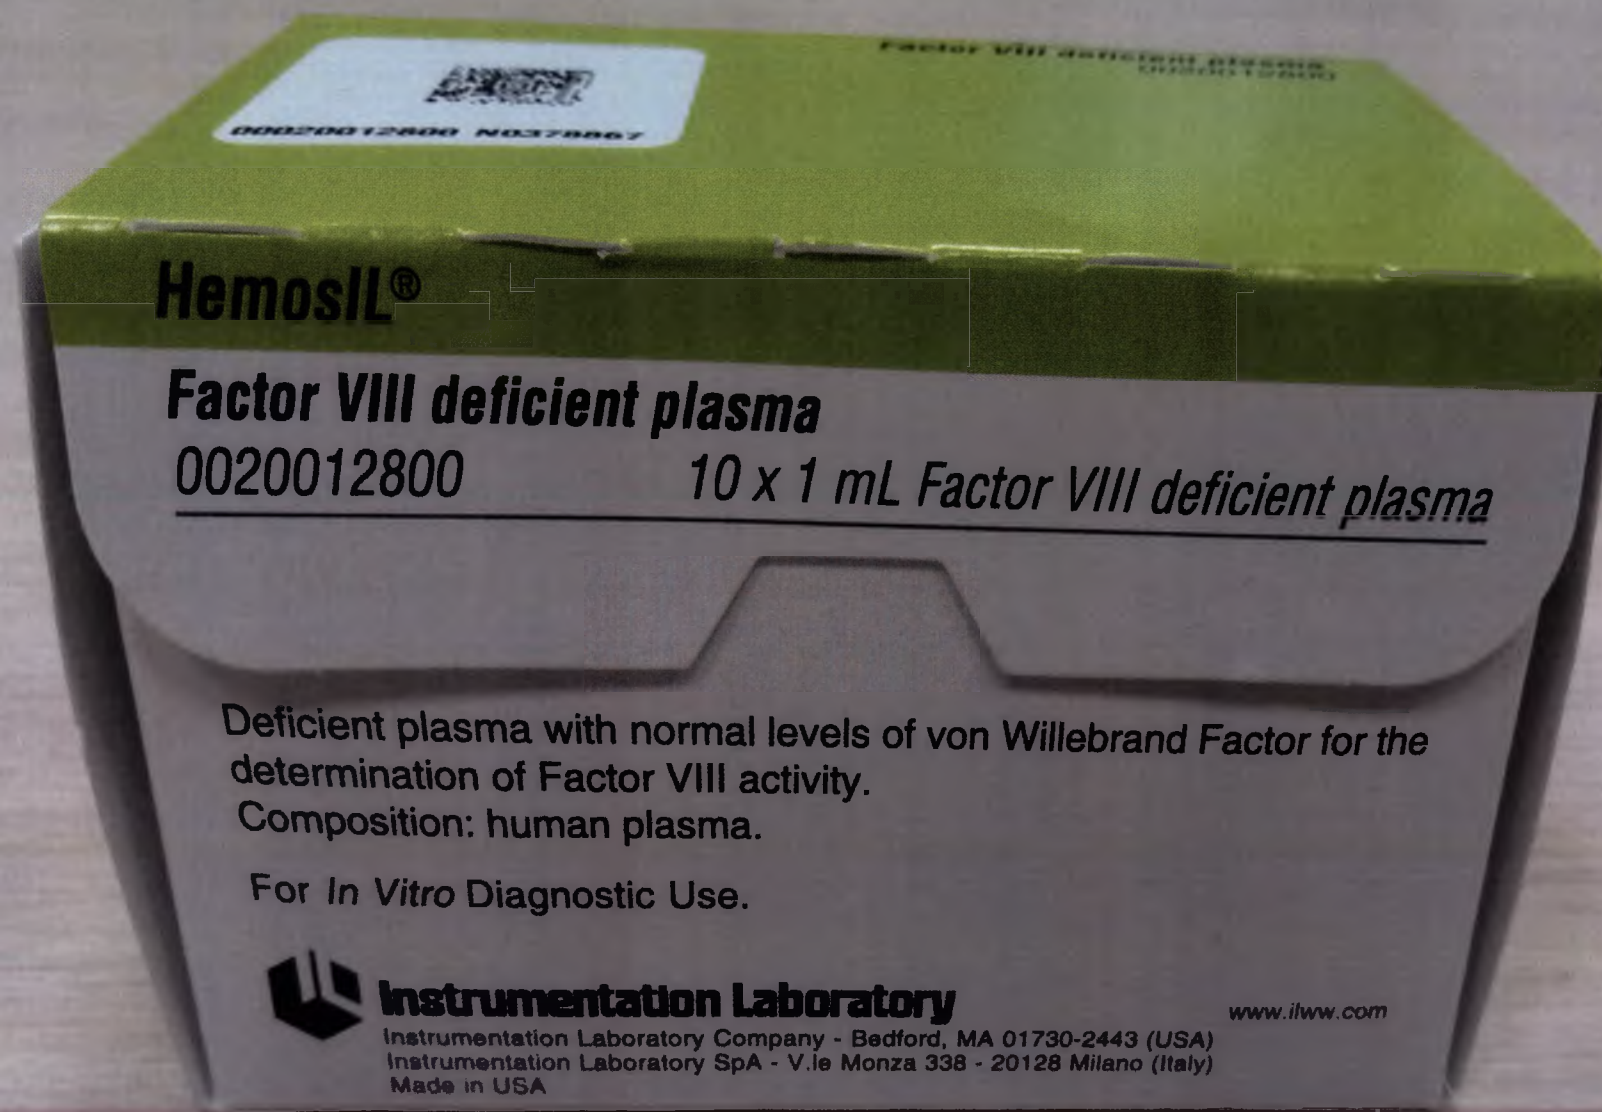

Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)

HemosIL®
Factor VIII
deficient plasma
0020012800

LOT

N0378867
SEQ00449
2019-04




Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)




Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)

Фактор VIII дефицитная плазма, нормальный уровень VWF – HemosIL Factor VIII Deficient Plasma(normal VWF)




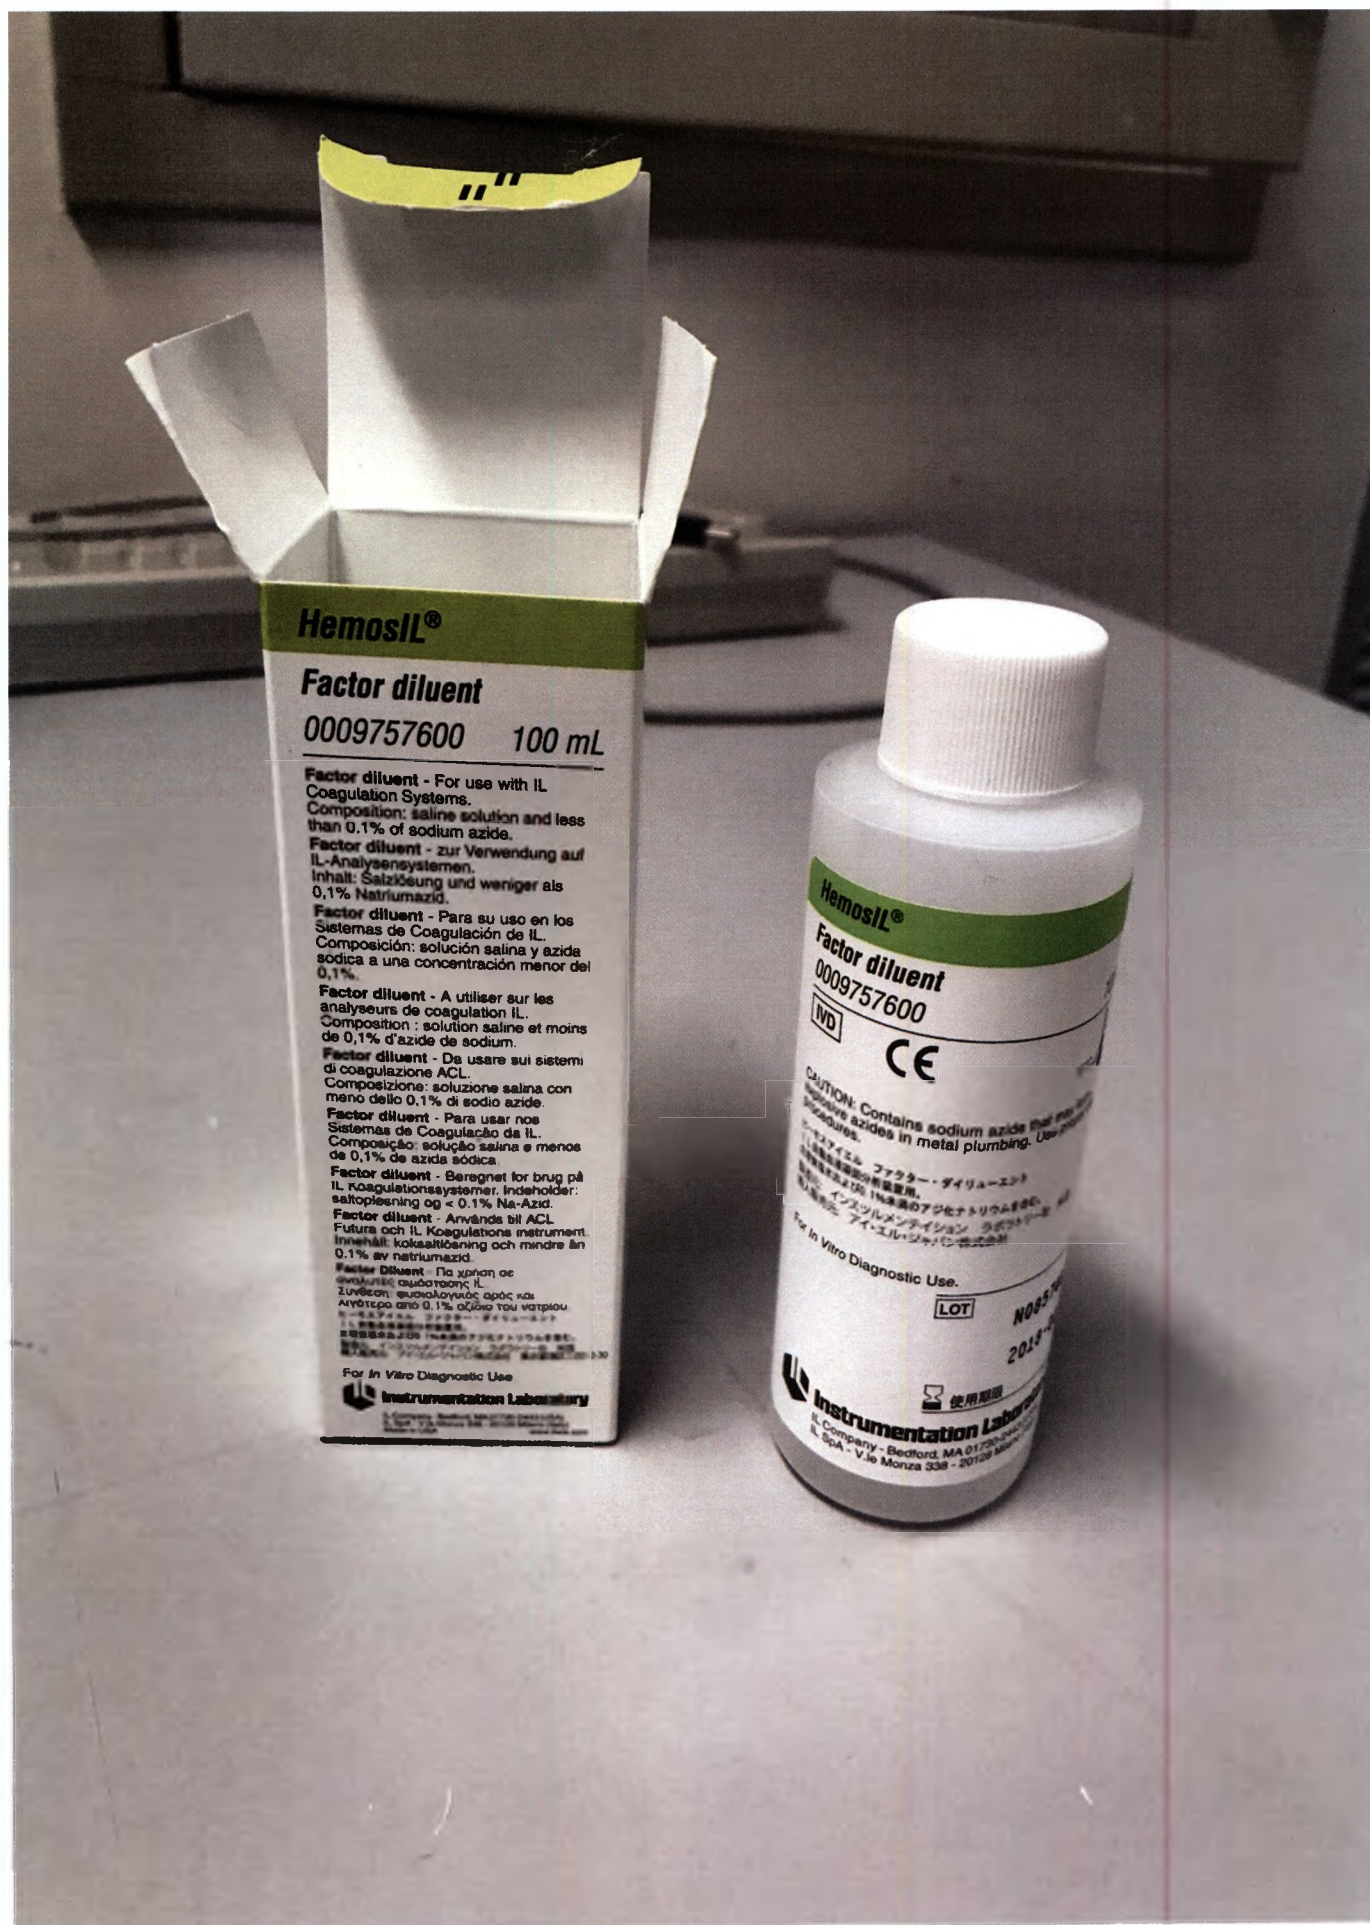


Фактор VIII дефицитная плазма - HemosIL Factor VIII Deficient Plasma

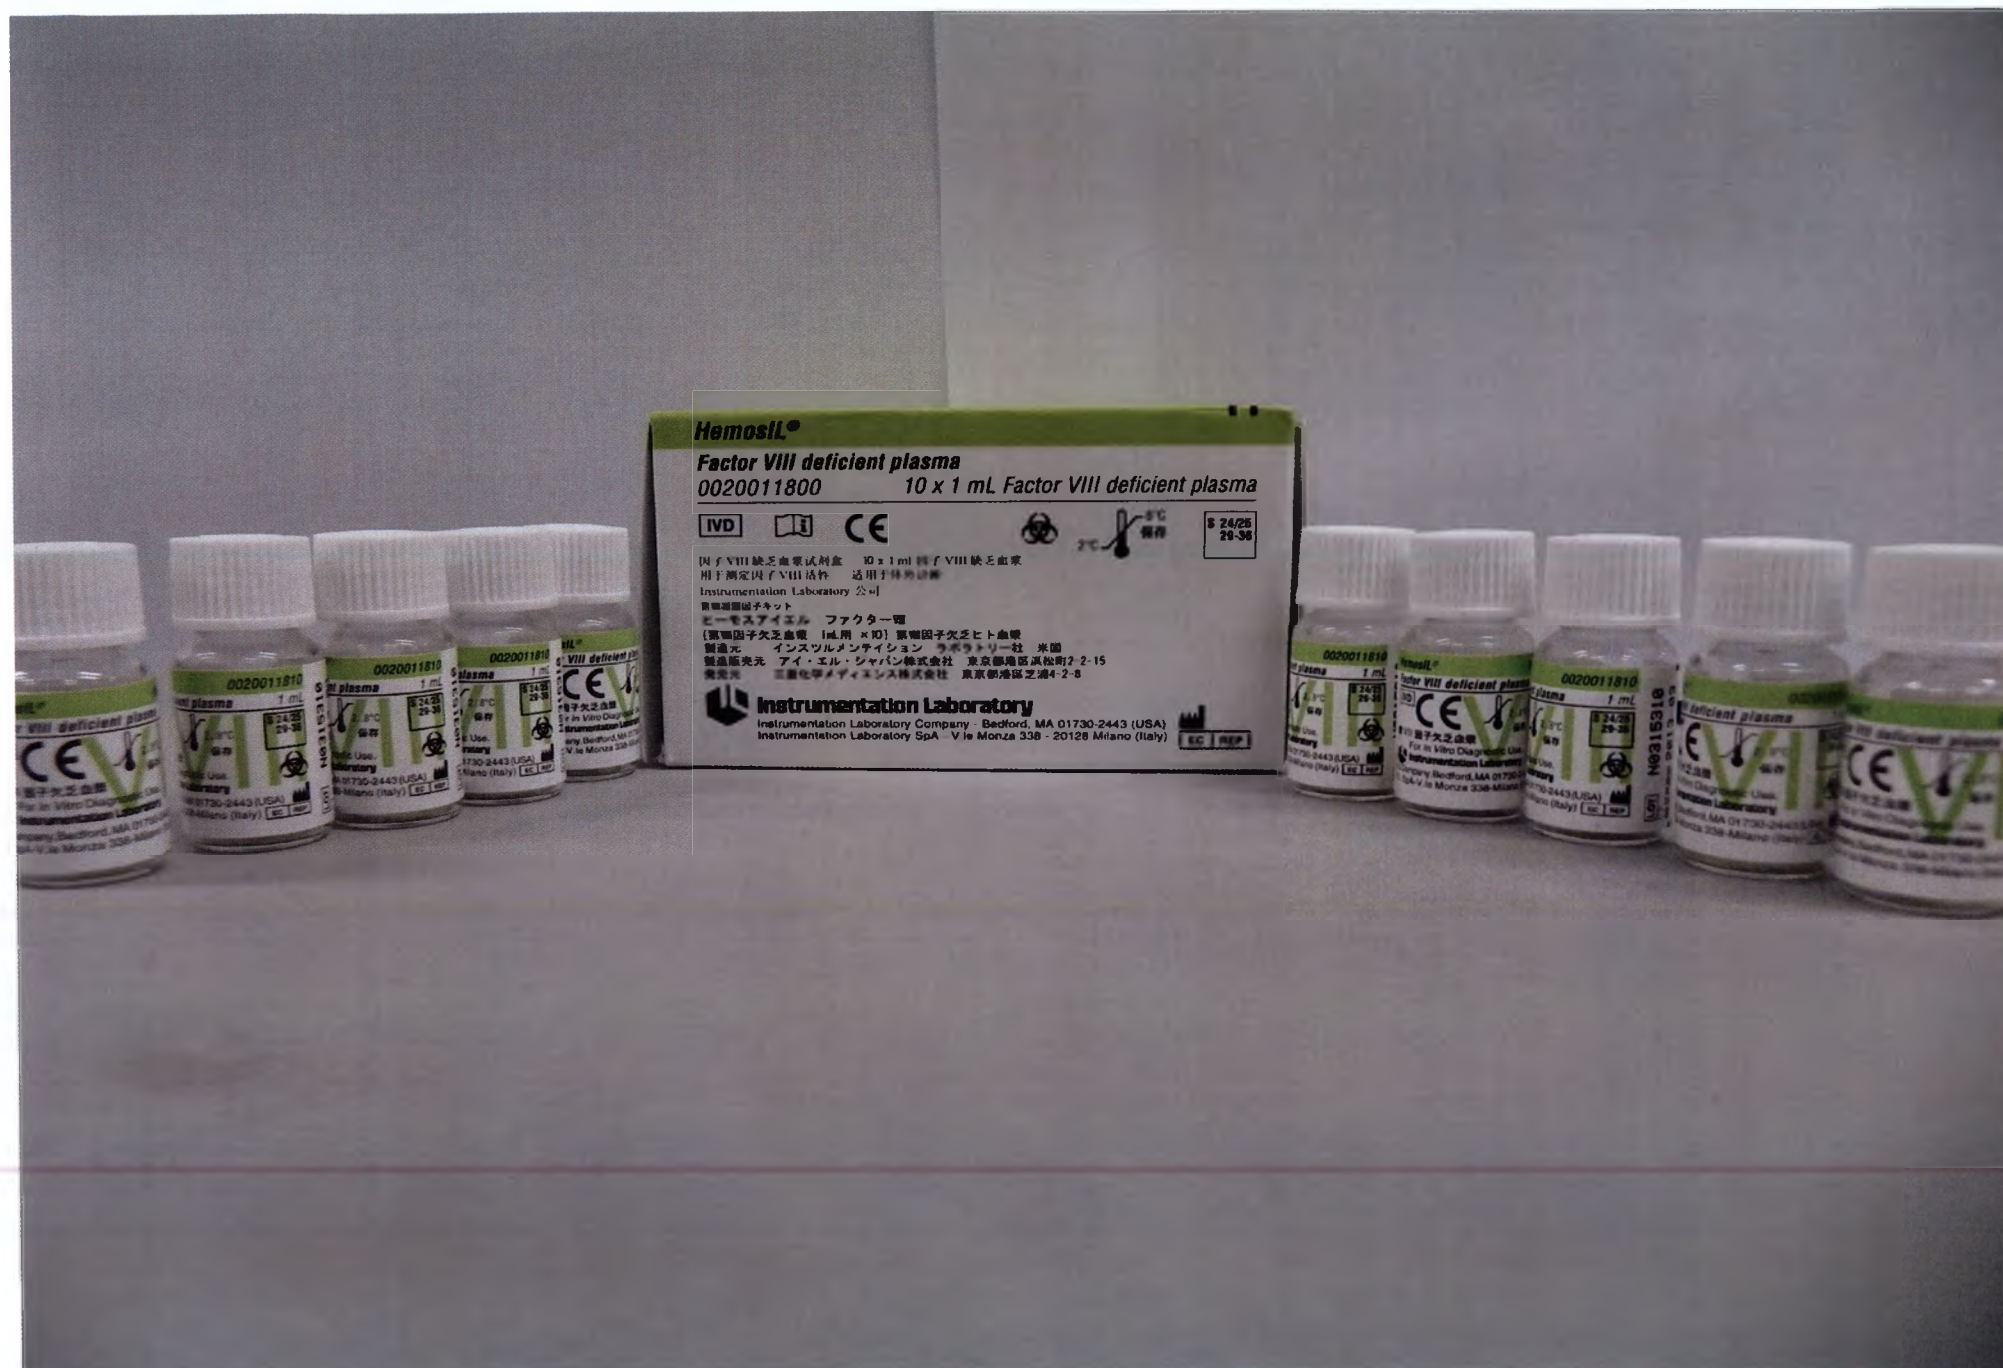


Фактор IX дефицитная плазма - HemosIL Factor IX Deficient Plasma

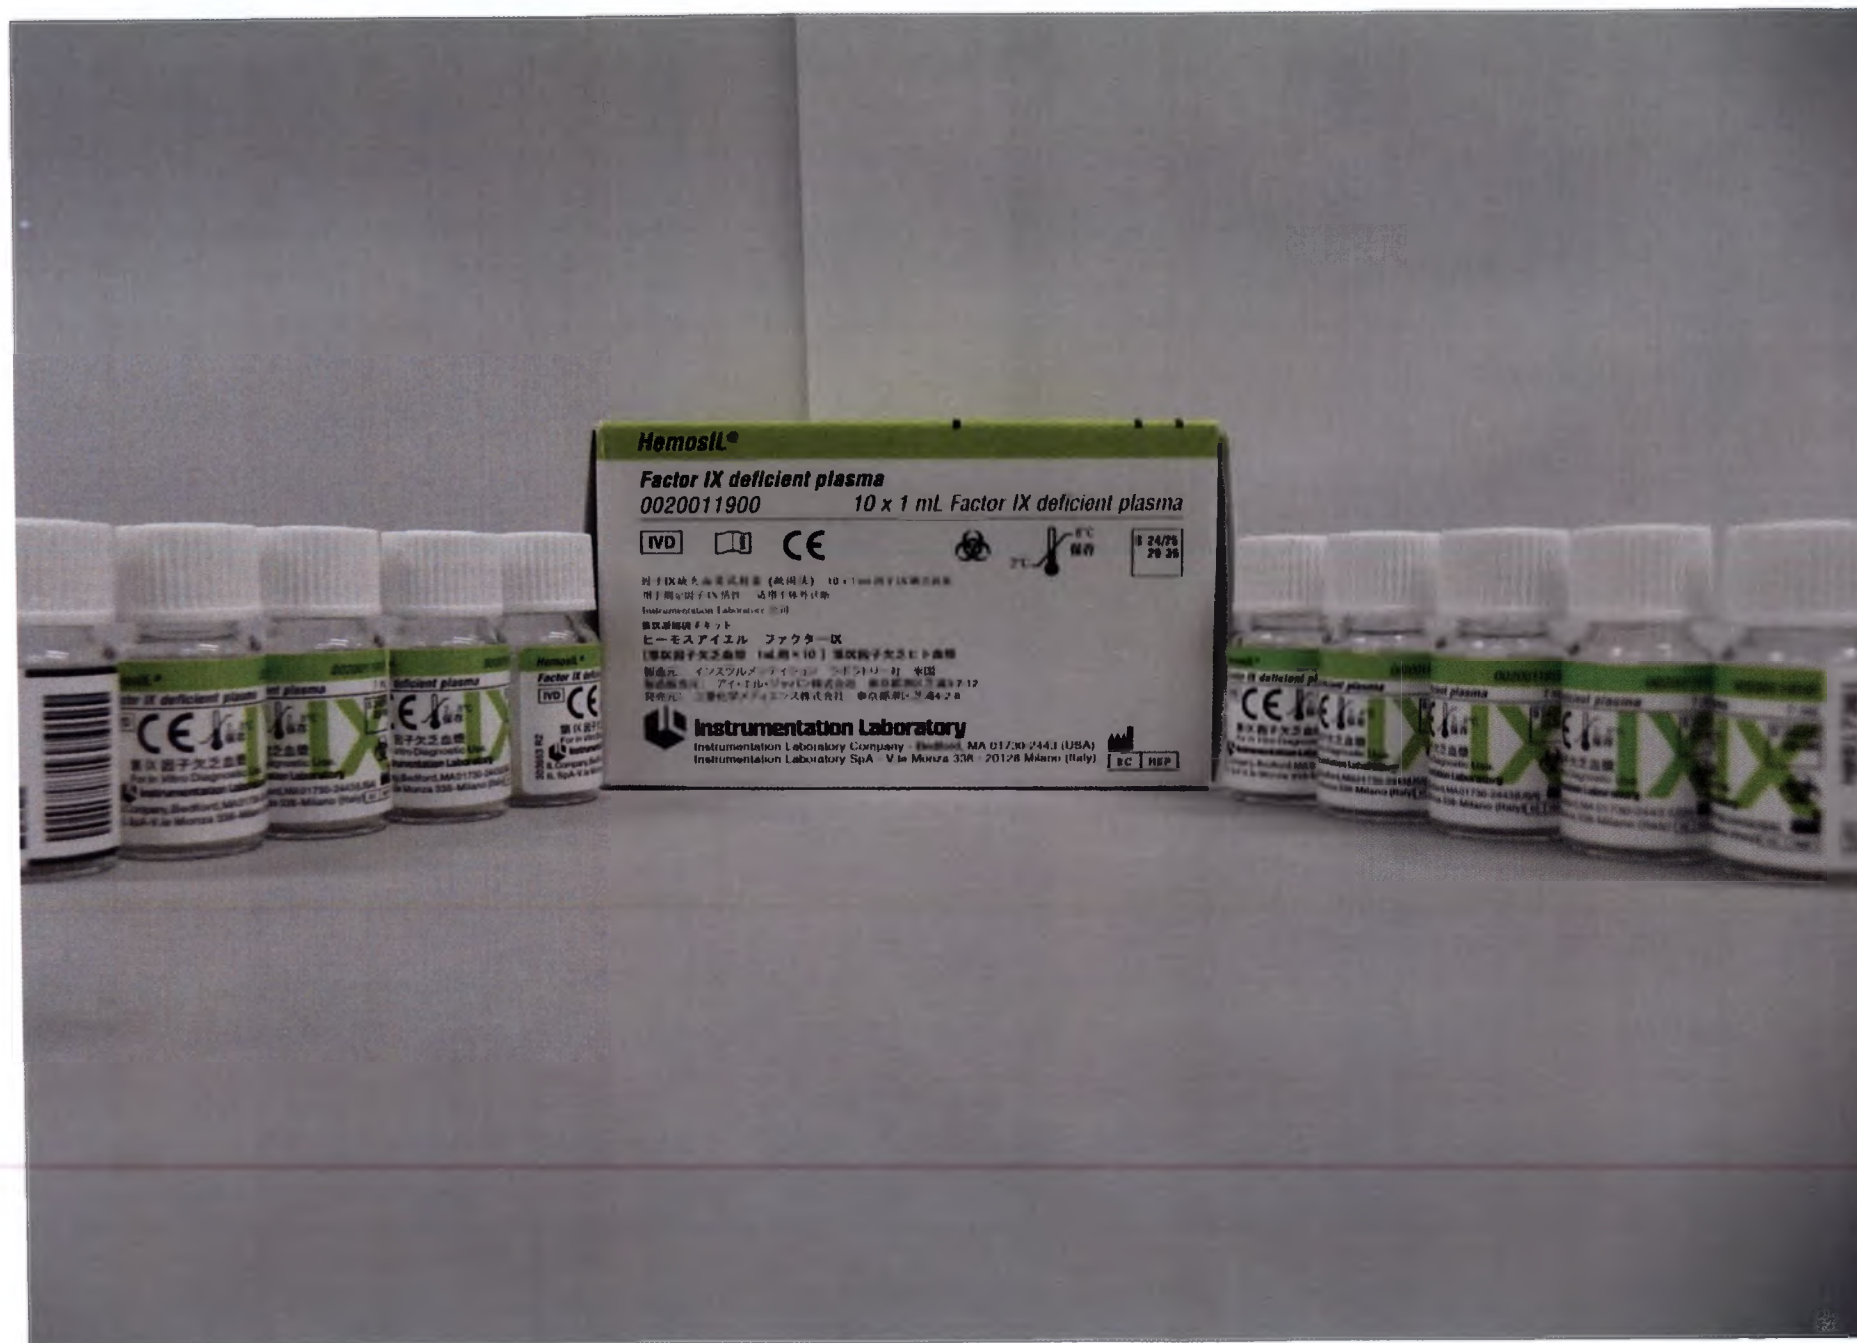


Фактор X дефицитная плазма - HemosIL Factor X Deficient Plasma

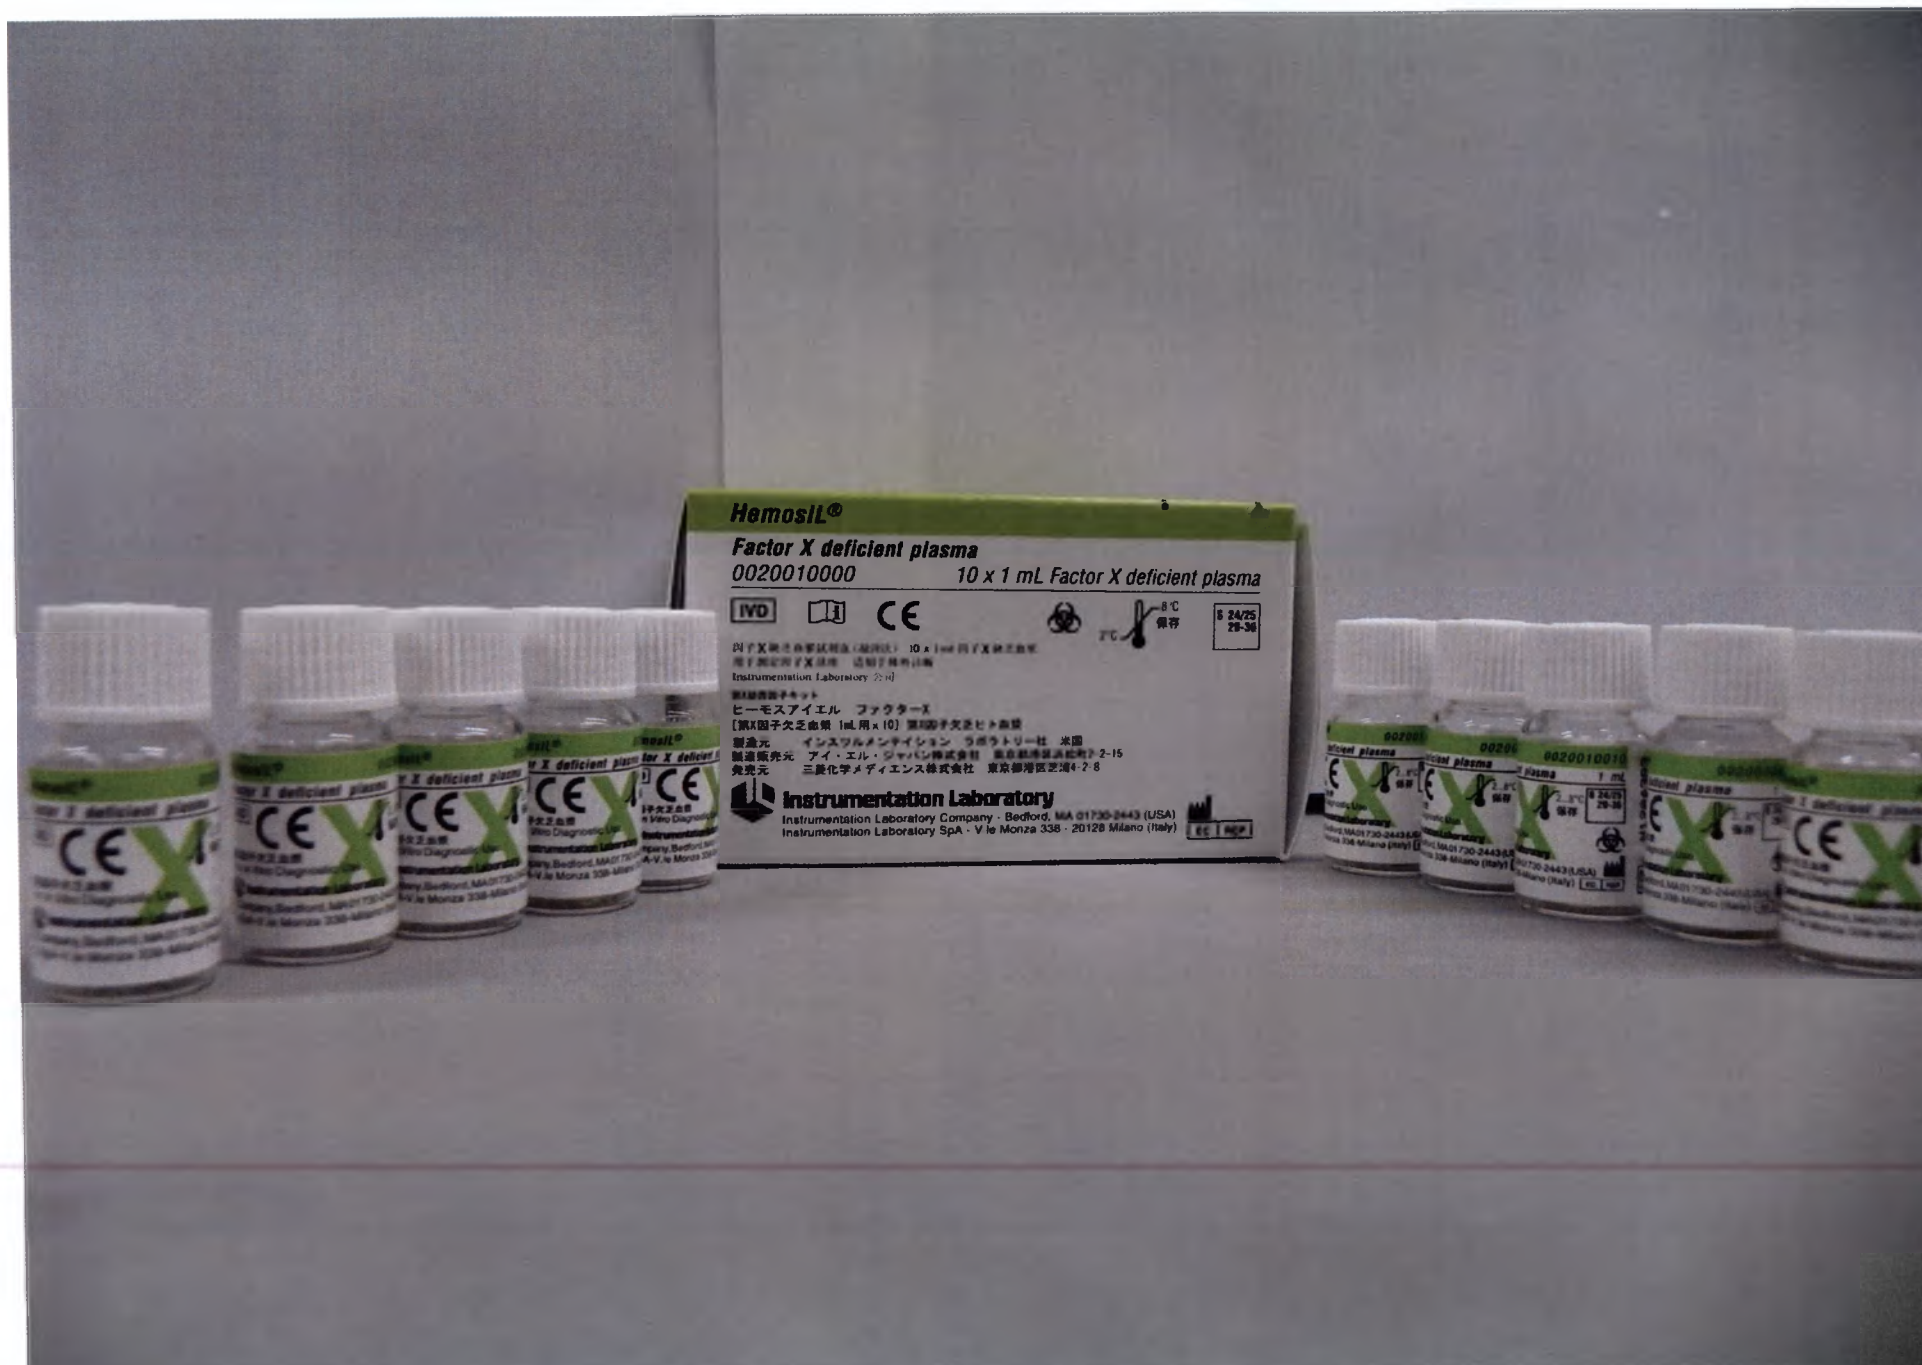


Фактор II дефицитная плазма - HemosIL Factor II Deficient Plasma

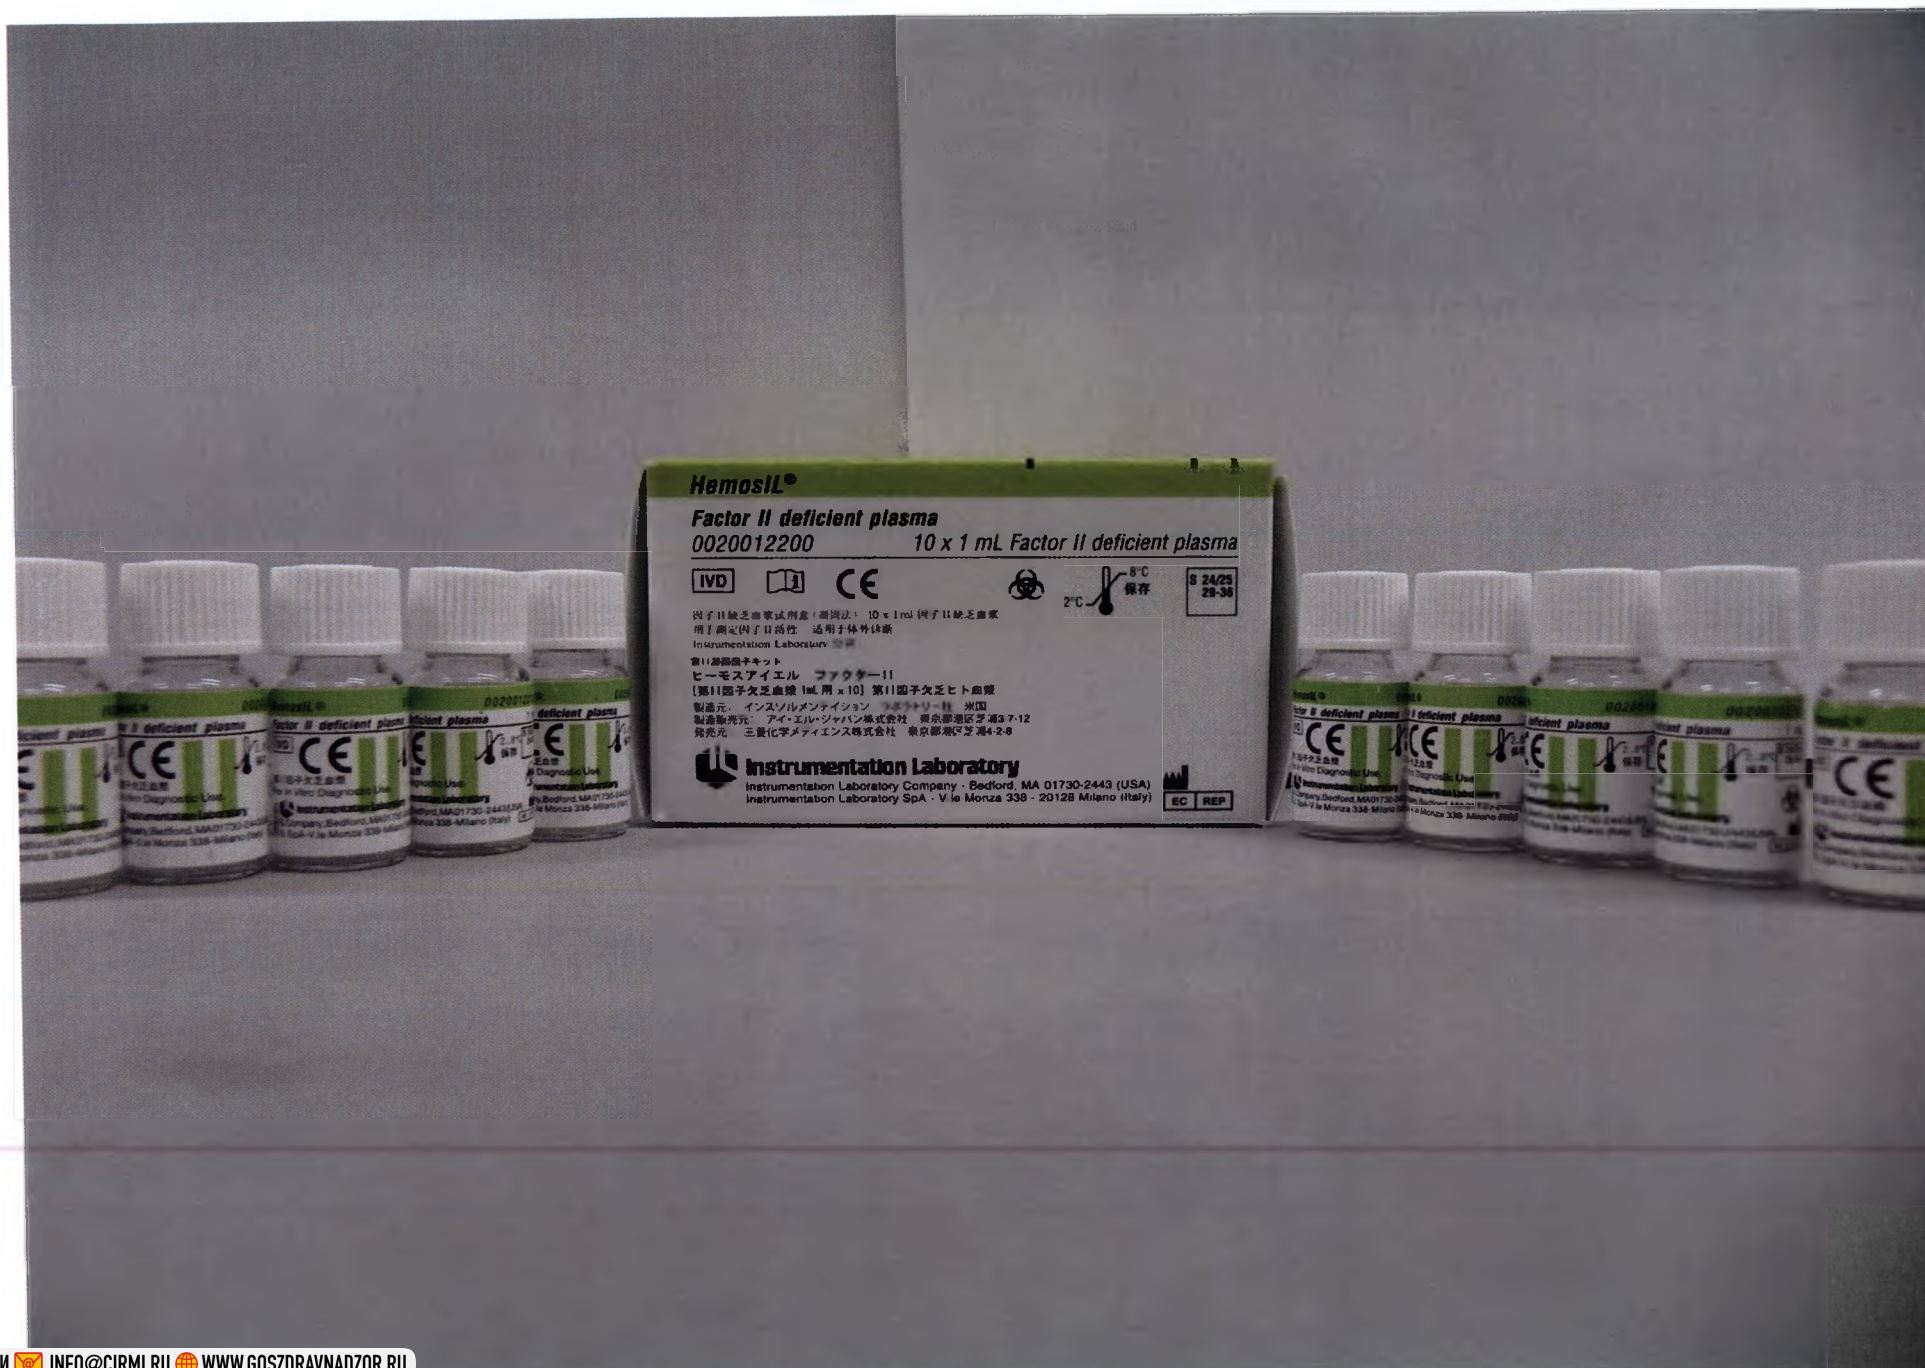


Фактор V дефицитная плазма - HemosIL Factor V Deficient Plasma

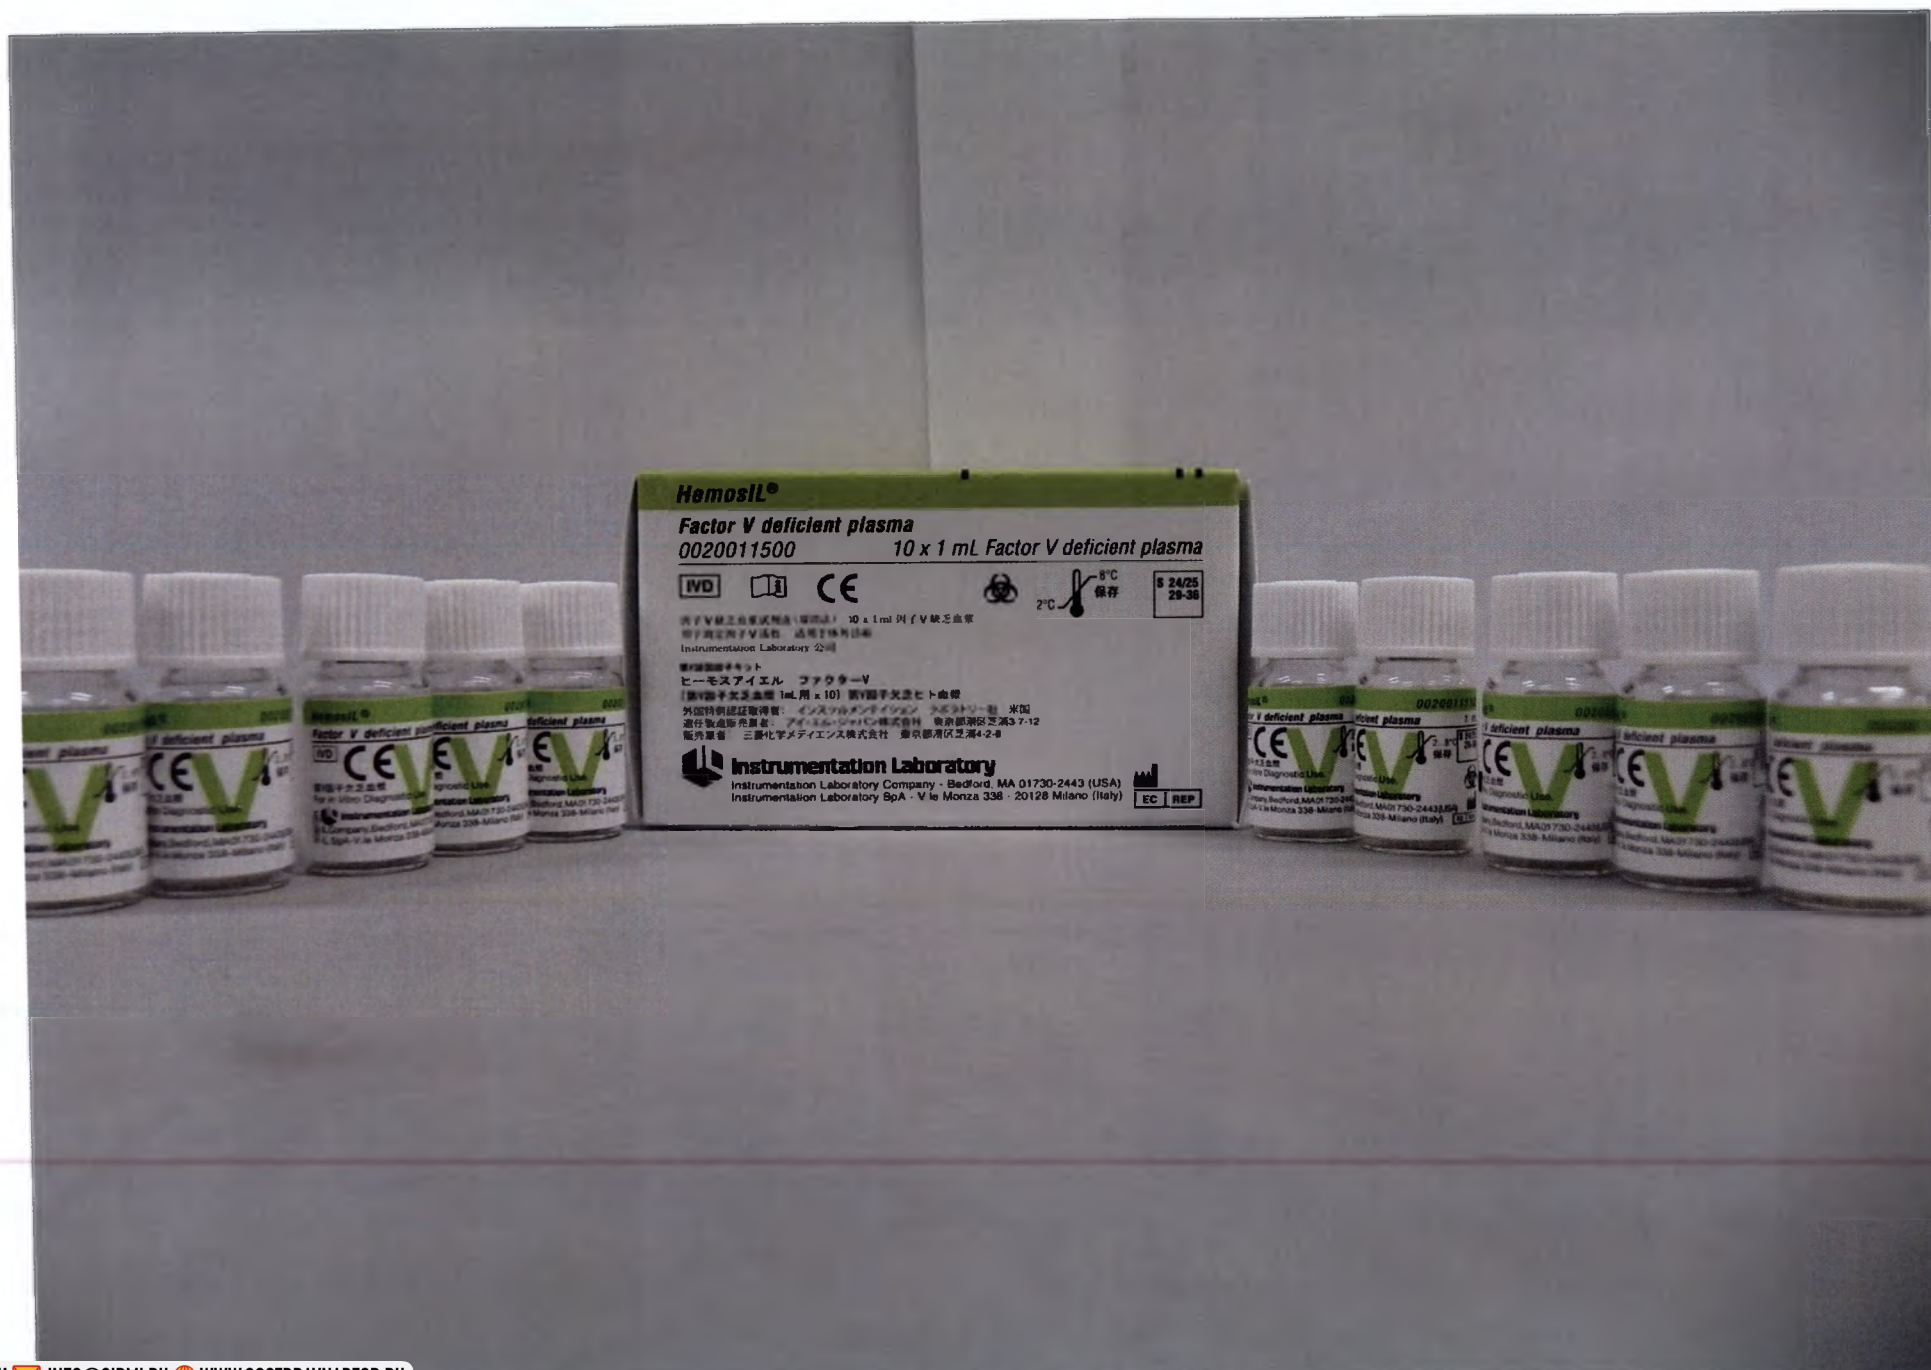


Фактор VII дефицитная плазма - HemosIL Factor VII Deficient Plasma

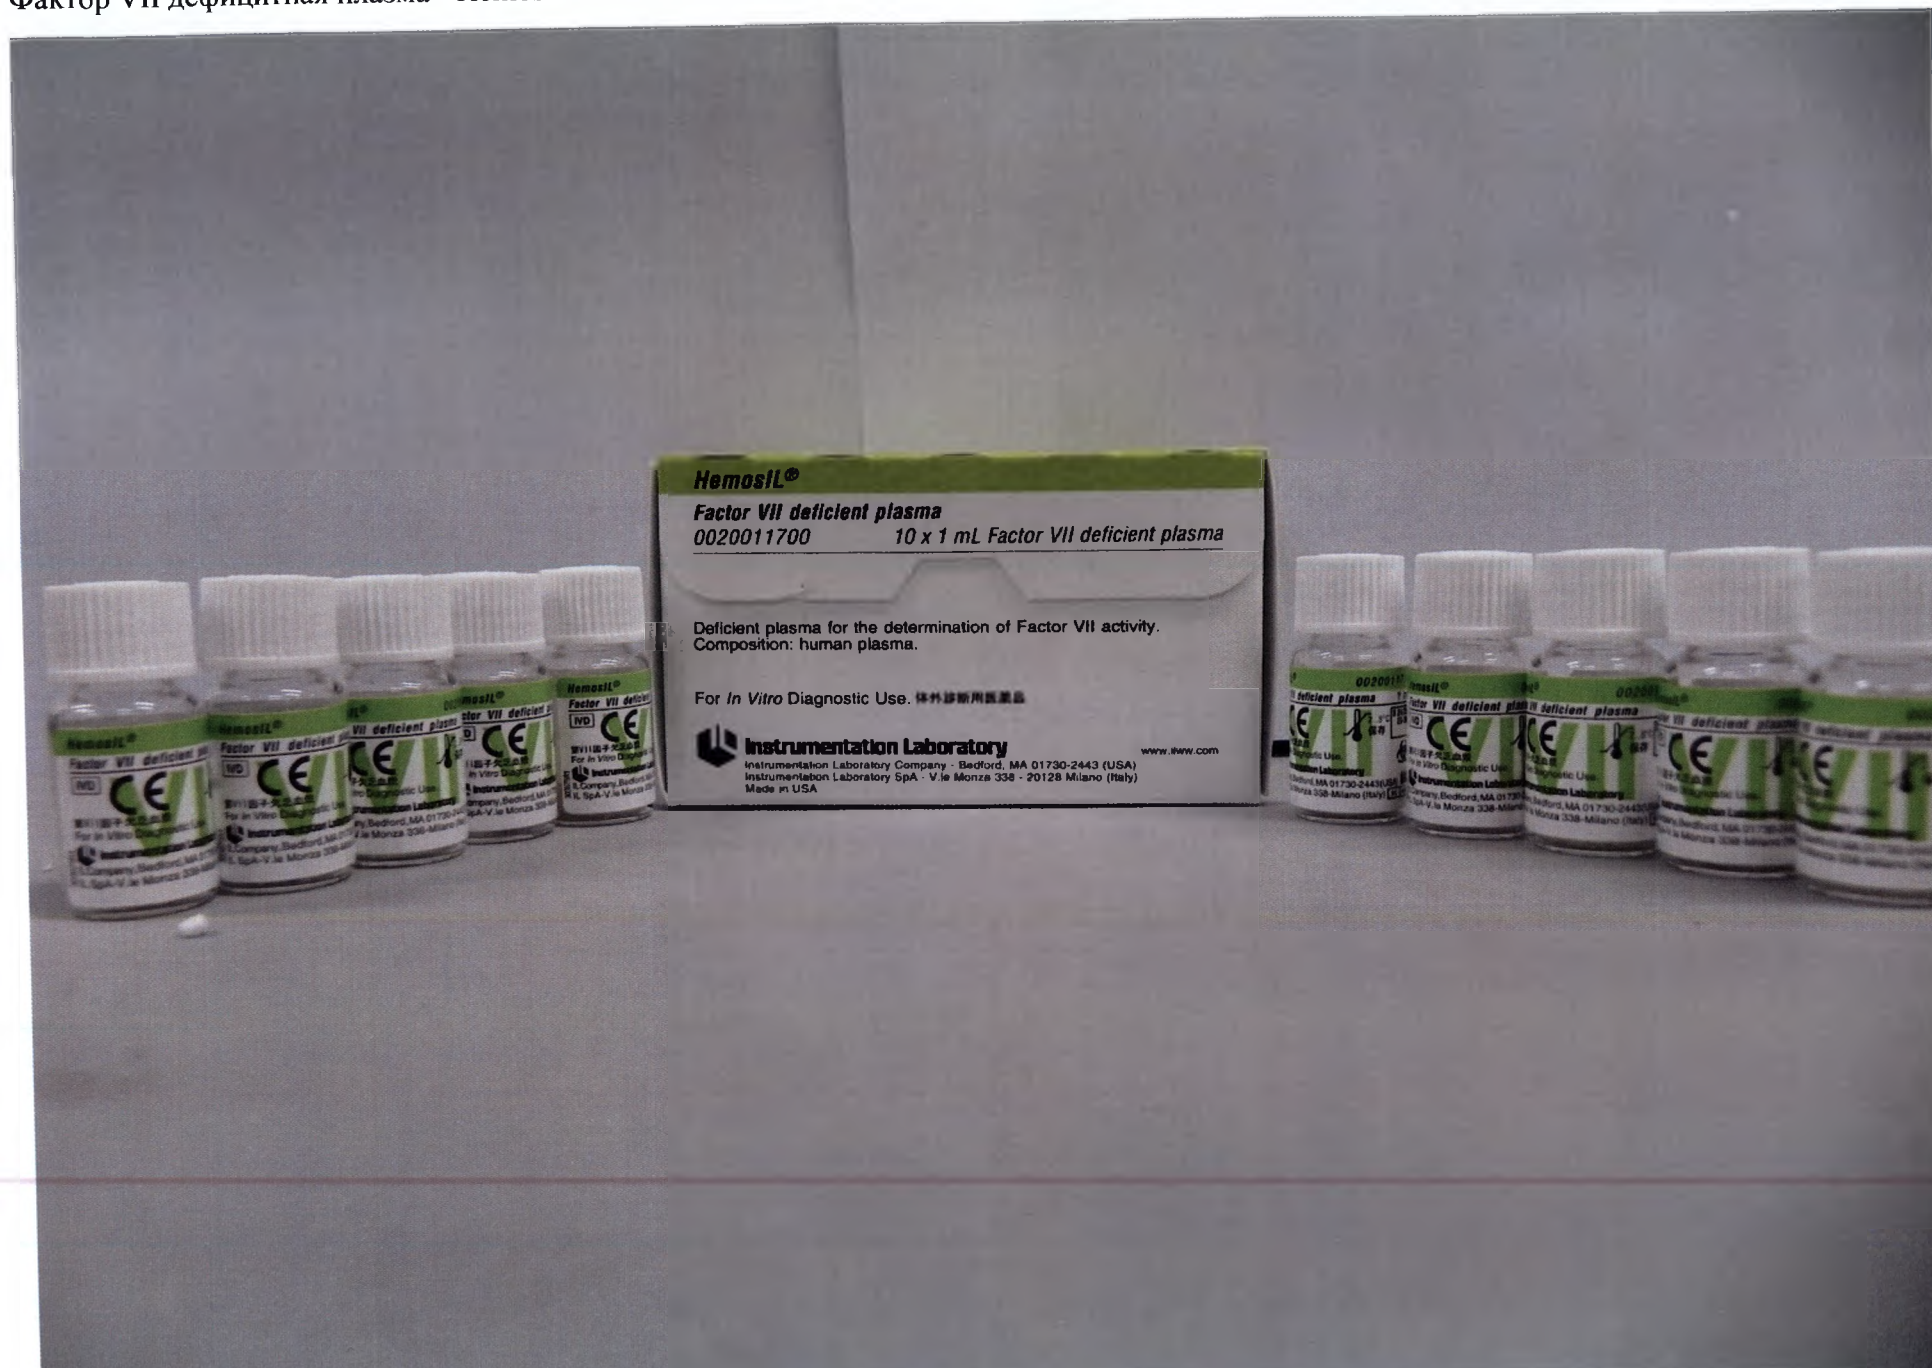

Фактор XI дефицитная плазма - HemosIL Factor XI Deficient Plasma

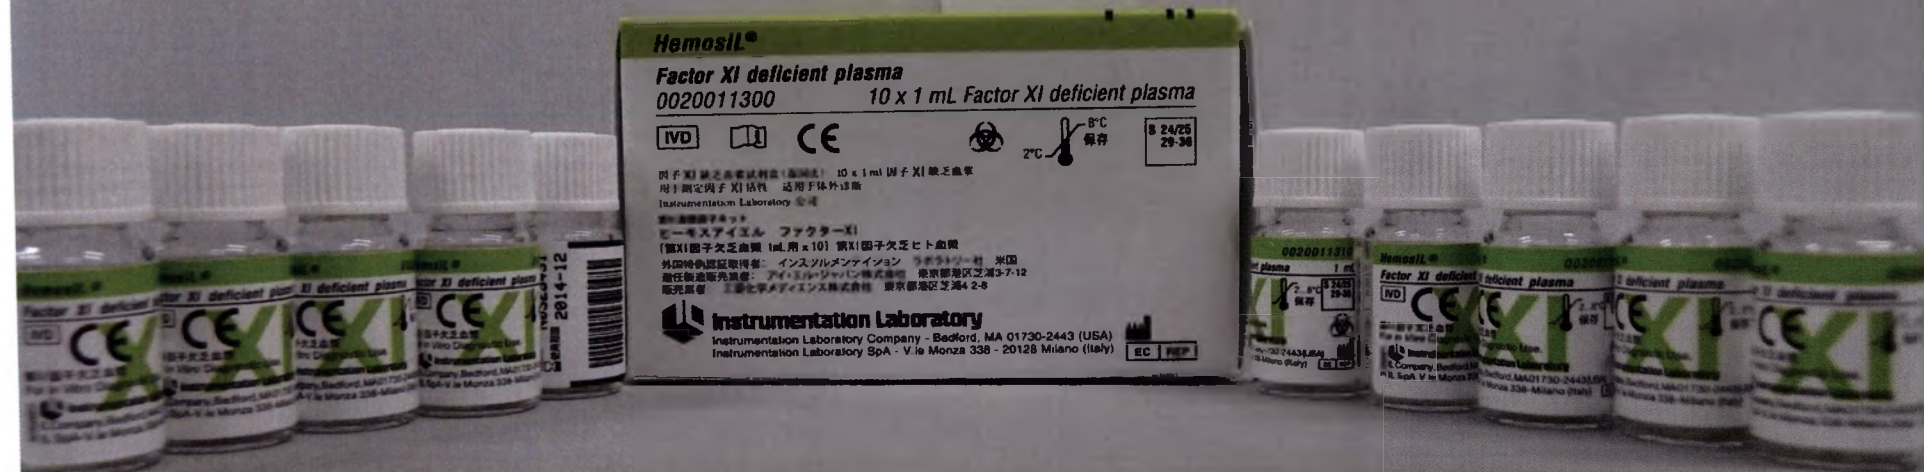


Фактор XII дефицитная плазма - HemosIL Factor XII Deficient Plasma

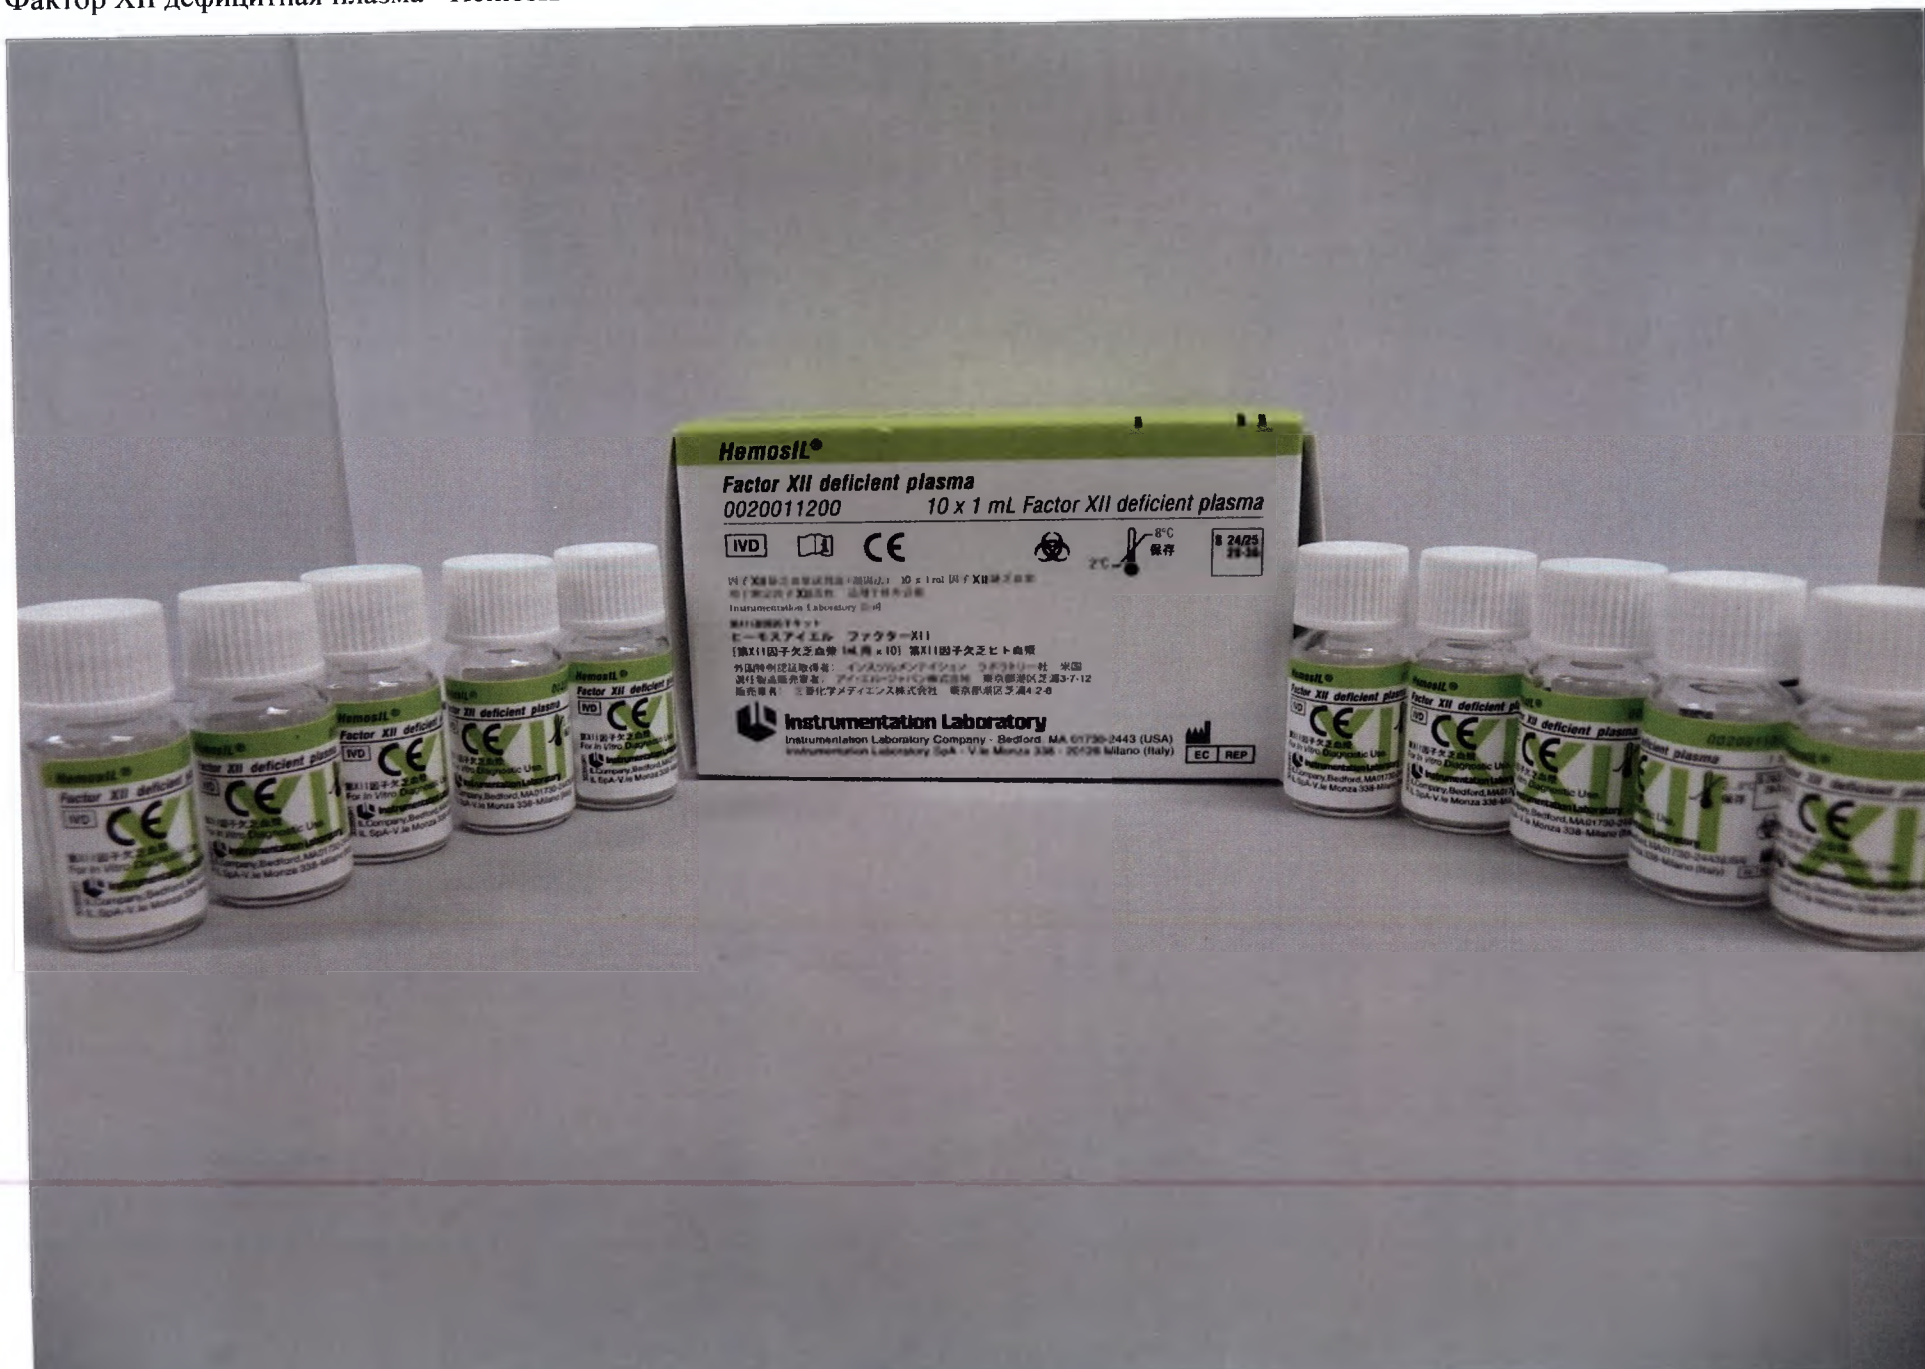

Фактор XIII антиген - HemosIL Factor XIII Antigen



Фактор V Лейден - HemosIL Factor V Leiden

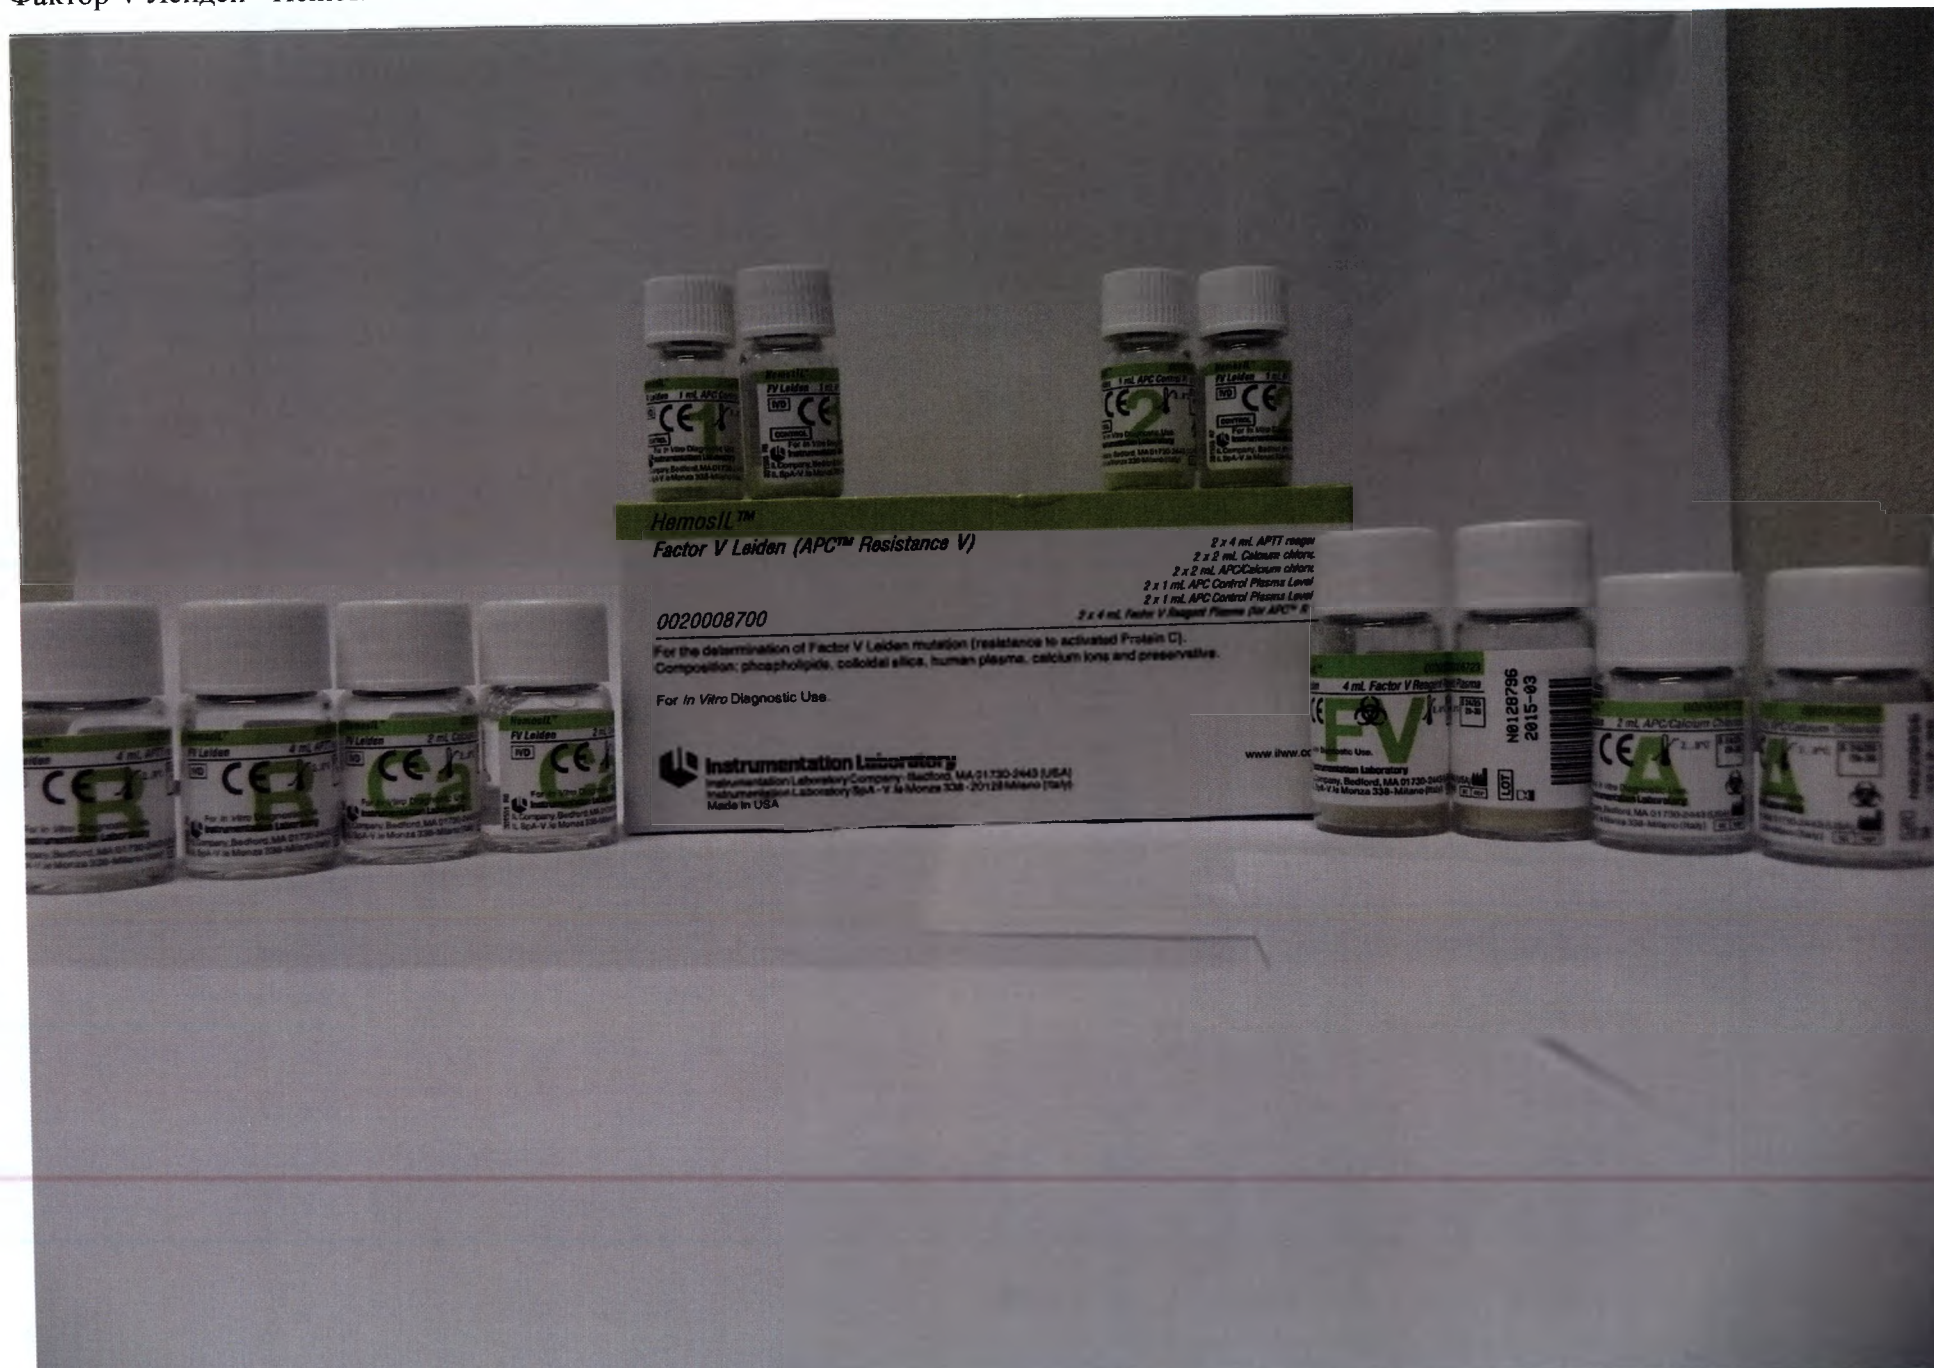

Время коагуляции с кварцевым активатором - HemosIL Silica Clotting Time



HemosIL®

Factor V Reagent Plasma (for APC™ R V)

0020008800 **5 x 4 mL Factor V Reagent Plasma (for APC™ R V)**


For use with the Factor V Leiden (APC™ Resistance V) kit.
Composition: human plasma. For *In Vitro* Diagnostic Use.

因子 V 试剂血浆试剂盒 (用于活化蛋白 C 抵抗物测定)
5 x 4ml 因子 V 试剂血浆 (用于活化蛋白 C 抵抗物测定)
和因子 V Leiden 突变试剂盒一齐用于测定
因子 V Leiden 突变 (即活化蛋白 C 抵抗物) 适用于体外诊断
Instrumentation Laboratory 公司

LOT

N0249011


2017-04



**Instrumentation
Laboratory**

A Werfen Company

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA




301850 R7



EC REP

Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen

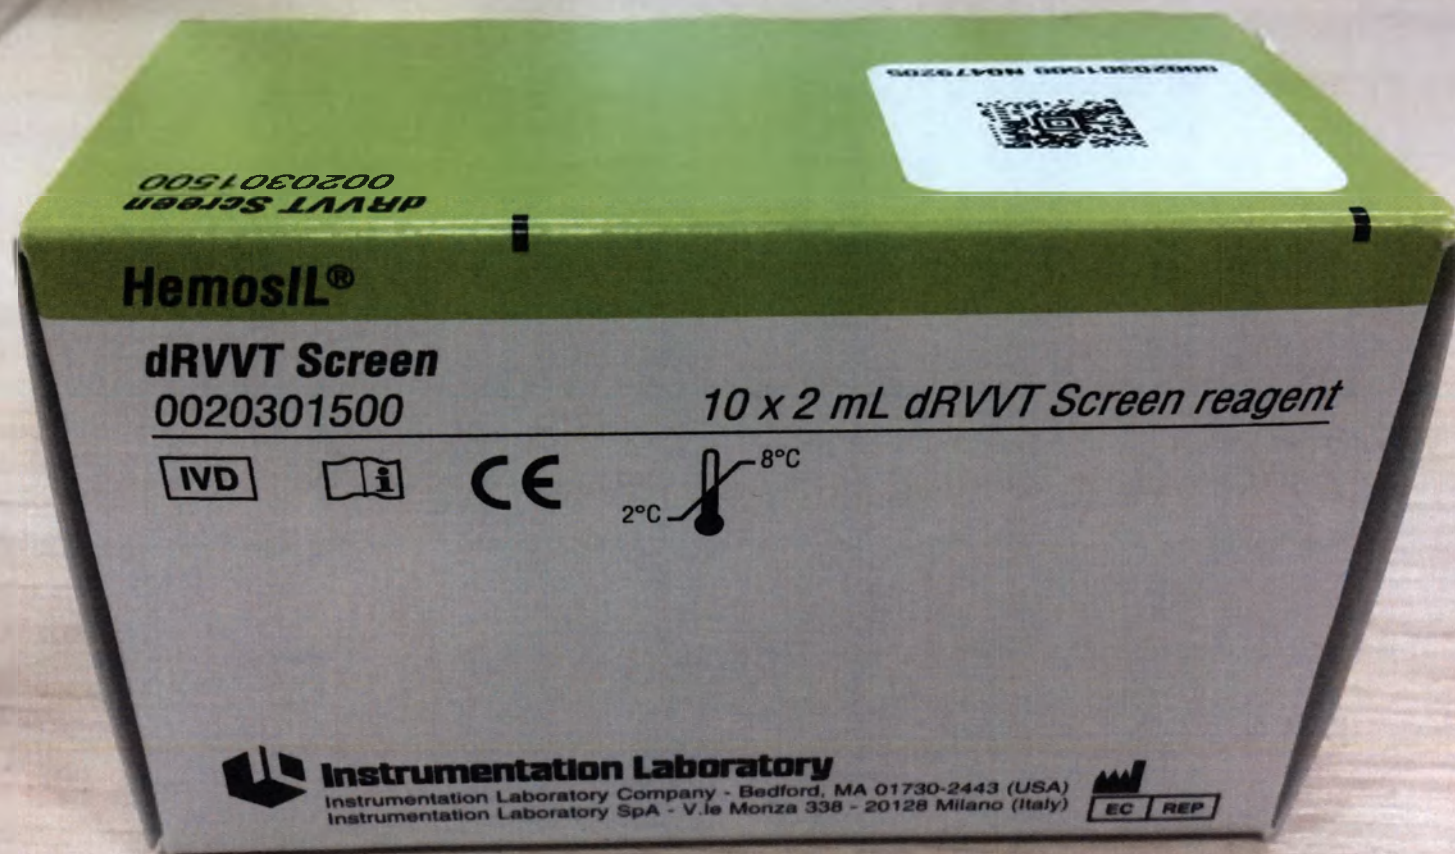

Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen




Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (скрининг) – HemosIL dRVVT Screen



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm

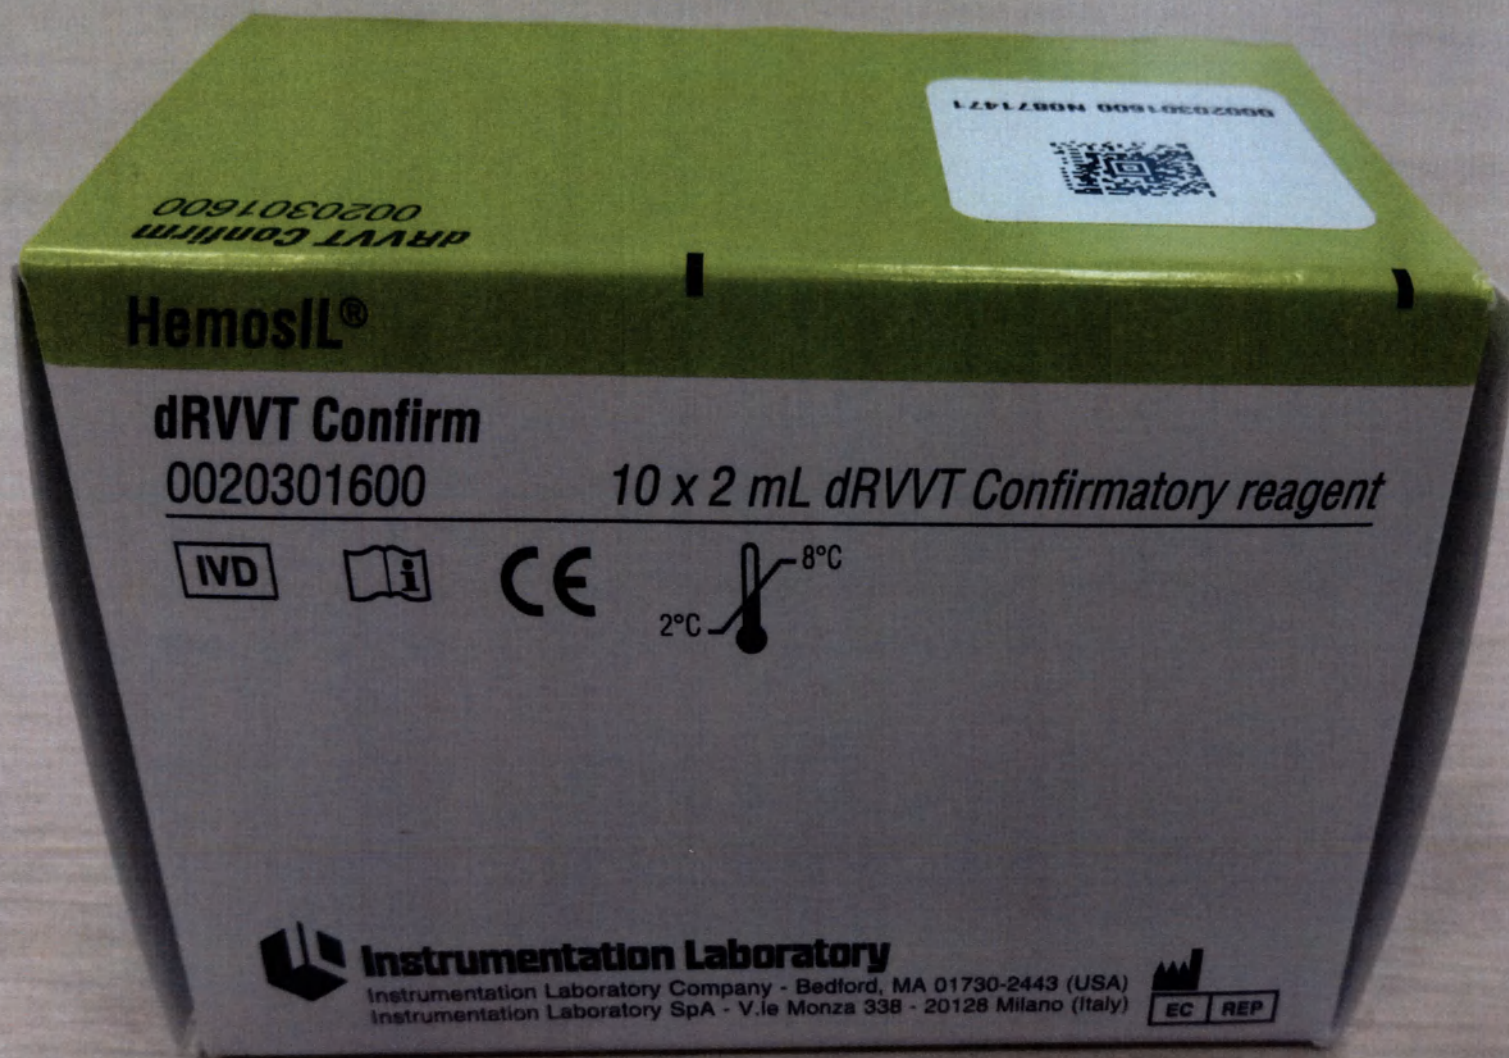

Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm

HemosIL®


dRVVT Confirm

0020301600

LOT

N0871471
SEQ00876
2019-08

Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm

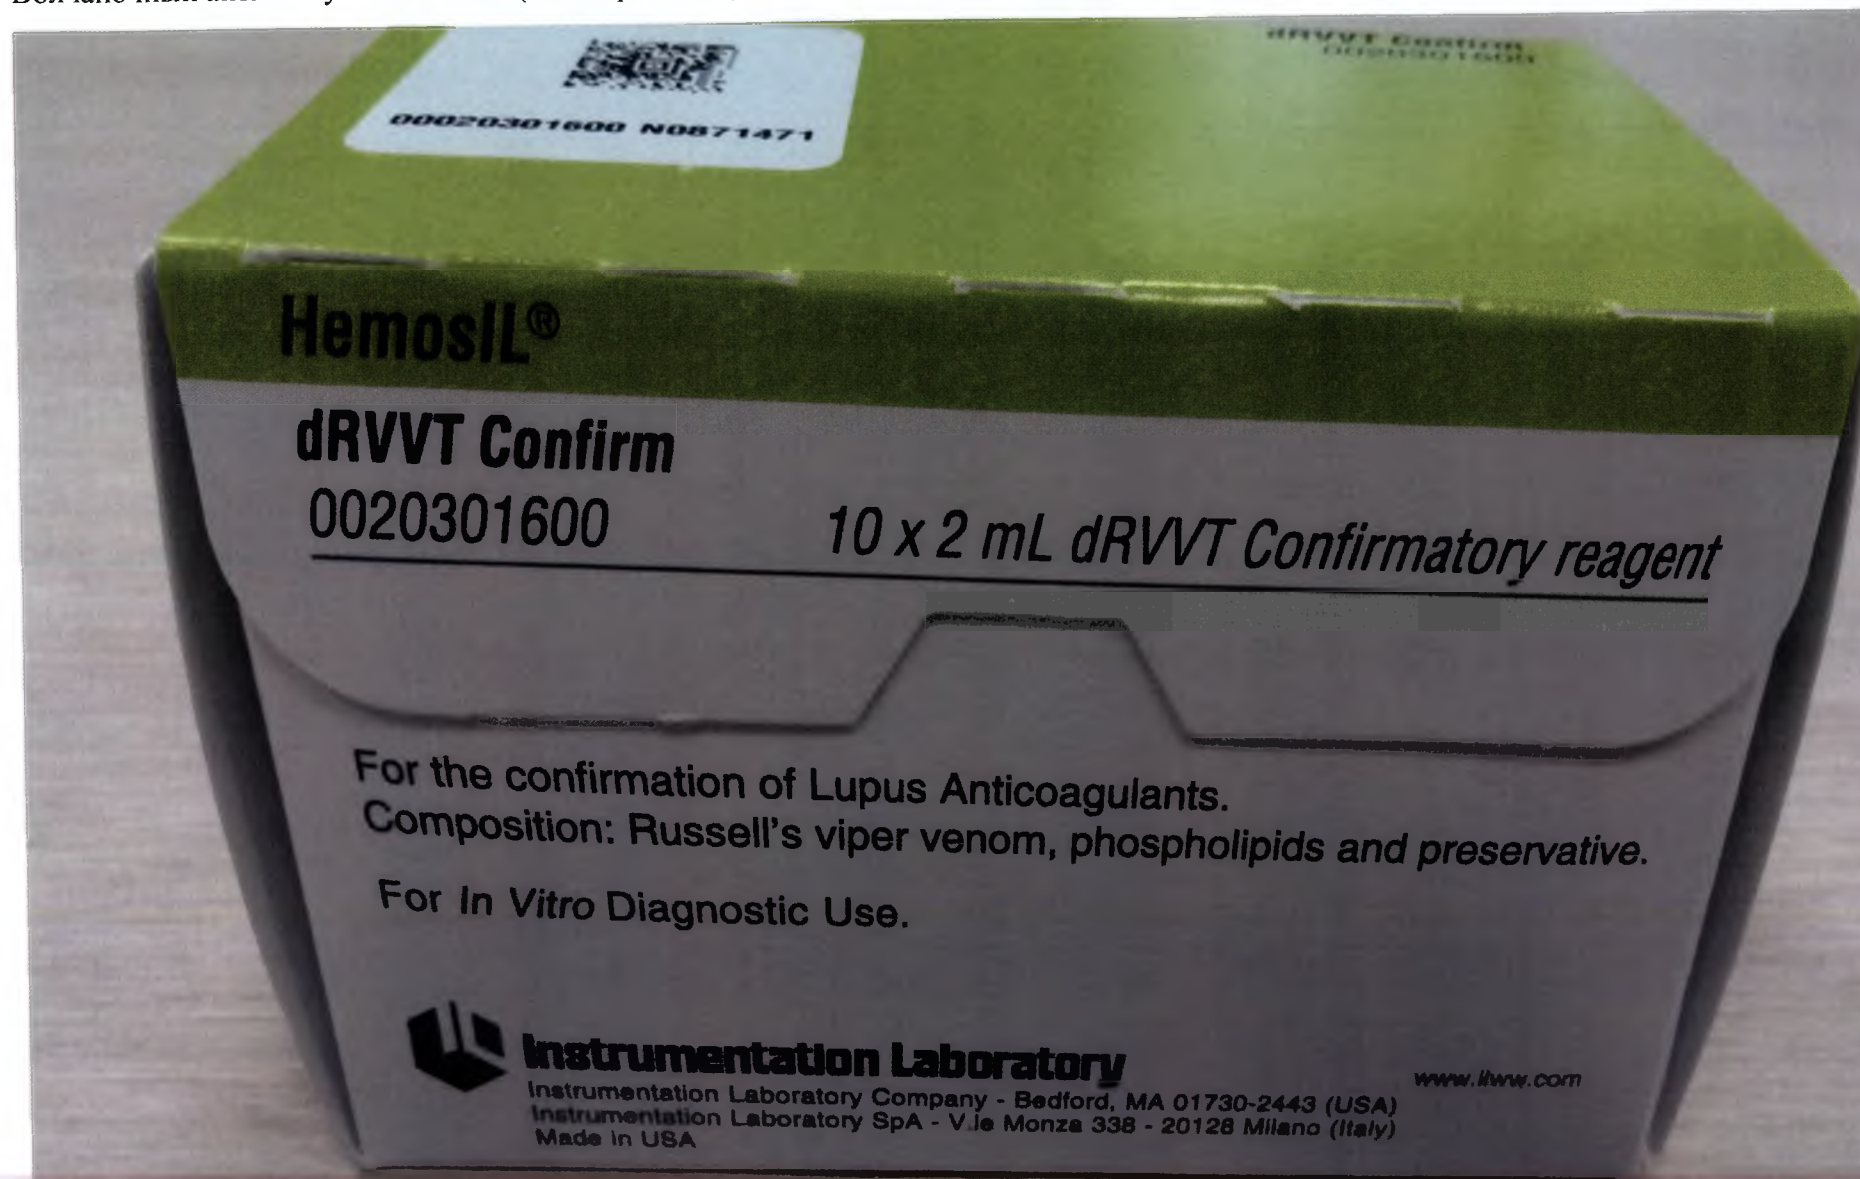

Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm

HemosIL®
dRVVT Confirm
0020301600

LOT N0871471
2019-08-31



(01)08420050513711
(17)100831
(10)N0871471


Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm



Волчаночный антикоагулянт dRVVT (подтверждение)– HemosIL dRVVT Confirm



Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control

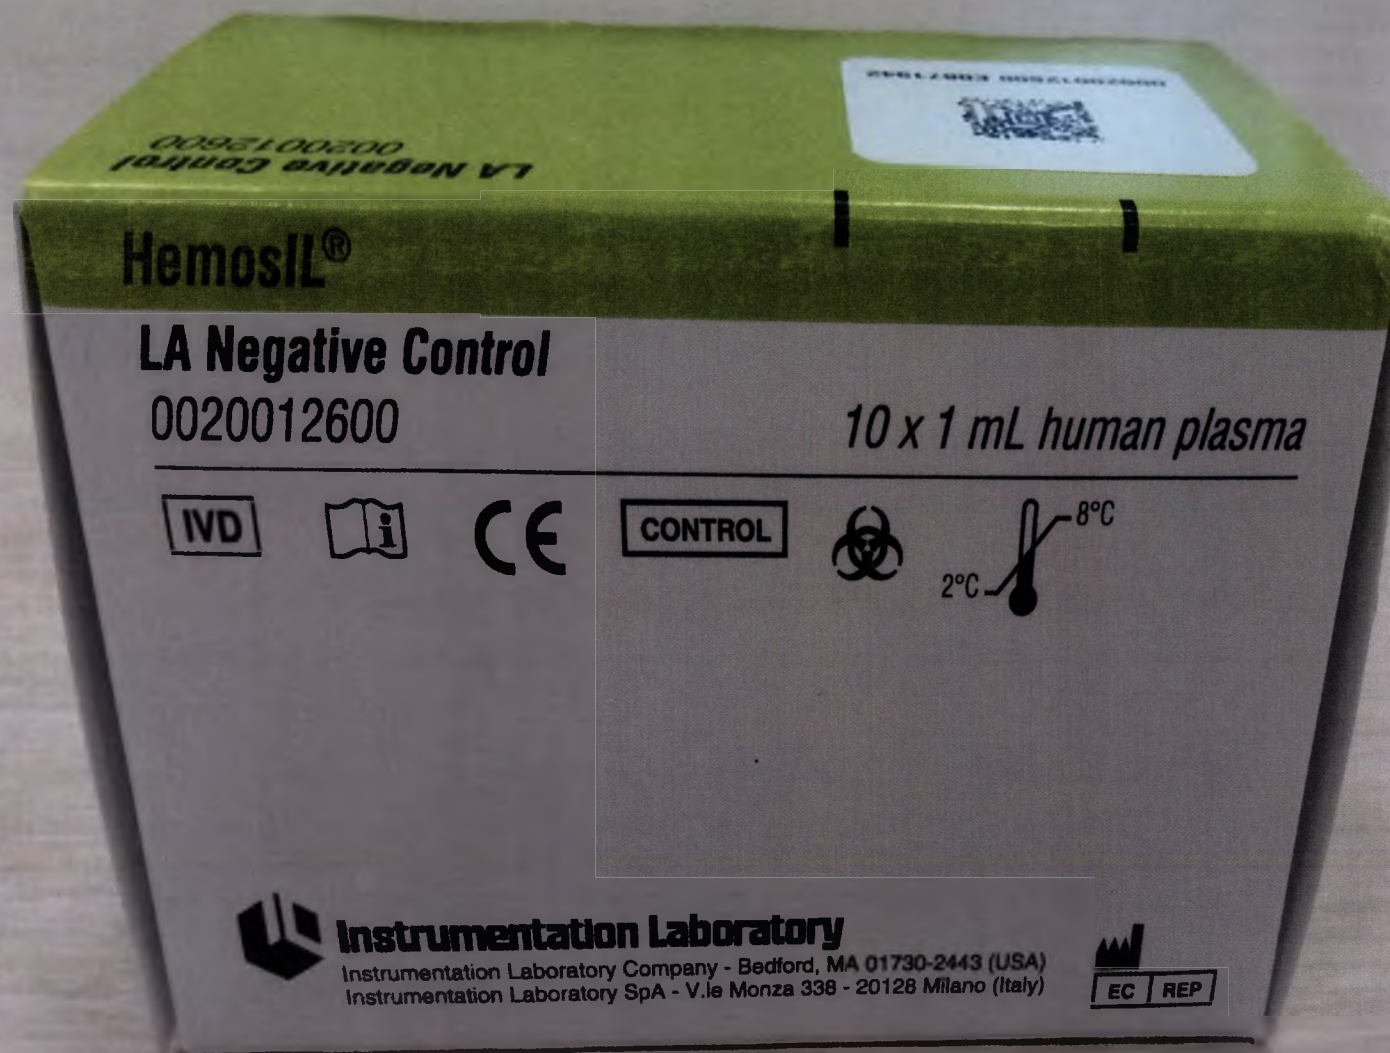

Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control

HemosIL®

LA Negative Control

0020012600

LOT

E0871942
SEQ00936
2019-08



Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control

HemosIL®

LA Negative Control

0020012600

LOT

E0871942



2019-08-31




(01)08426950578980

(17)190831

(10)E0871942

Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control

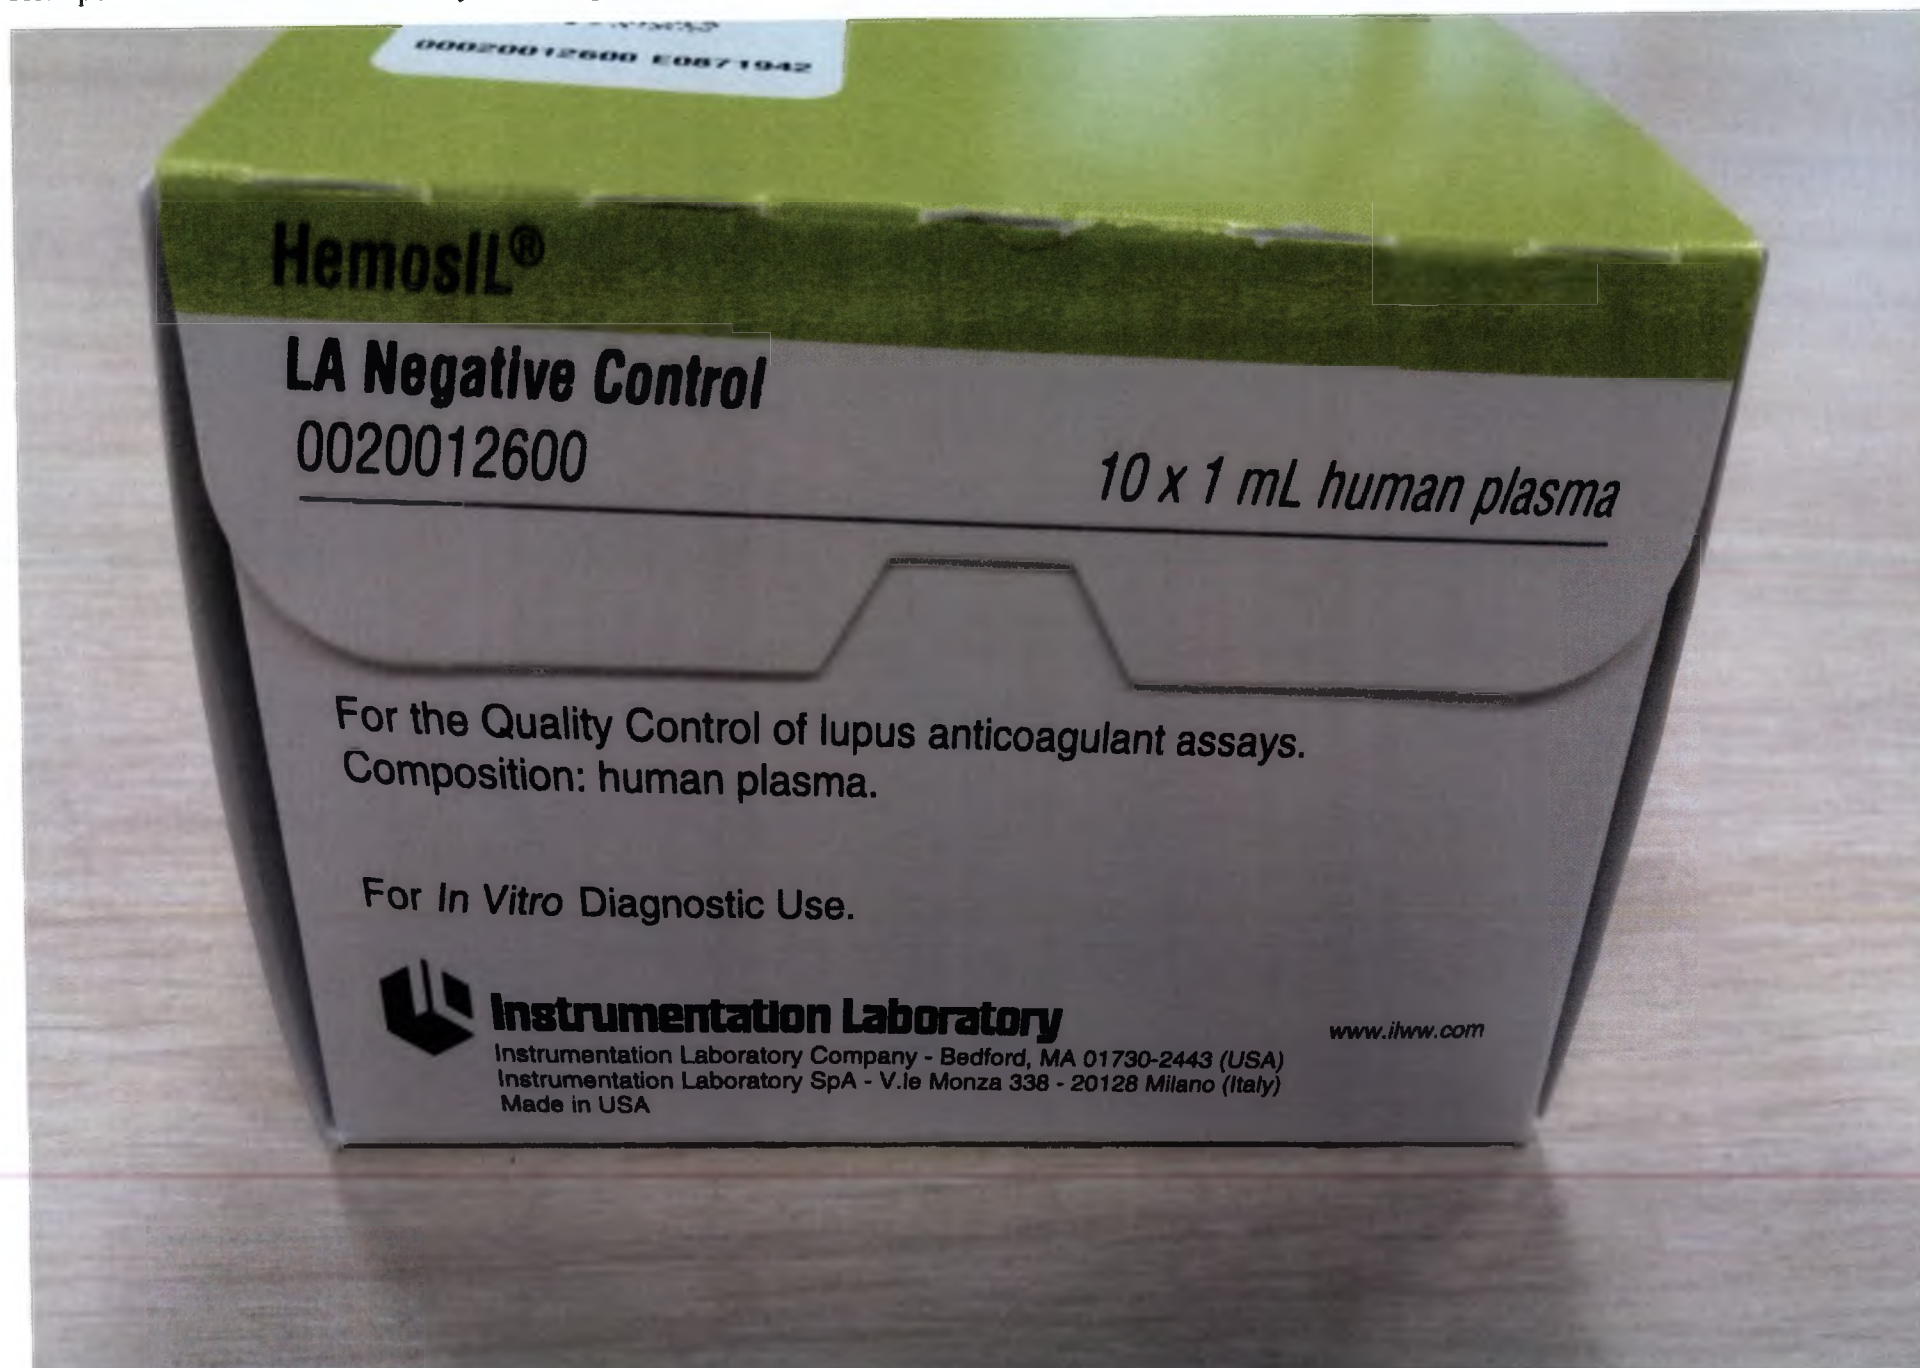

Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control



Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control



Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control




Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control



Контроль волчаночного антикоагулянта, отрицательный – HemosIL LA Negative Control




Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control

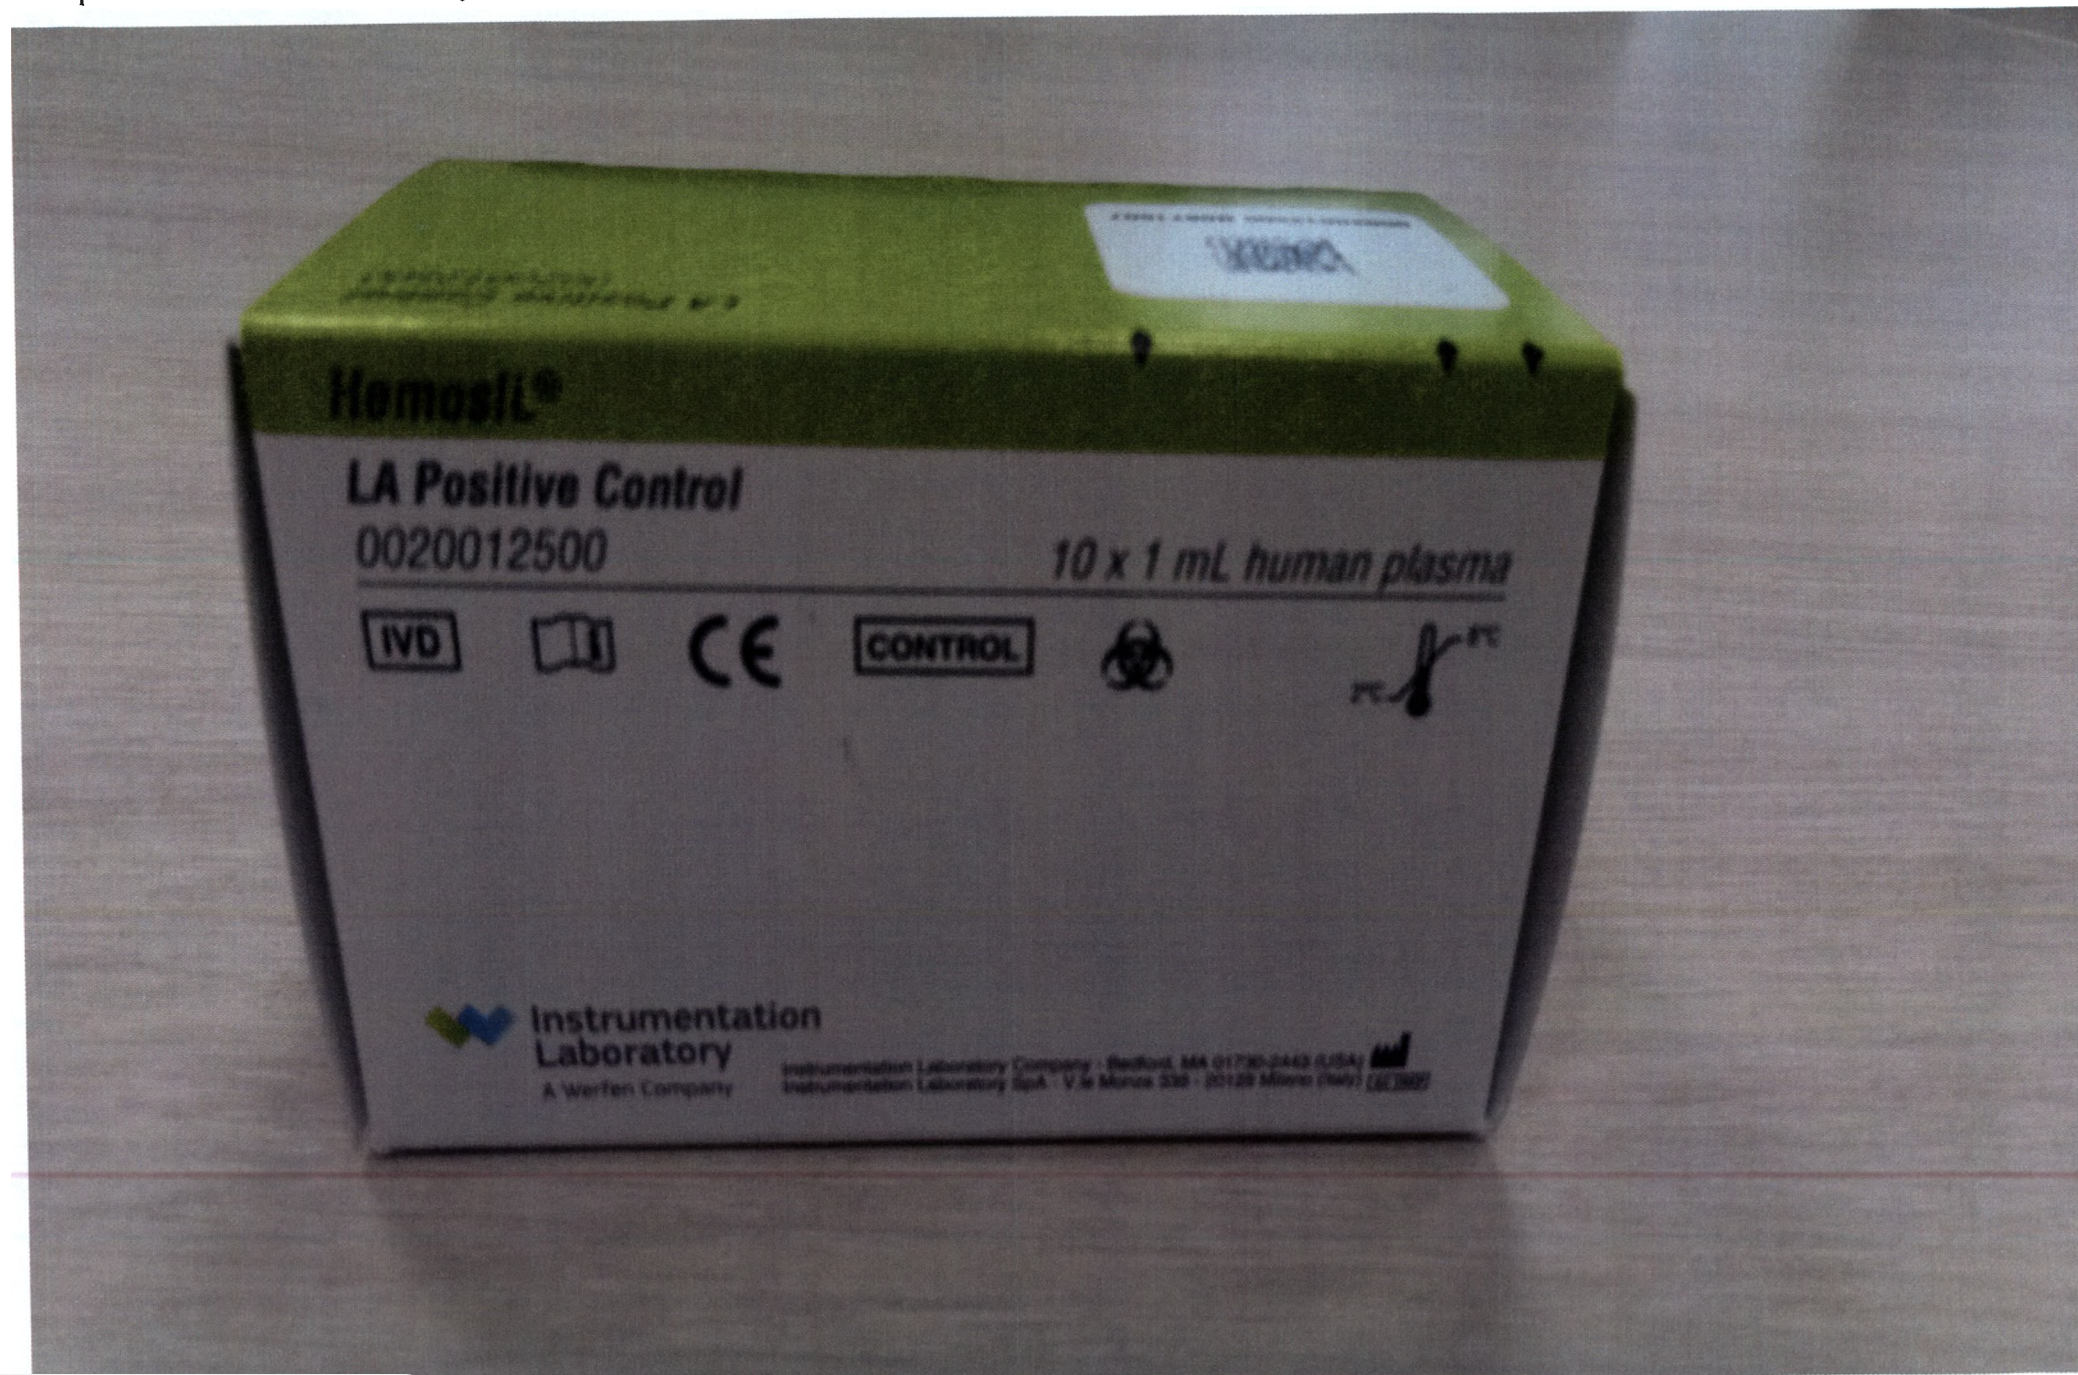

Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control



Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control

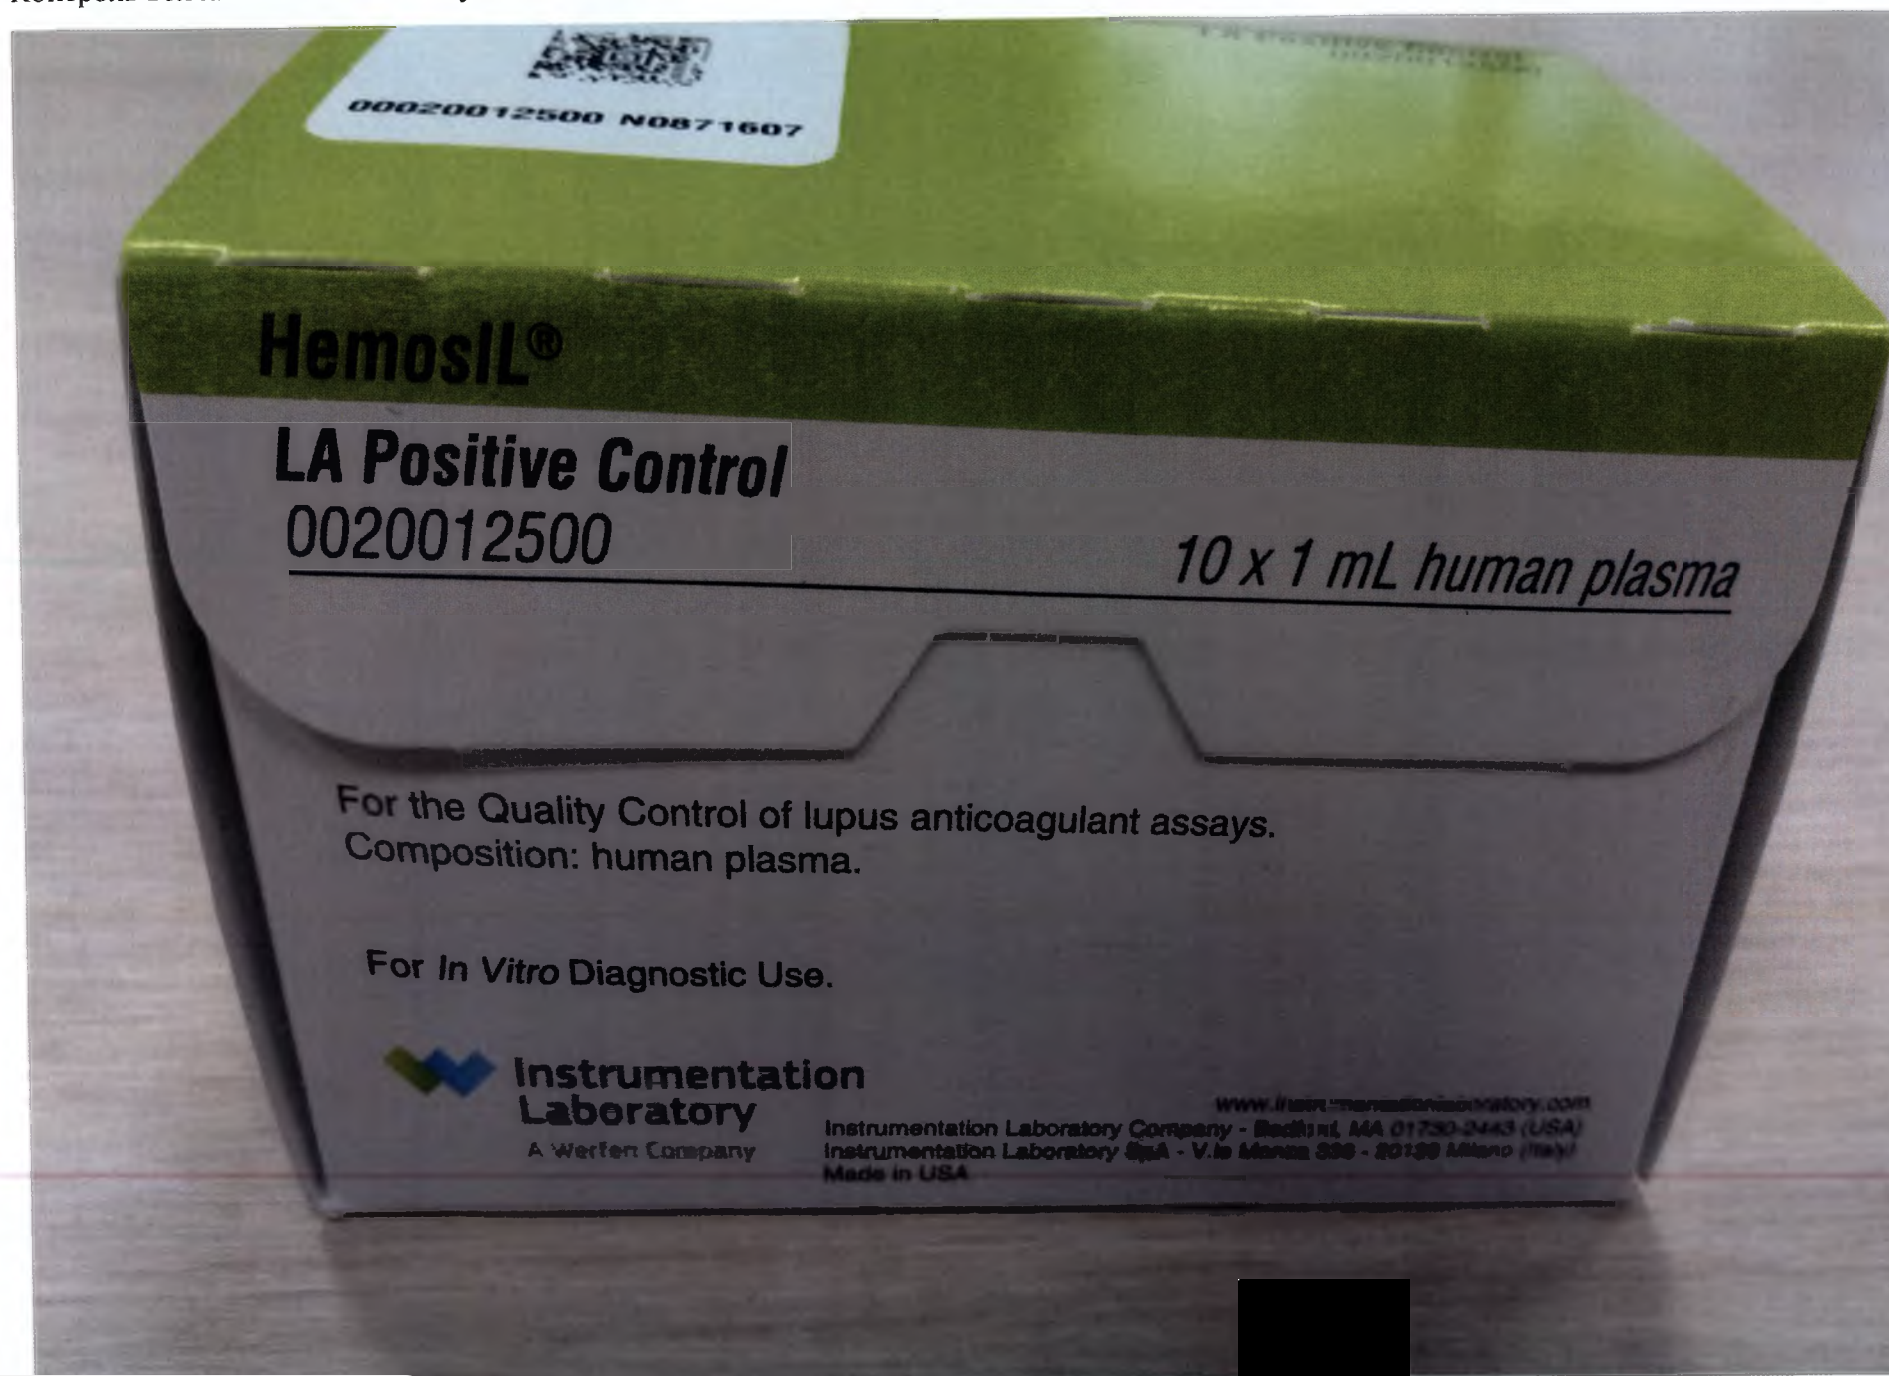

Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control

HemosIL®
LA Positive Control
0020012500

LOT


N0871607
SEQ01074
2019-08

Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control




Контроль волчаночного антикоагулянта, положительный – HemosIL LA Positive Control



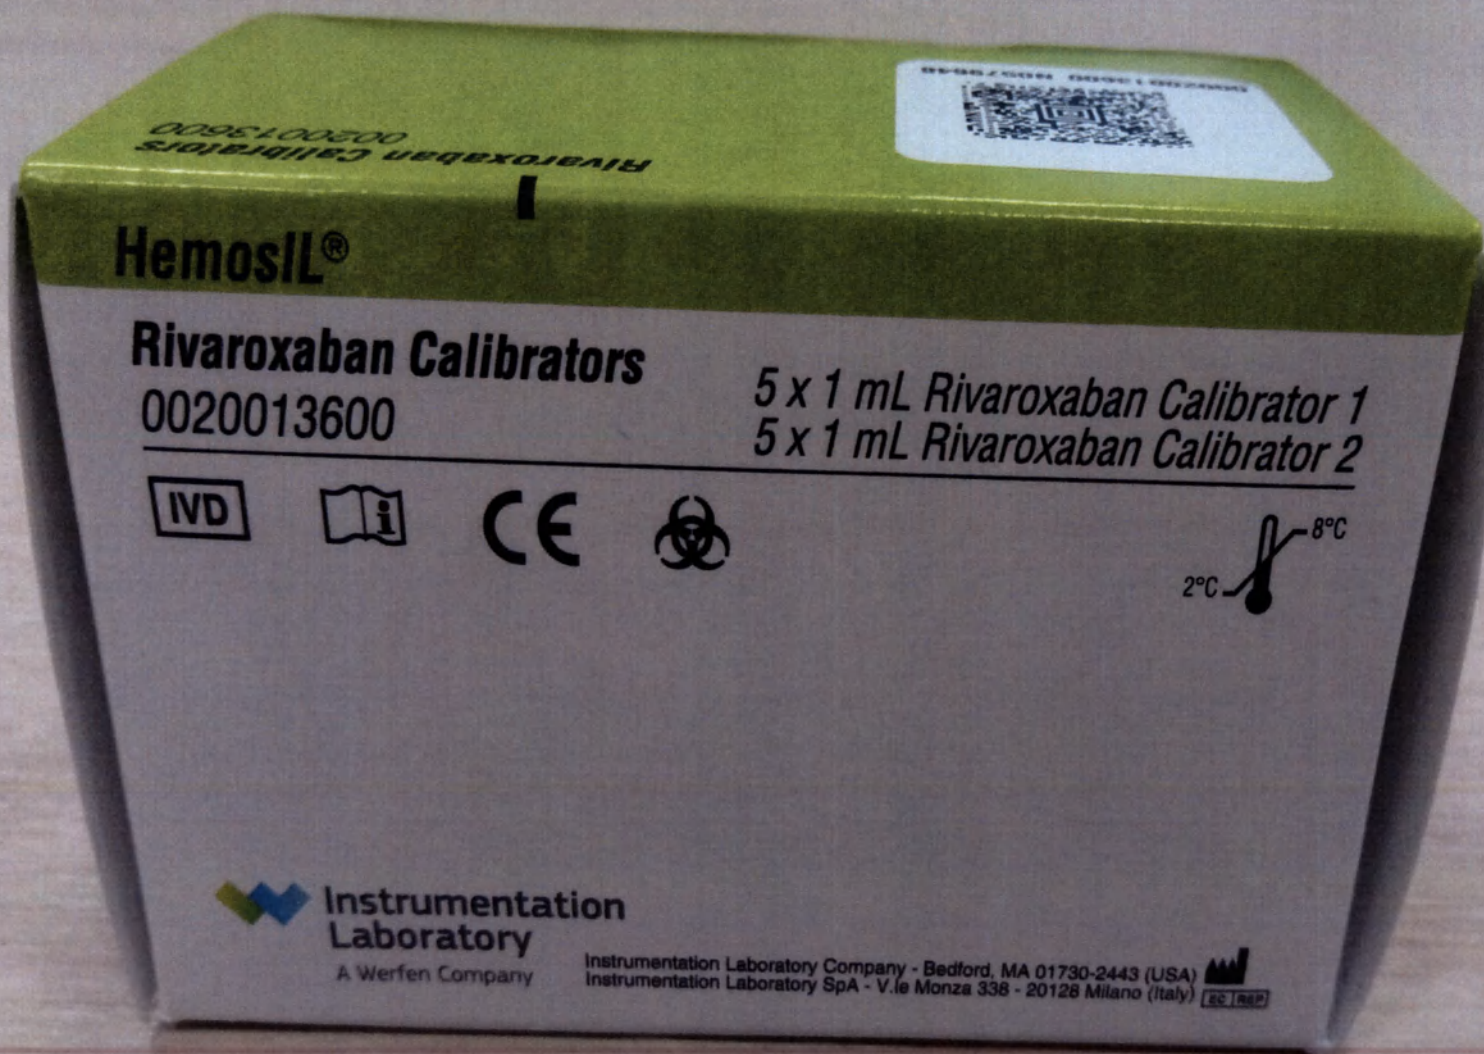



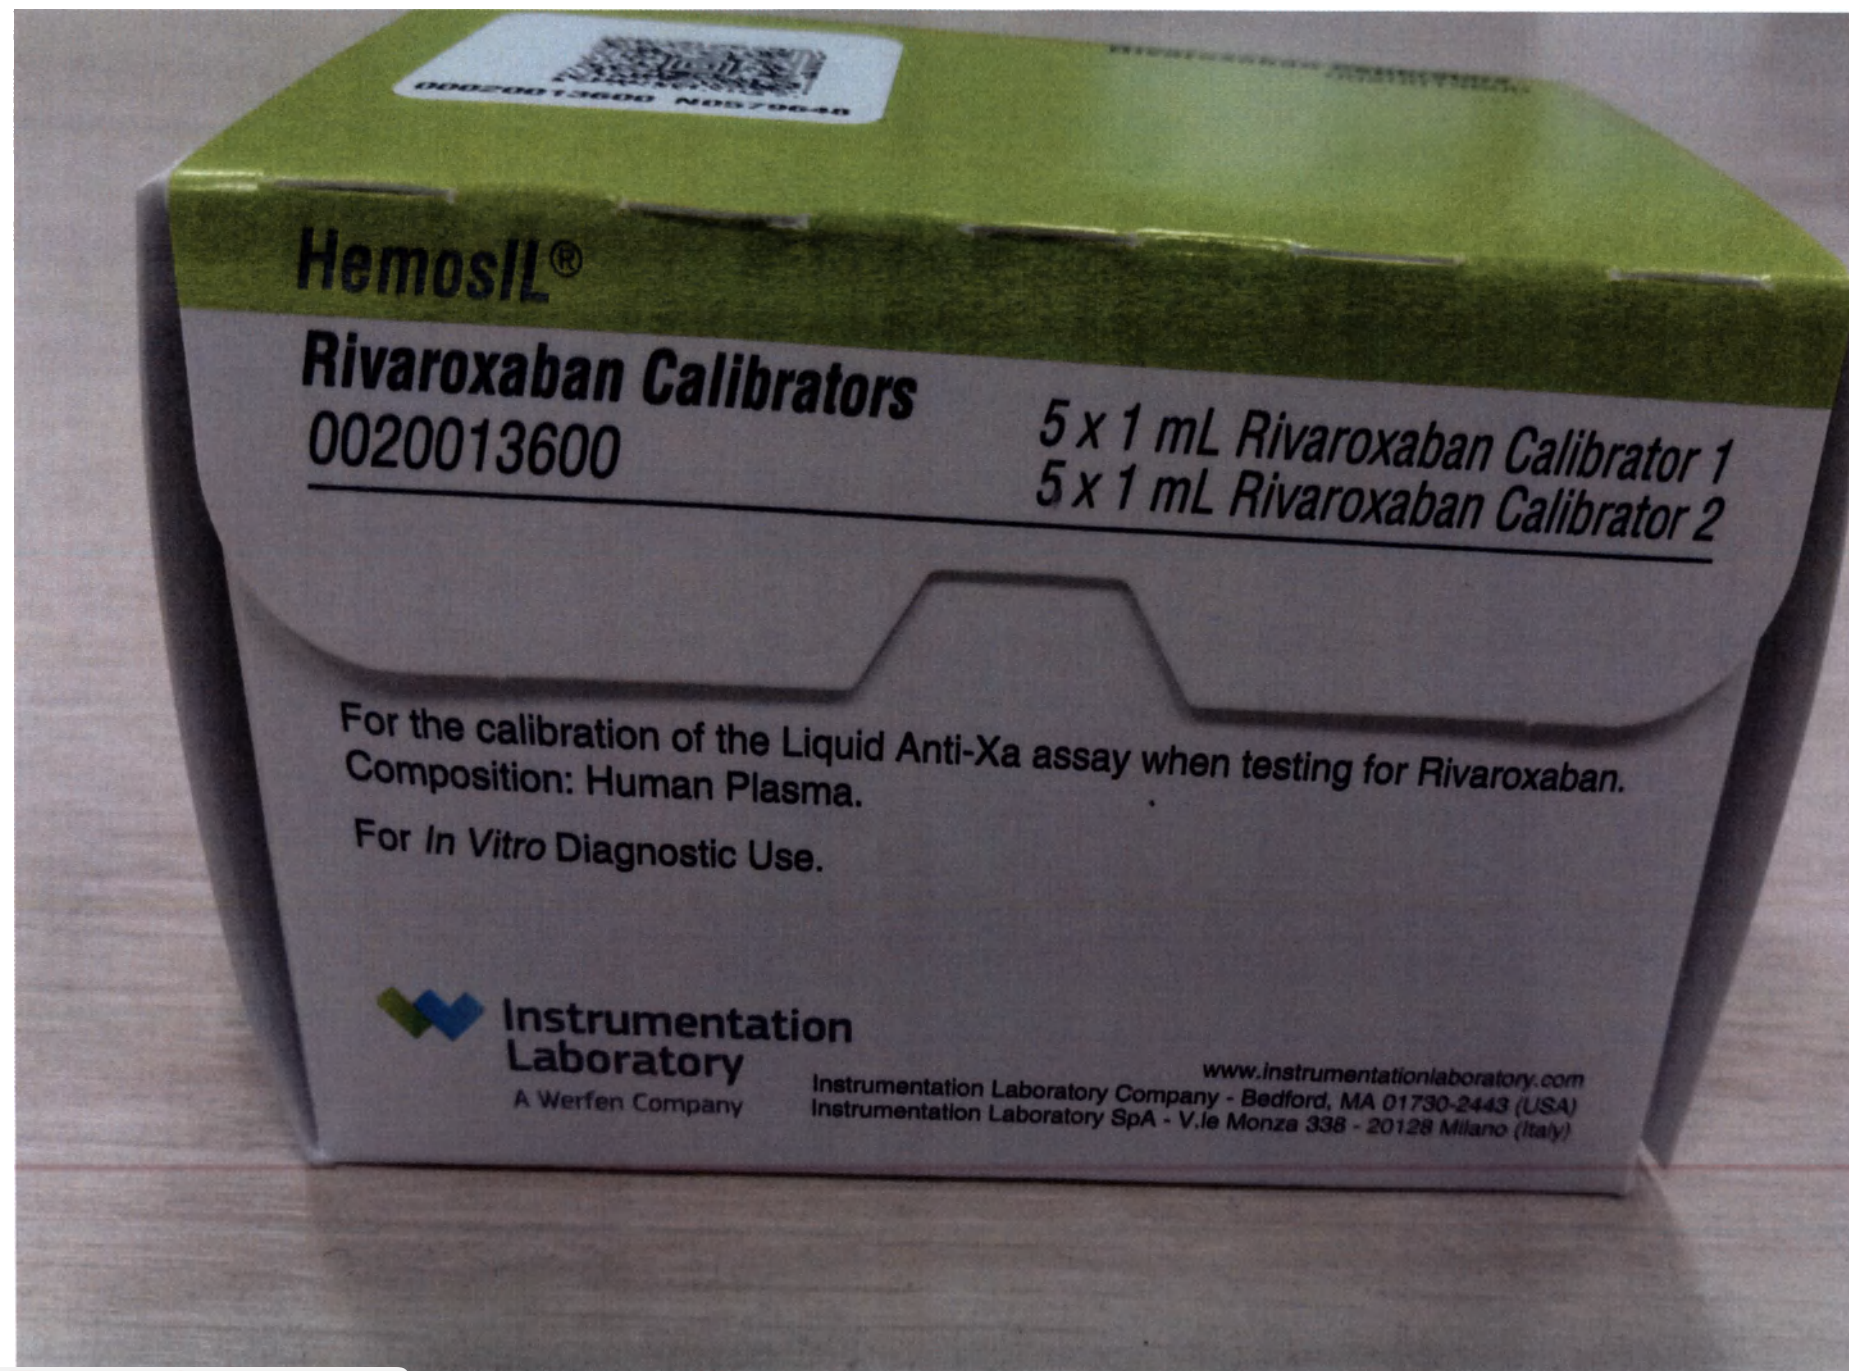

HemosIL®
Rivaroxaban Calibrators
0020013600

LOT

N0579648
SEQ00187
2019-05


Калибраторы Ривароксабана – HemosIL Rivaroxaban Calibrators



Калибраторы Ривароксана – HemosIL Rivaroxaban Calibrators



Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma

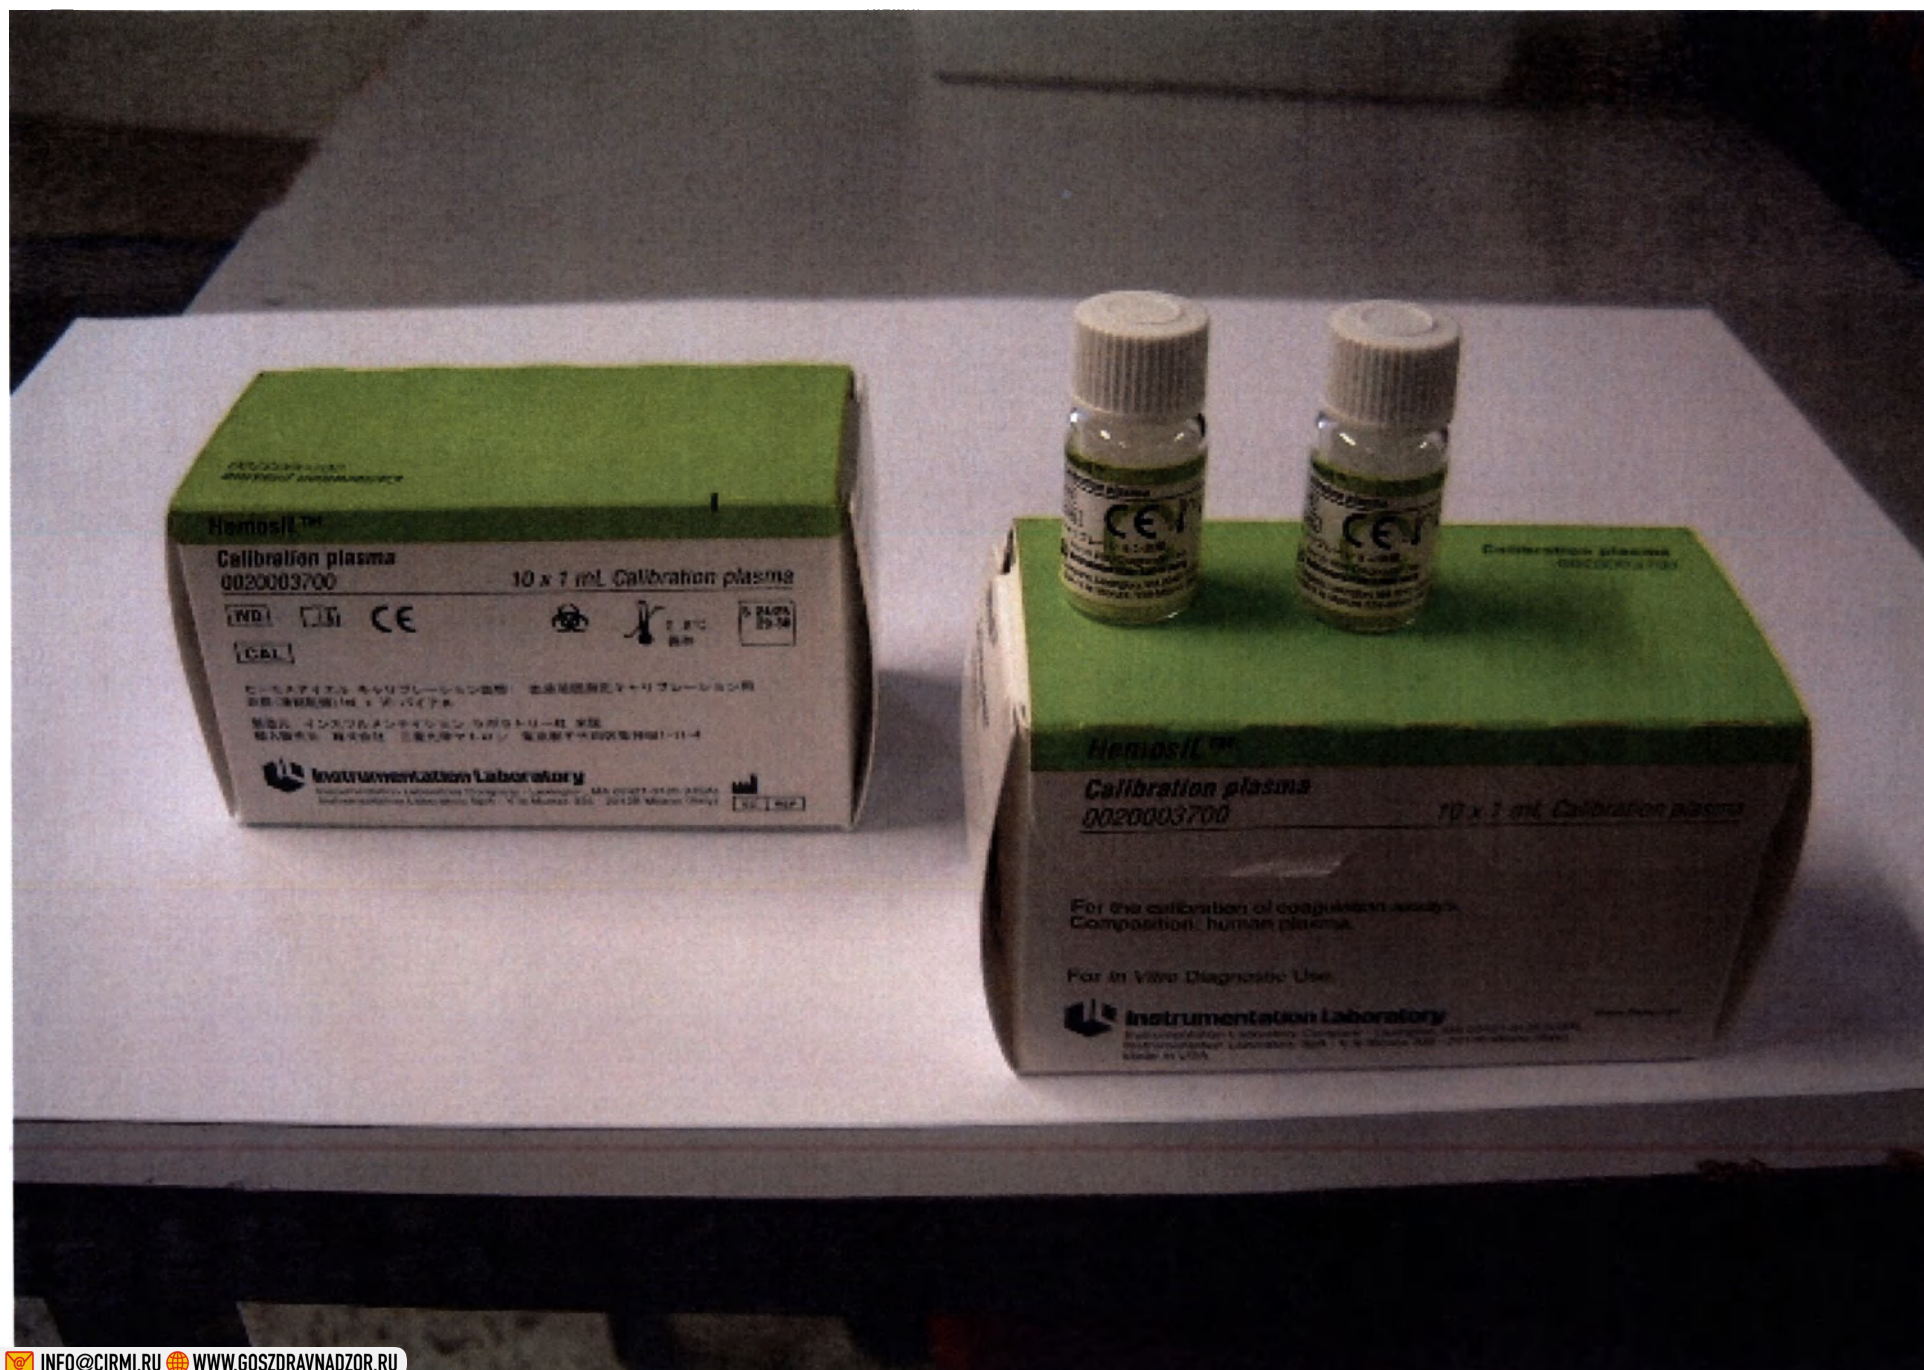

HemosIL®

Heparin

0020009400

1 x 8 mL Buffer
1 x 3 mL Antithrombin
1 x 5 mL Factor Xa reagent
1 x 4 mL Chromogenic substrate

For the determination of Heparin.

Composition: Chromogenic substrate, bovine Factor Xa and human antithrombin.


For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

www.ilww.com

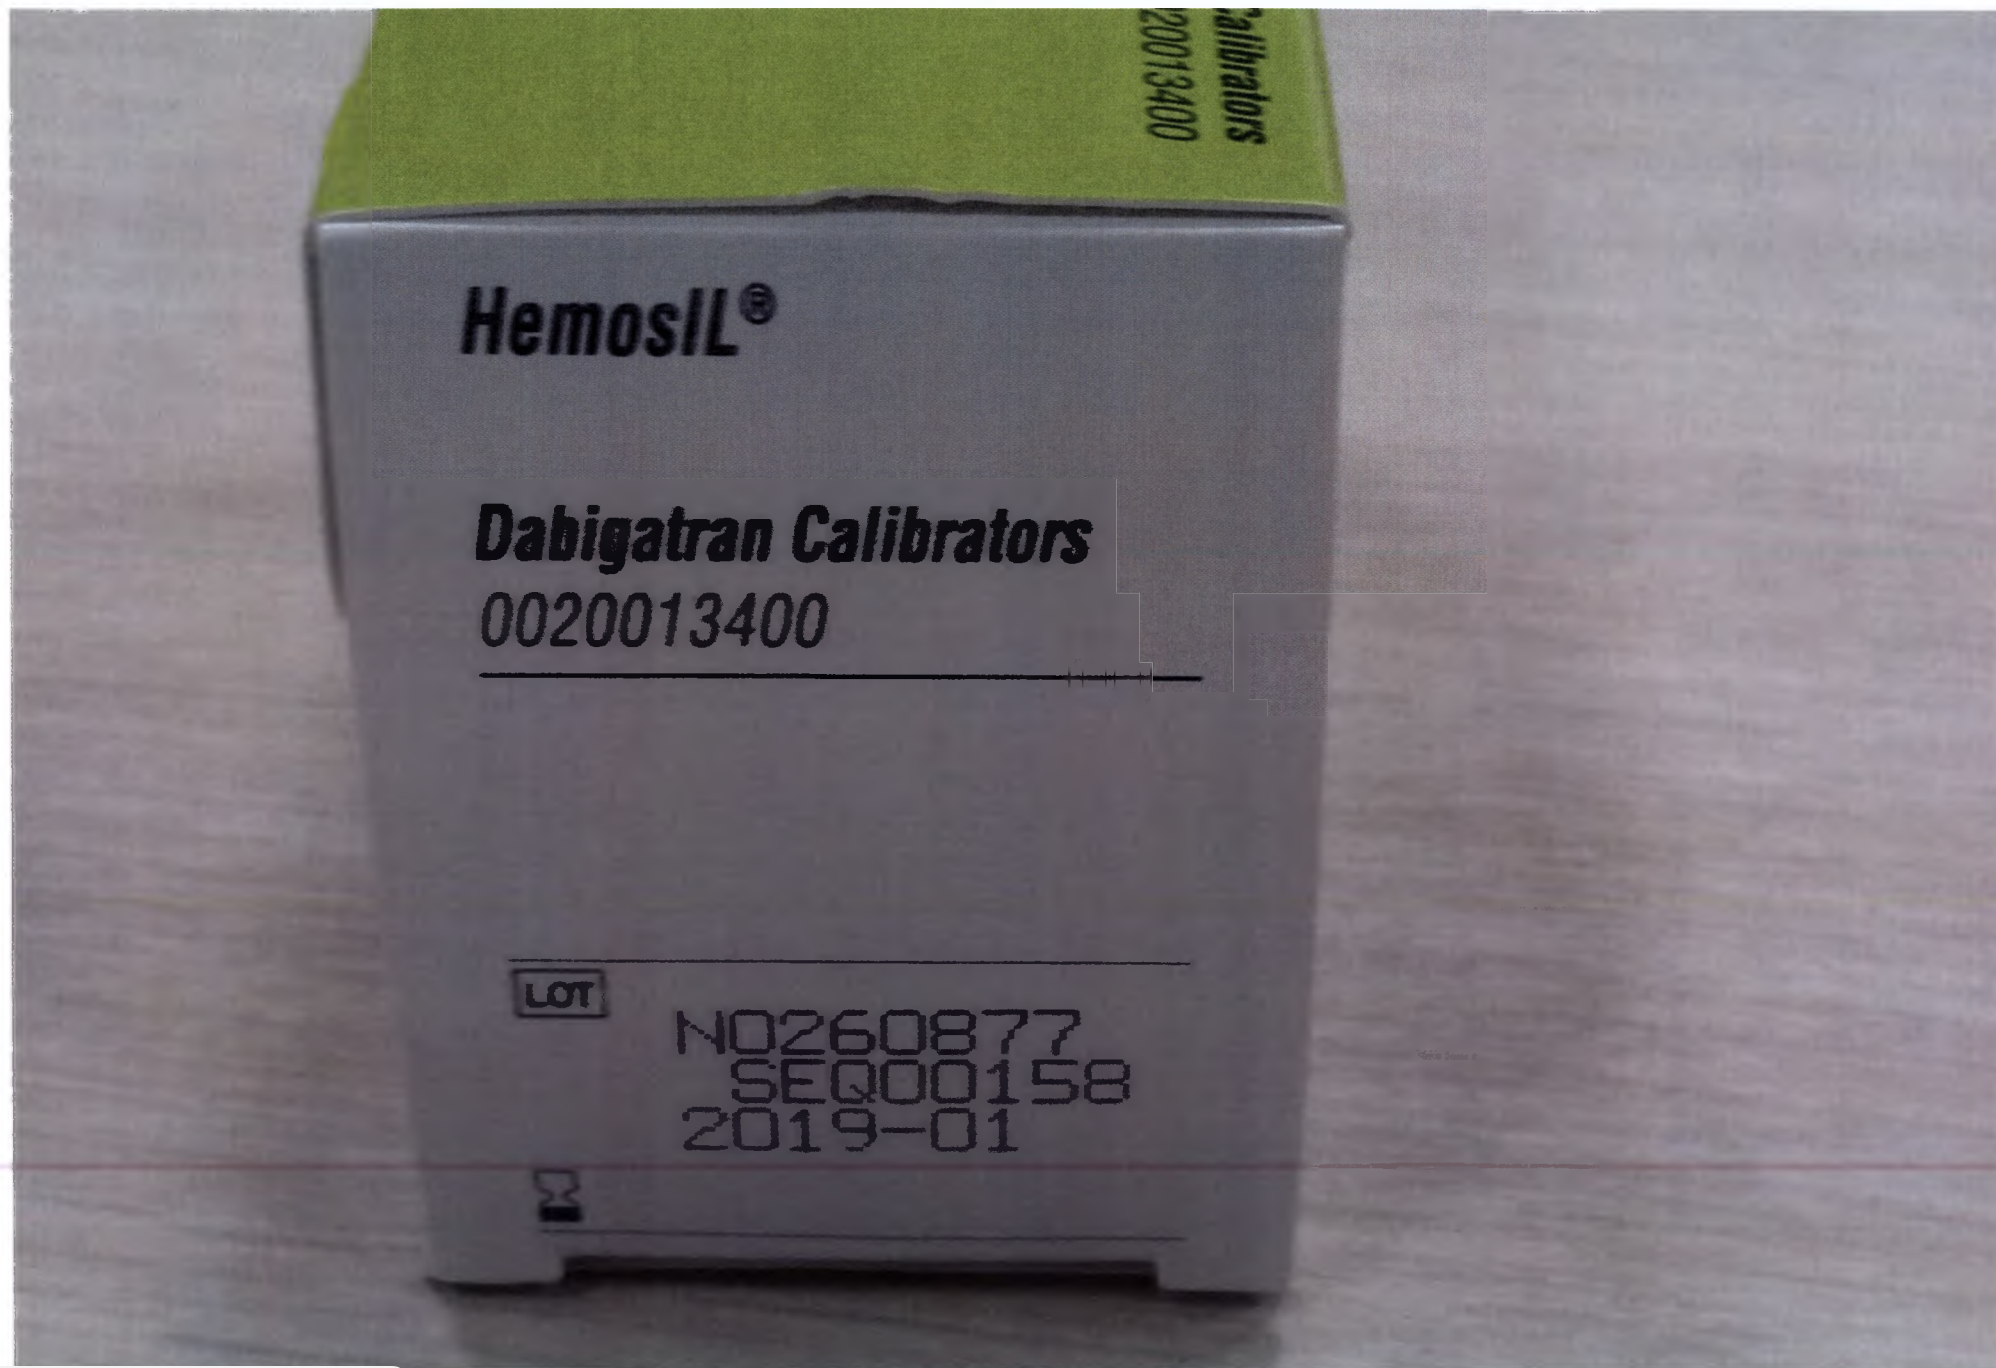

Калибраторы Дабигатрана – HemosIL Dabigatran Calibrators



Калибраторы Дабигатрана – HemosIL Dabigatran Calibrators



Калибраторы Дабигатрана – HemosIL Dabigatran Calibrators



Калибраторы Дабигатрана – HemosIL Dabigatran Calibrators



HemosIL®

Plasminogen

0020009000

2 x 2.5 mL Streptokinase reagent
2 x 2 mL Chromogenic substrate

For the determination of Plasminogen.

Composition: Chromogenic substrate, Streptokinase and human plasma.


For *In Vitro* Diagnostic Use. 体外診断用医薬品




Instrumentation Laboratory


Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

www.ilwww.com

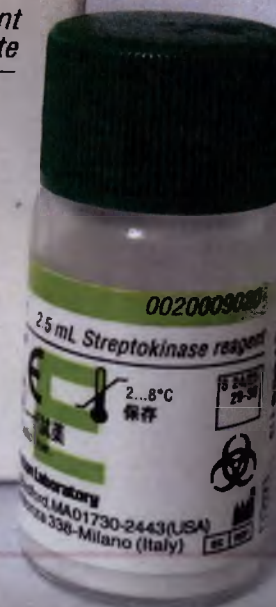

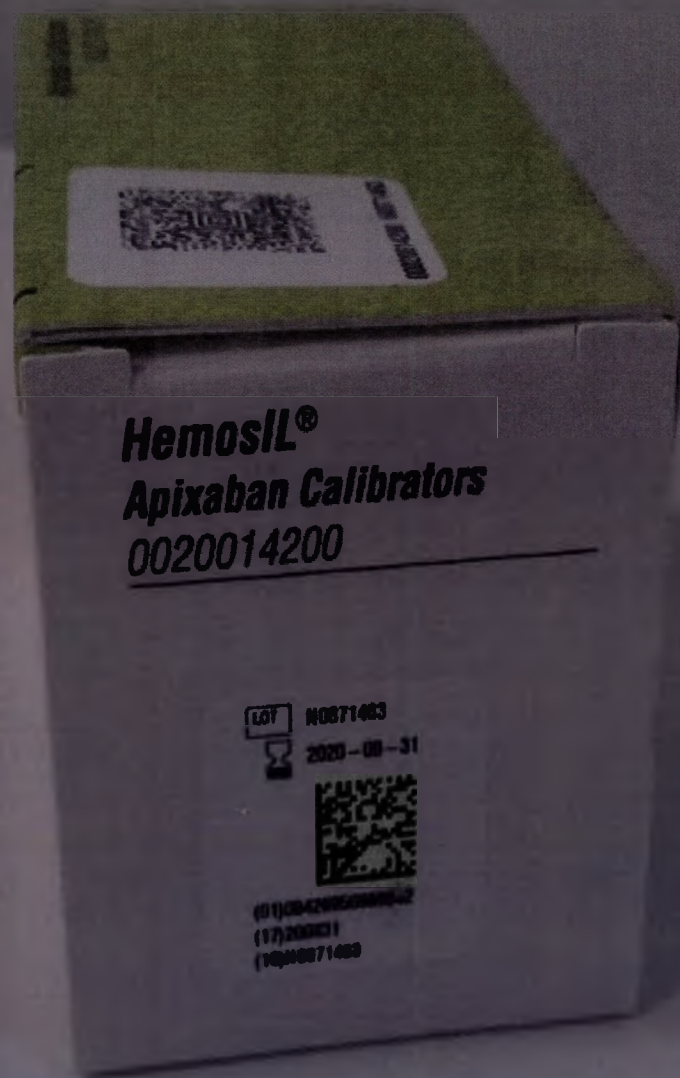



Калибраторы Апиксабана – HemosIL Apixaban Calibrators

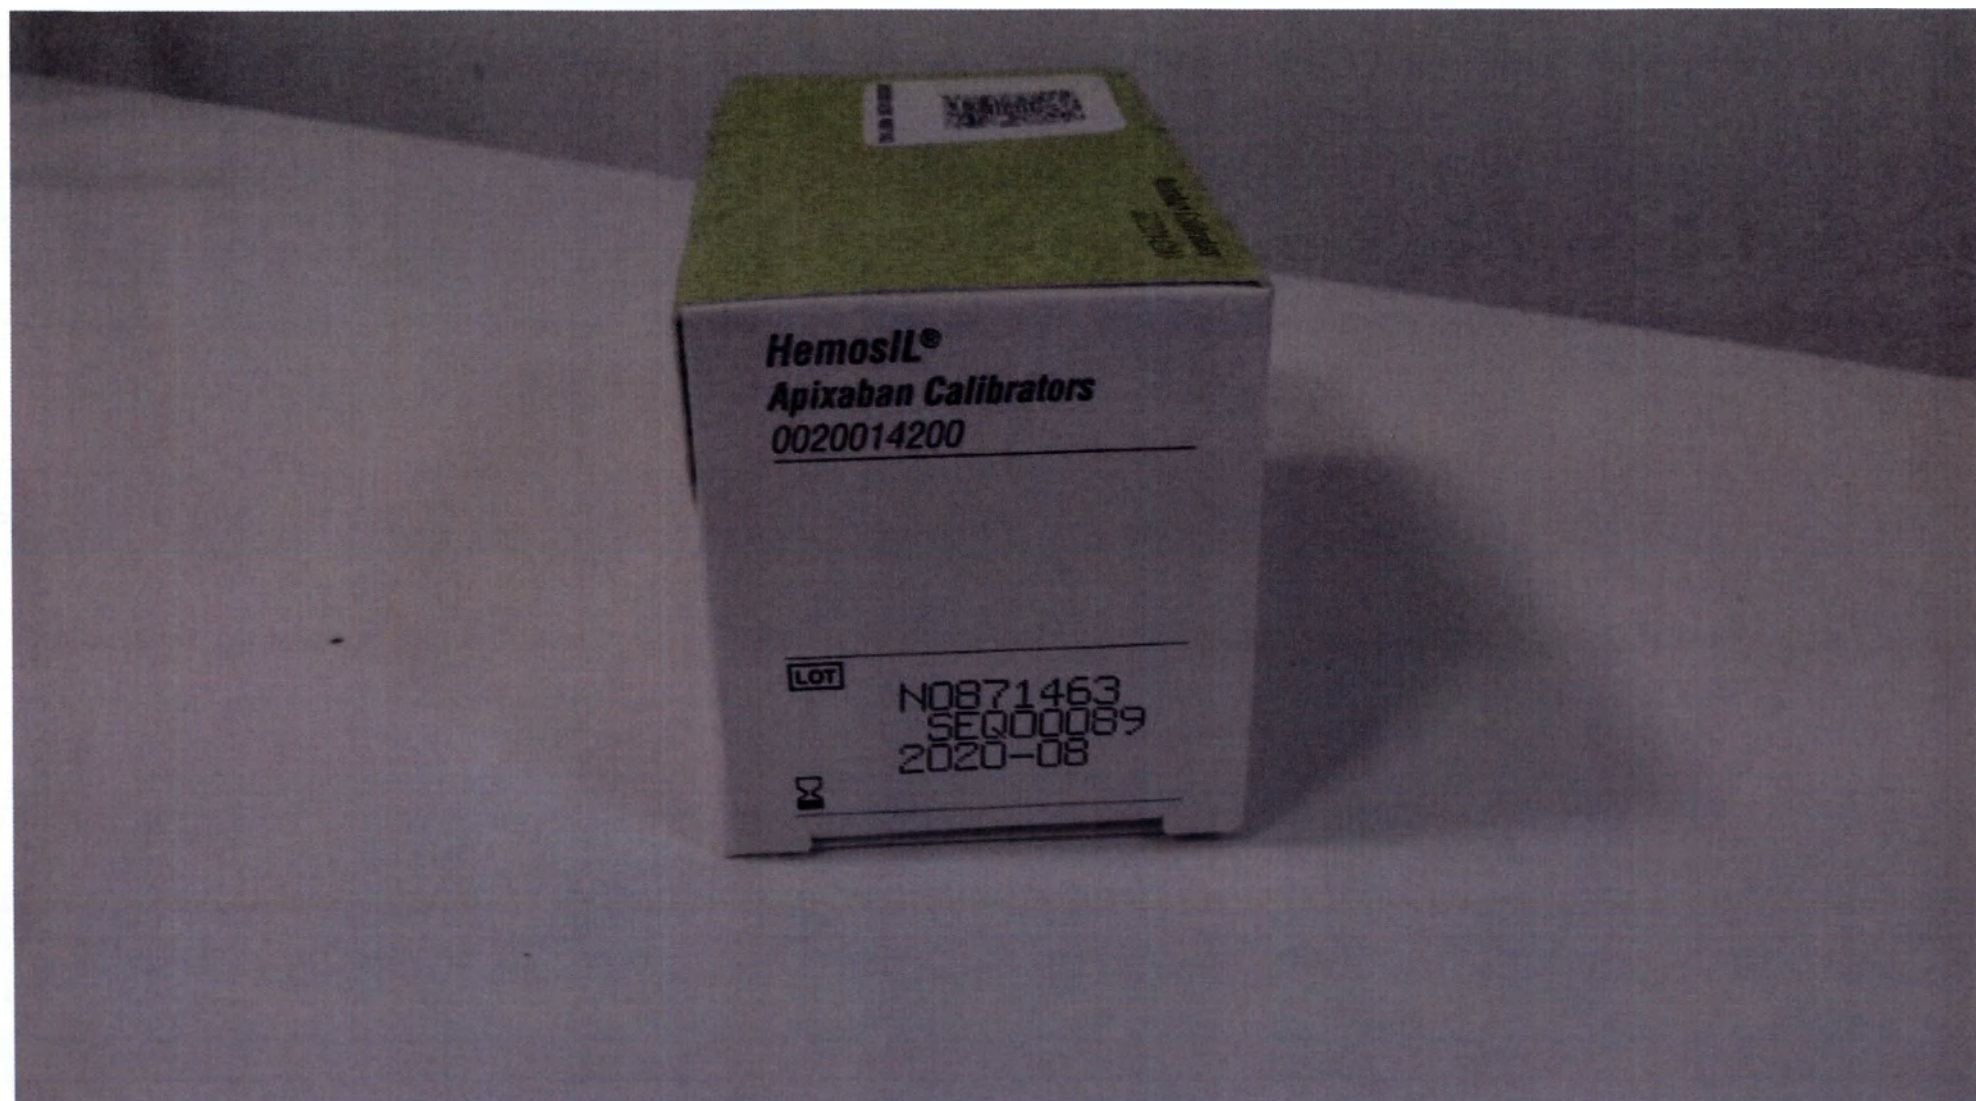

Калибраторы Аликсабана – HemosIL Apixaban Calibrators



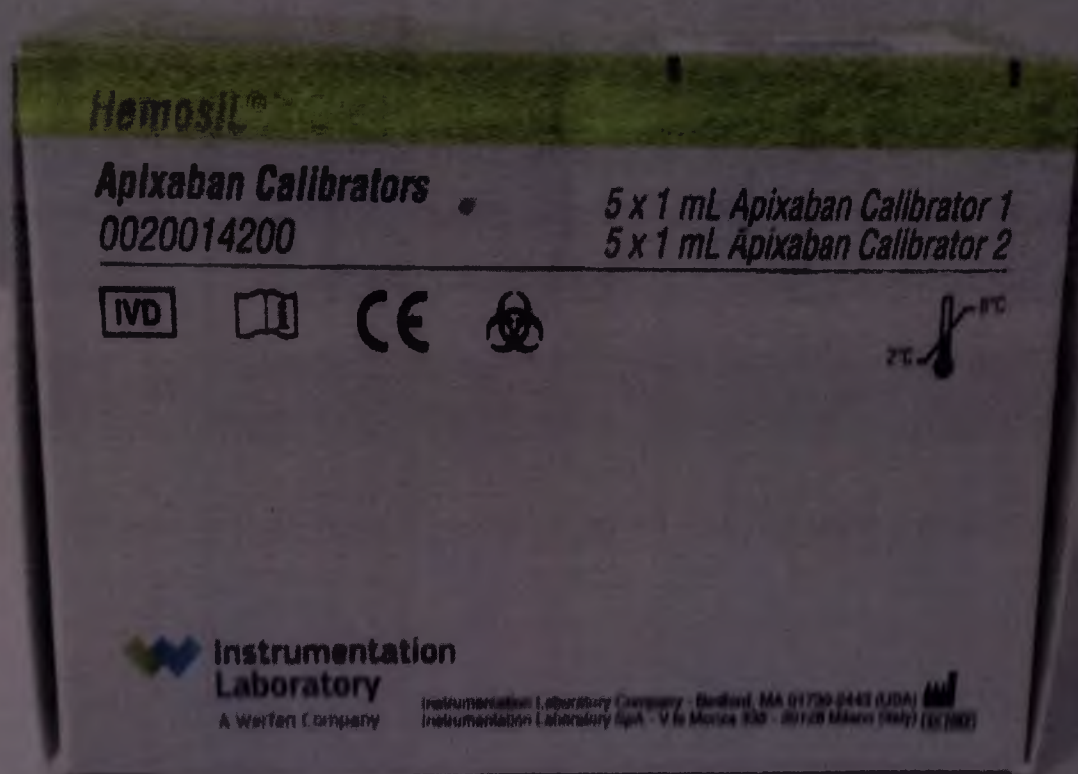

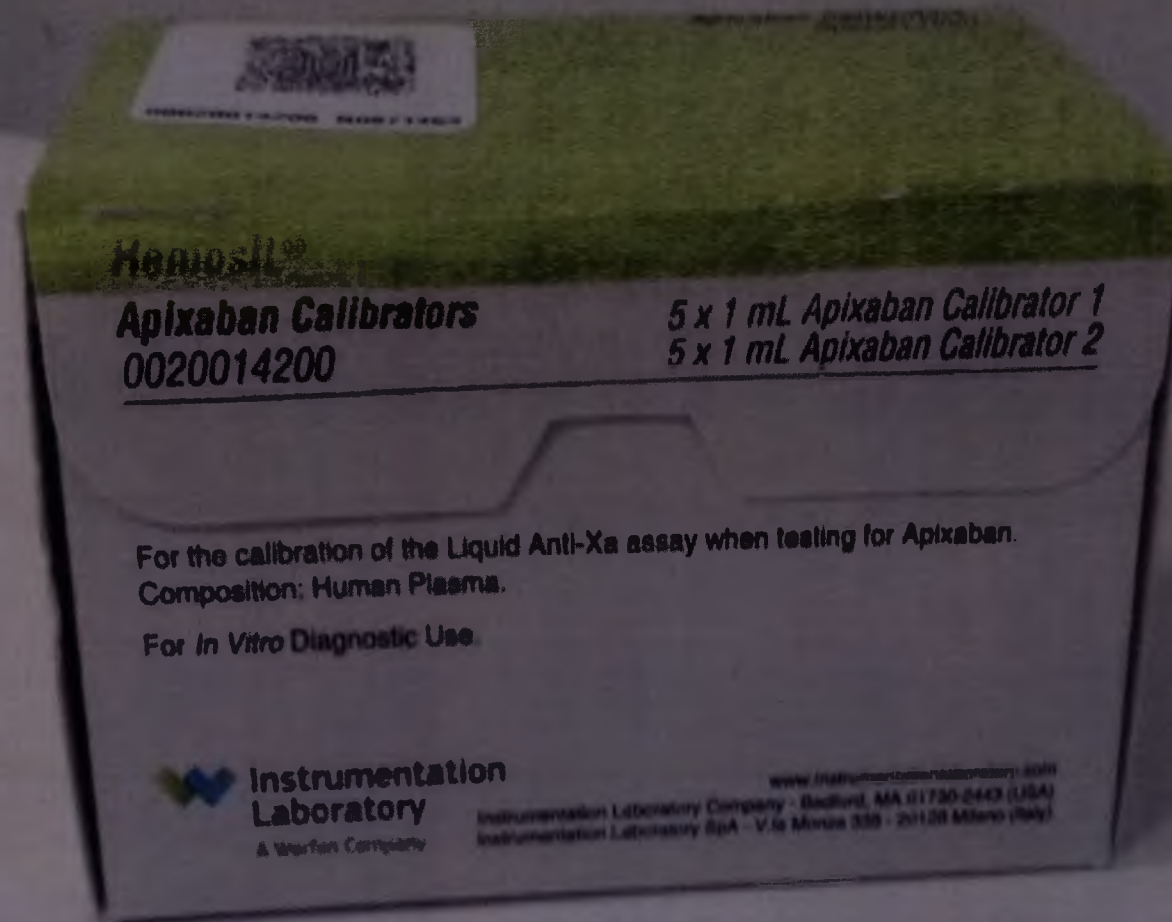

HemosIL[®]

Plasmin Inhibitor

0020009200

2 x 9 mL Buffer

2 x 2.5 mL Plasmin reagent

1 x 4 mL Chromogenic substrate

For the determination of Plasmin Inhibitor.

Composition: Chromogenic substrate, human Plasmin and human serum albumin.

For In Vitro Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory

www.innco.it

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - Via Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in U.S.A.

Специальный контроль, уровень 1 - HemosIL Special Test Control Level 1



HemosIL®

Special Test Control Level 2

0020012000

10 x 1.0 mL *Special Test Control Level 2*

For the Quality Control of factors and special coagulation assays in the high abnormal range.

Composition: human plasma.

For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory


Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in USA


www.ilwww.com

Контроли специальные - HemosIL Special Test Controls

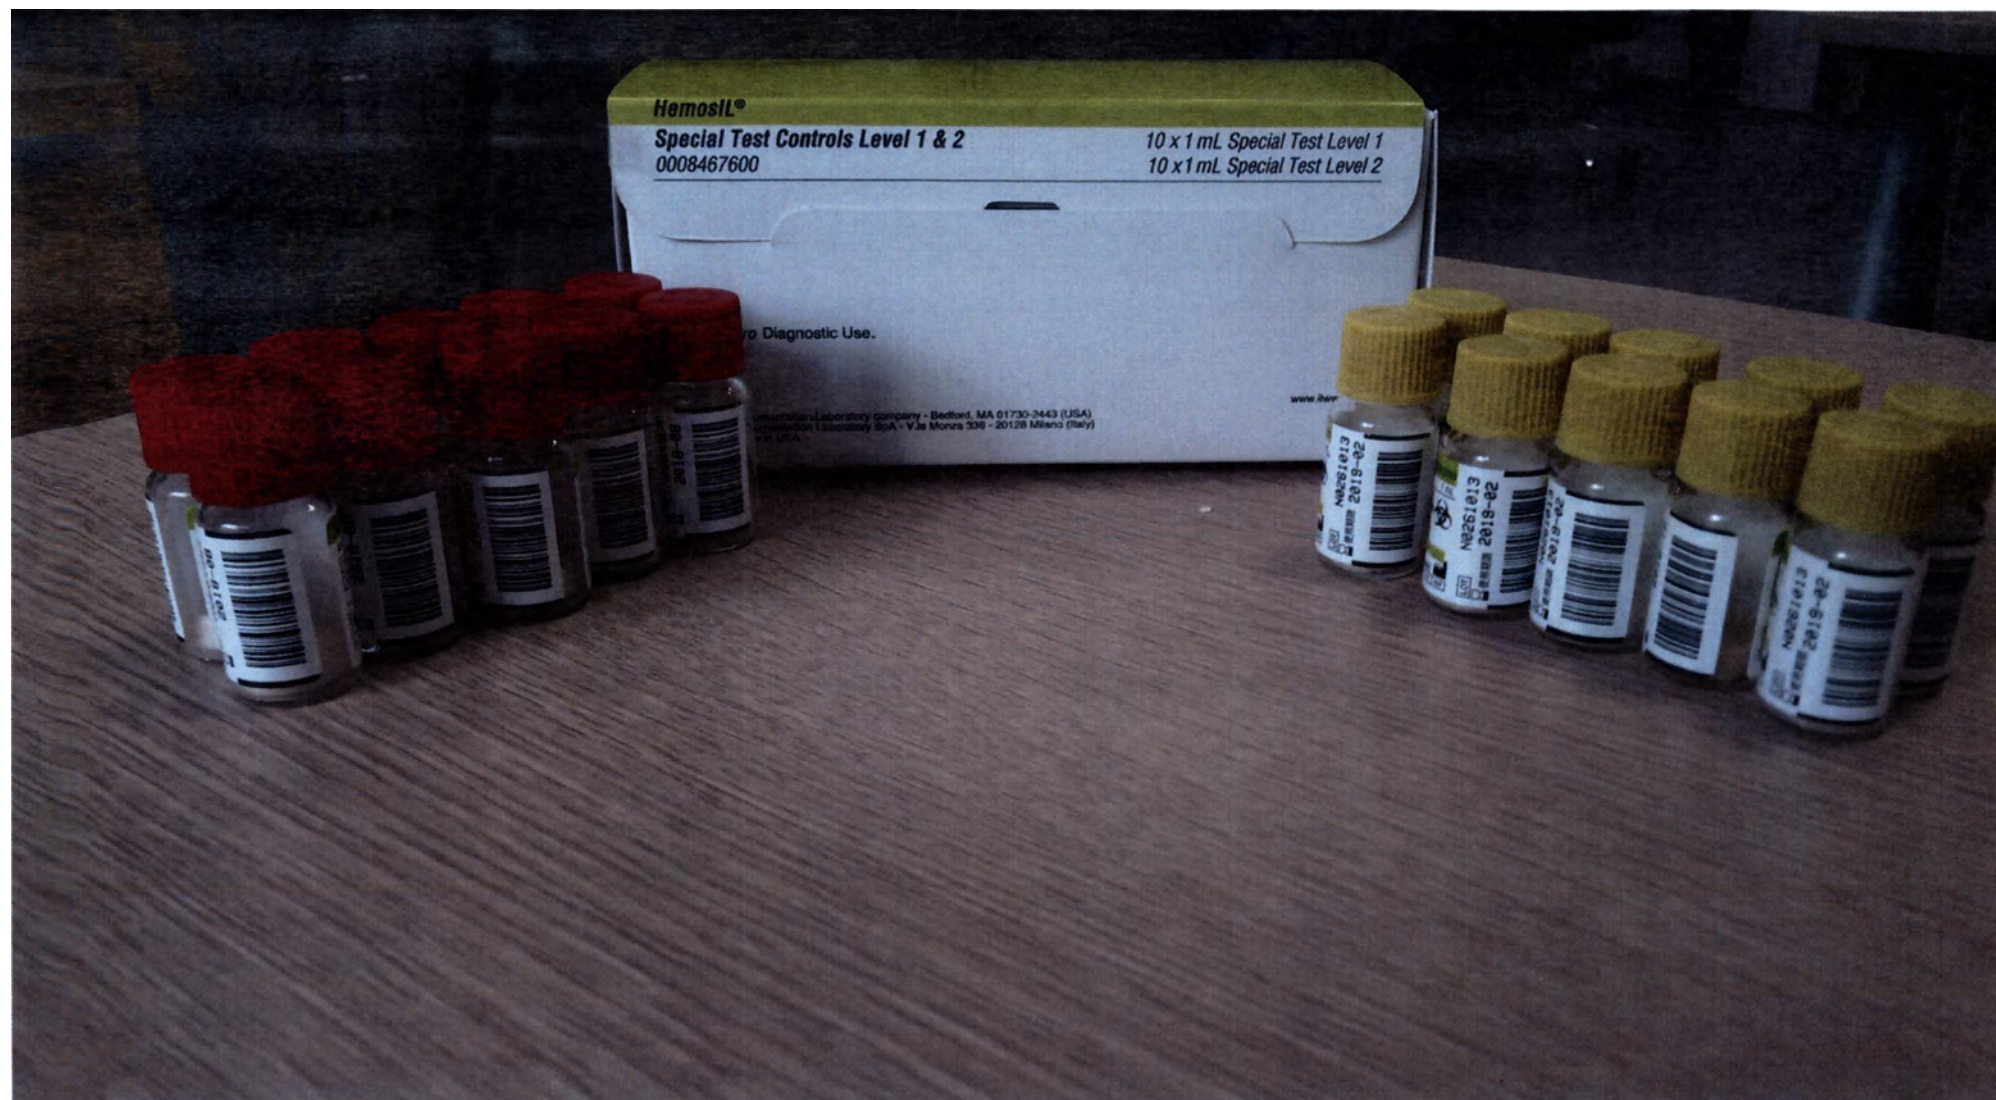


Буфер QFA - HemosIL QFA Buffer



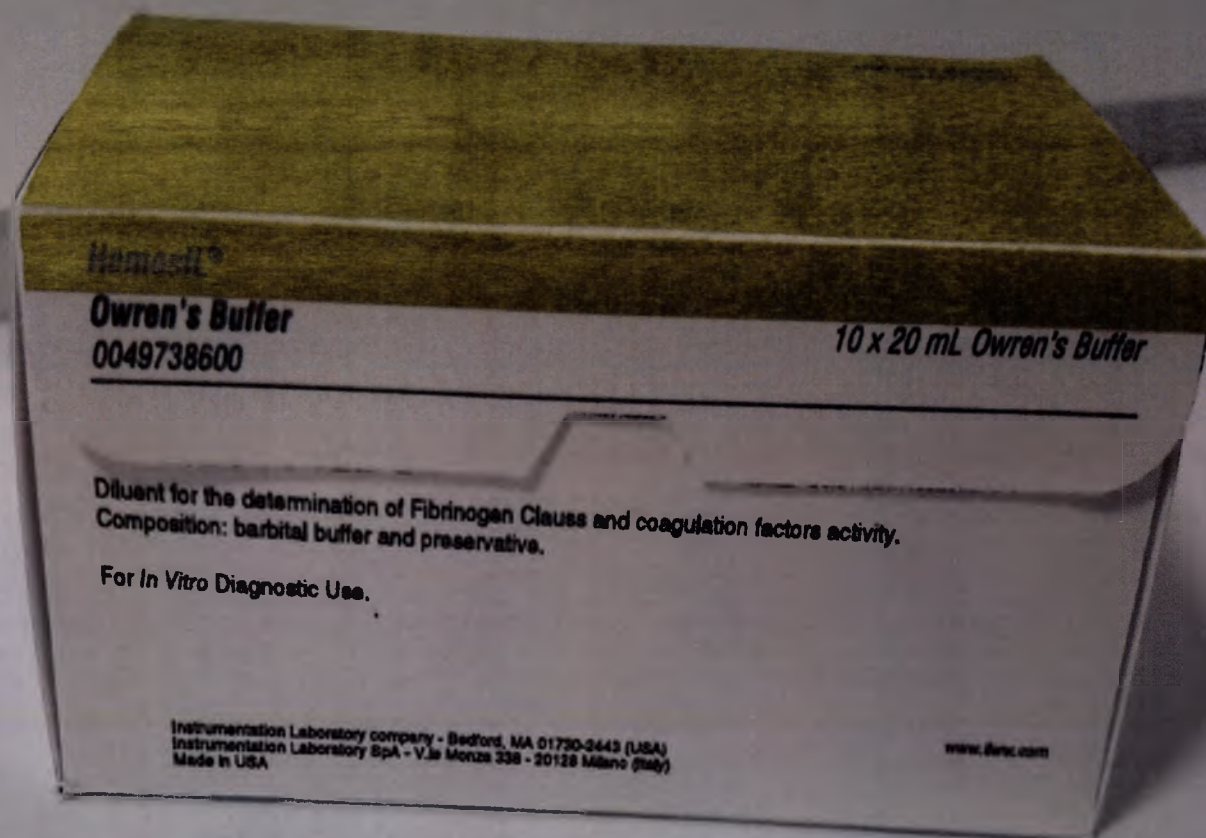



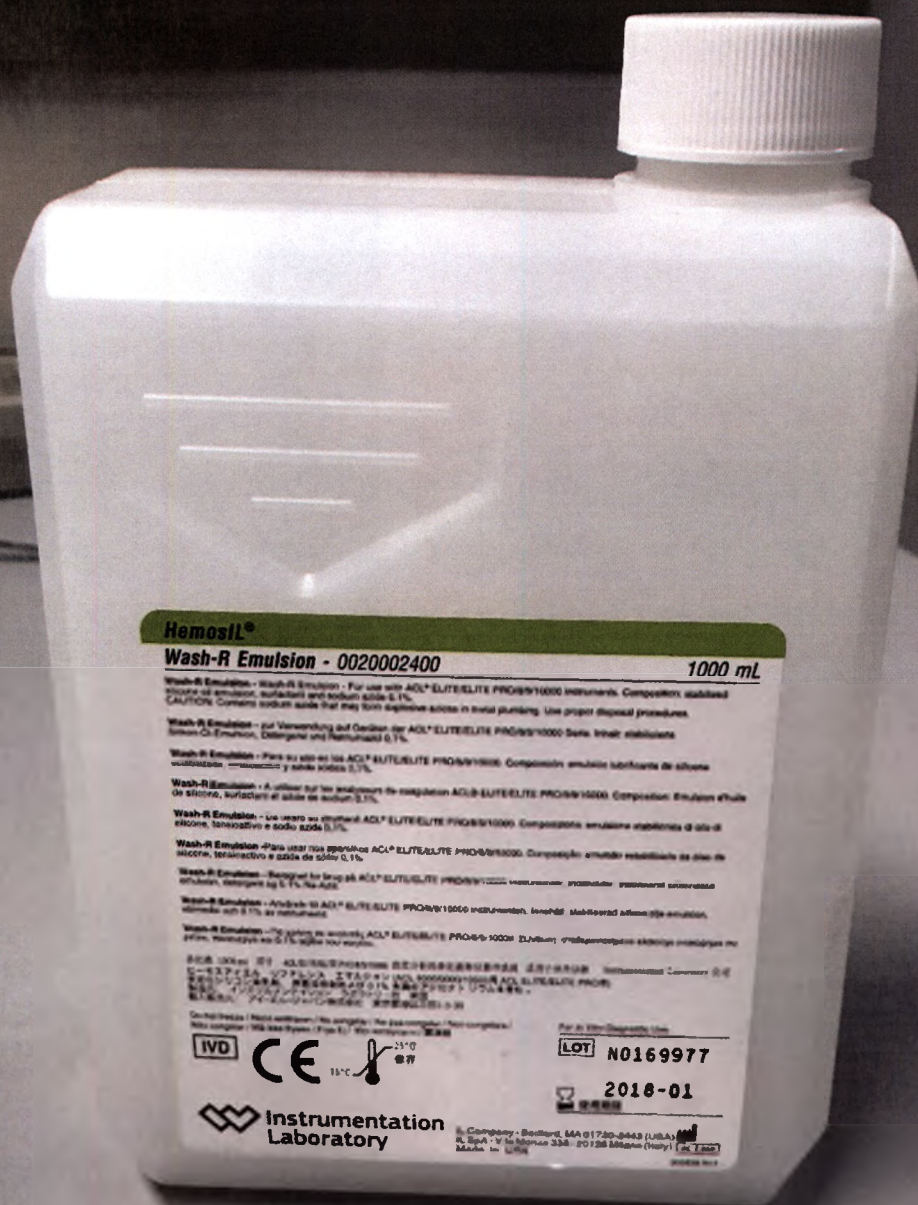



HemosIL®

Chromogenic Optic Test Kit

0009757950

For use with ACL® Family instruments (service test).
Refer to the appropriate ACL instrument's Service Manual for procedure instructions.
Composition: Tris buffer, ethanol and P-Nitroaniline.

13 x Chrom. test 160 µmol/L
19 x Chrom. test 80 µmol/L
12 x Chrom. test 40 µmol/L
6 x Chrom. test 20 µmol/L

LOT

N0260547

2018-02

For In Vitro Diagnostic Use.



11770 800 15




Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2445 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 336 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA

www.ilab.com



Хромогенный оптический тест Futura – HemosIL Chromogenic Optics Test Futura

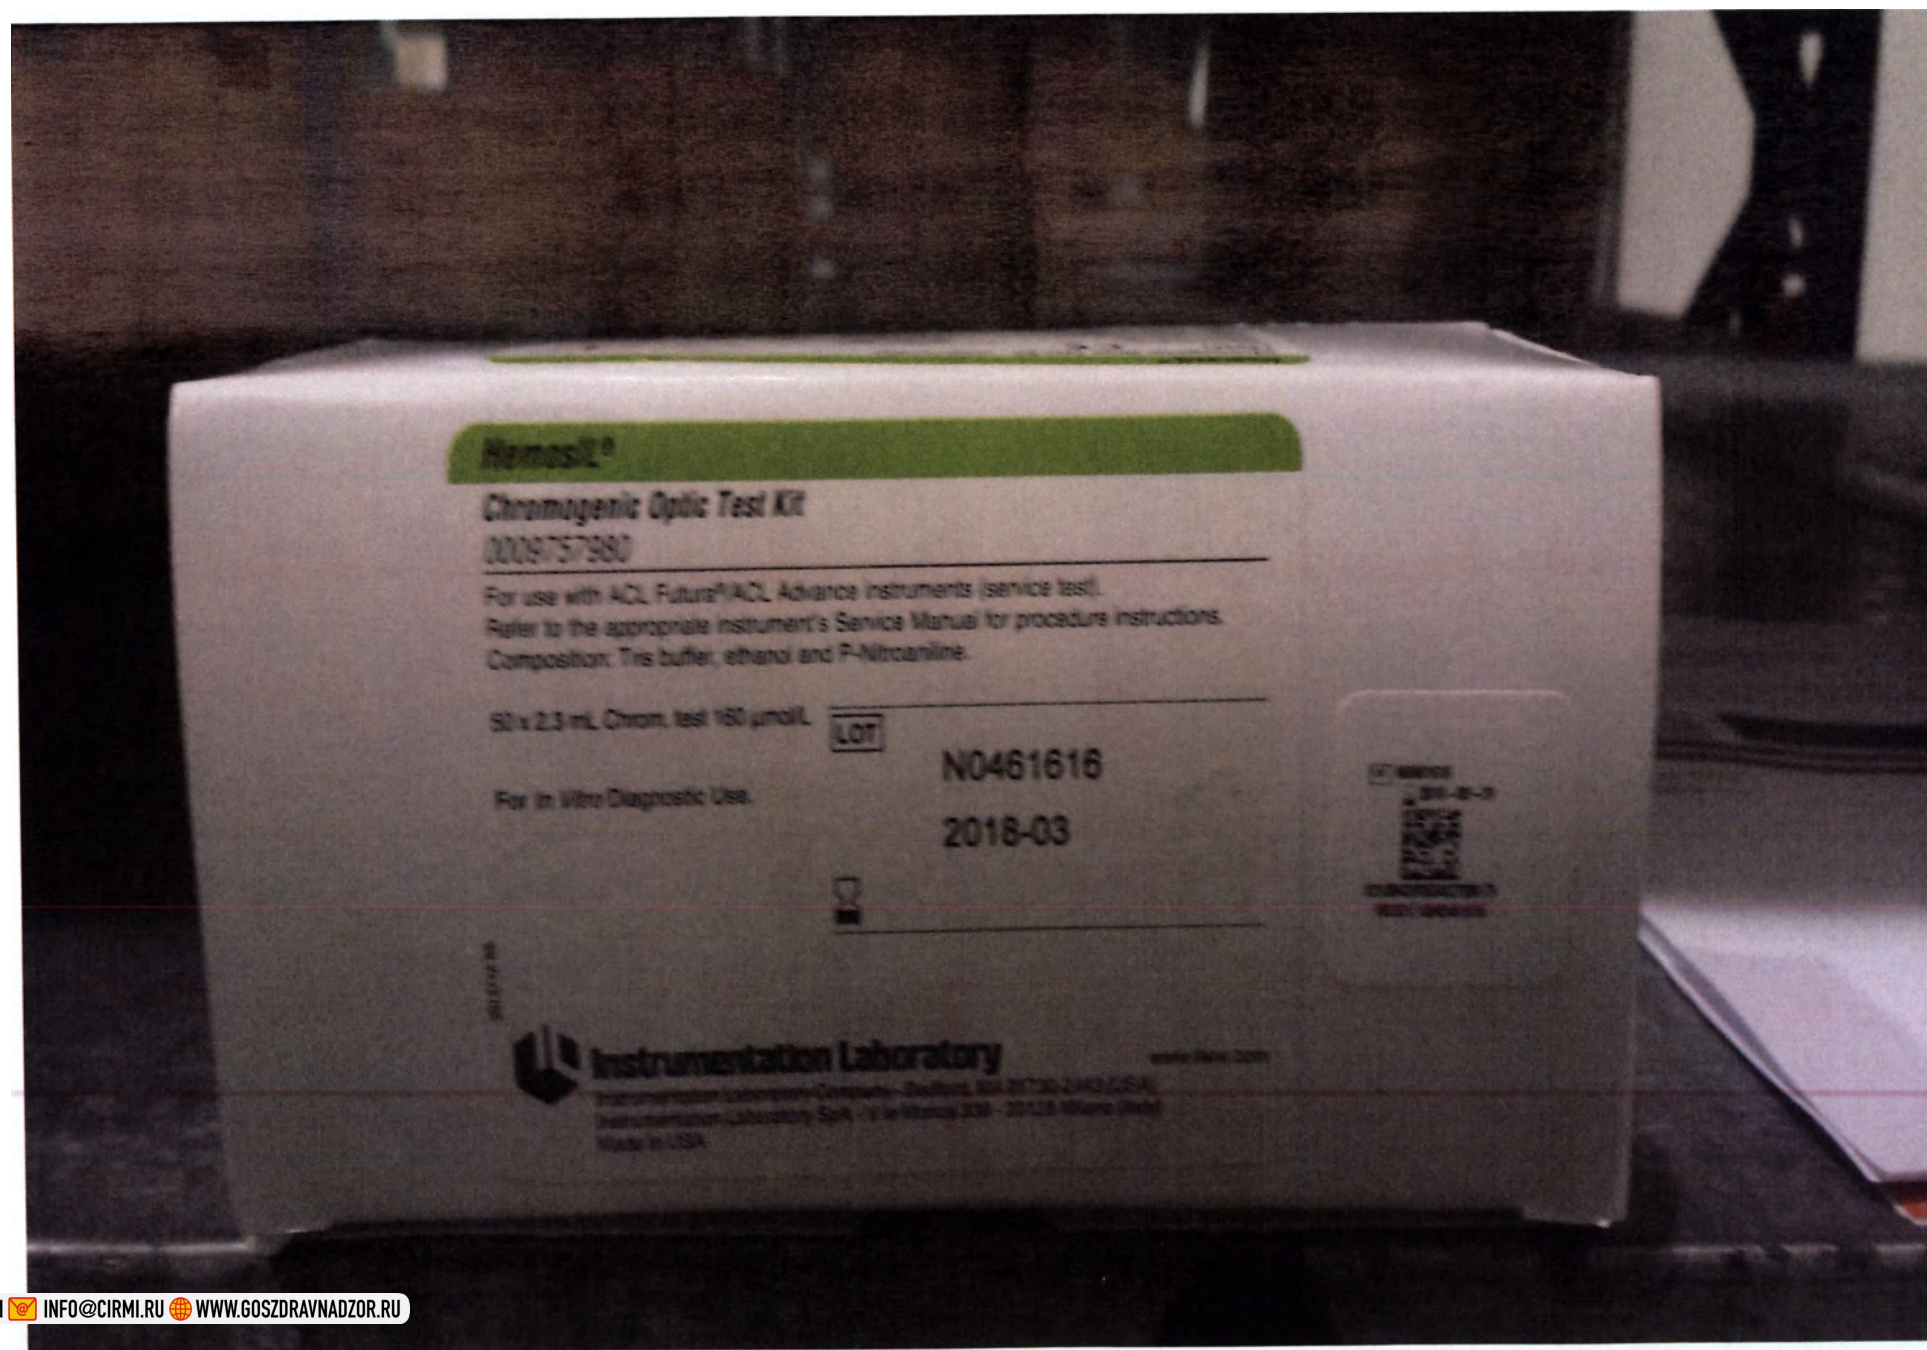

Critical Care/HemosIL®

Cleaning agent

0009832700

80 mL

Hazard class: None
Risk phrases: None
Safety phrases: None

Gefahrenklasse: keine
Risikoeinstufung: keine
Sicherheitseinstufung: keine

Indicaciones de peligro: ninguna
Frases de Riesgo: ninguna
Frases de Seguridad: ninguna

Classification risque: Aucune
Phrases risque: Aucune
Phrases sécurité: Aucune

Simbolo di pericolo: nessuno
Frase di rischio: nessuno
Consigli di prudenza: nessuno

Classe de risco: nenhuma
Frases de risco: nenhuma
Frases de segurança: nenhuma

Fareklass: ingen
Riskfraser: ingen
Skyddsfraser: ingen

Fareklasse: Ingen
Risikosætninger: Ingen
Sikkerhedssætninger: Ingen

Σημα κινδύνου Κατηγορία: ουδέν
Φράσεις κινδύνου: ουδέν
Φράσεις οδηγιών ασφαλούς χρήσης: ουδέν

危険: なし
リスクフレーズ: なし
セーフティフレーズ: なし

 **Instrumentation Laboratory**

S. Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
S. Spa - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Critical Care/HemosIL®

Cleaning agent

0009832700

CE

80 mL

15°C — 25°C
保存

Sodium hypochlorite with less than 5% of
active chlorine.

クリーニングエージェント/クリーン8:

低濃度次亜塩素酸ナトリウム溶液。

インストレーション ラボラトリー社 米国
インストレーション株式会社

LOT


N0740826

2015-10

使用期限

 **Instrumentation Laboratory**

S. Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
S. Spa - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

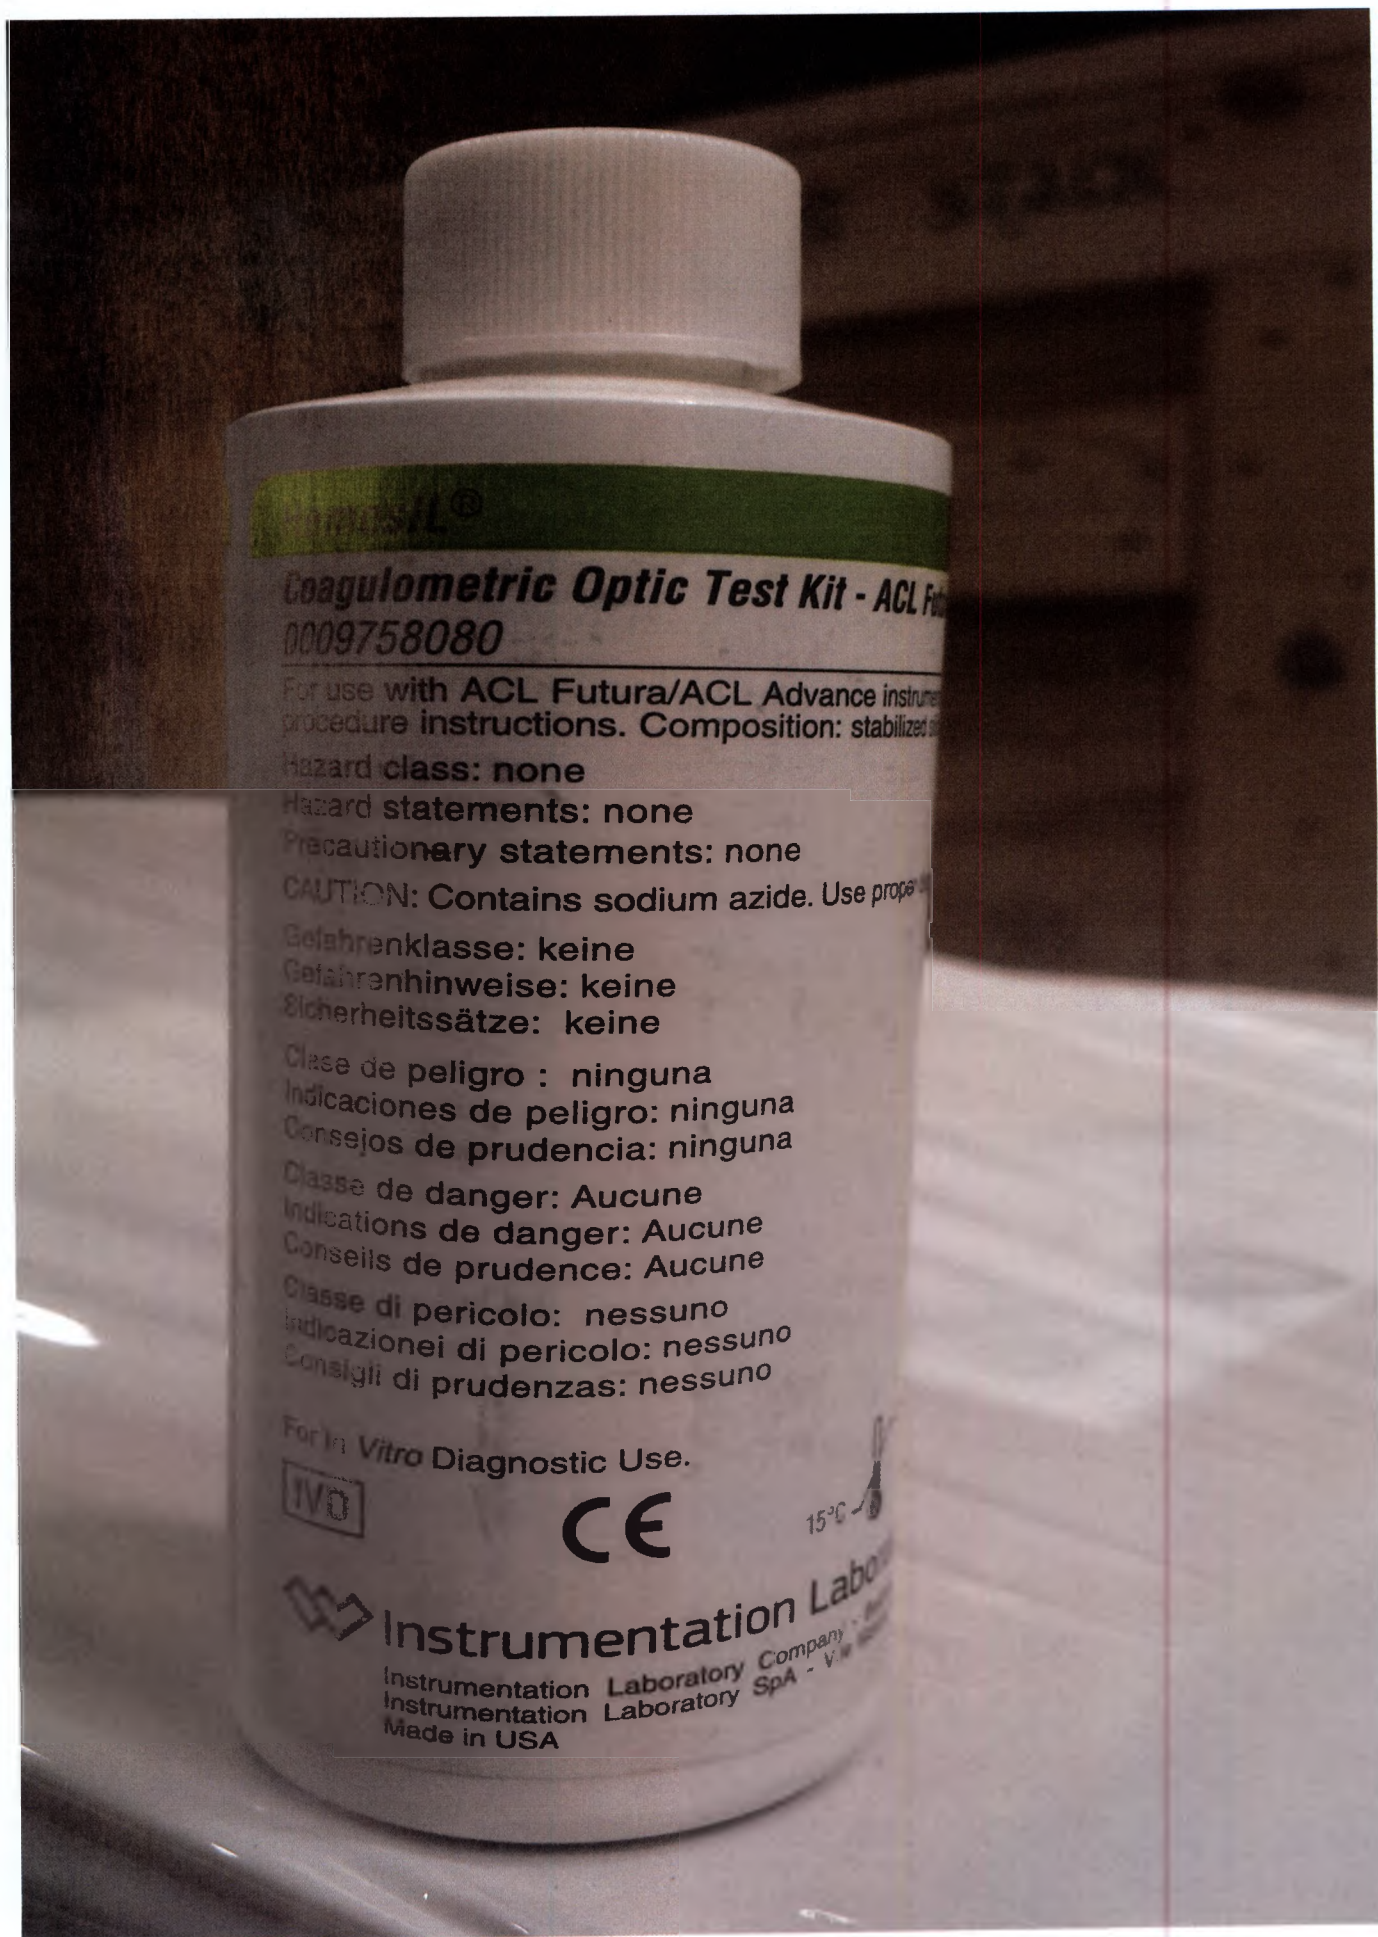

HemosIL®

Coagulometric Optic Test Kit

0009758050

For use with ACL® Family instruments (service test).

Refer to the appropriate ACL instrument's Service Manual for procedure instructions.

Composition: stabilized silicone oil emulsion, surfactant and sodium azide 0.1%.

13 x Coag. test 2

19 x Coag. test 1

12 x Coag. test 0.5

6 x Coag. test 0.25

LOT

N0433590

2015-03

For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in USA


www.ilwww.com

Коагулометрический оптический тест – HemosIL Coag Optic Test






Моющий раствор – HemosIL Cleaning Solution

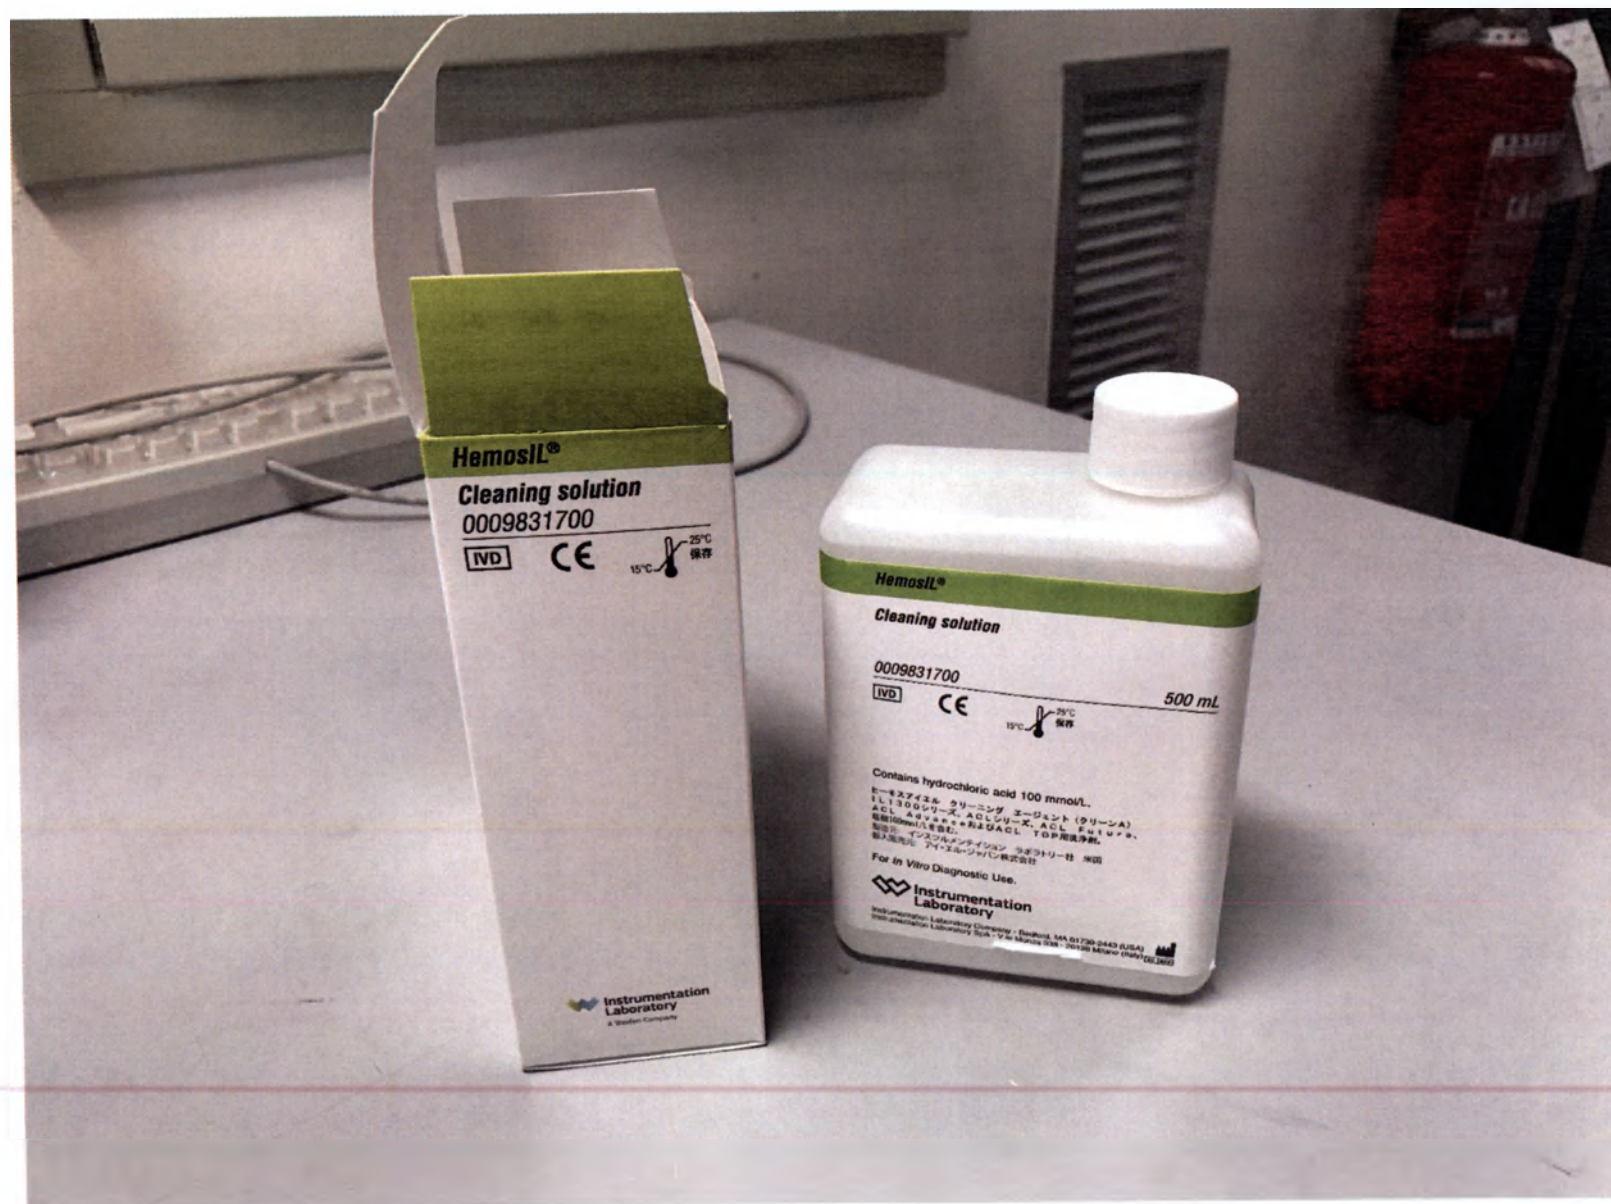

Свободный белок S - HemosIL Free Protein S




Д-Димер - HemosIL D-Dimer

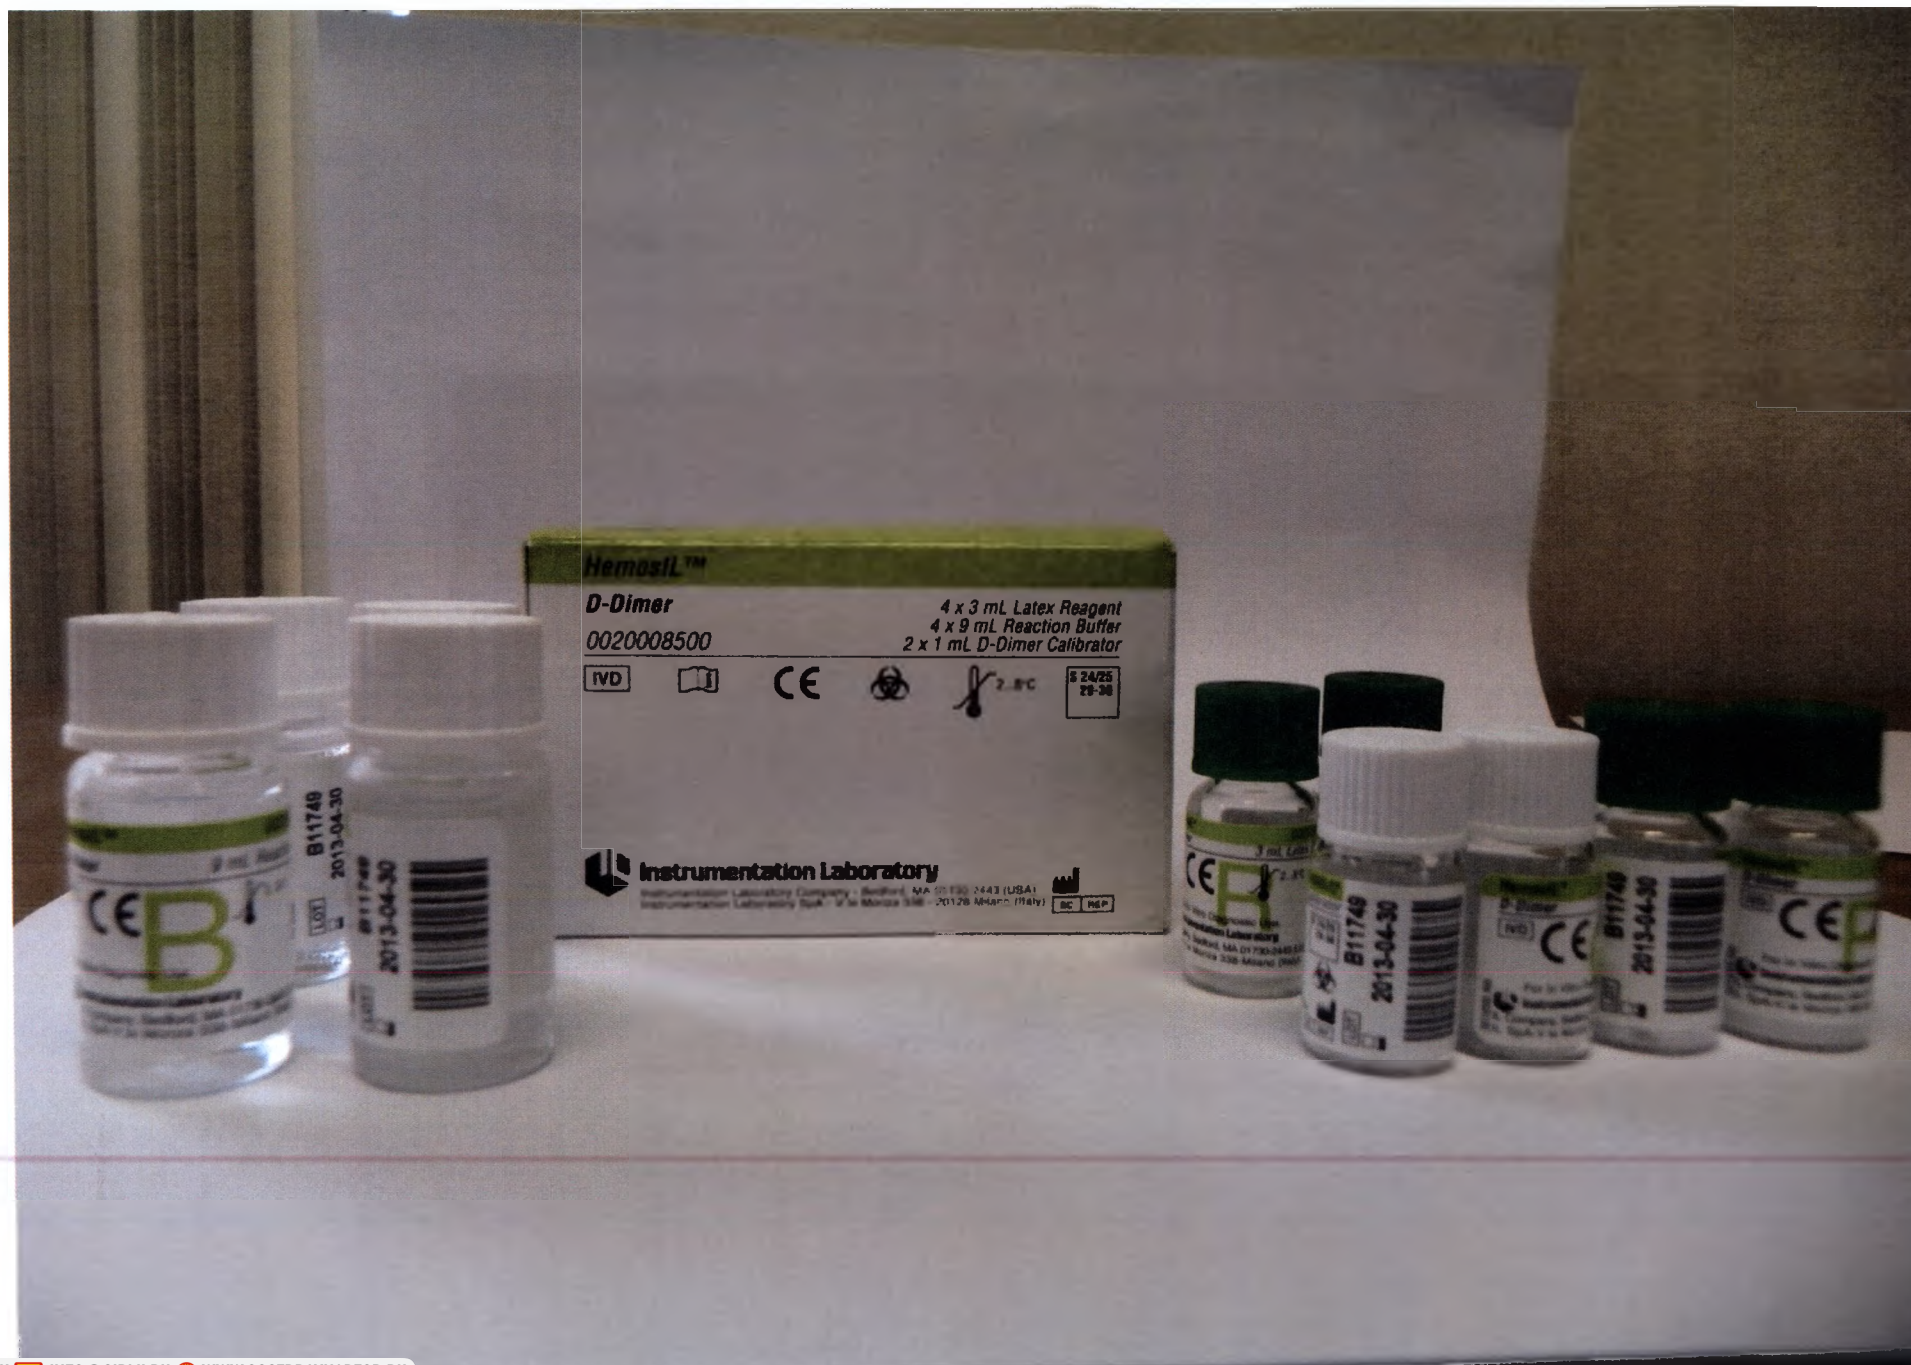


Д-Димер Высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS




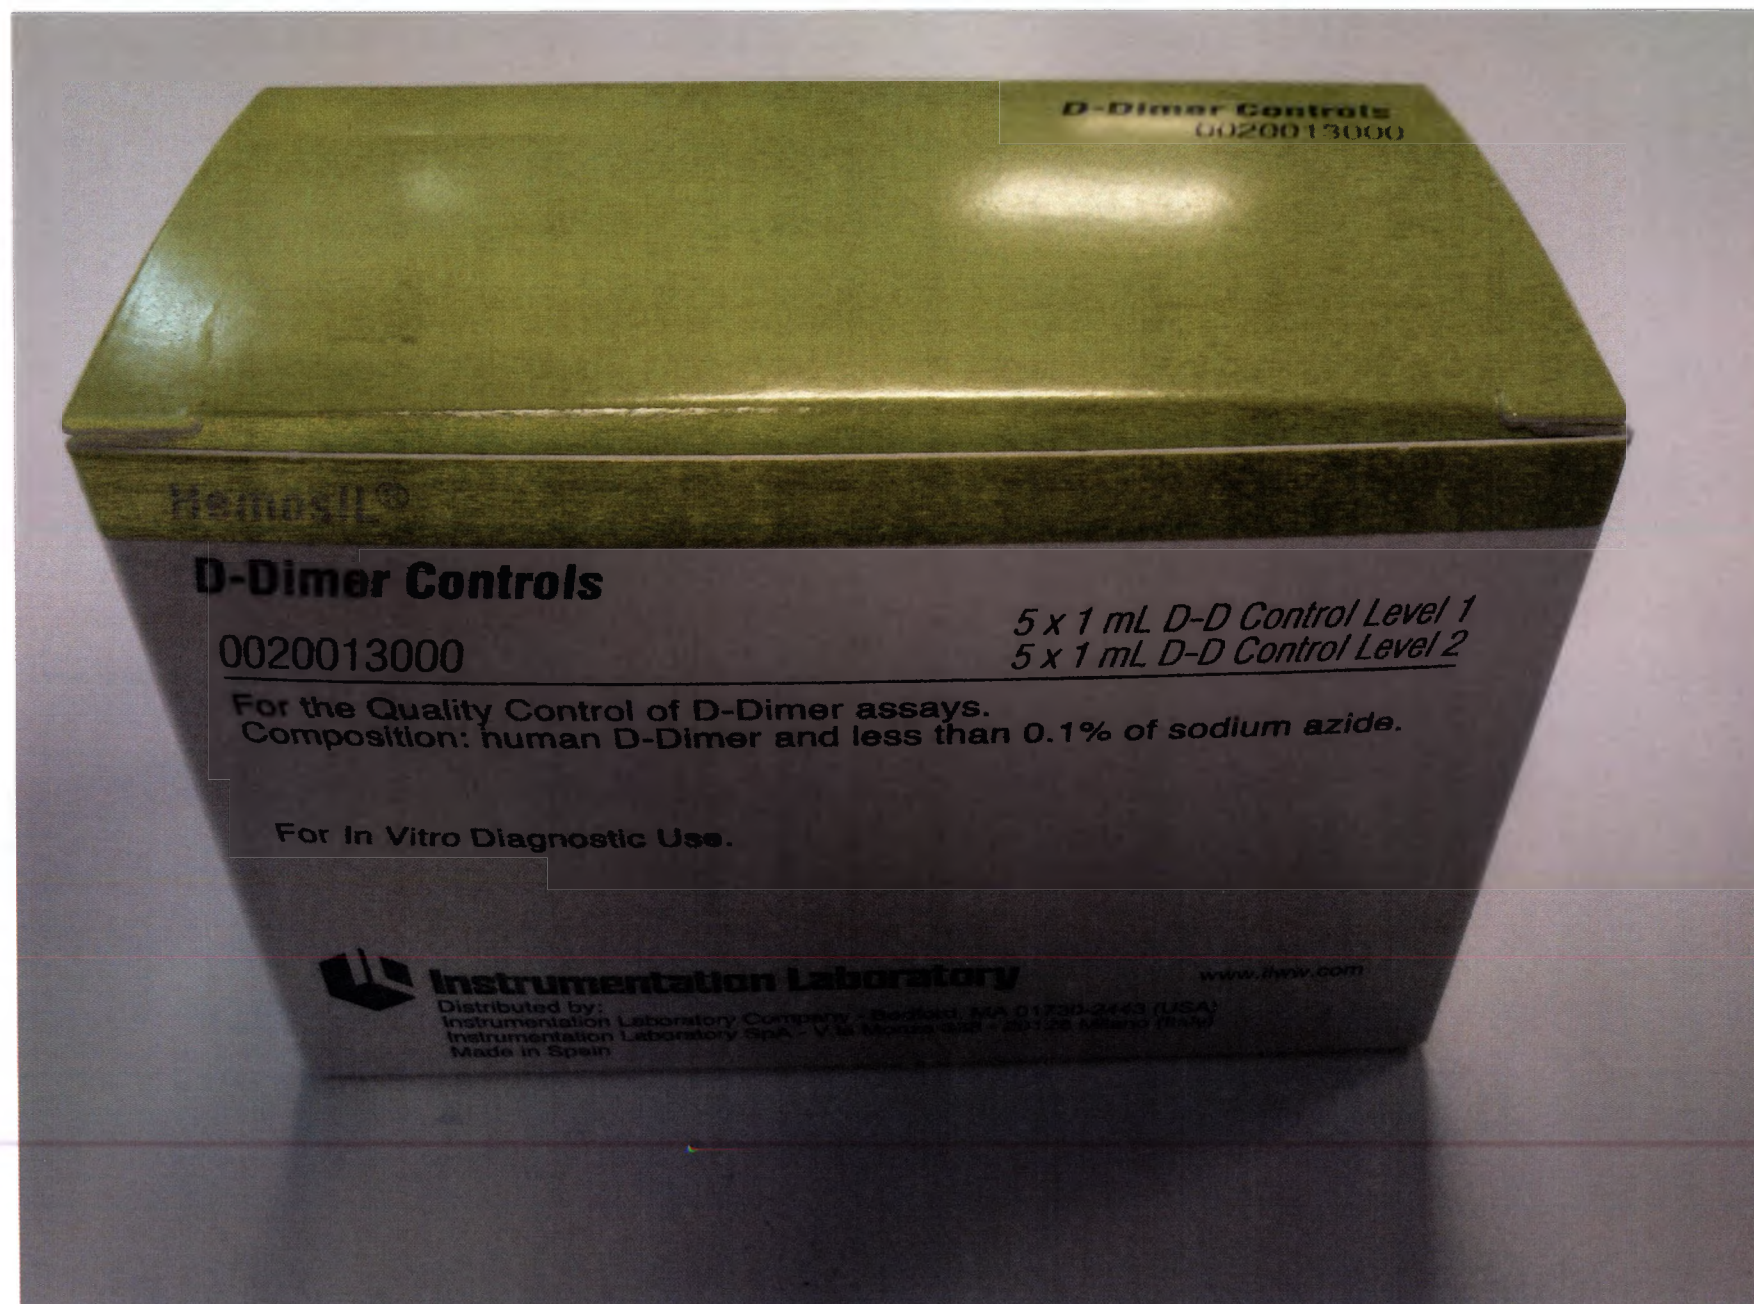

Активность фактора Виллебранда – HemosIL von Willebrand Factor Activity

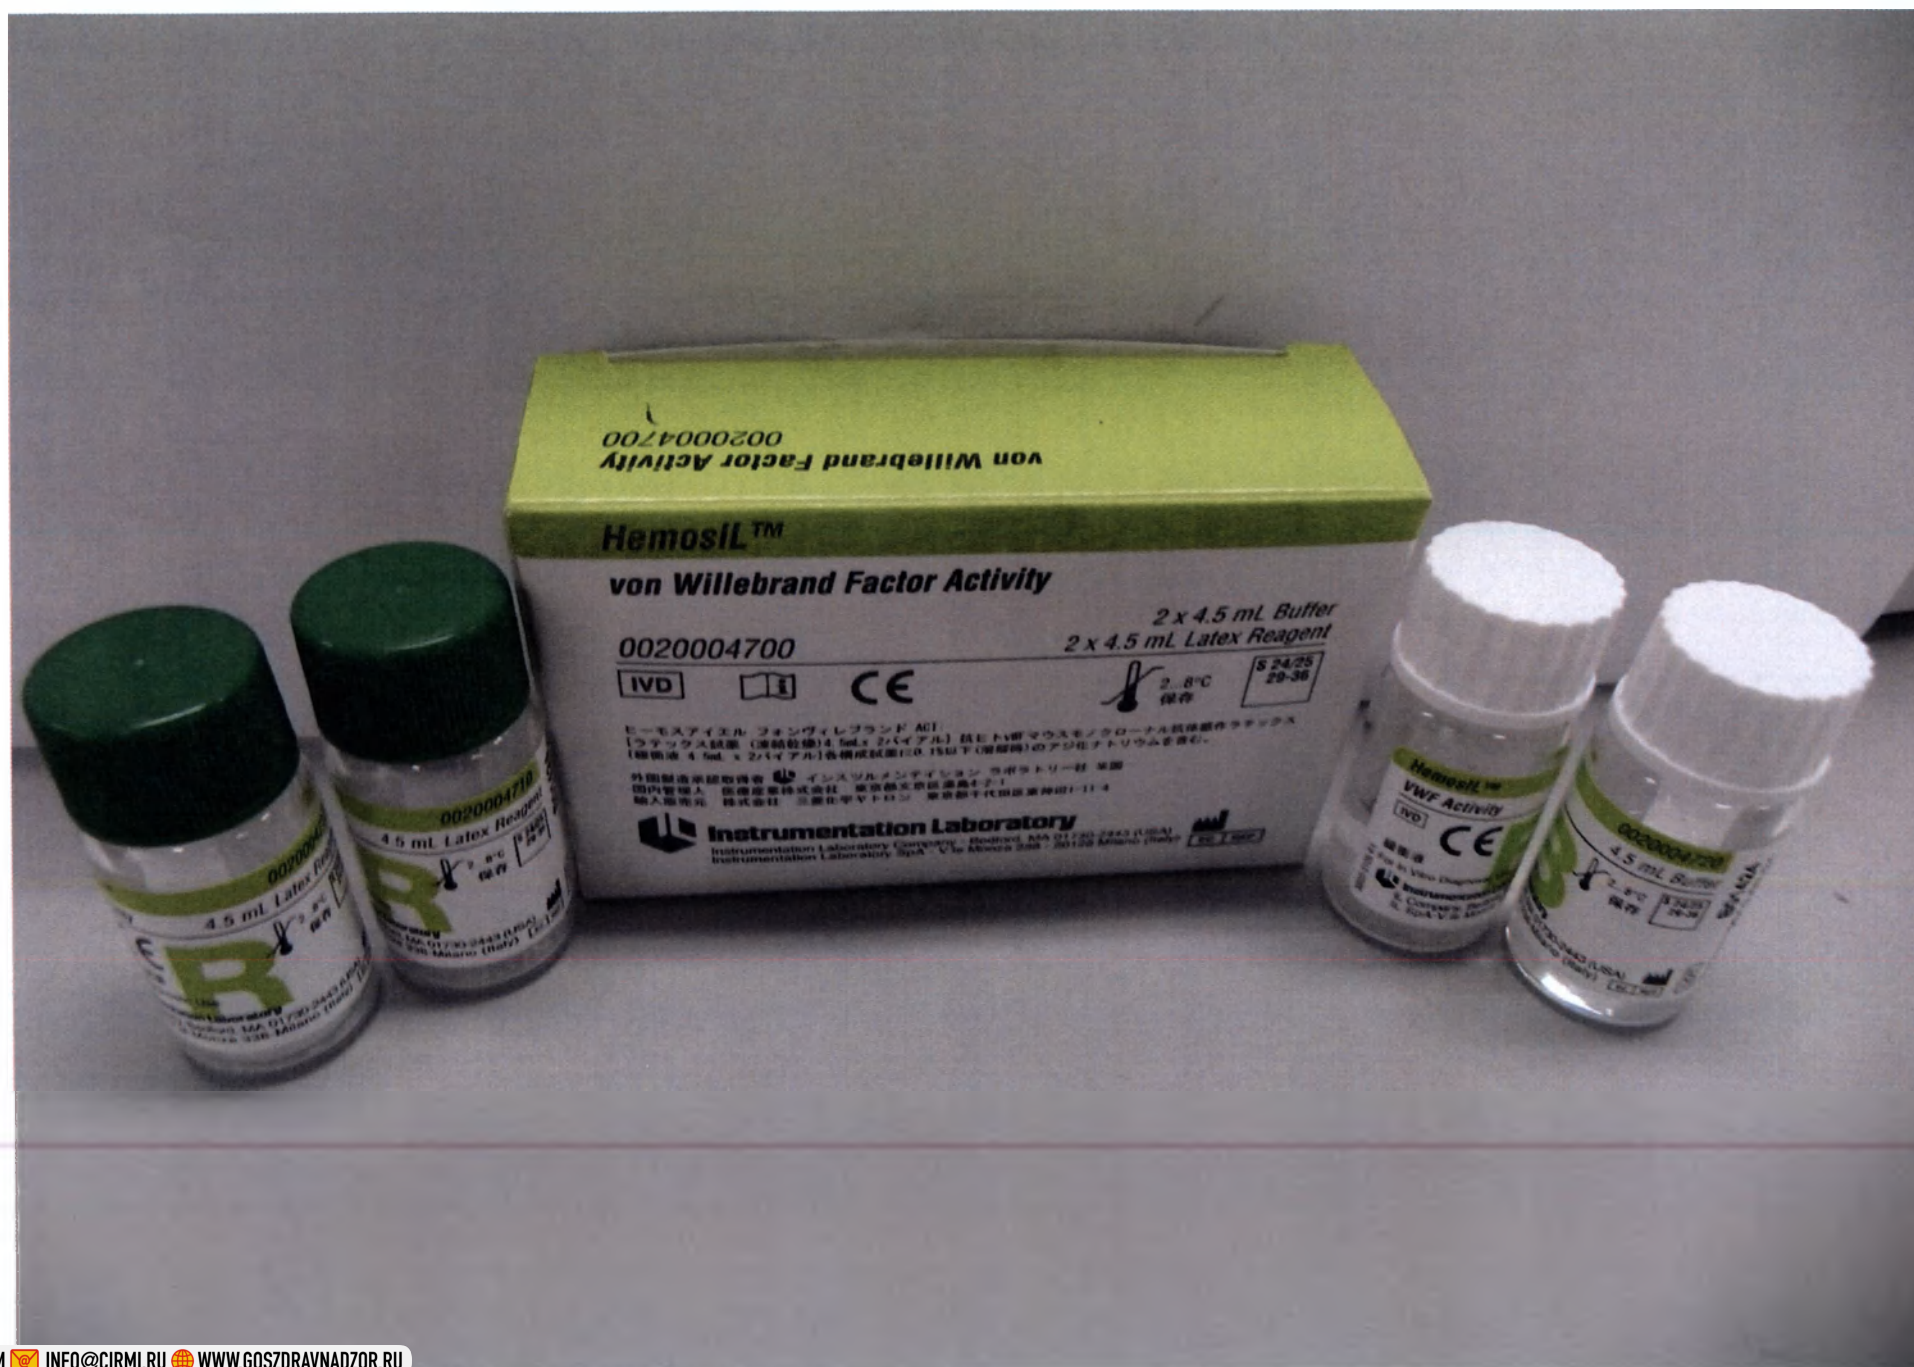

Фактор Виллебранда Антиген – HemosIL von Willebrand Factor Antigen

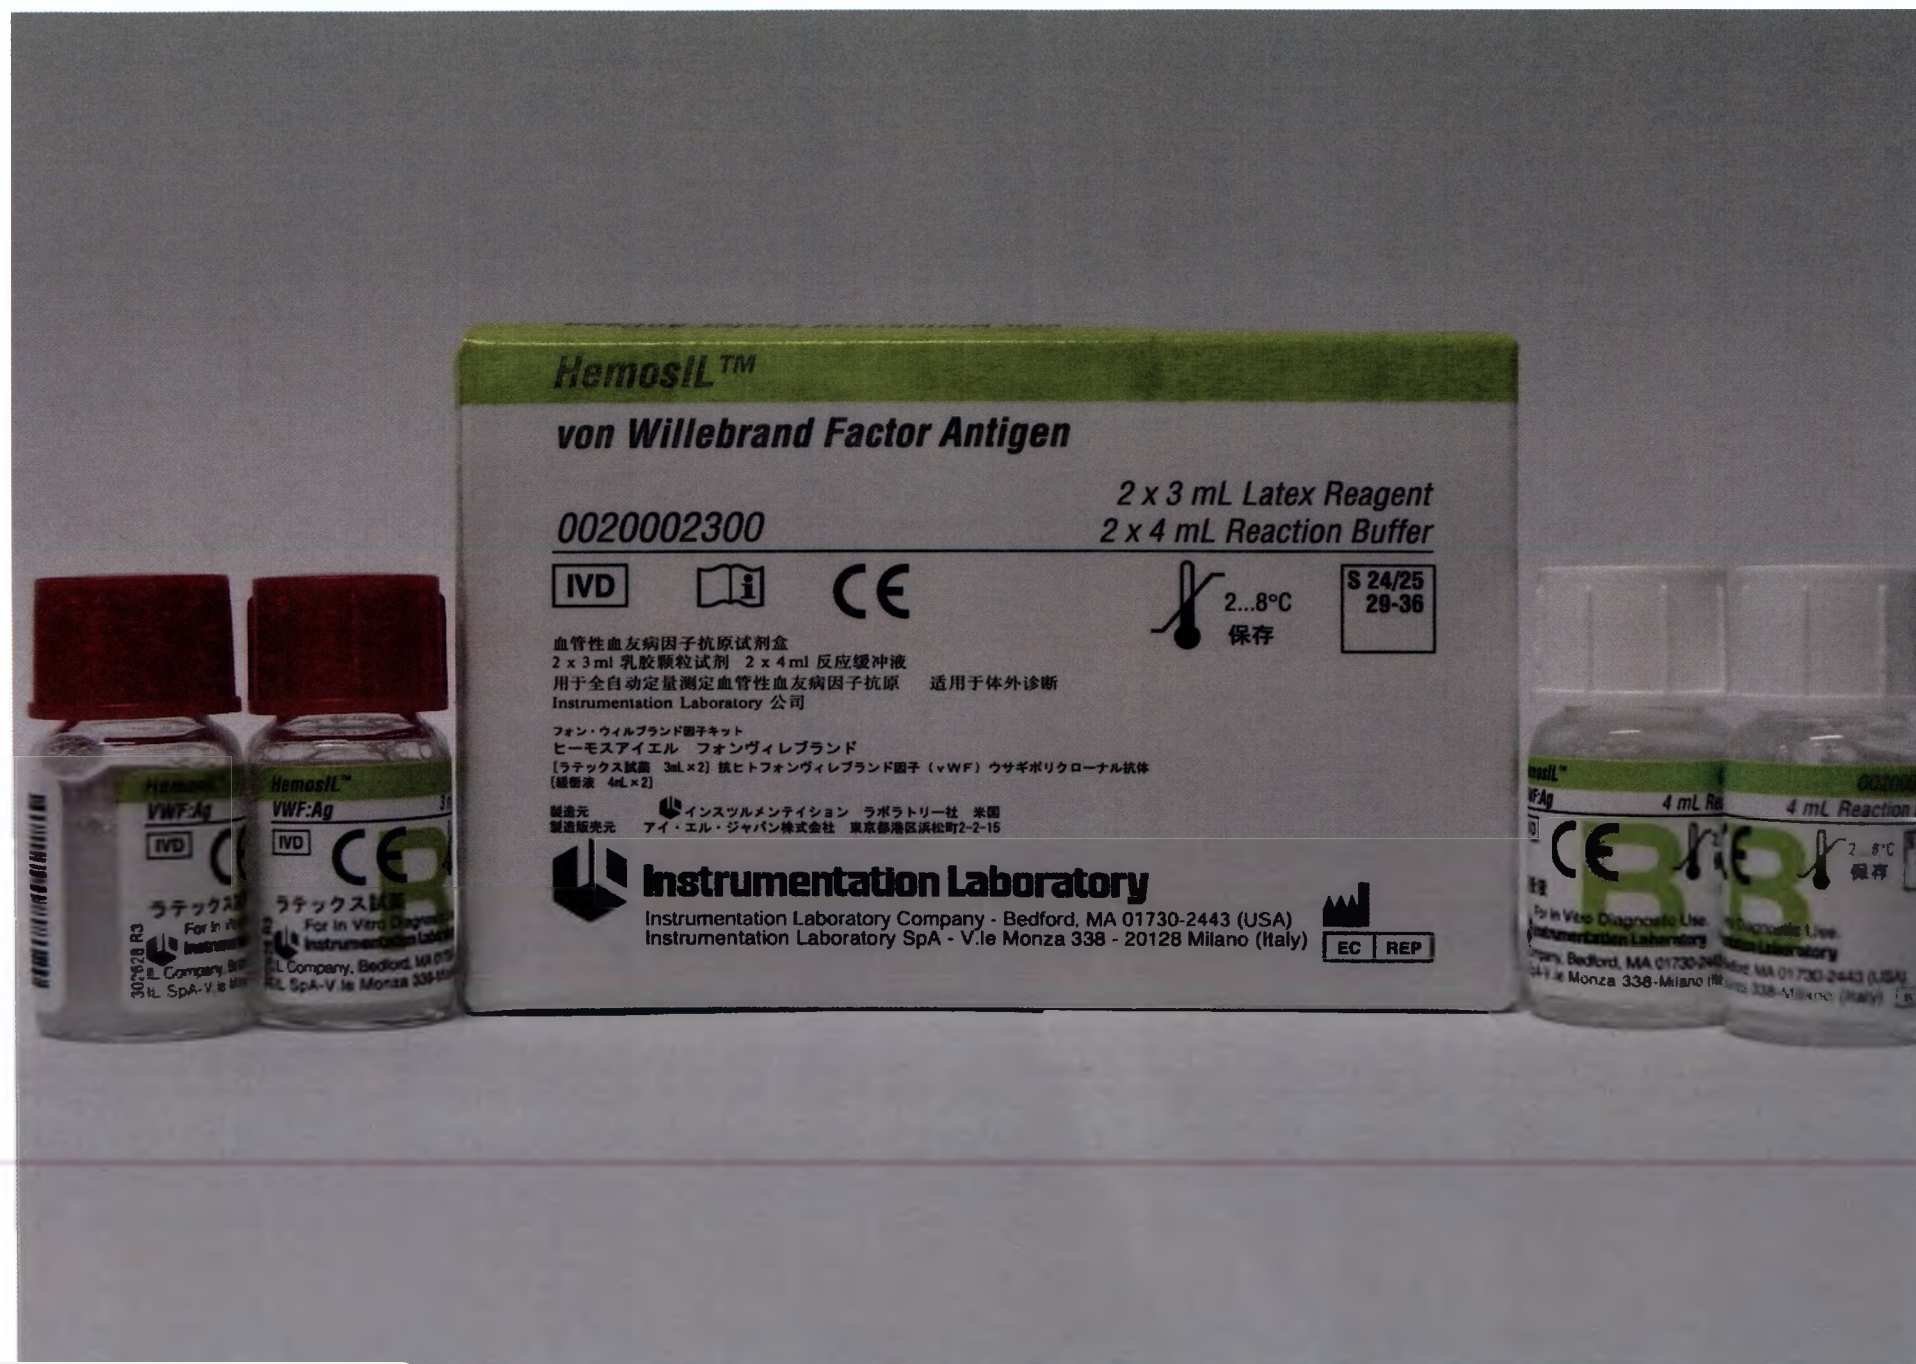

ТромбоПас – HemosIL ThromboPath



Гомоцистеин – HemosIL Homocysteine



Контроли гомоцистеина - HemosIL Homocysteine Controls




The image shows a box of Hemostil™ INR Validate 0020010500 and three vials. The box is white with a green top and contains text in English and Japanese. It includes the following information:

- Hemostil™**
- INR Validate**
- 0020010500**
- IVD** (In Vitro Diagnostic)
- CE** (Conformé Européen)
- 1 x 1 mL INR Level 1**
- 1 x 1 mL INR Level 2**
- 1 x 1 mL INR Level 3**
- Instrumentation Laboratory**

The three vials are labeled 1, 2, and 3, corresponding to the INR levels mentioned on the box. Vial 1 has a white cap, Vial 2 has a yellow cap, and Vial 3 has a red cap. Each vial also features a biohazard symbol.

Калибратор ISI- HemosIL ISI Calibrate

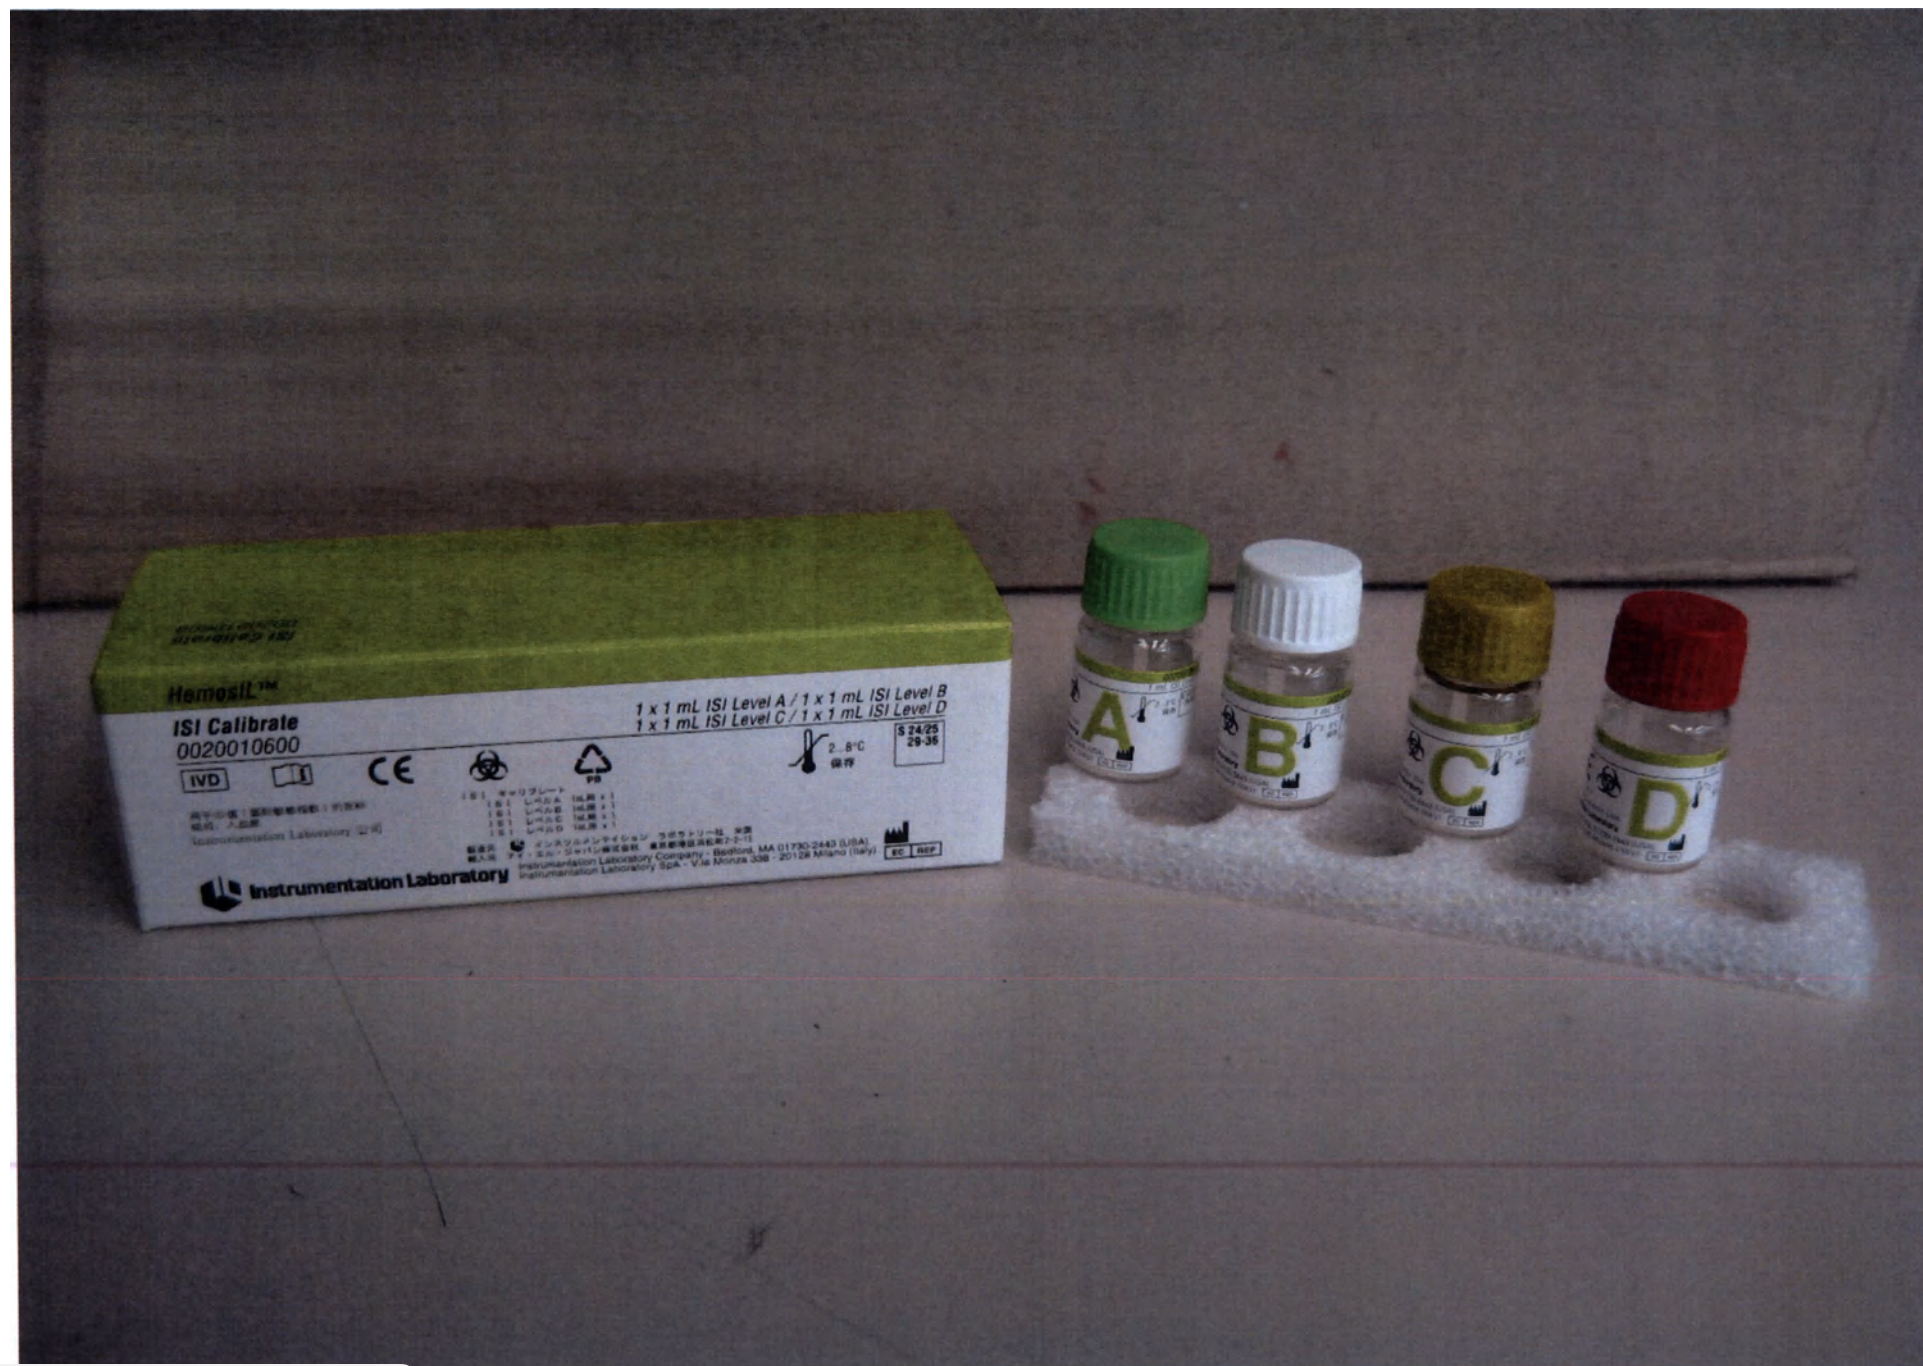

HemosIL®

FII & FV DNA Control

0020003500

3 x 0.5 mL FII & FV DNA Control

For the Quality Control of Factor II 20210G>A and
Factor V 1691G>A (Leiden) mutations.
Composition: Synthetic FII and FV heterozygous DNA.

For *In Vitro* Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory

www.ilwww.com


Distributed by:

Instrumentation Laboratory Company-Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA -V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in USA

Контроли ГИТ - HemosIL HIT-Ab(PF4-H) Controls

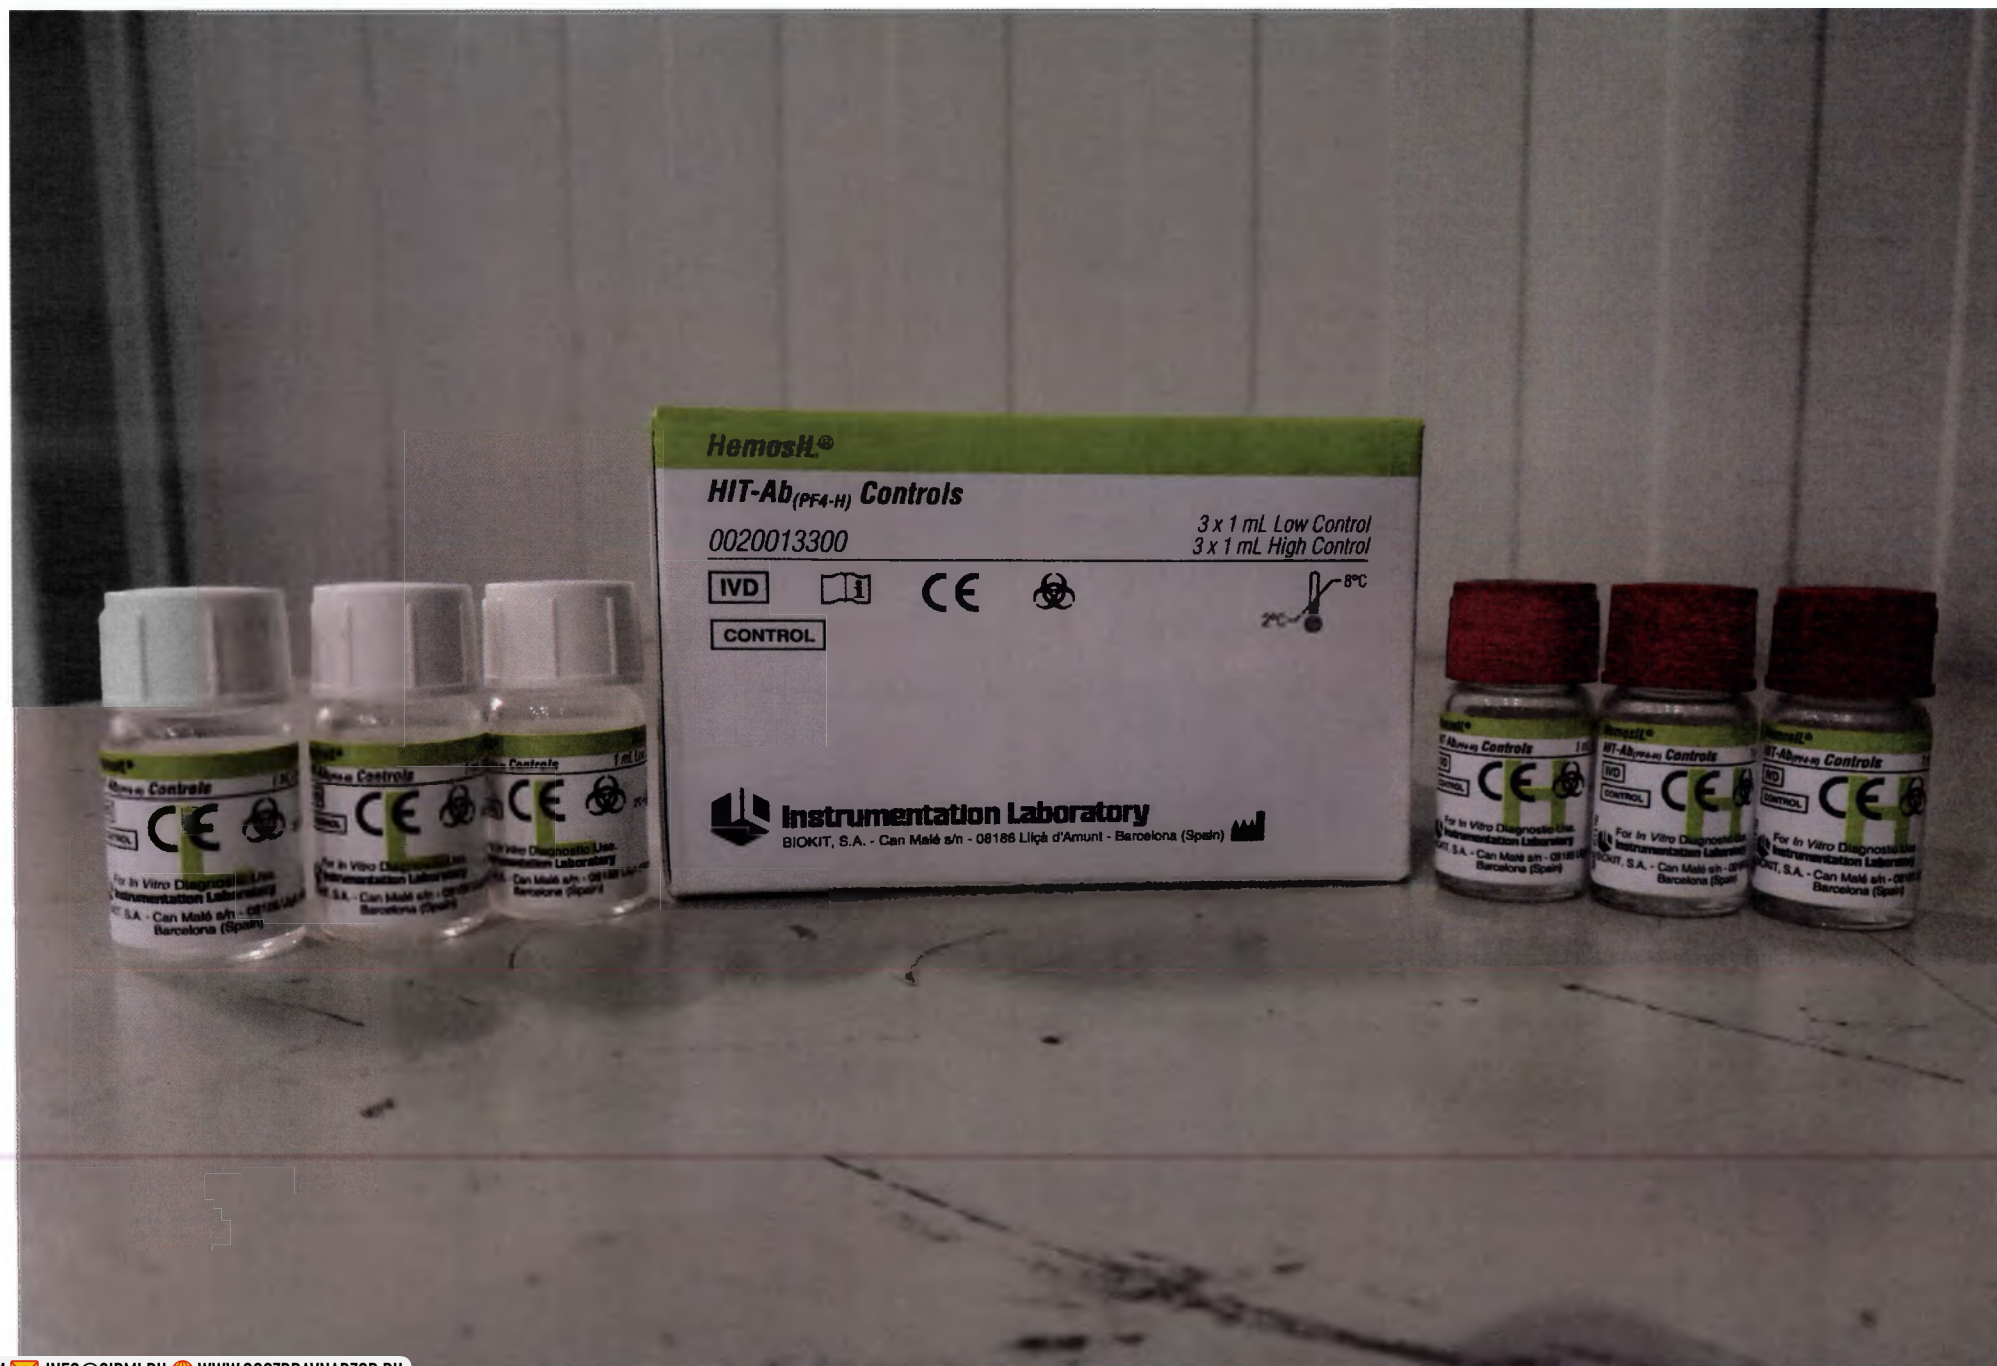


Контроли ГИТ - HemosIL HIT-Ab(PF4-H) Controls

•

ГИТ - HemosIL HIT-Ab(PF4-H)



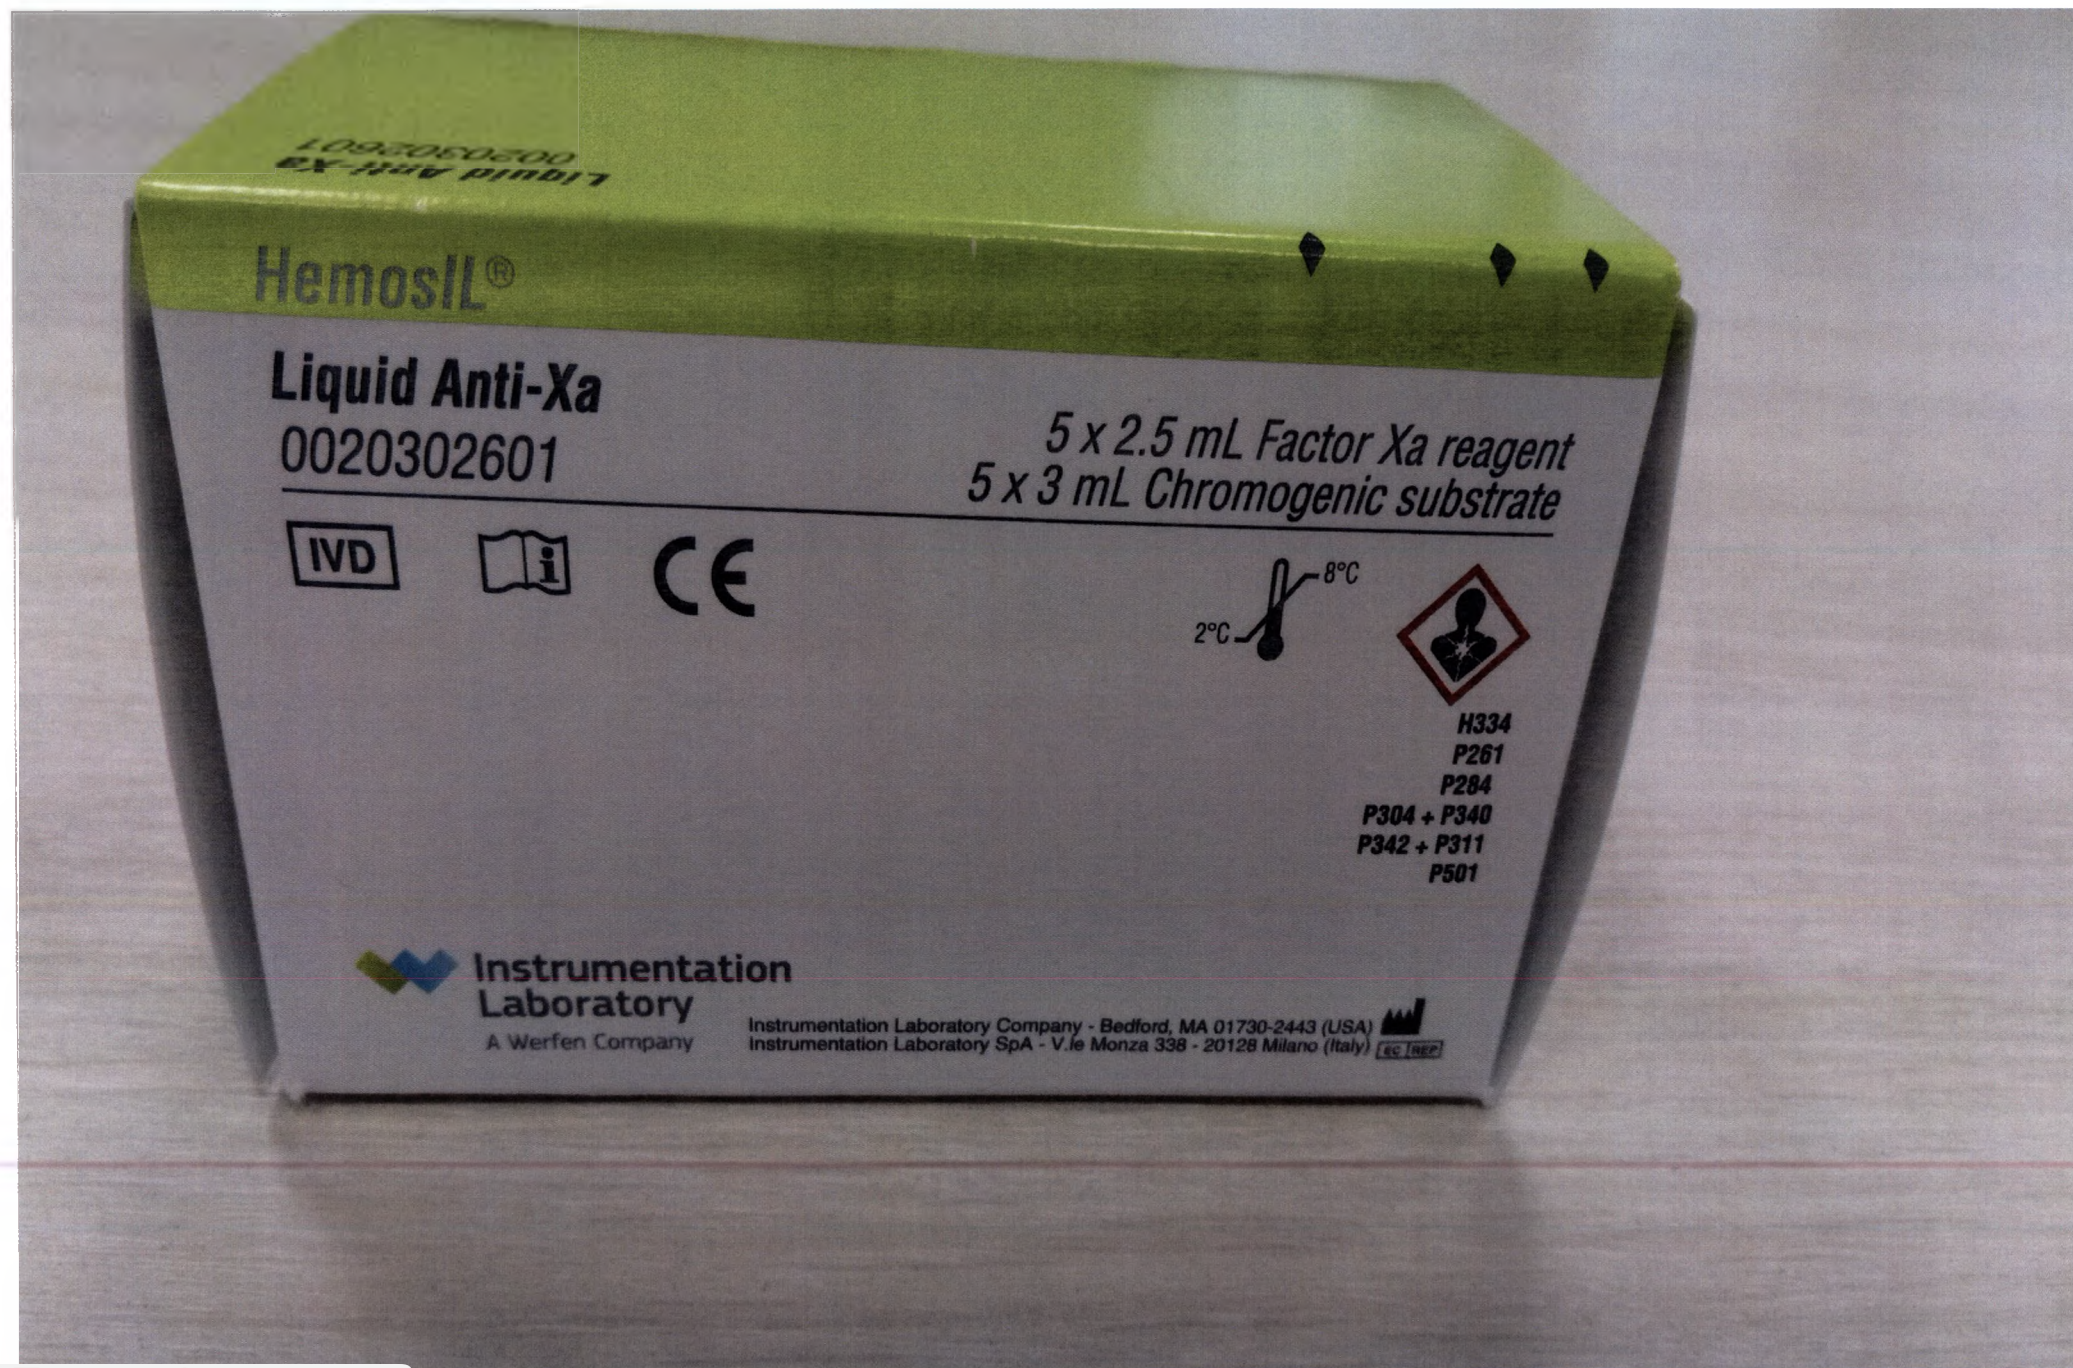

Анти-Ха, жидкий – HemosIL Liquid Anti-Xa

HemosIL®
Liquid Anti-Xa
0020302601

LOT

N0871734



2020-02-29



(01)08420050808855

(17)200229

(10)N0871734

Анти-Ха, жидкий – HemosIL Liquid Anti-Xa

HemosIL

Liquid Anti-Xa

0020302601

5 x 2.5 mL Factor Xa reagent
5 x 3 mL Chromogenic substrate

For the determination of Heparin and the measurement of direct FXa inhibitors.
Composition: Chromogenic substrate and bovine Factor Xa.

For In Vitro Diagnostic Use.



**Instrumentation
Laboratory**

A Werfen Company

www.instrumentationlaboratory.com

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)

Made in USA

Анти-Ха, жидкий – HemosIL Liquid Anti-Xa


HemosIL®
Liquid Anti-Xa
0020302601

LOT


N0871734
SEQ00865
2020-02



Анти-Ха, жидкий – HemosIL Liquid Anti-Xa

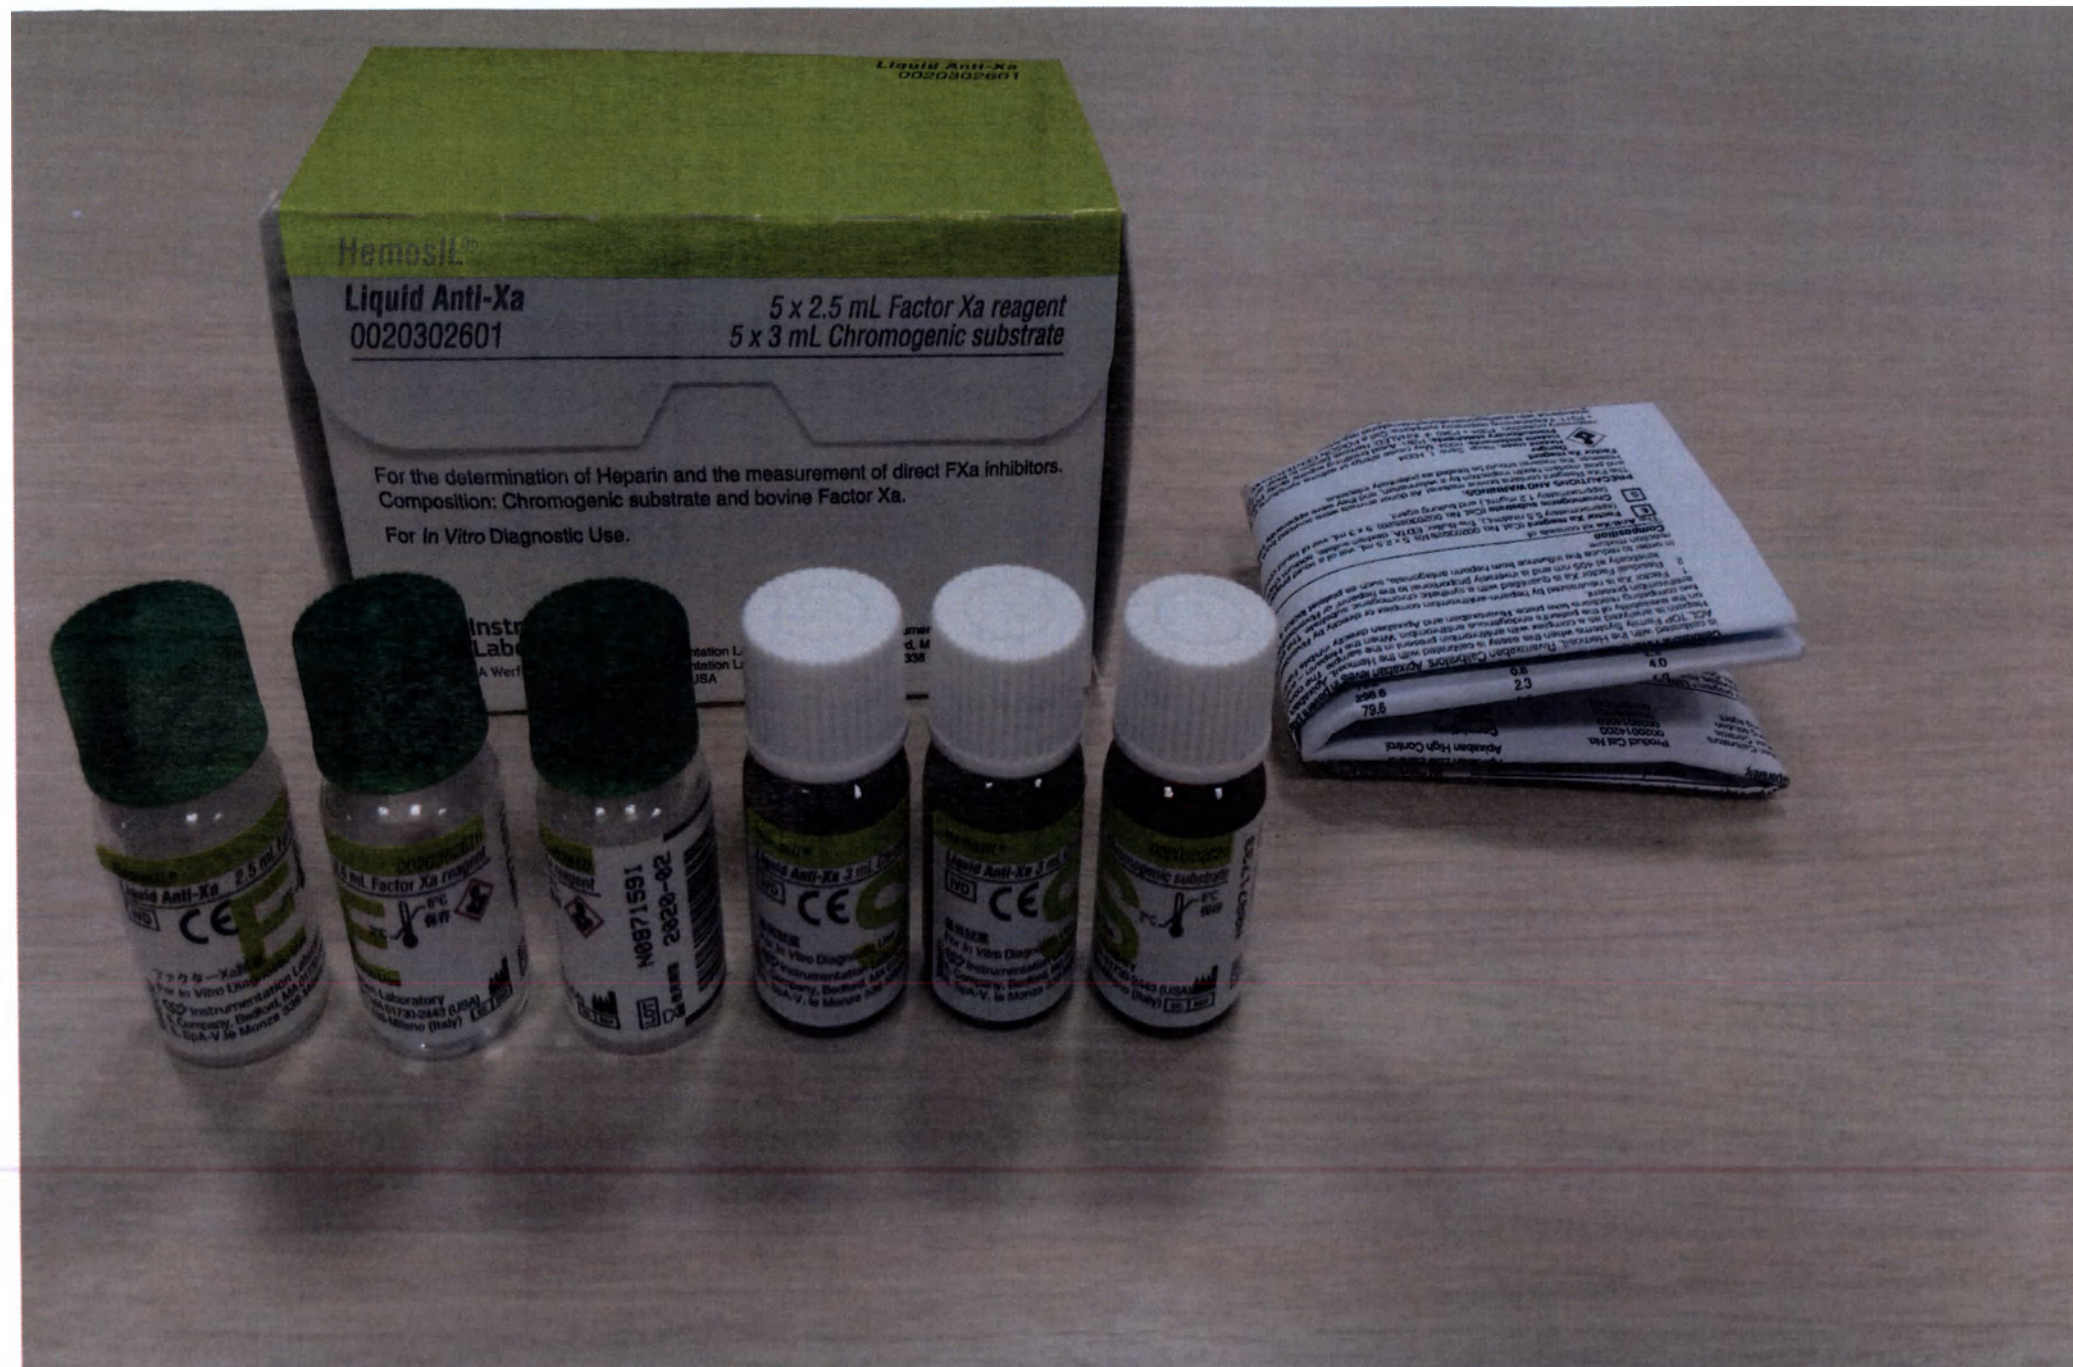

Анти-Ха, жидкий – HemosIL Liquid Anti-Xa

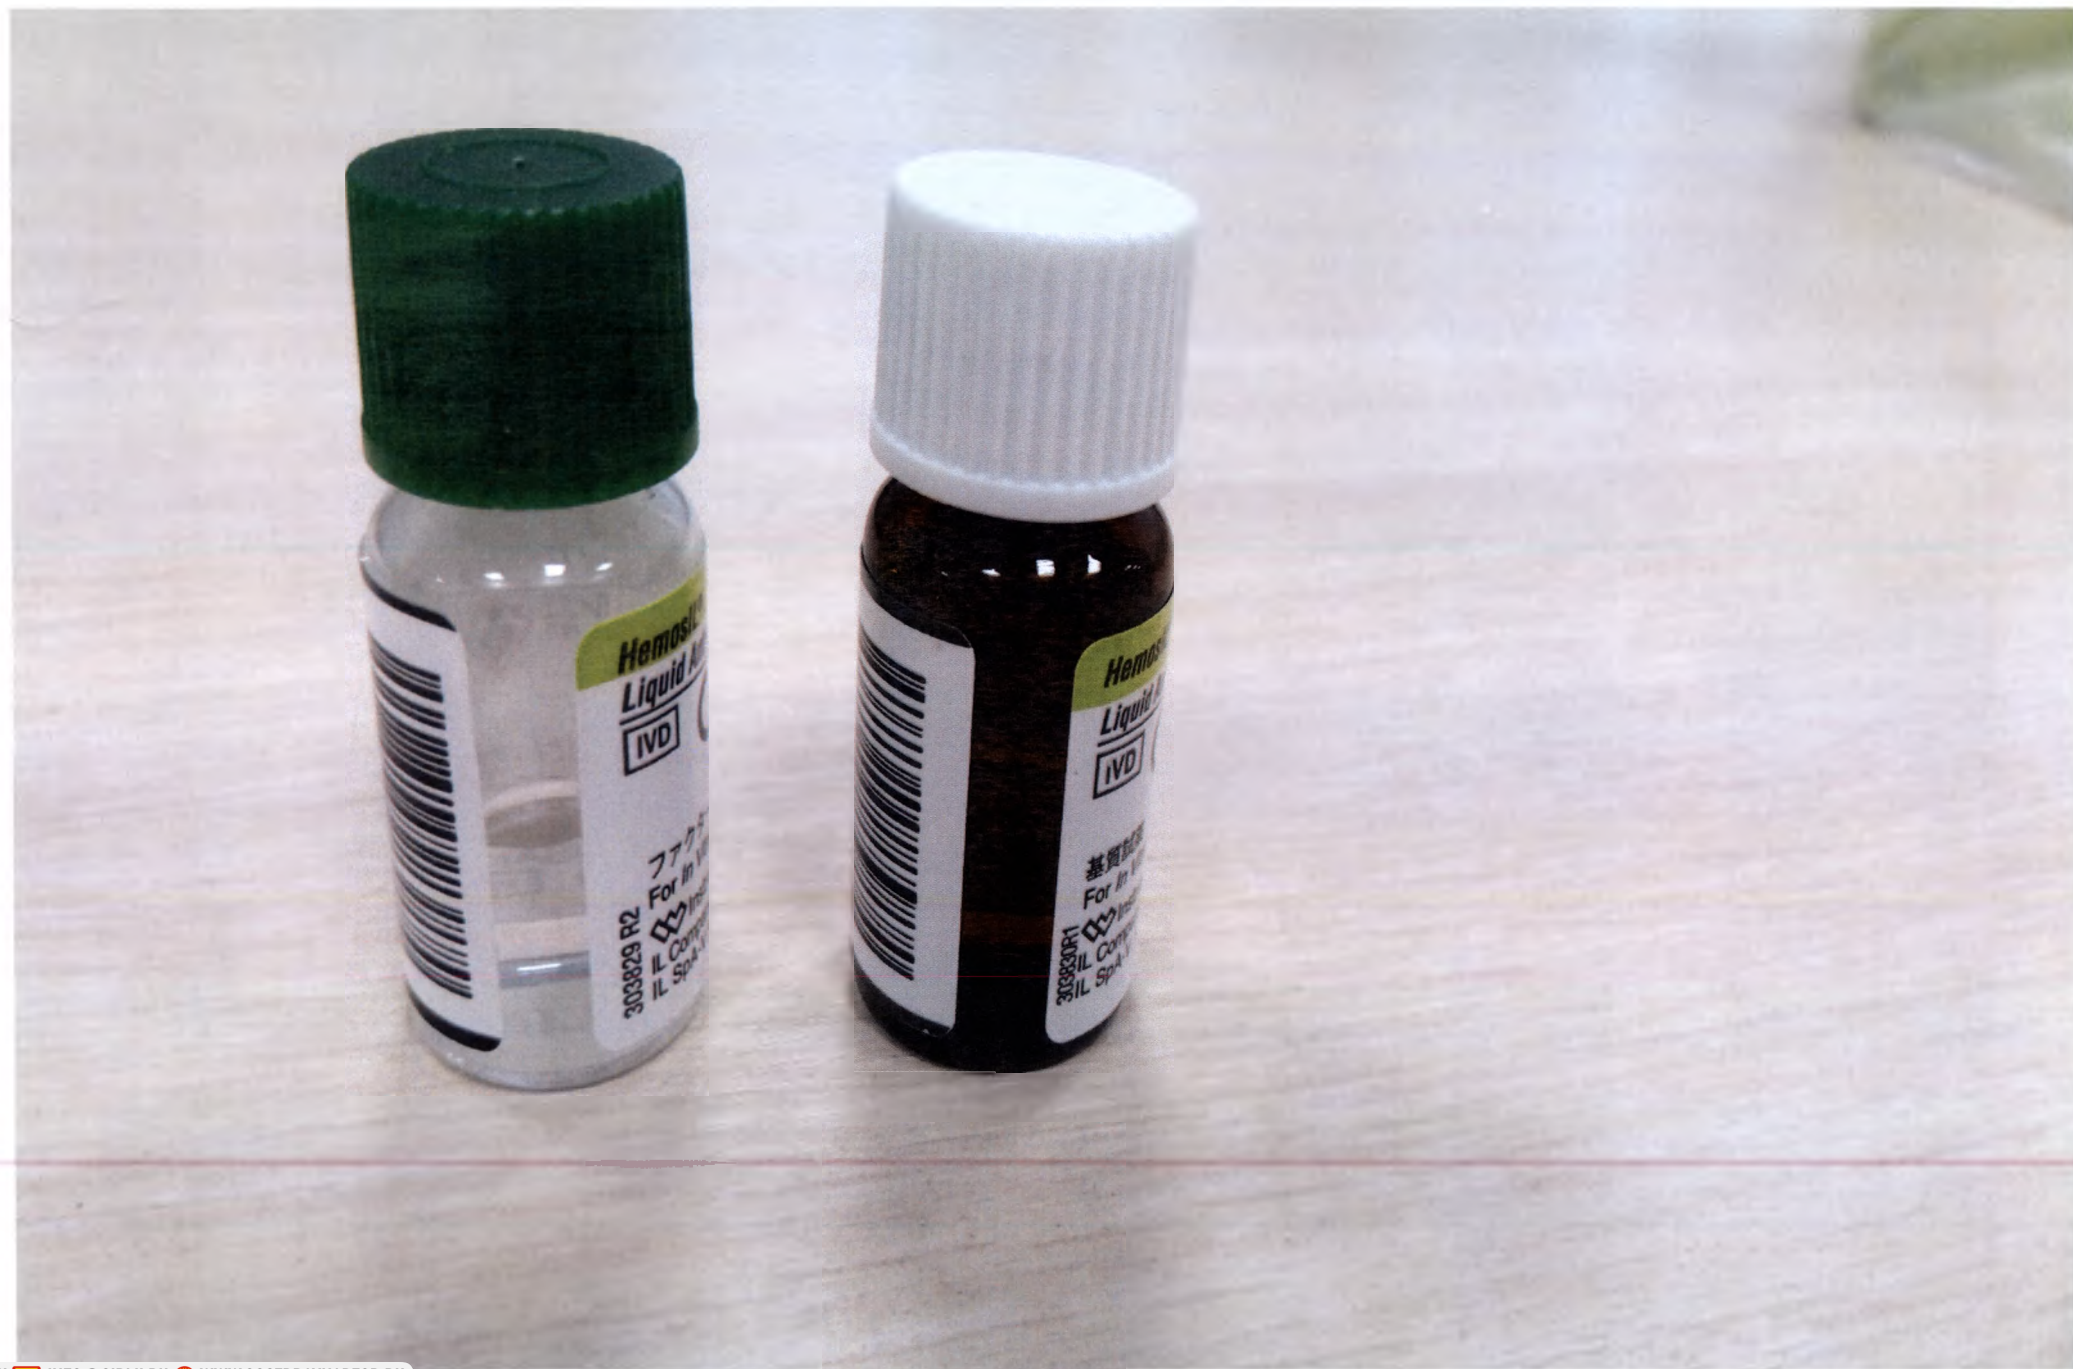


Контроли LMW гепарина - HemosIL LMW Heparin Controls




Контроли UF гепарина - HemosIL UF Heparin Controls



Калибраторы гепаринов - HemosIL Heparin Calibrators

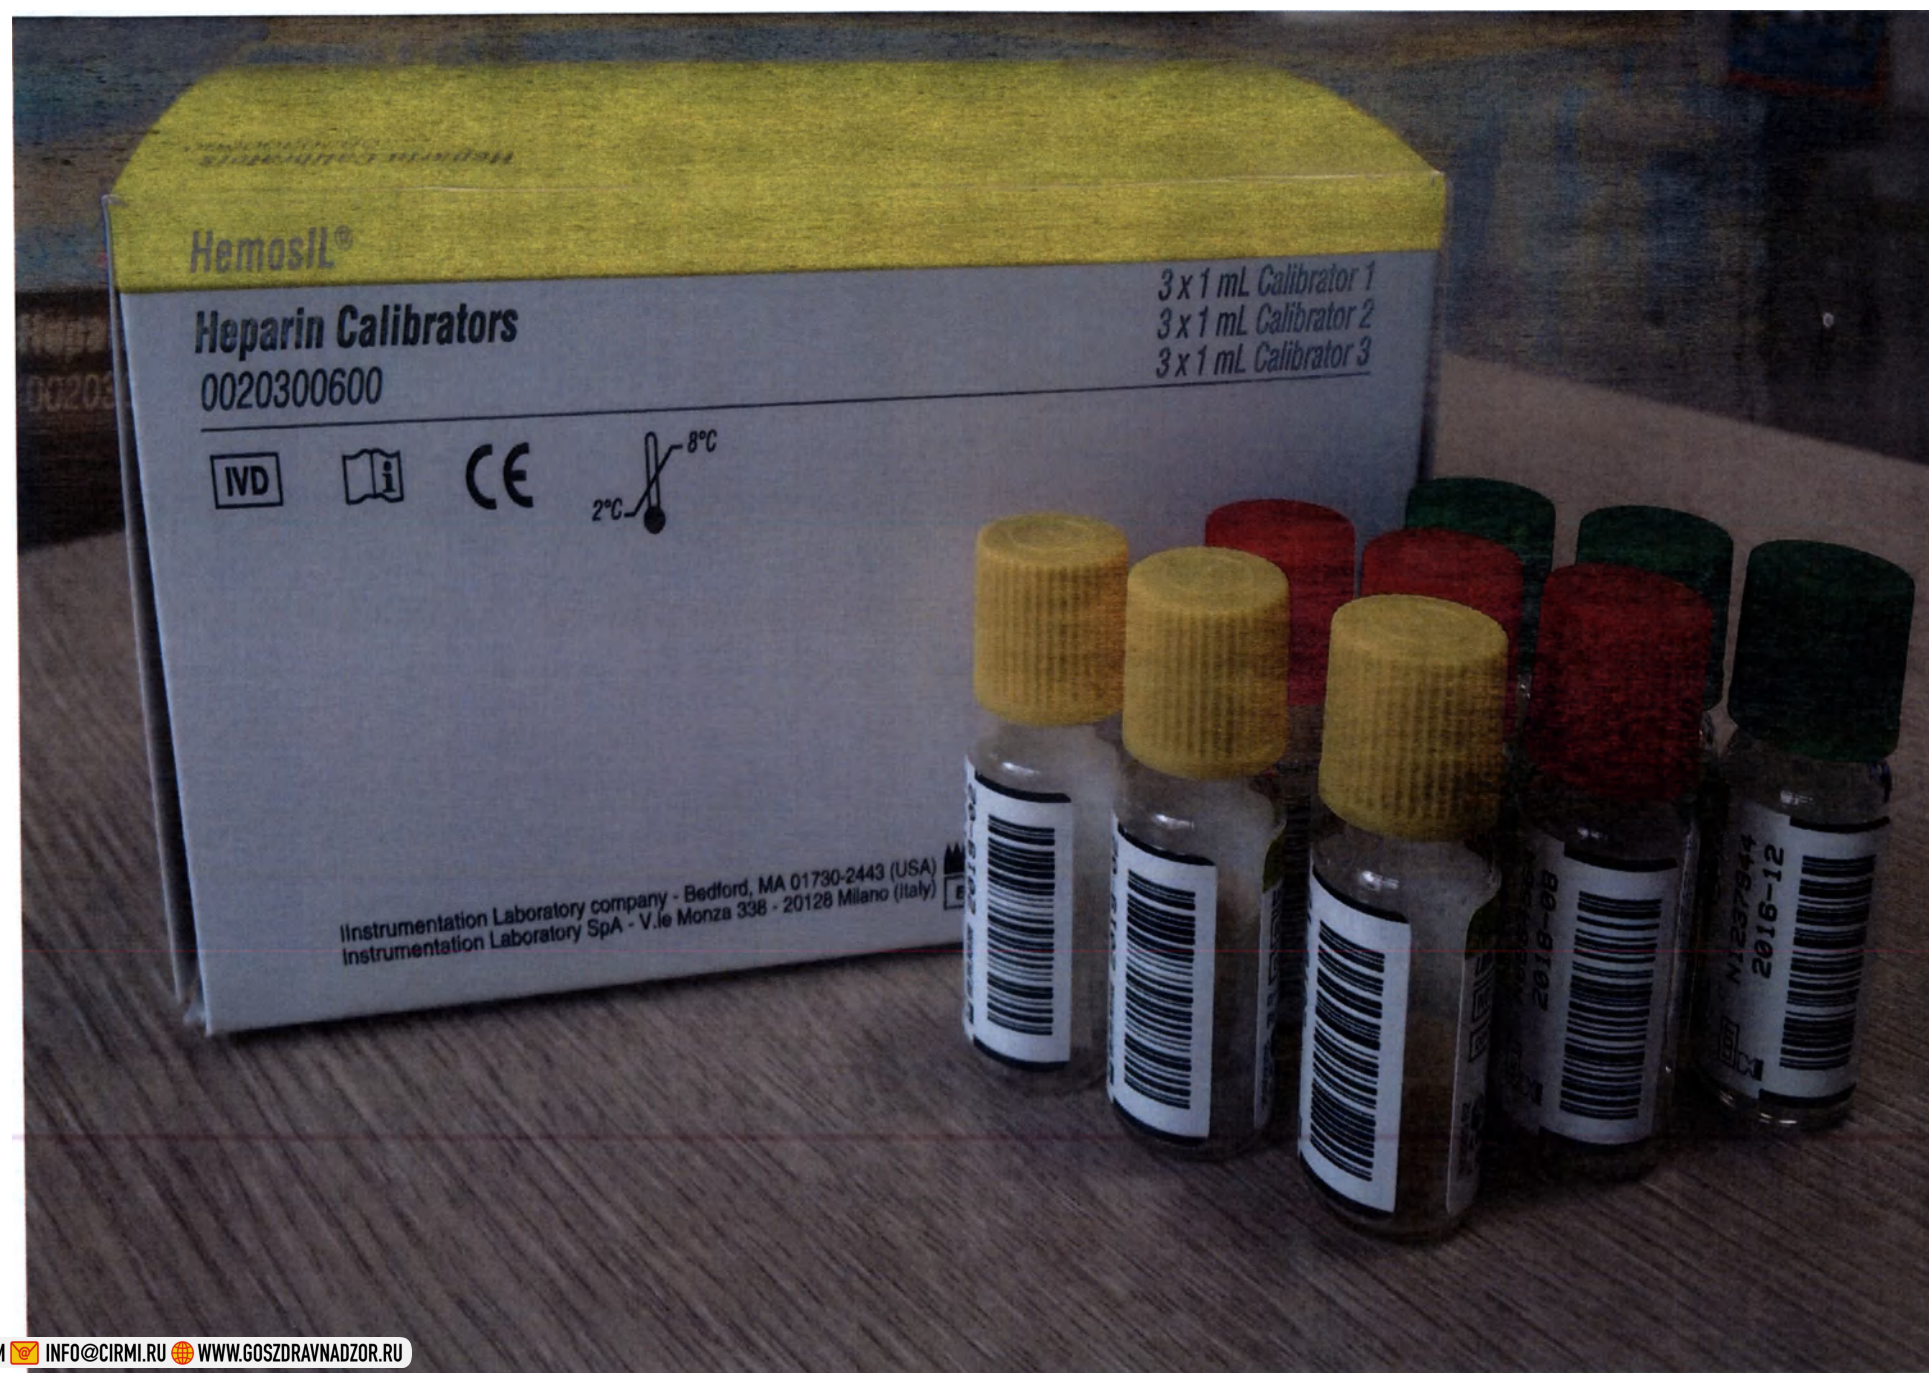

Фибриноген-С – HemosIL Fibrinogen-C

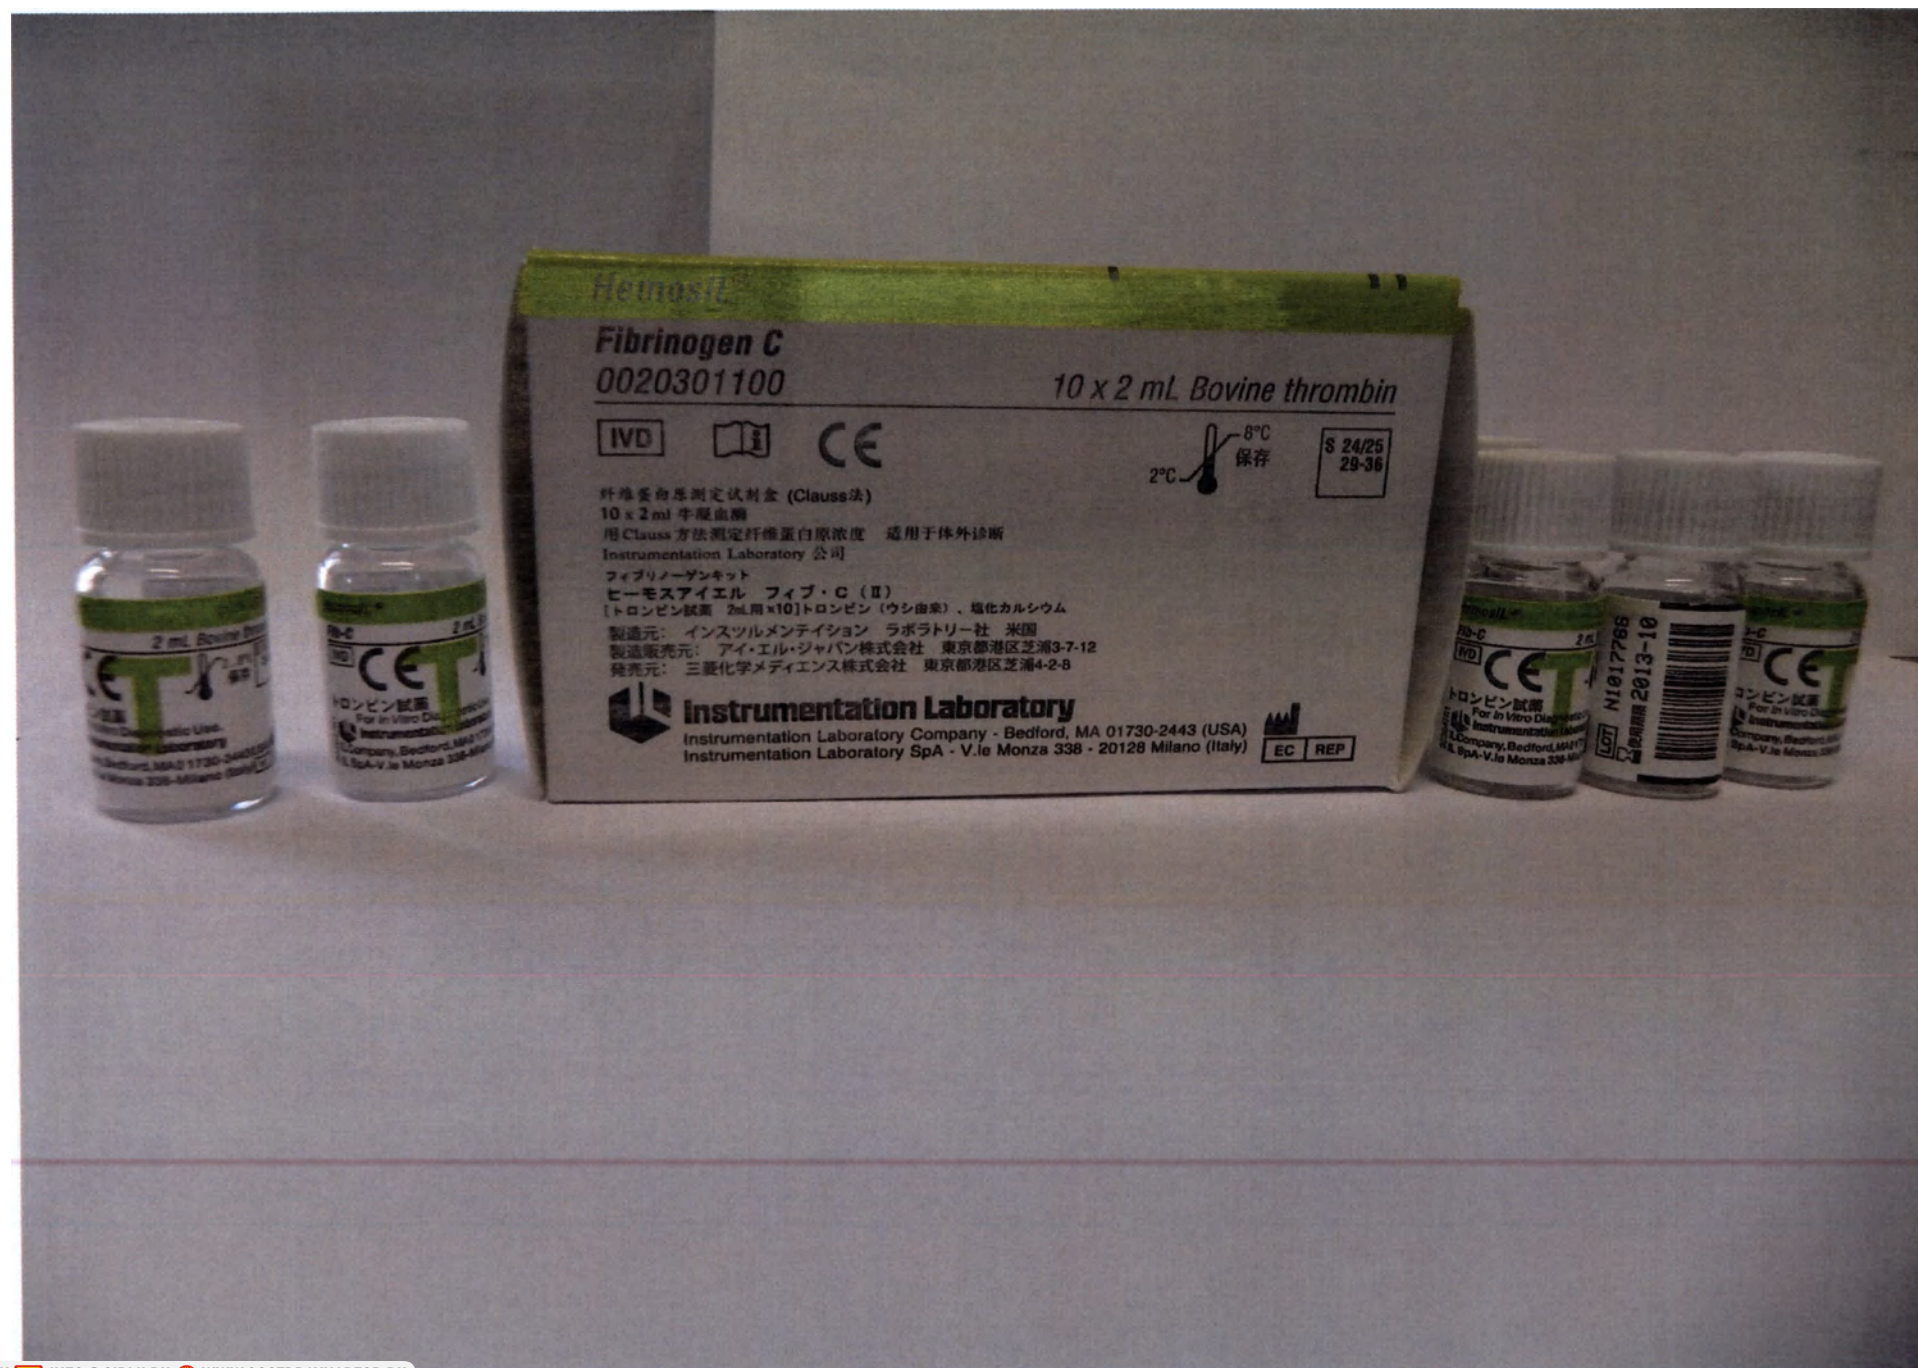

Д-Димер Высокочувствительный 500 - HemosIL D-Dimer HS 500



Контроли Д-Димера высокочувствительного 500, жидкие - HemosIL D-Dimer HS 500 Controls






HemosIL®

D-Dimer 500

0020301000

4 x 3 mL Latex Reagent
4 x 9 mL Reaction Buffer
2 x 1 mL D-Dimer Calibrator



**Instrumentation
Laboratory**

A Werfen Company

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 33B - 20128 Milano (Italy)




ISO 13485




Фактор Виллебранда RCo - HemosIL VWF: RCo




Acustar Д-Димер- HemosIL Acustar D-Dimer

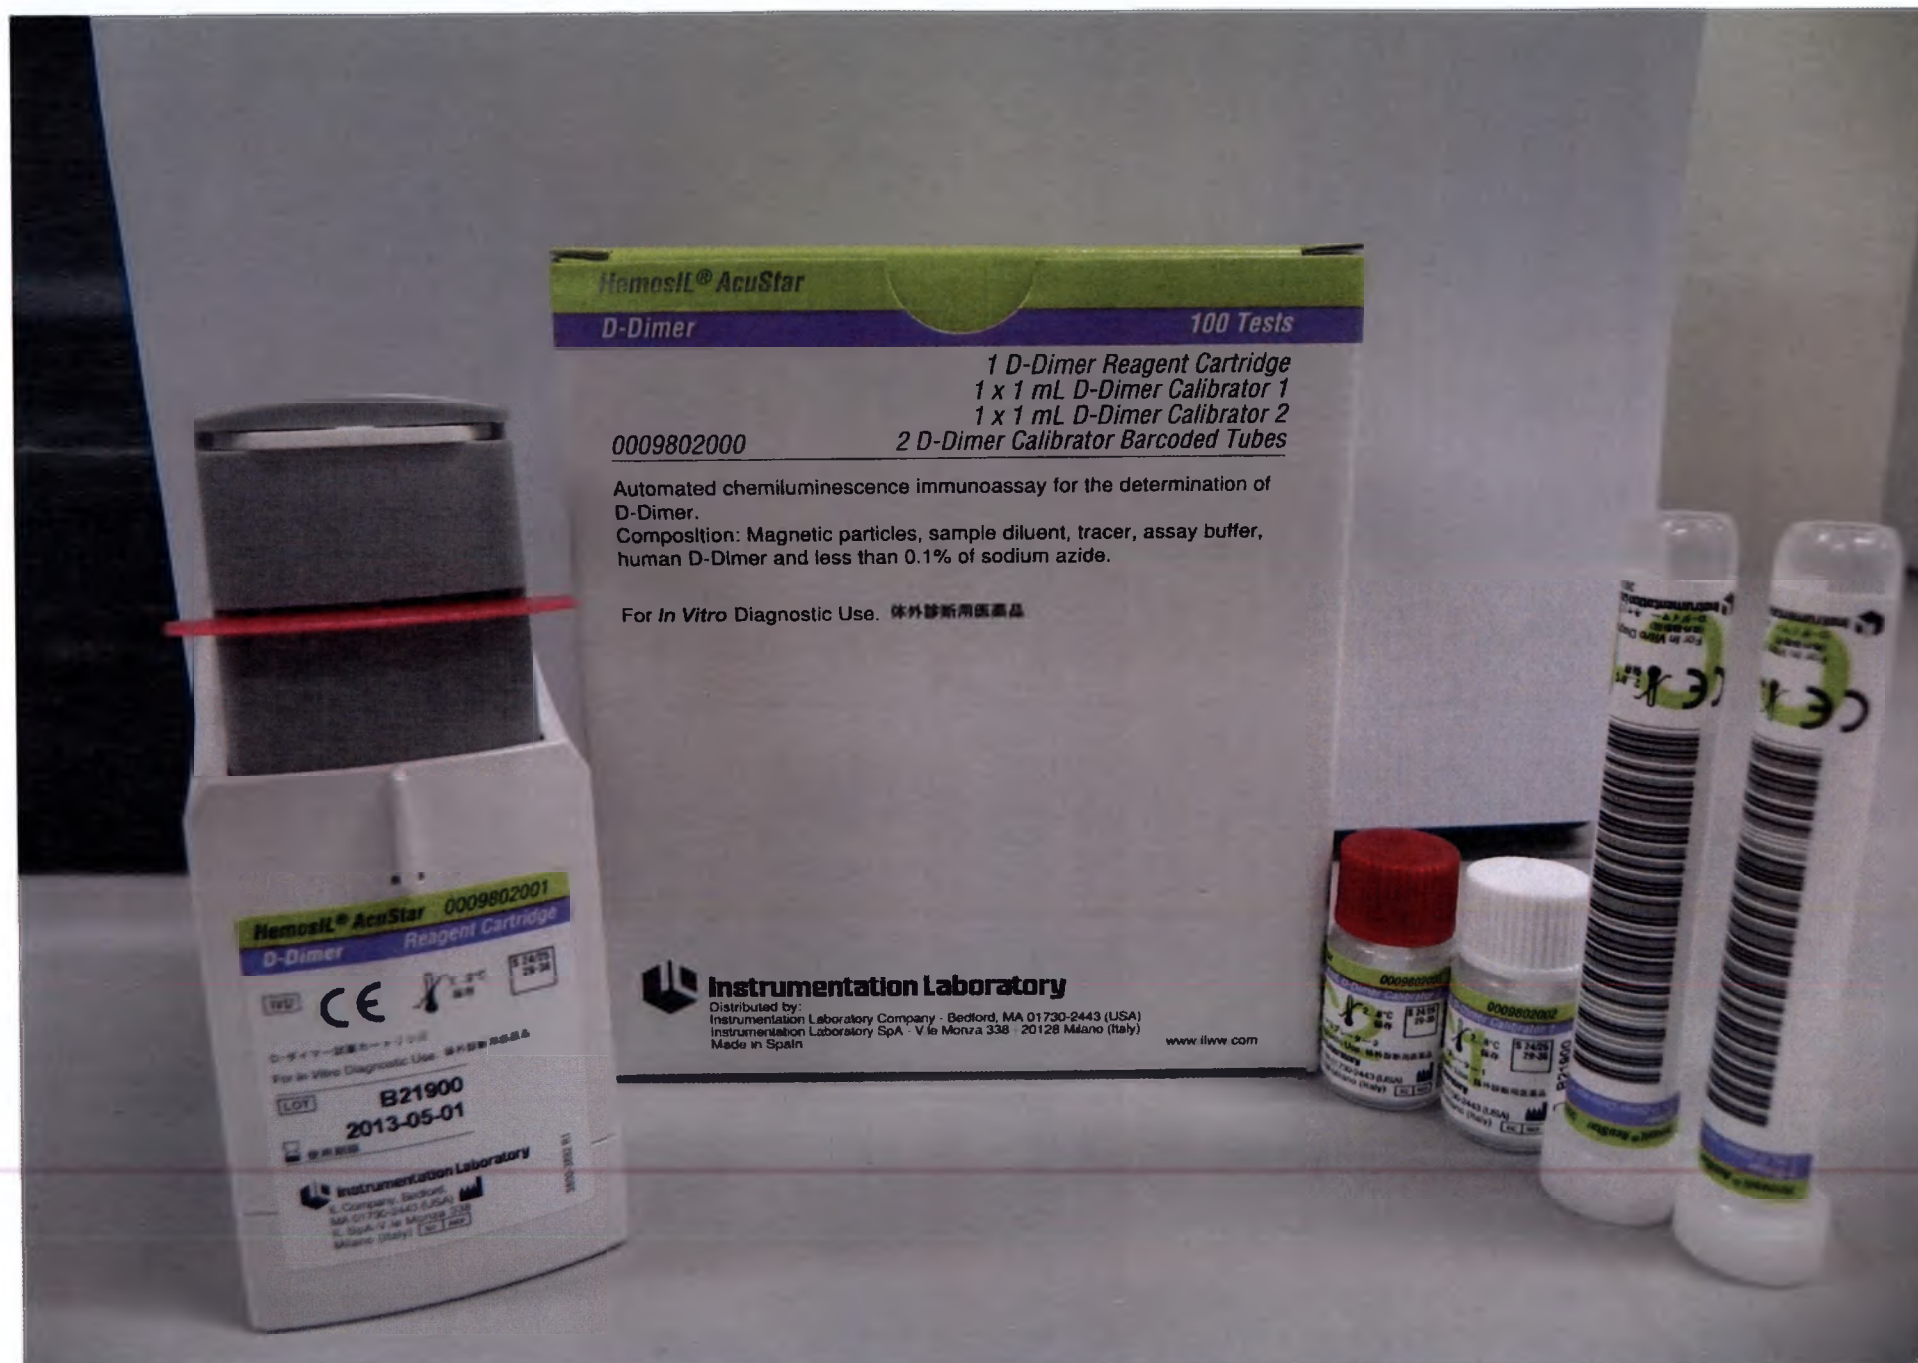


Acustar Анти-Кардиолипин IgG - HemosIL AcuStar Anti-Cardiolipin IgG

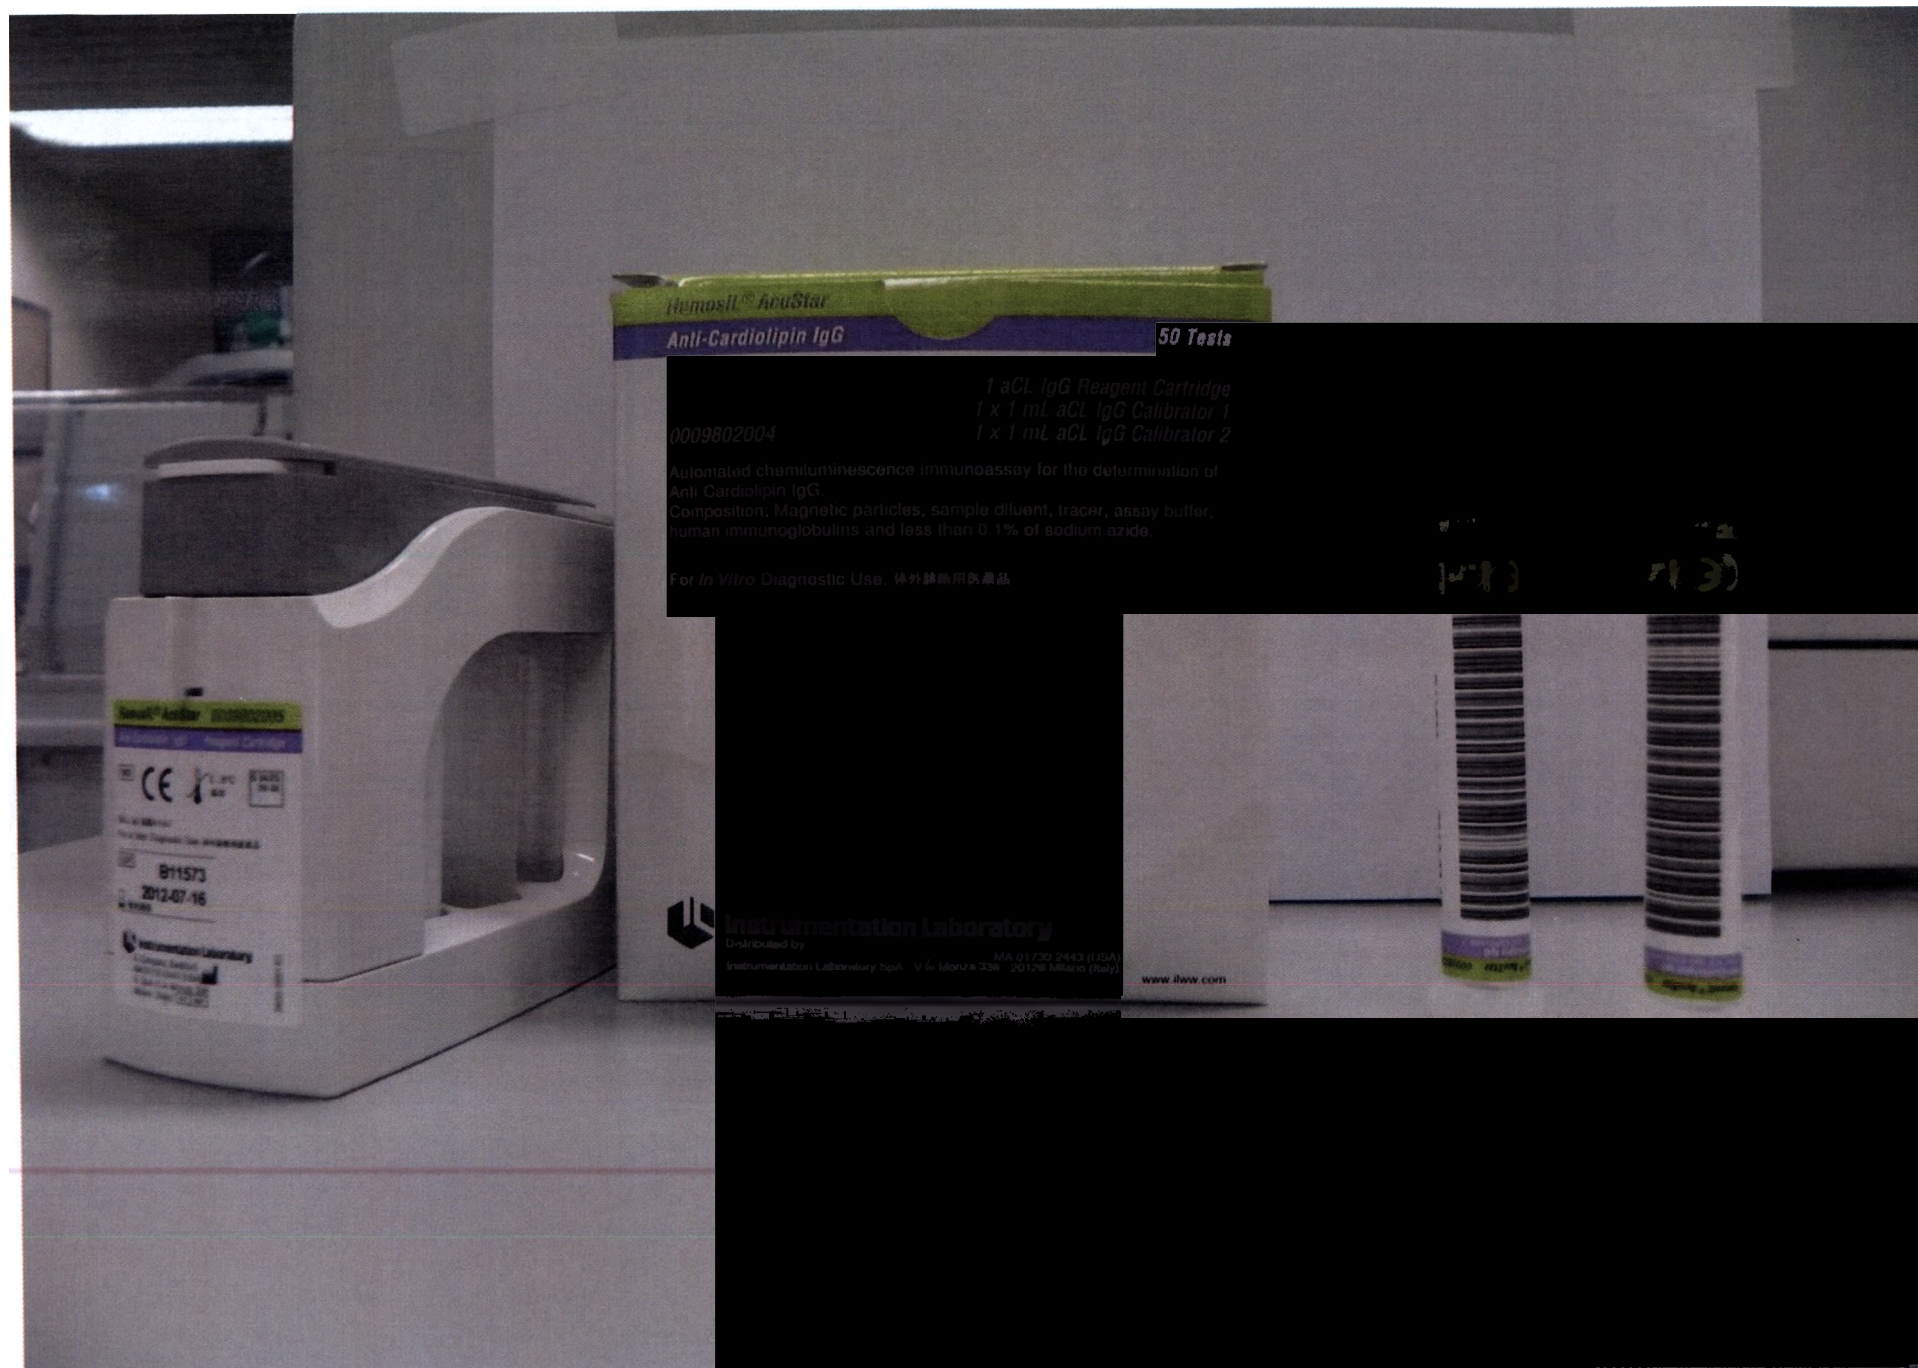


AcuStar Анти-Кардиолипин IgM - HemosIL AcuStar Anti-Cardiolipin IgM

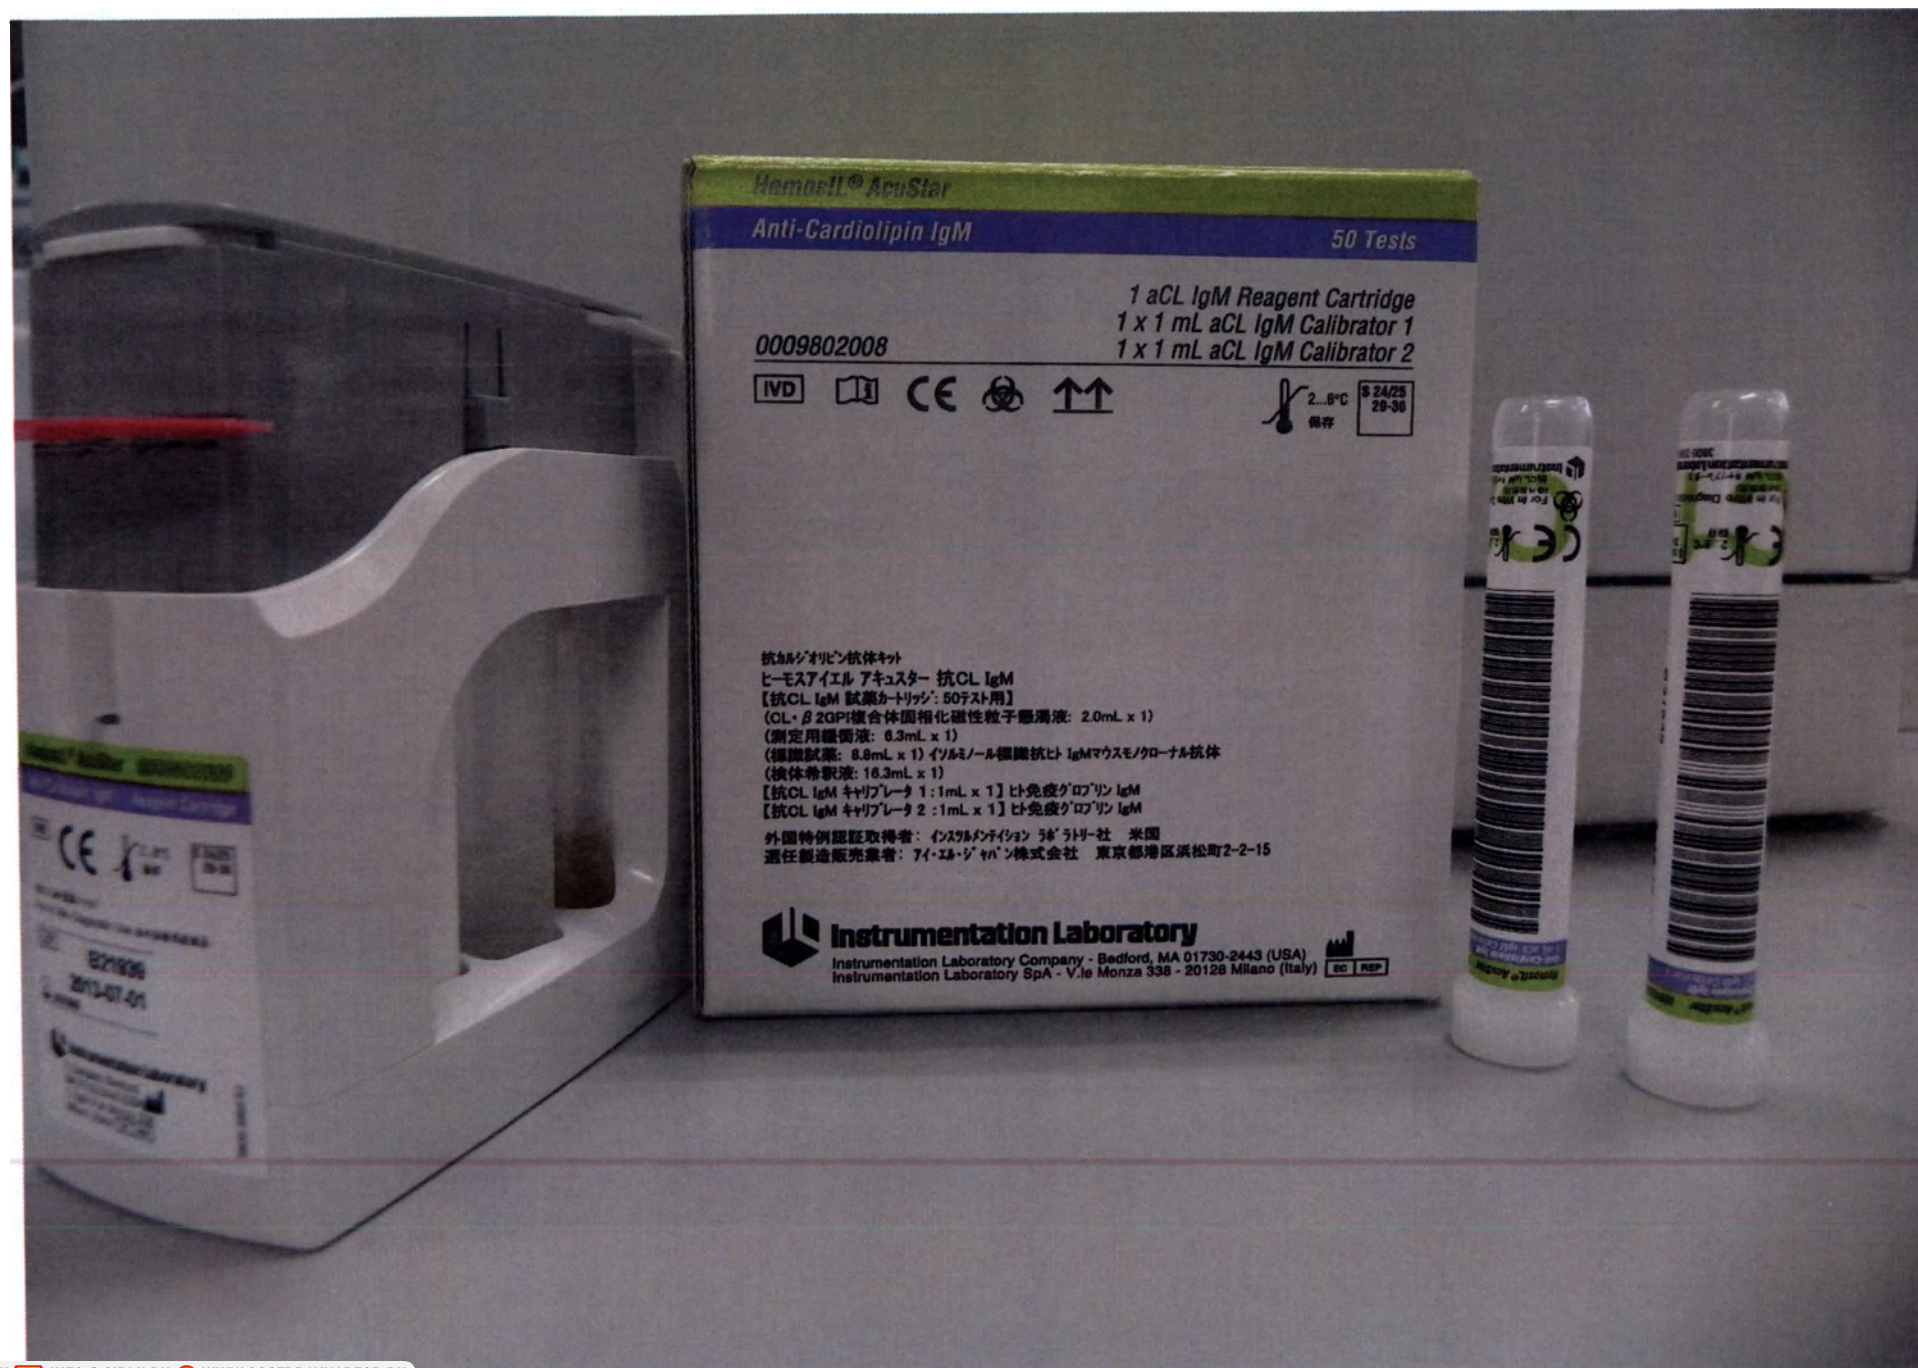


AcuStar Анти-β2 Гликопротеин-I IgG - HemosIL AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgG

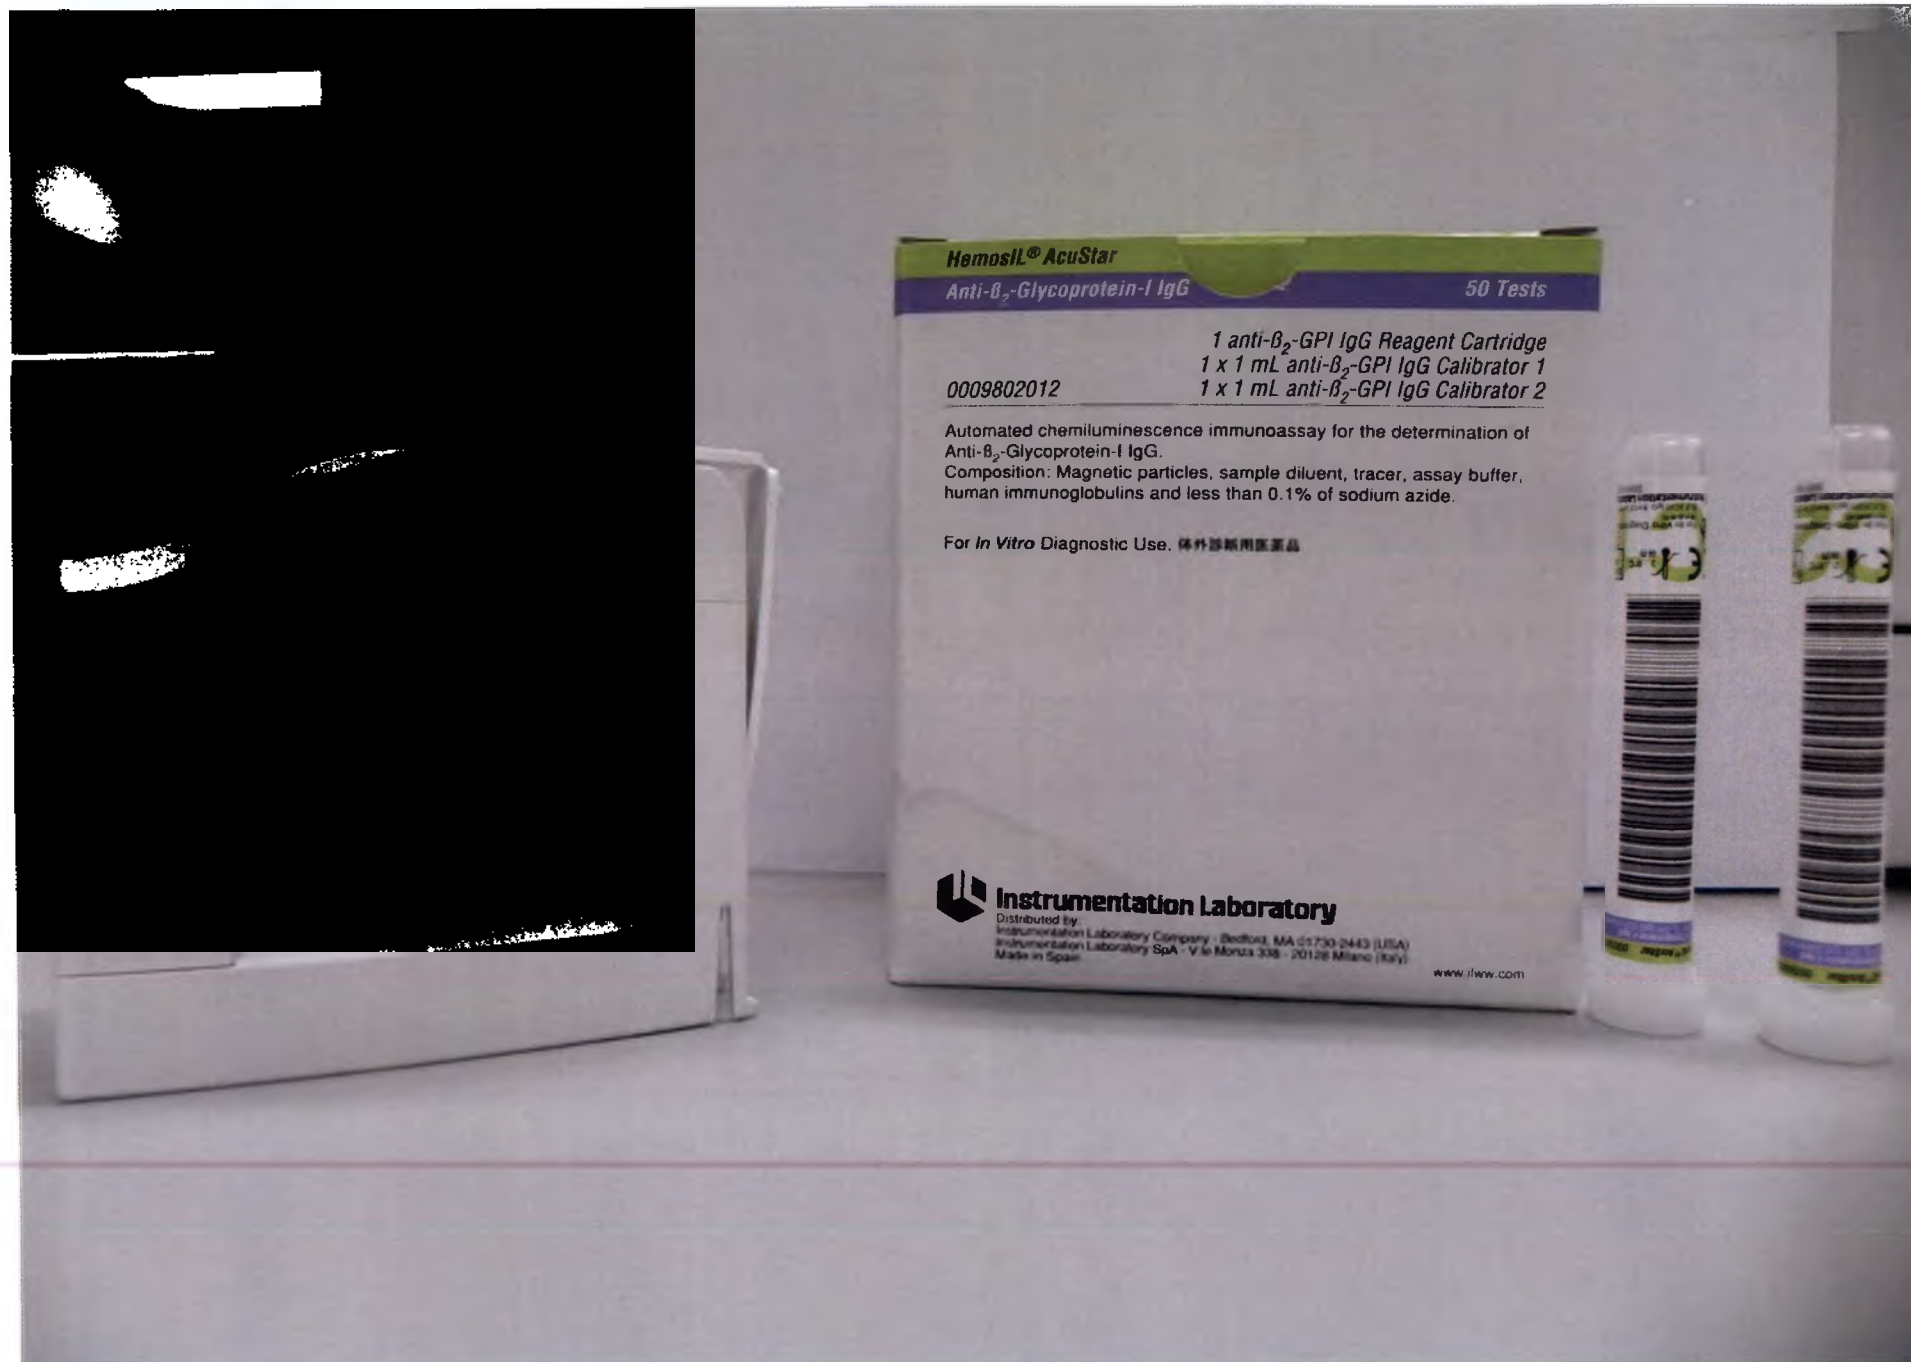


АcuStar Анти-β2 Гликопротеин-I IgM - HemosIL АcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgM

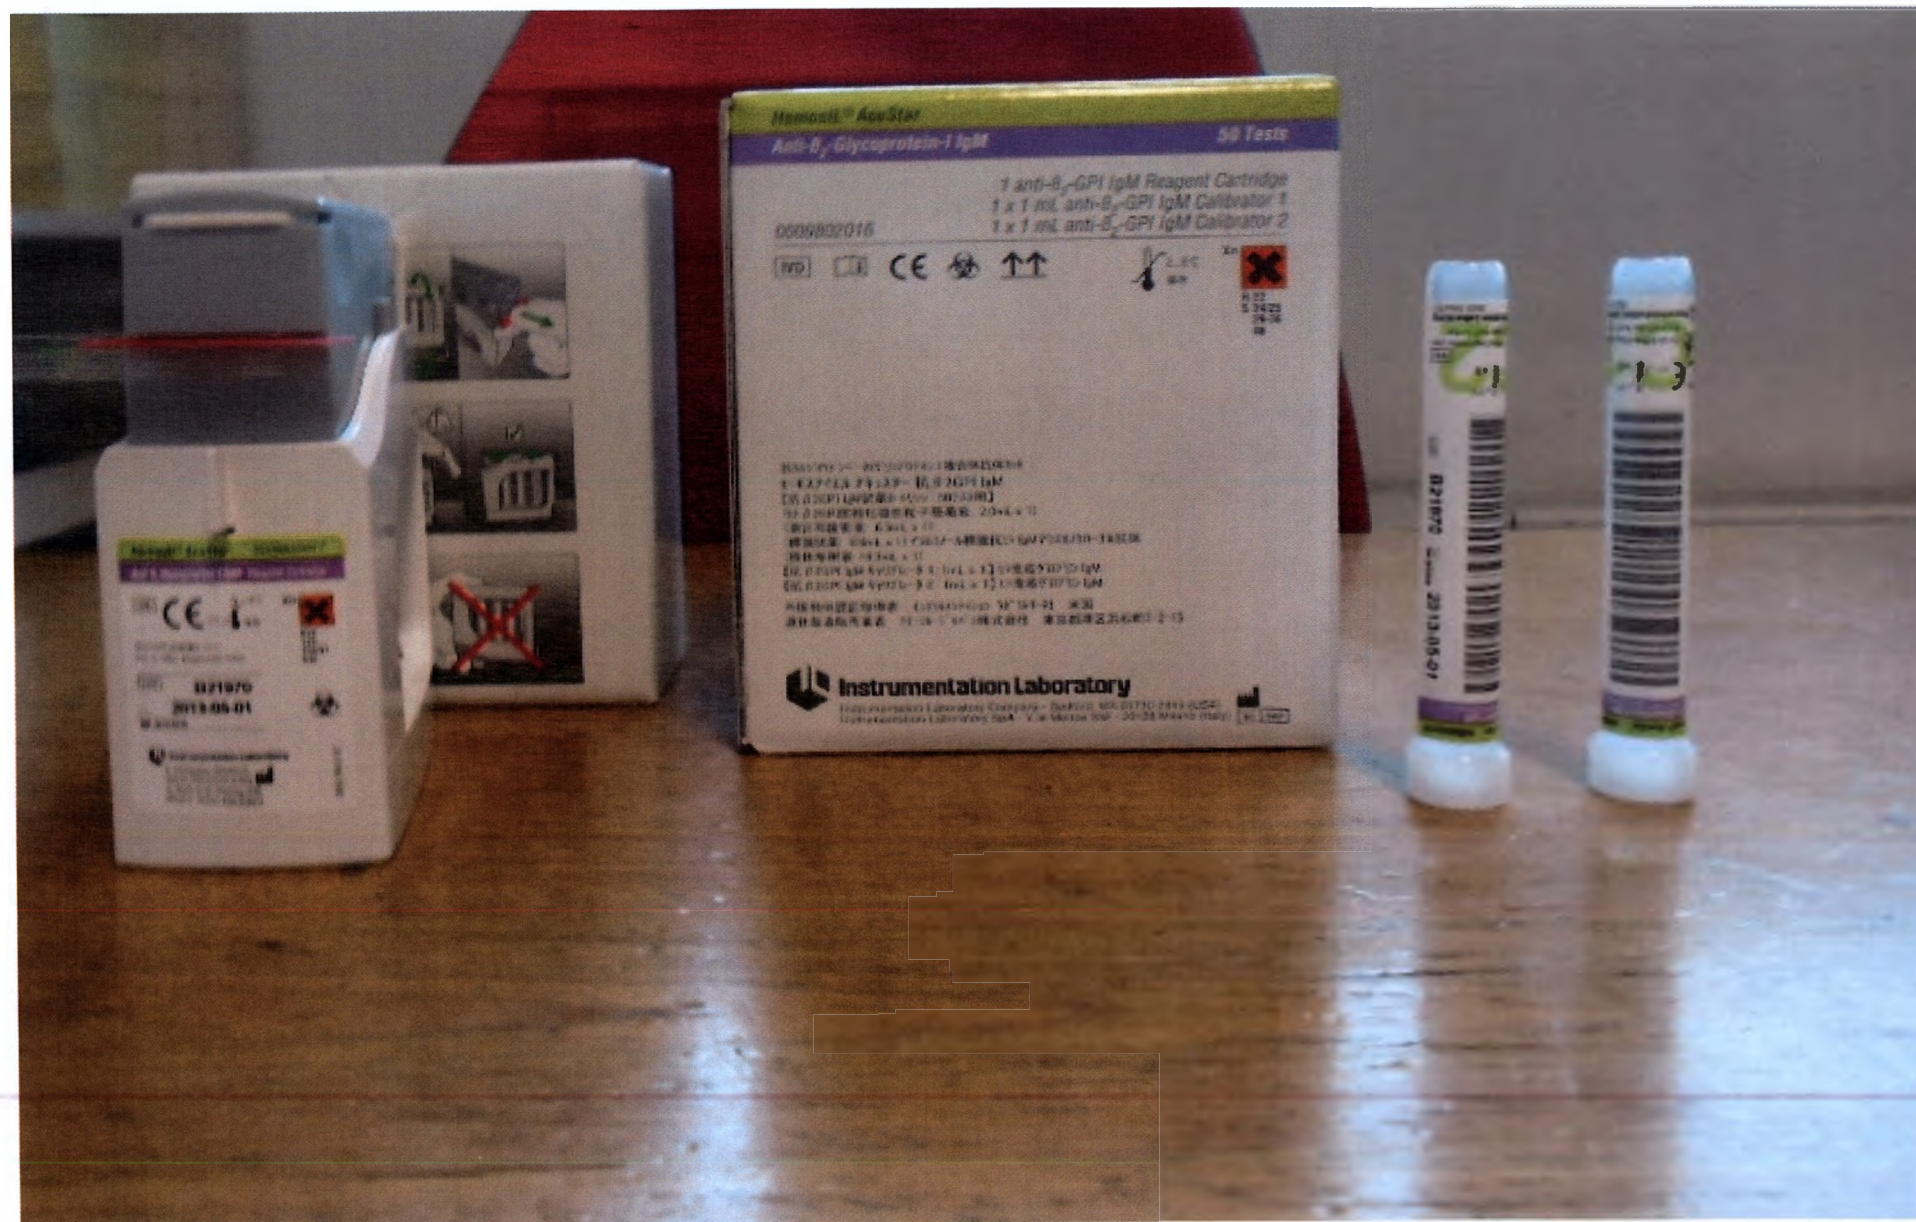


Acustar Д-Димер Контроли - HemosIL Acustar D-Dimer Controls

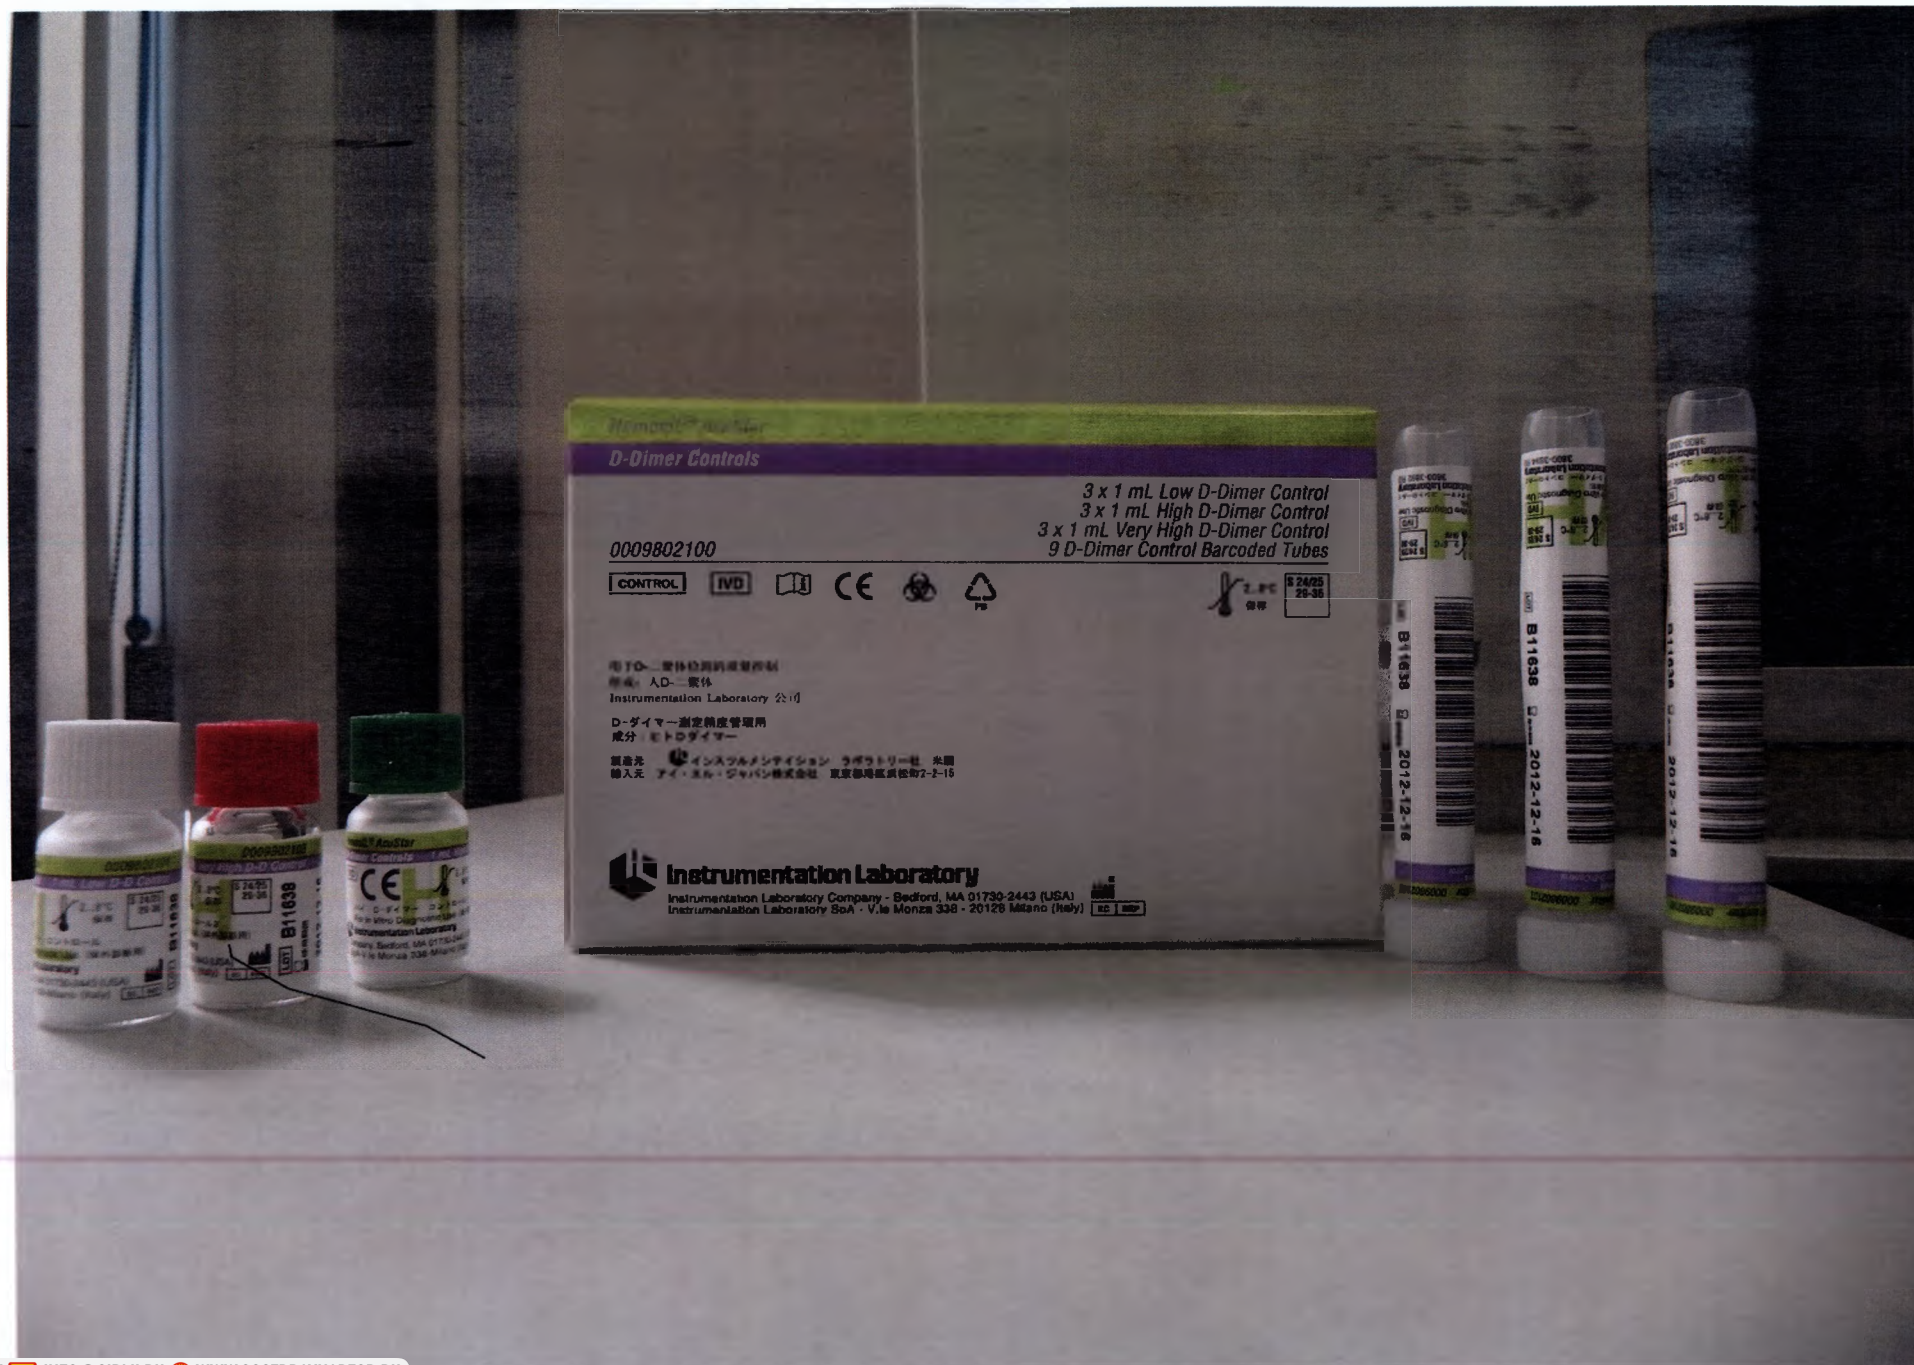


AcuStar Анти-Кардиолипин IgG Контроли - HemosIL AcuStar Anti-Cardiolipin IgG

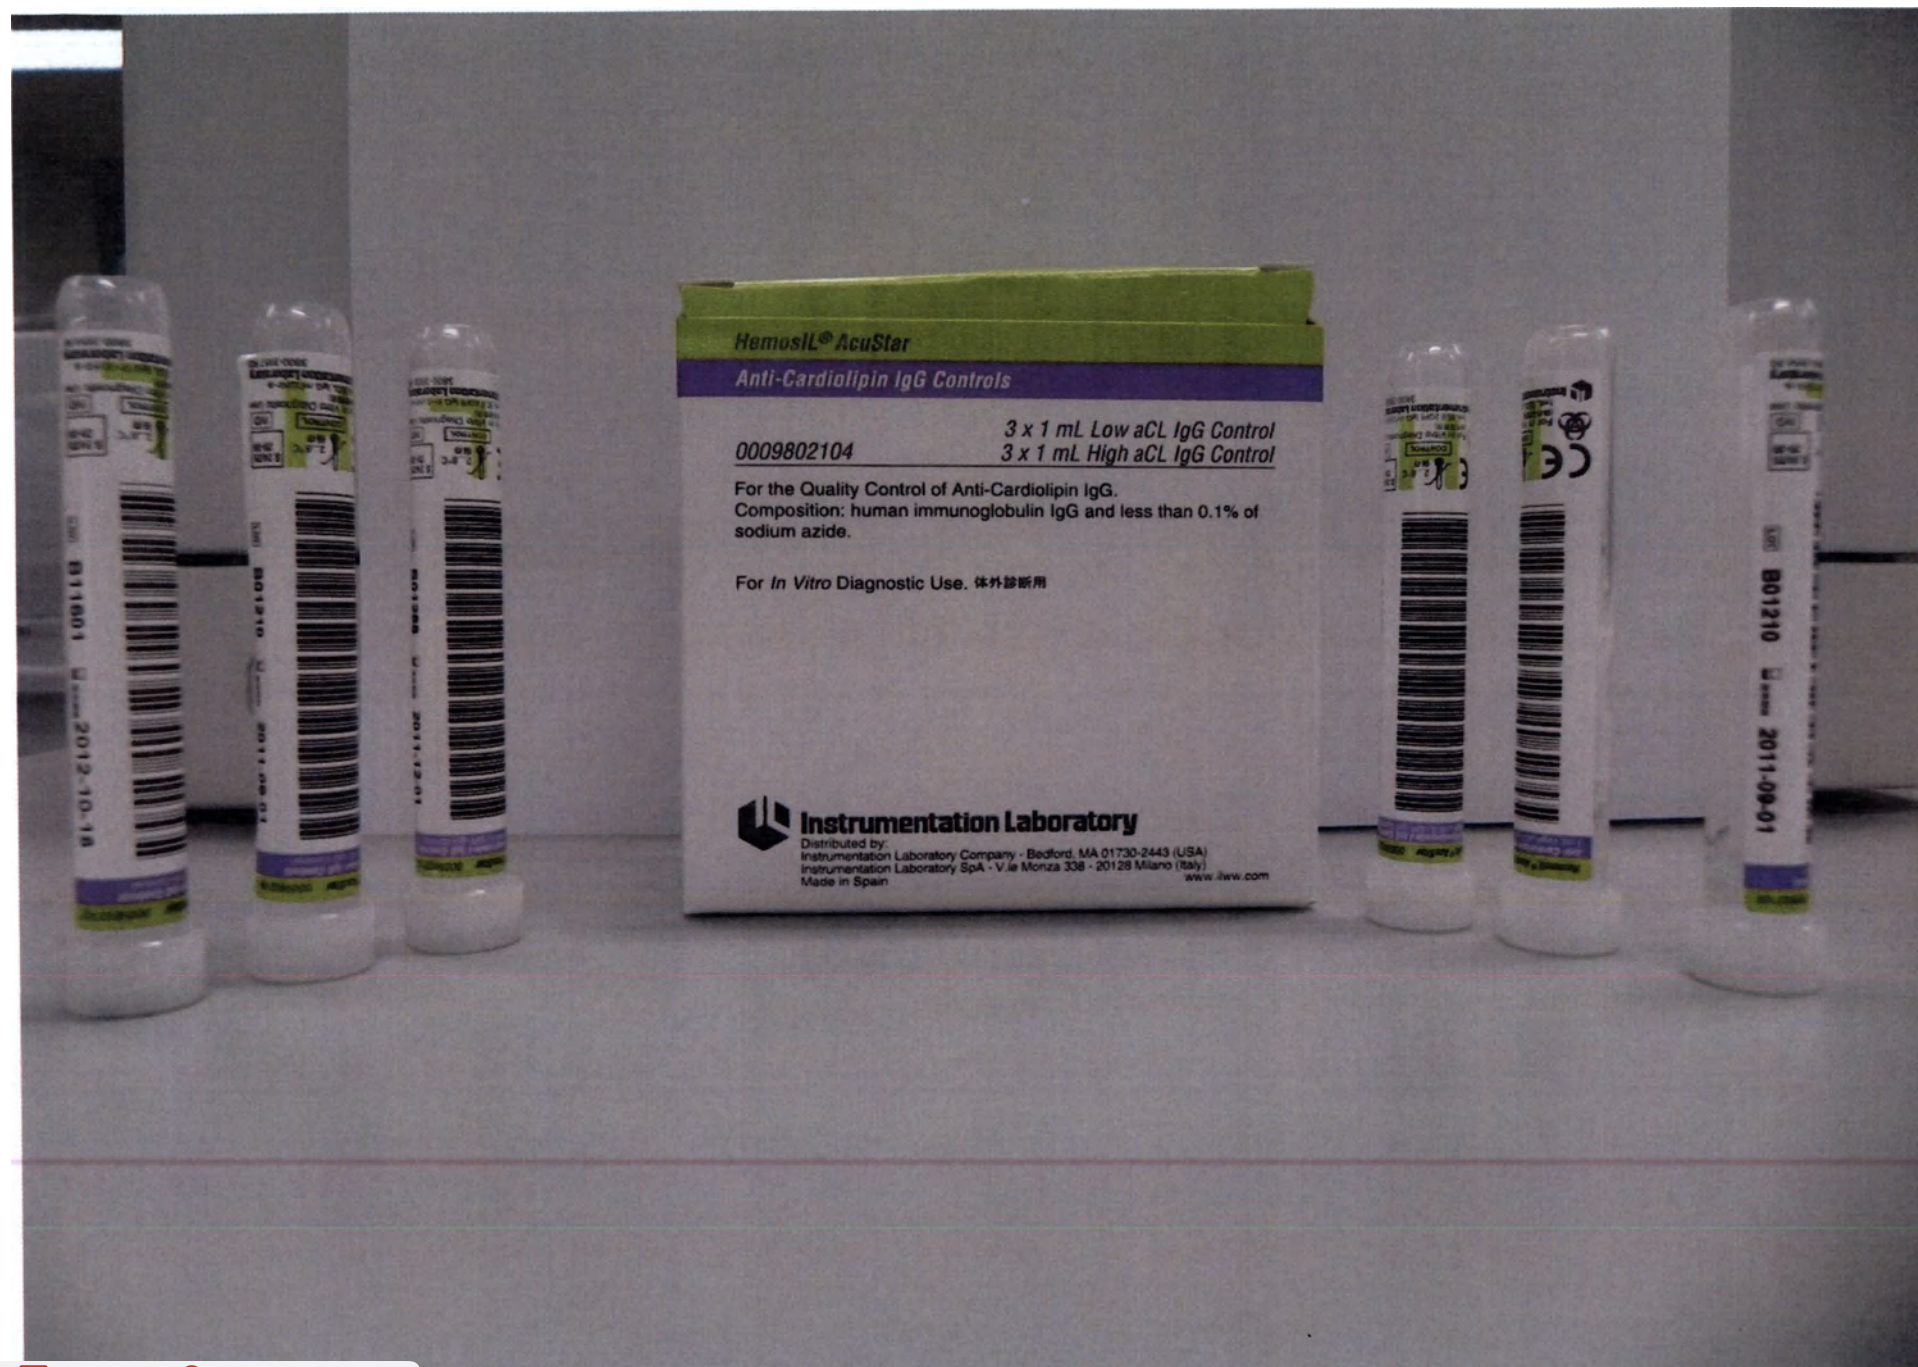

AcuStar Анти-Кардиолипин IgM Контроли - HemosIL AcuStar Anti-Cardiolipin IgM controls

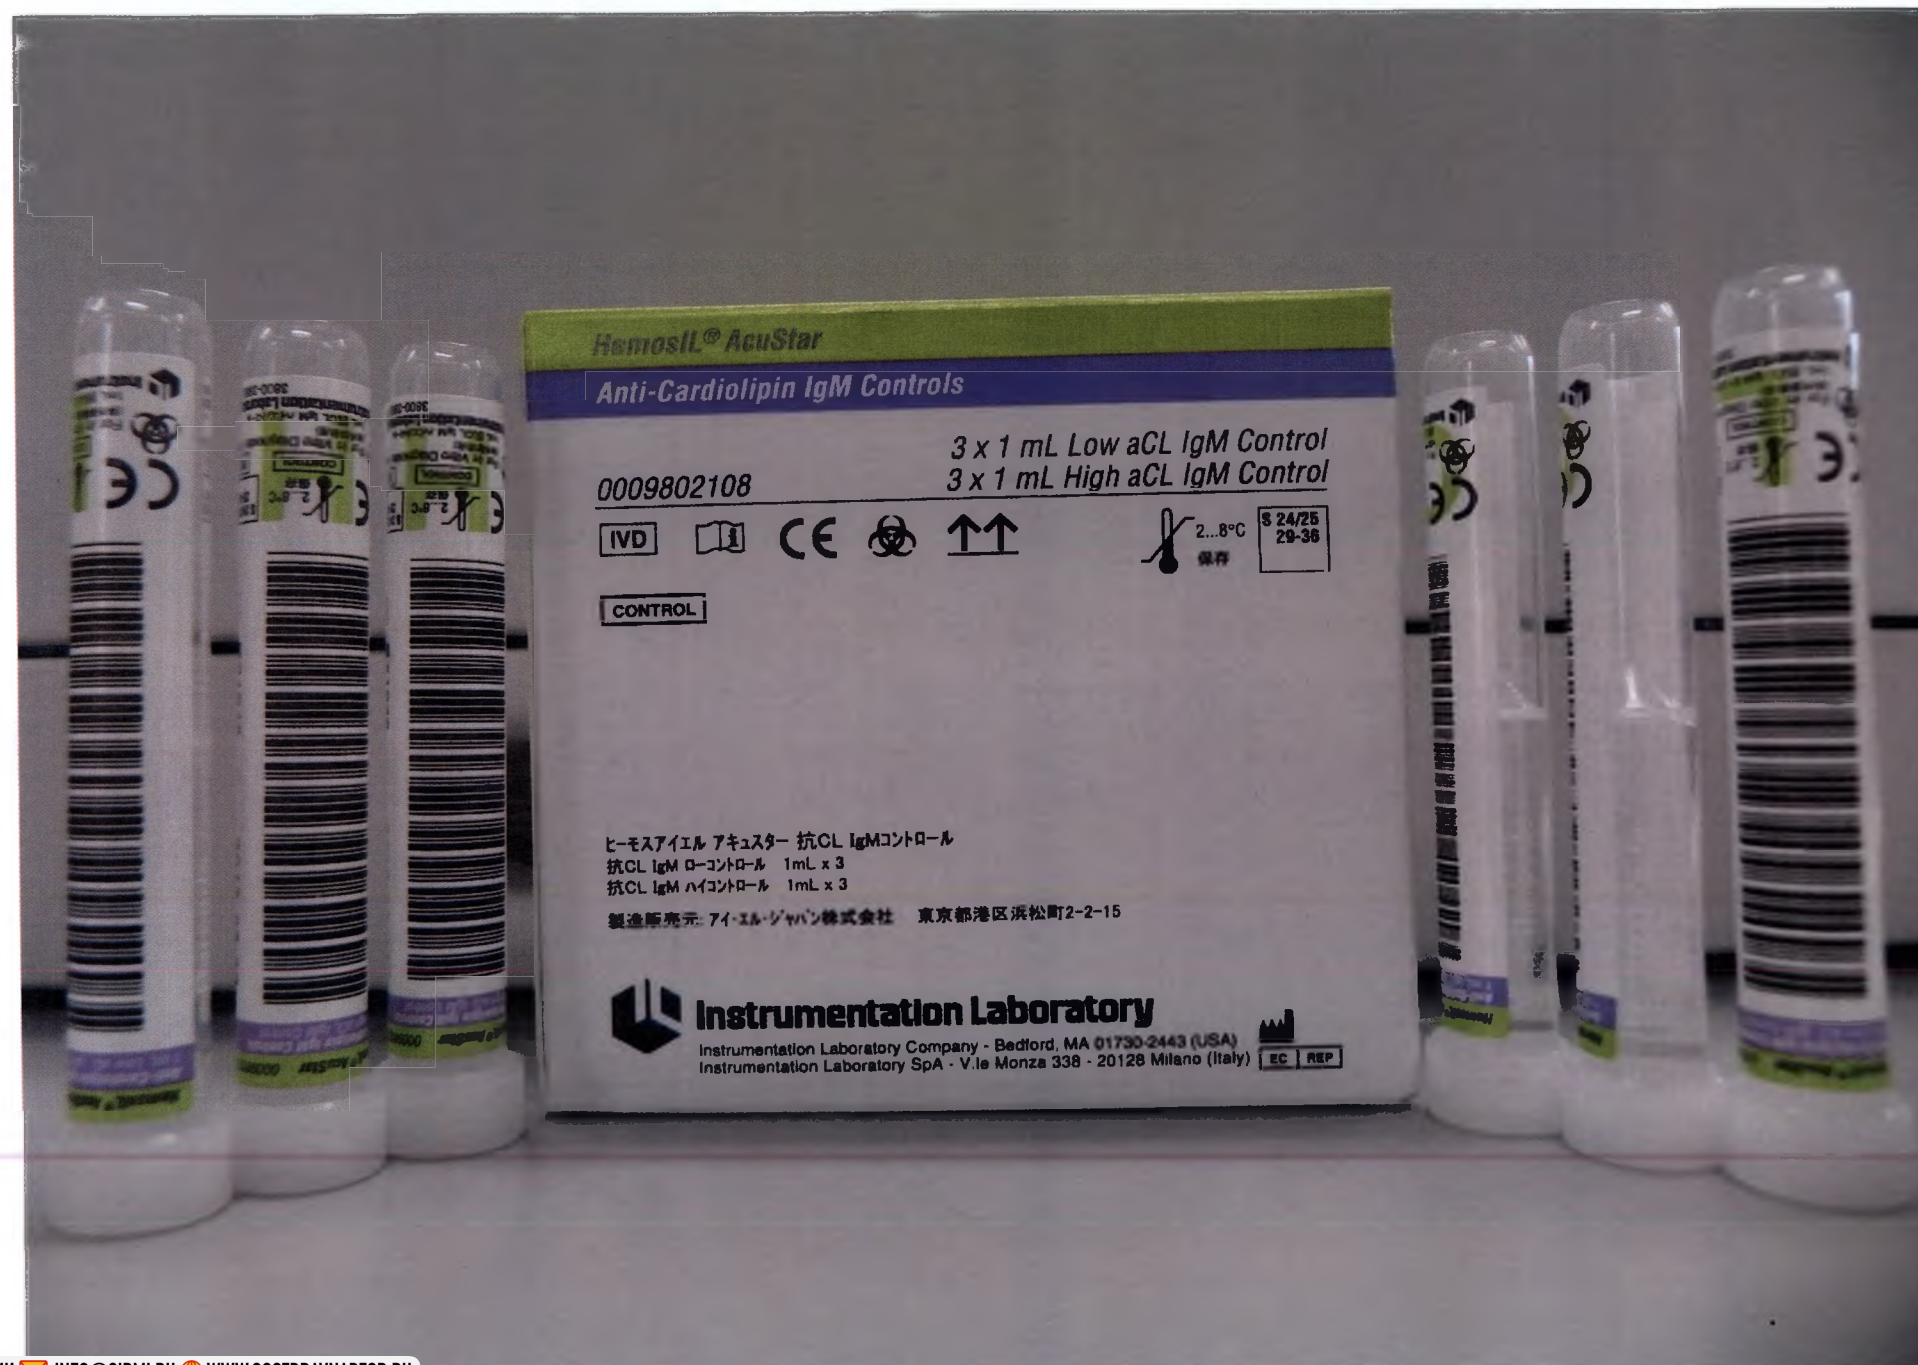


AcuStar Анти-β2 Гликопротеин-I IgG Контроли - HemosIL AcuStar Anti-β2 Glycoprotein-I IgG Controls

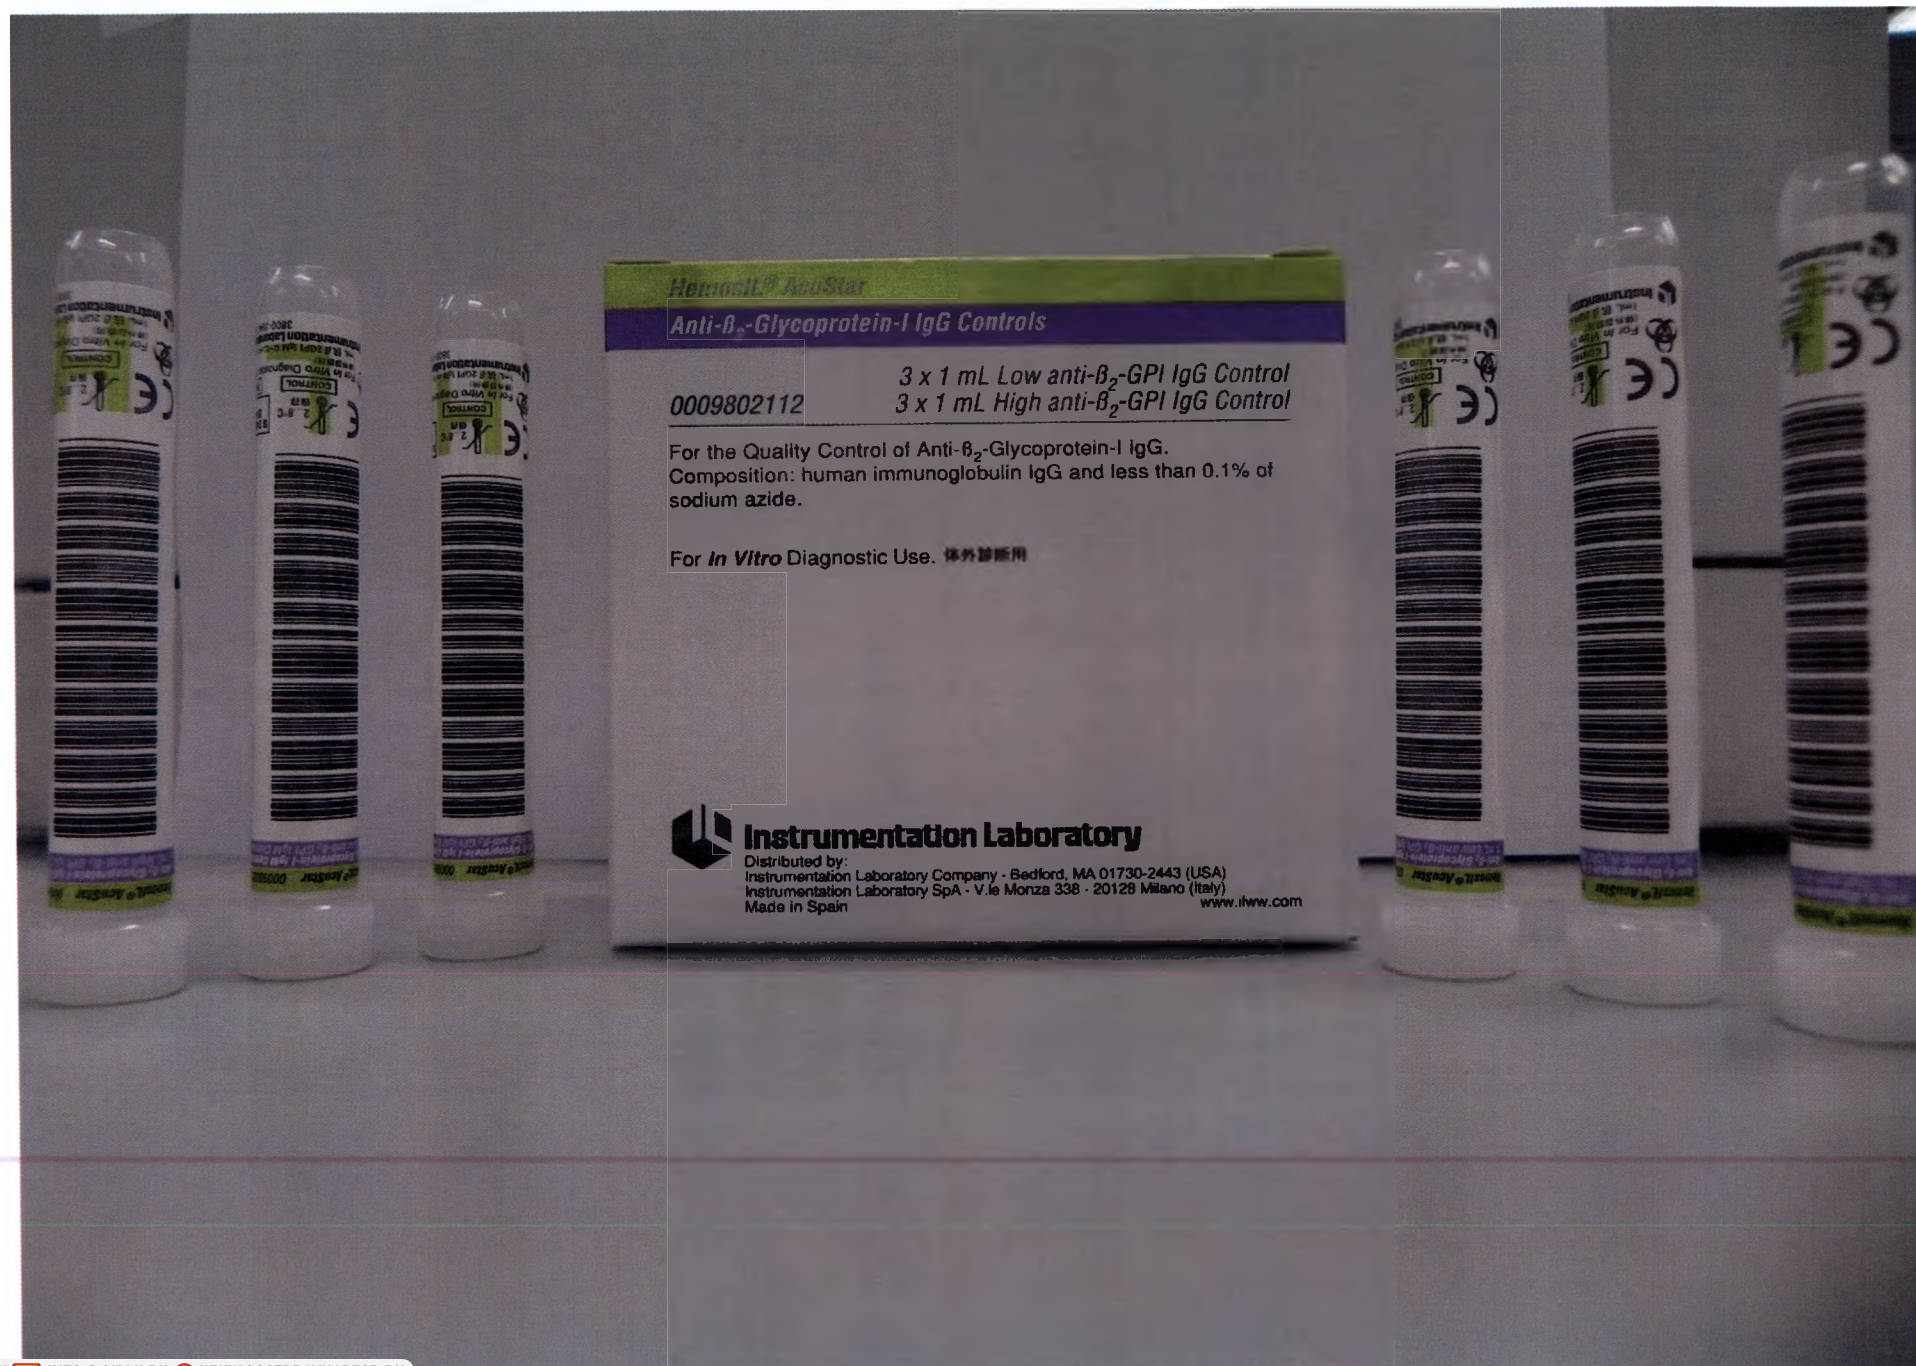


AcuStar Анти- β 2 Гликопротеин-I IgM Контроли - HemosIL AcuStar Anti- β 2 Glycoprotein IgM Controls



Acustar Моющий раствор - HemosIL Acustar System Rinse

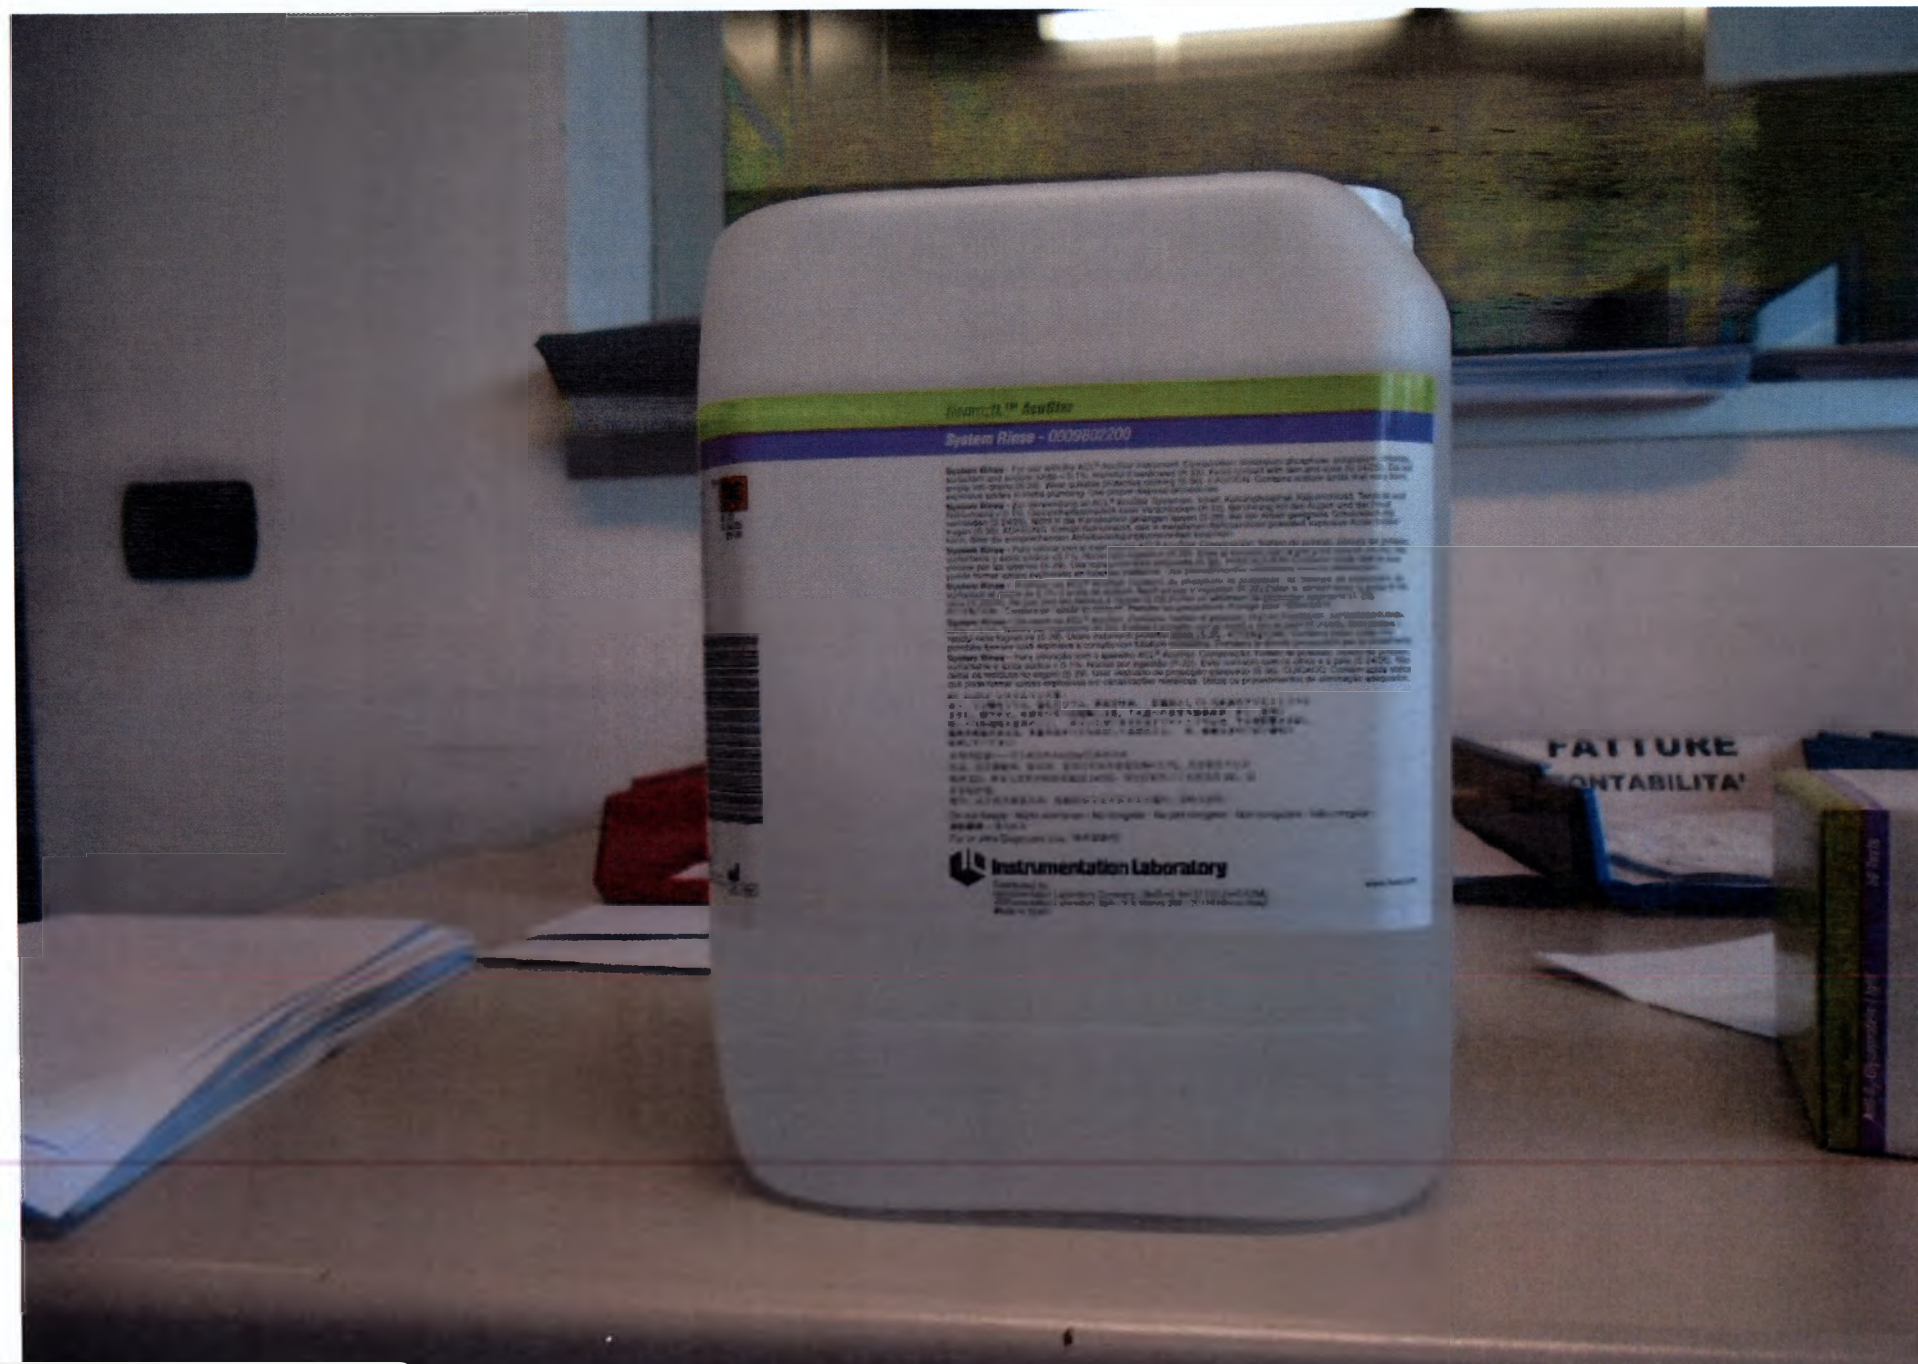

Acustar Триггеры - HemosIL Acustar Triggers

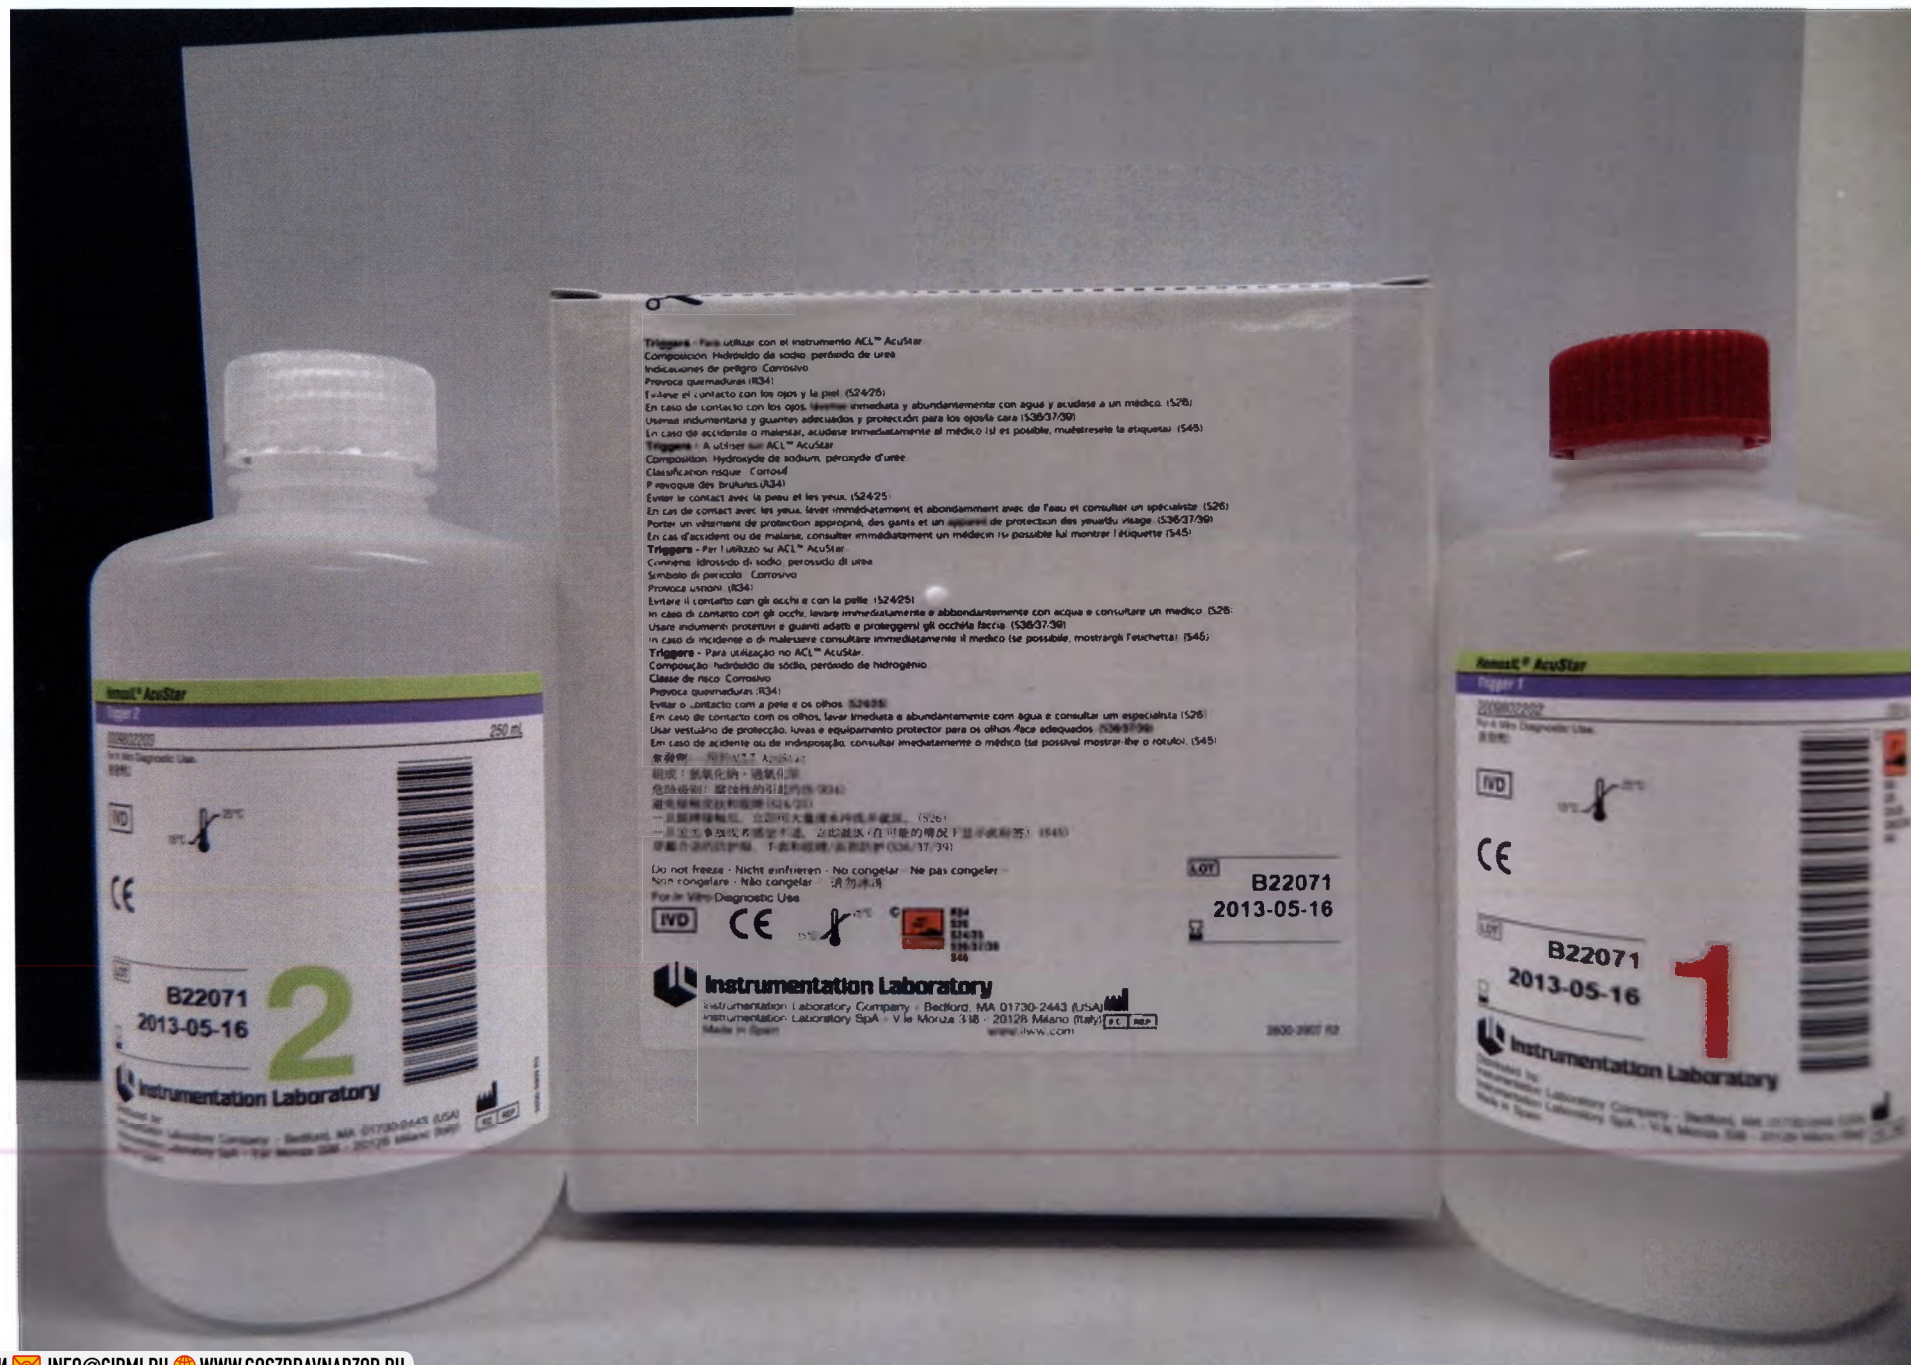

Роторы для анализов (1x20 позиций, 100 шт/уп) - Rotors (20 cuvette)



Rotors

0006800000

Contains: 100 rotors 20 positions, For use with the ACL[®] Systems. For single use only.

For *in Vitro* Diagnostic Use

LOT


SSH1510
14



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in Spain

Роторы для анализов (1x20 позиций, 100 шт/уп) - Rotors (20 cuvette)

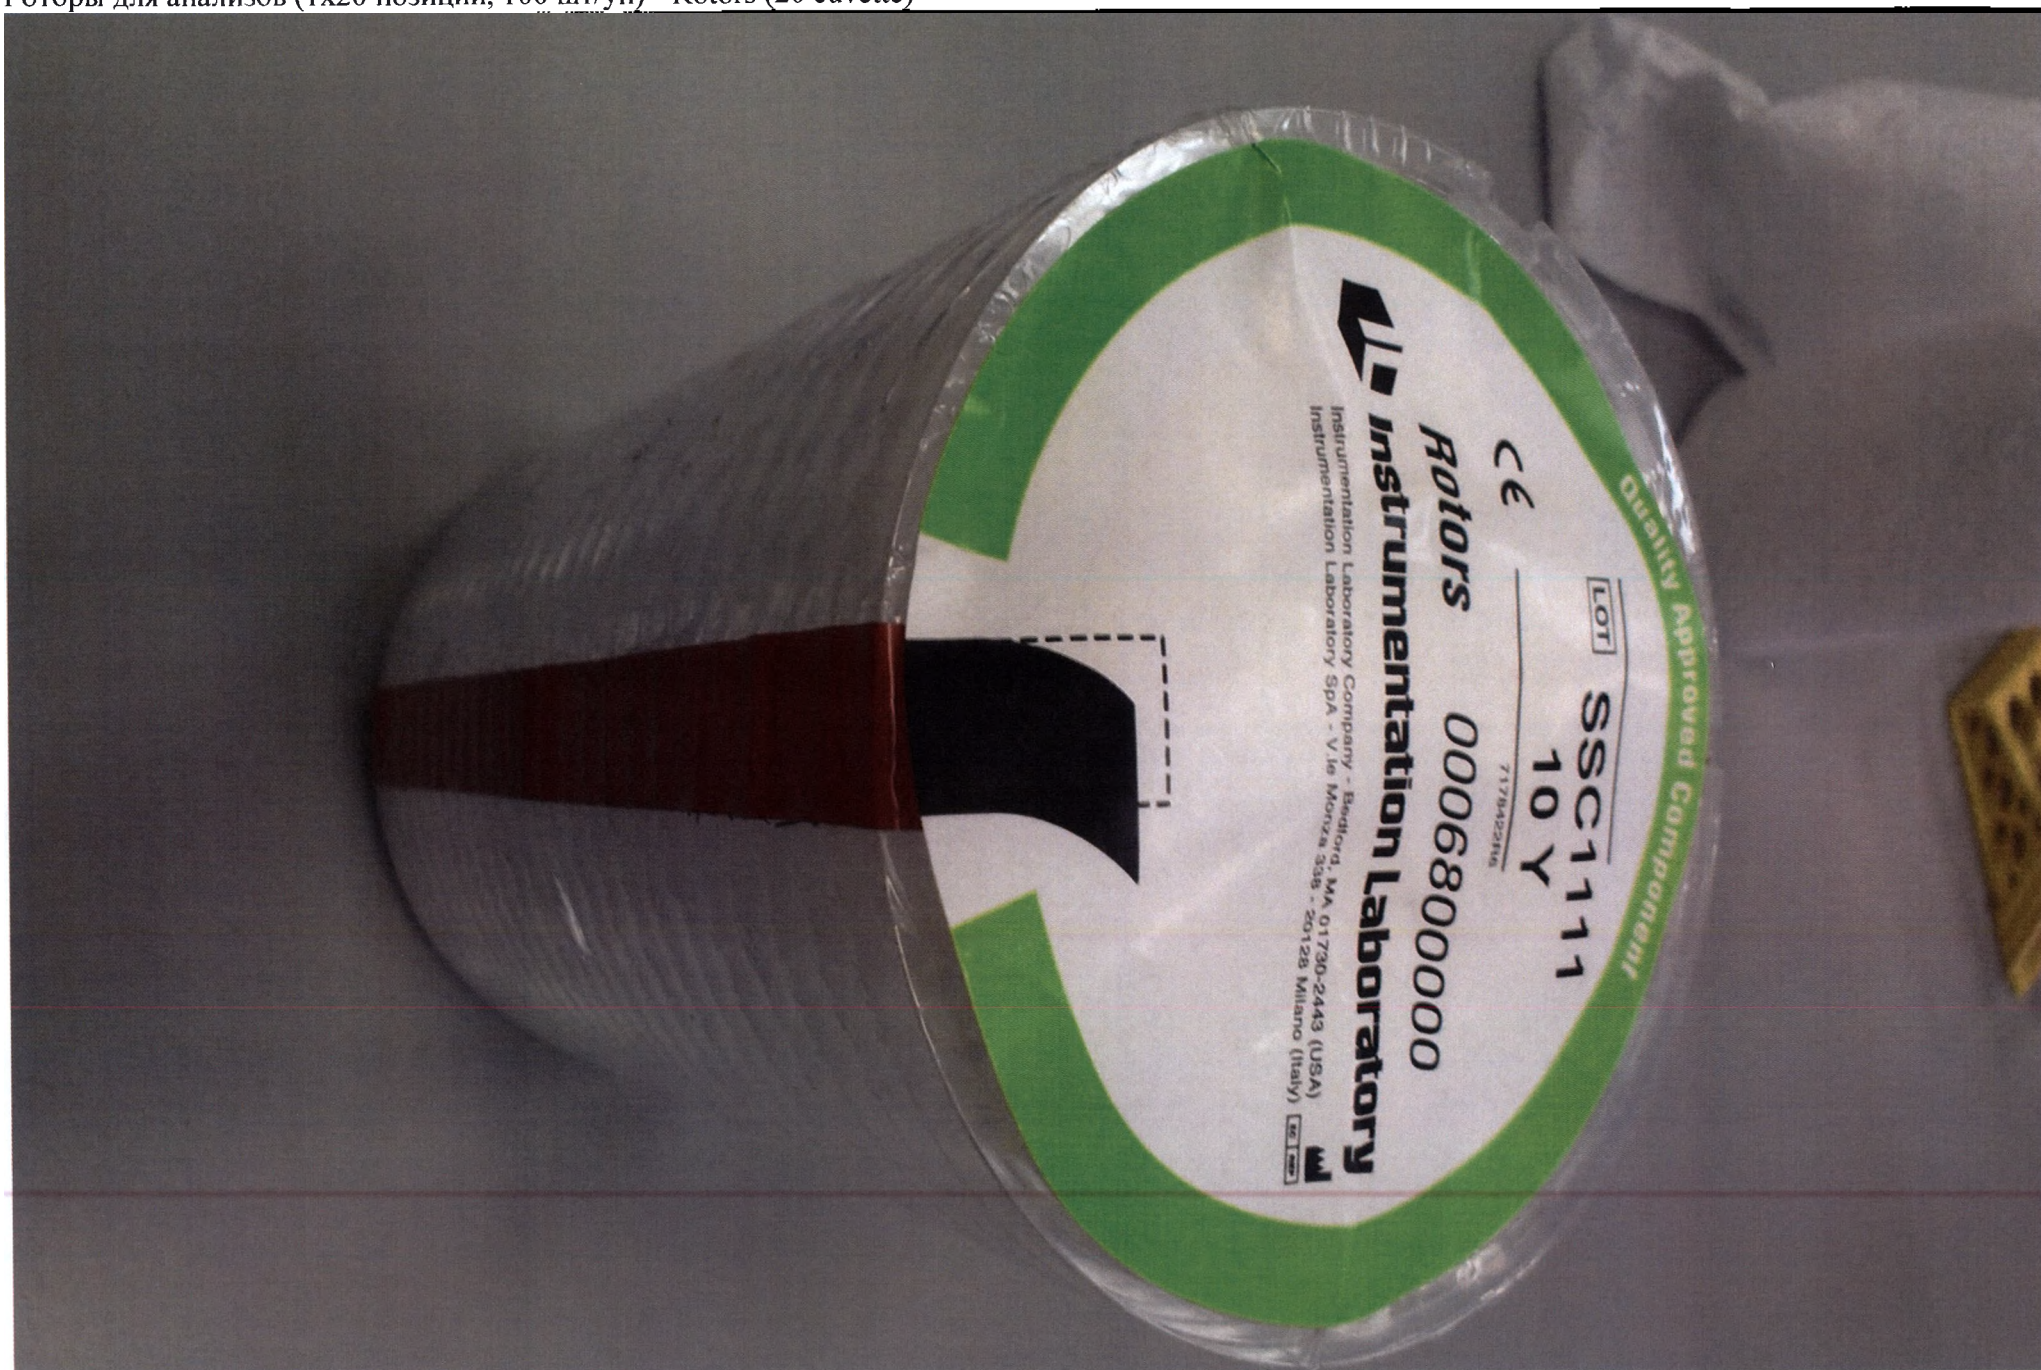

Магнитные мешалки, 6 шт – Magnetic Stir Bars



Чашечки для образцов 0,5 мл (1000 шт/уп) - Sample Cups 0,5 ml

Quality Approved Component

Sample Cups

0006799200

IVD



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



EC REP

Чашечки для образцов 0,5 мл (1000 шт/уп) - Sample Cups 0,5 ml

Quality Approved Component

Sample Cups

0006799200

IVD




Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



Чашечки для образцов 2,0 мл (1000 шт/уп) - Sample Cups 2 ml

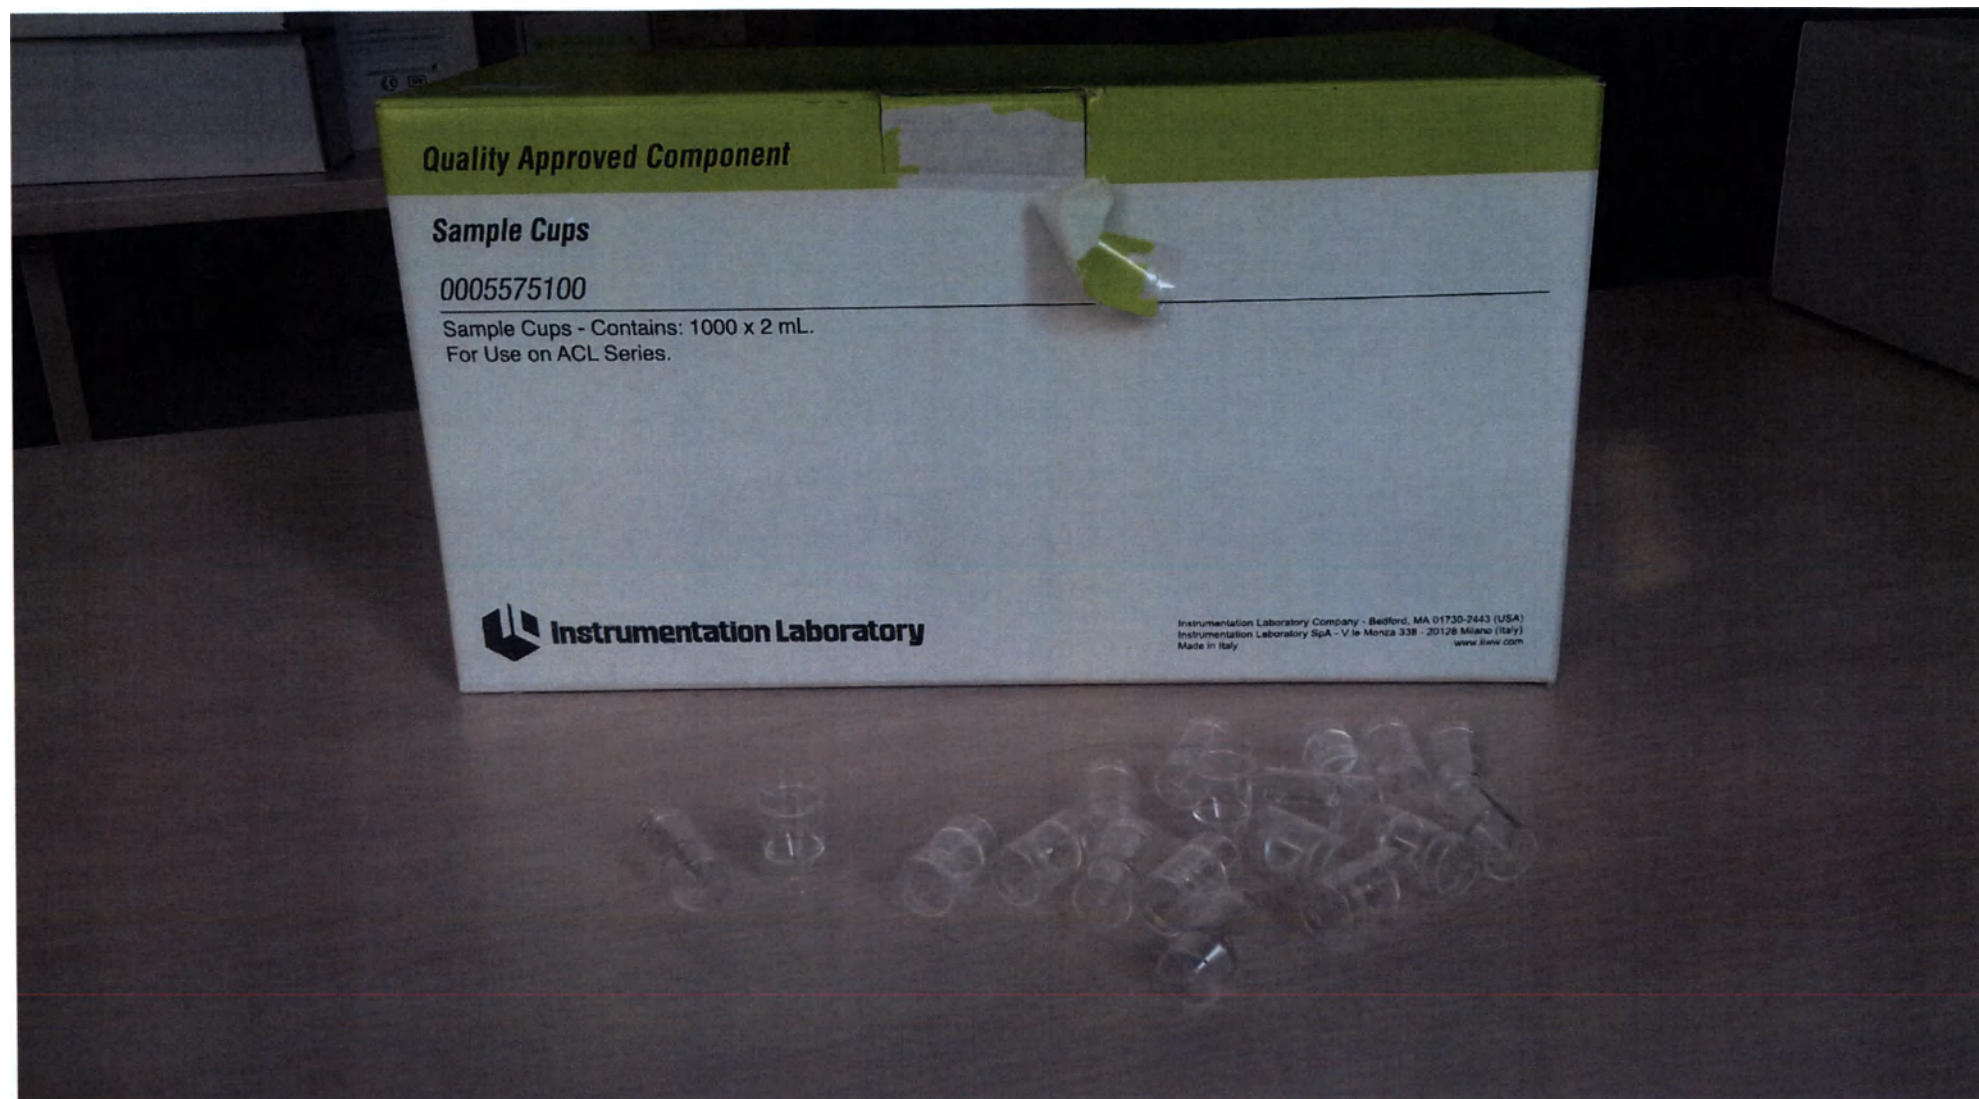

Чашечки для образцов 4.0 мл (100 шт/уп) – Cups 4 ml

Quality Approved Component

Cups

0006799400

**Cups - Contains: 100 x 4 mL.
For Use on ACL Series.**



Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)
Made in USA www.ilwww.com

Адаптеры штатива образцов для пластиковых чашечек - Sample tray adaptor for plastic sample cup

Quality Approved Component

SAM TRADY ADAPT X
CUPS PKG4
19076400

QTY 1 REV 02



Instrumentation Laboratory

Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Адаптеры штатива образцов для 4.0 мл чашечек - Sample tray adaptor for 4 ml vials

Quality Approved Component

**4 ML VIAL, SAM.
TRAY ADAPT. 6PKG**

19076300

REV 02
 **Instrumentation Laboratory**

Bedford, MA 01730-2443 (USA)

Адаптеры для 10 мл реактивных пузырьков с магнитным перемешиванием (серые) -
Adapter for 10 ml reagent vials with magnetic stirring (gray)



Адаптеры для 10 мл реактивных пузырьков без магнитного перемешивания (розовые)
Adapter for 10 ml reagent vials without magnetic stirring (pink)




Адаптеры для 4 мл реактивных пузырьков без магнитного перемешивания (зелёные) -
Adapter for 4 ml reagent vials without magnetic stirring (green)



Стеклянные ёмкости 10 мл - Glass vials, 10 ml

Instrumentation Laboratory 180 Hartwell Rd., Bedford, MA 01730-2443 U.S.A.
Instrumentation Laboratory SpA Viale Monza 338 - 20128 Milan, Italy  

BOTTLE, GLASS, 10/PK, ACL TOP/ADVANCE
P/N: 00018924100
Rev: 04
Qty: 1 UN
Date Code: 1711


+H507000189241001A


+H507001A9


(01)08426950452782

LDPE

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)  

189600-00 R01

Стеклянные ёмкости 10 мл - Glass vials, 10 ml




Пластиковые емкости 30 мл (с крышками) - Bottles Plastic 30 ml (with cap)



Стеклянные емкости 20 мл - Bottles Glass 20 ml



Стеклянные емкости 20 мл - Bottles Glass 20 ml

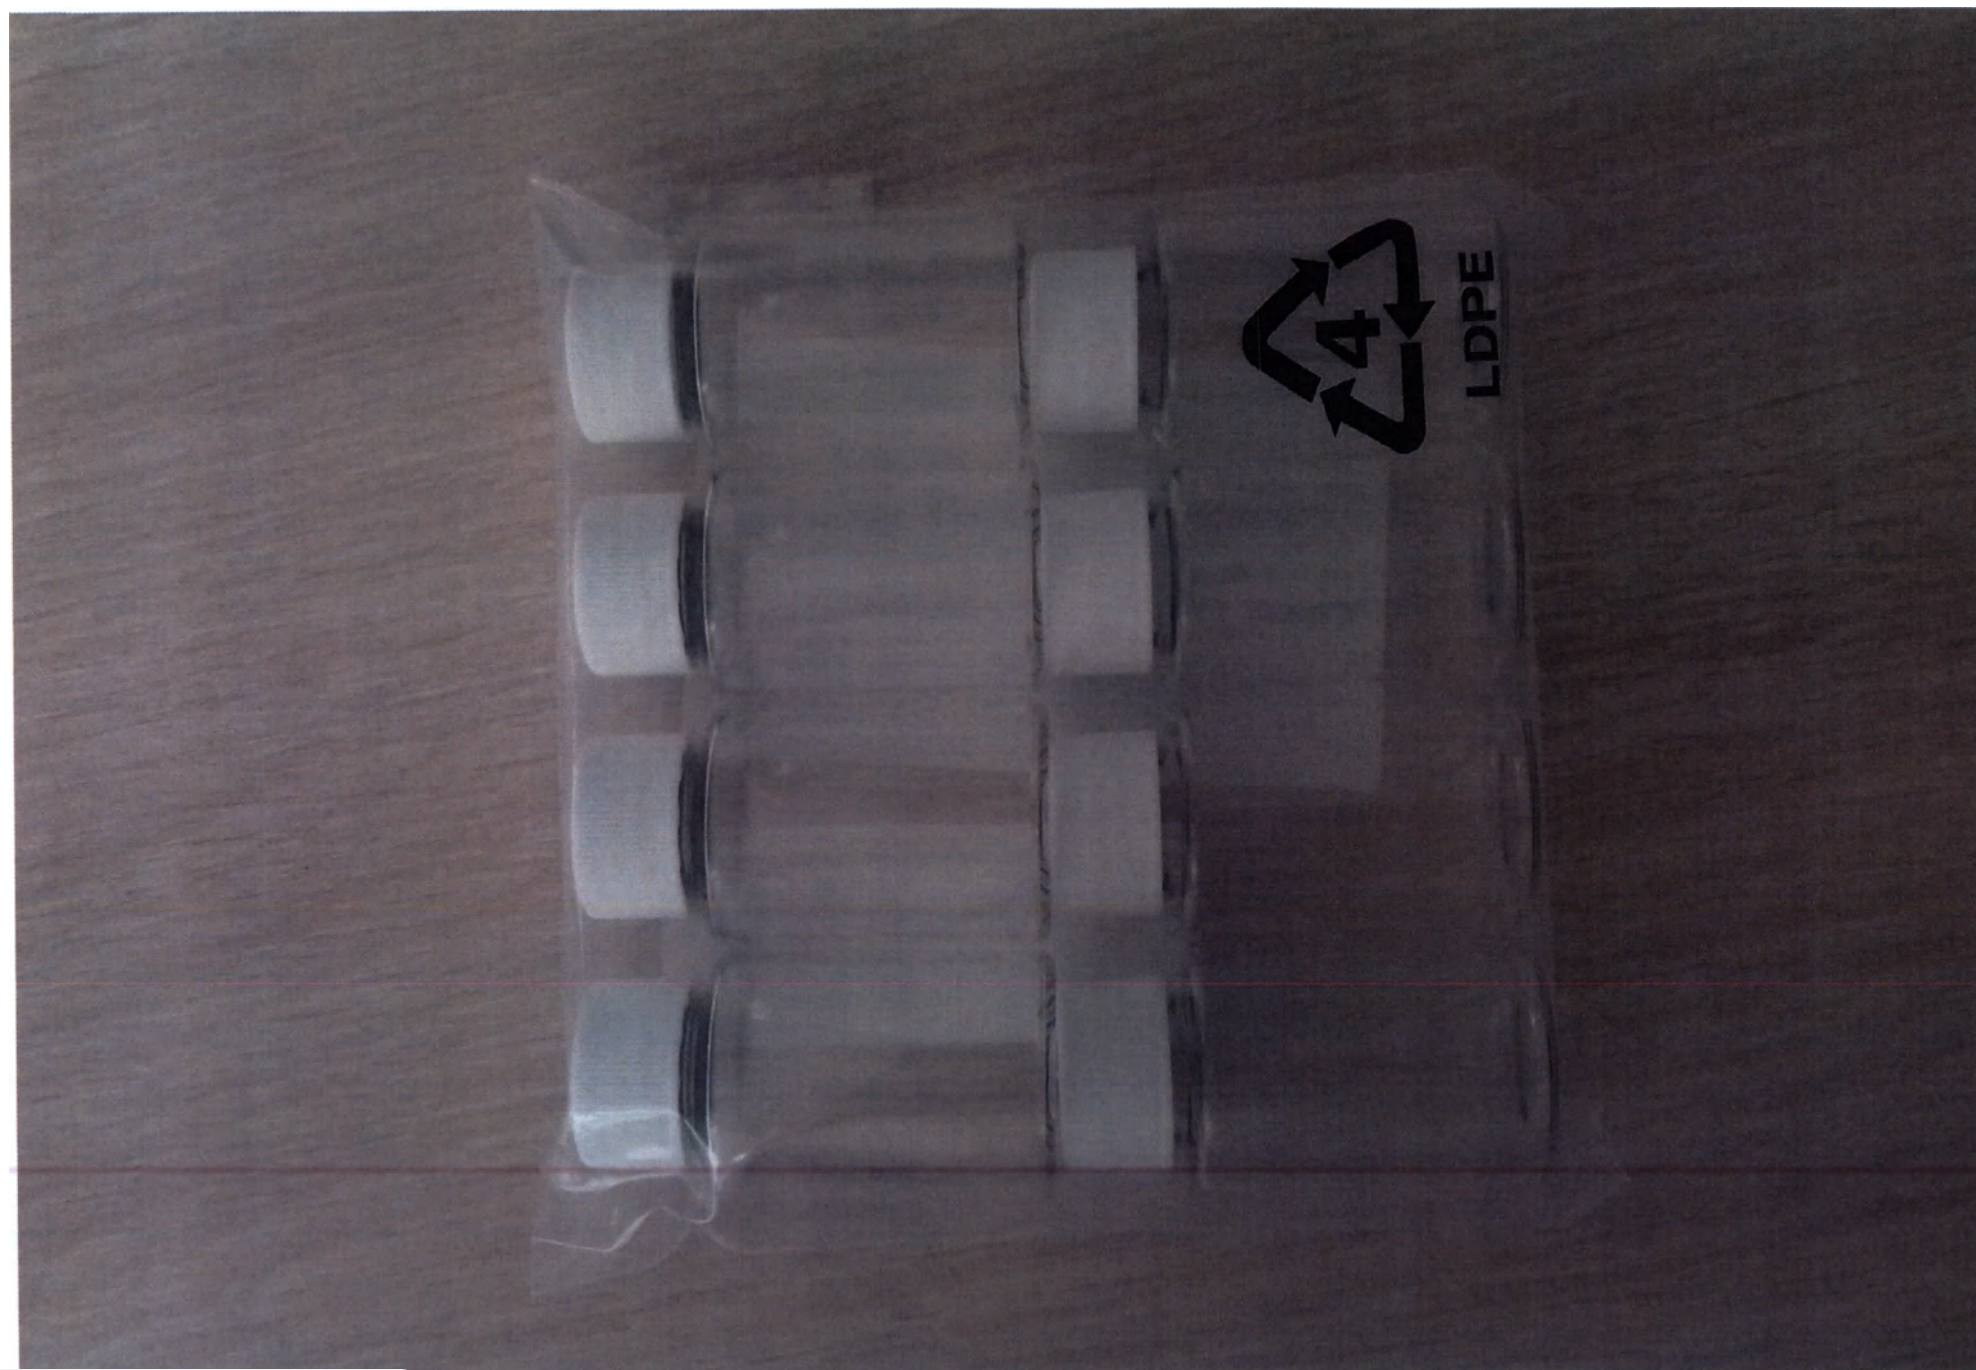


Стеклянные емкости 4 мл- Bottles Glass 4 ml

 **Instrumentation Laboratory** 180 Hartwell Rd., Bedford, MA 01730-2443 U.S.A.
Instrumentation Laboratory SpA Viale Monza 338 - 20128 Milano

BOTTLE KIT, 10X4 ML
P/N: 00018924104
Rev: 05
Qty: 1 UN
Date Code: 1710

 +H507000189241041E

 +\$\$801ED

 (01)084269504527

LDPE

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy) 


 

189600-00 R01

Стеклянные емкости 4 мл- Bottles Glass 4 ml




Кюветы (2400 шт – 600 стрипов, 4 кюветы в стрипе) - Cuvettes (2400 cuvettes, 600 strips)

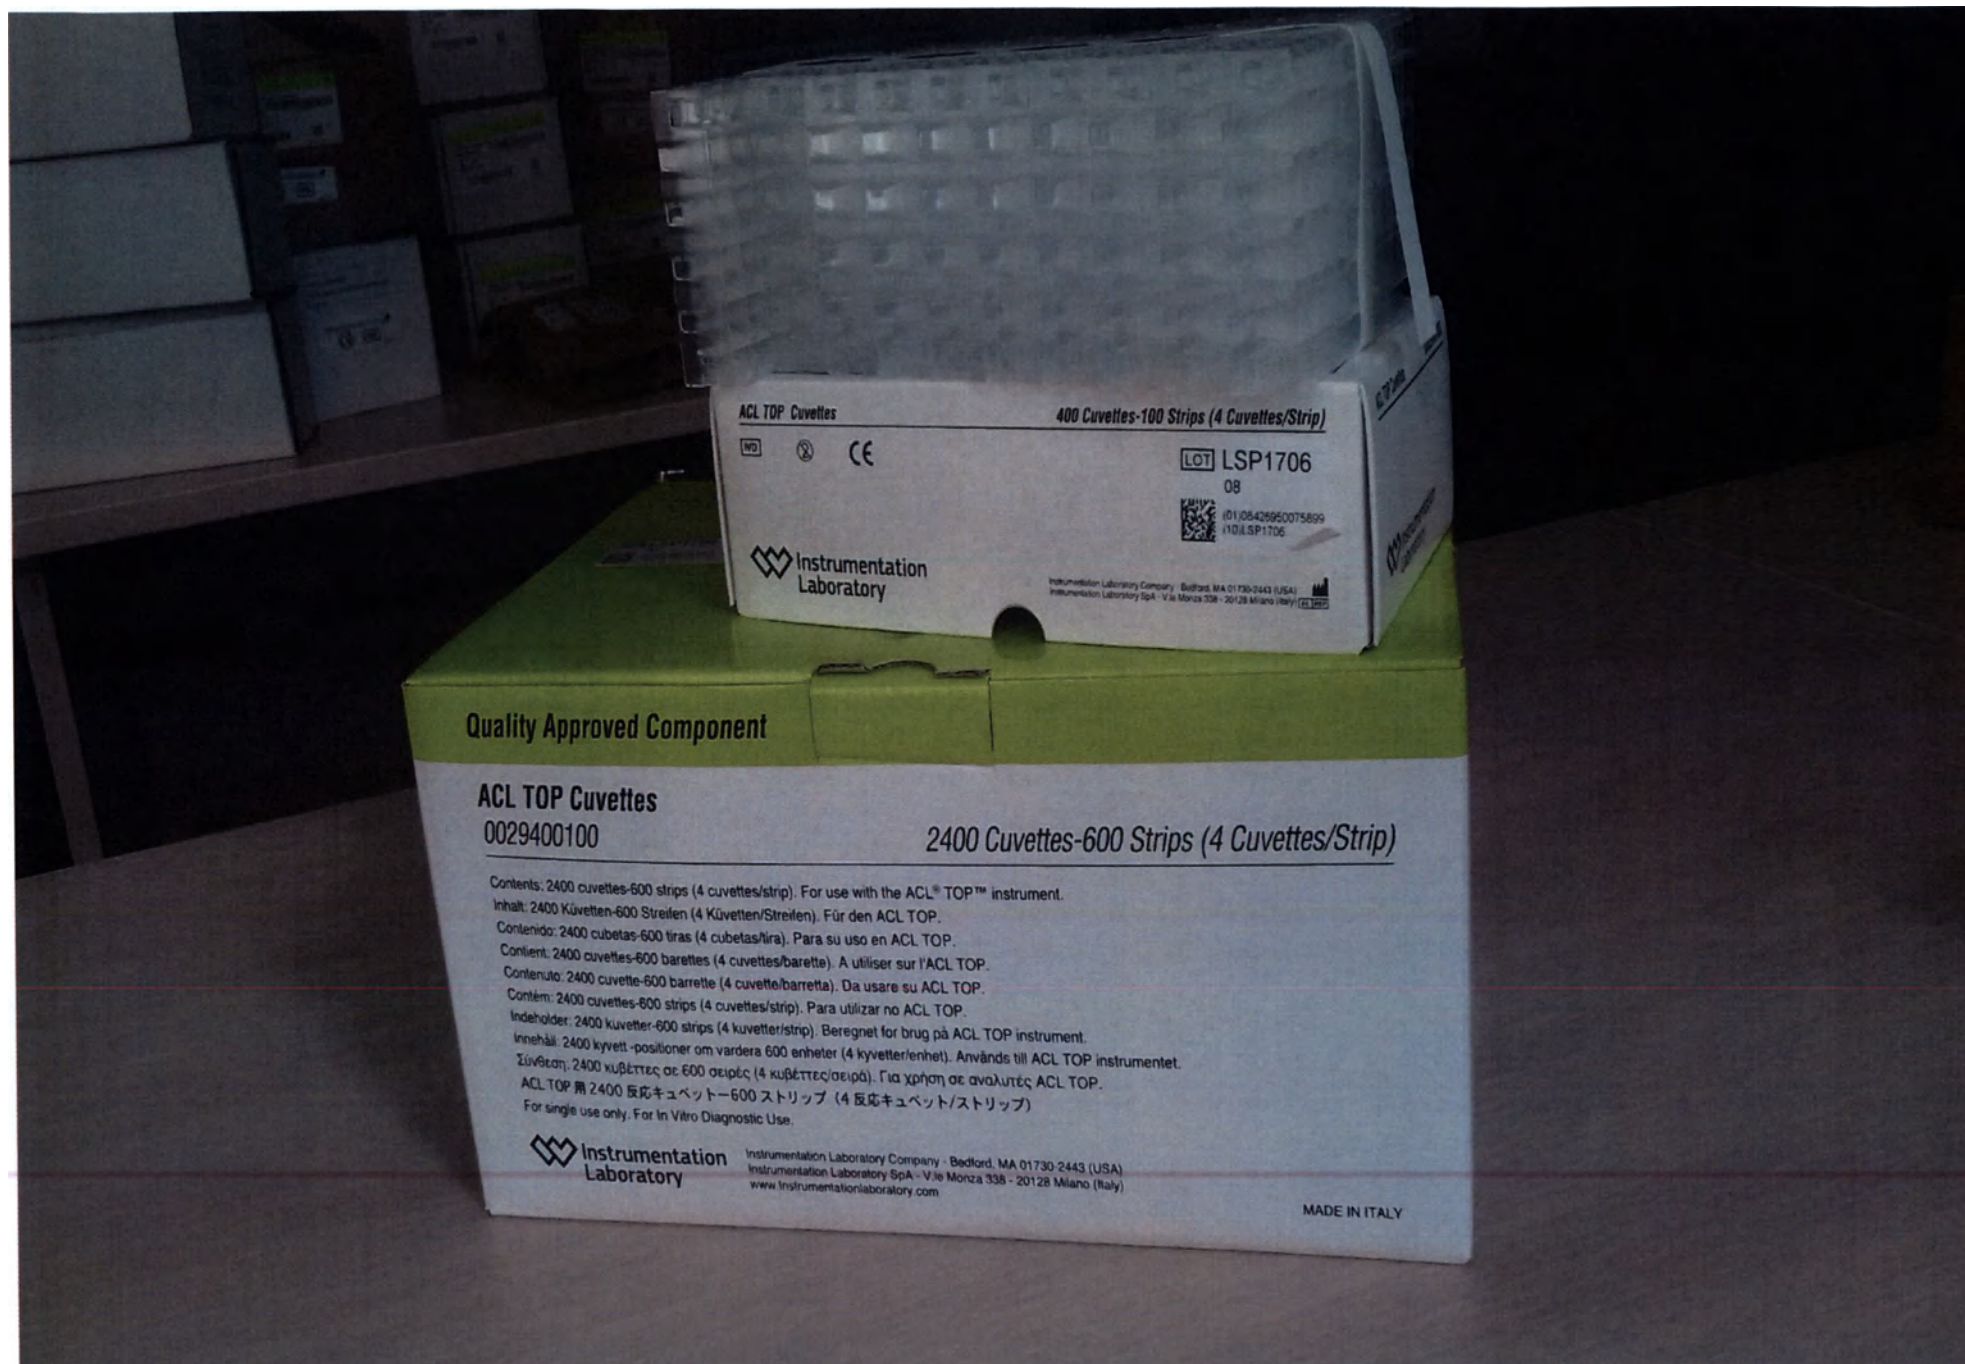

Держатель кювет-Cuvette Waste Liner



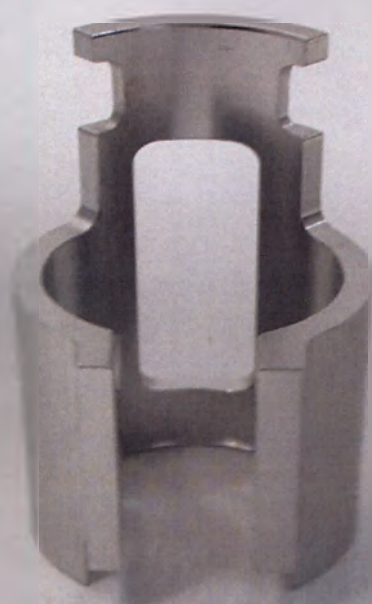




Адаптеры для штатива с разбавителями на 4 мл – Adaptor, Diluent, 4 ml



Адаптеры для штатива с разбавителями на 10 мл -10ml Diluent Rack Adaptor

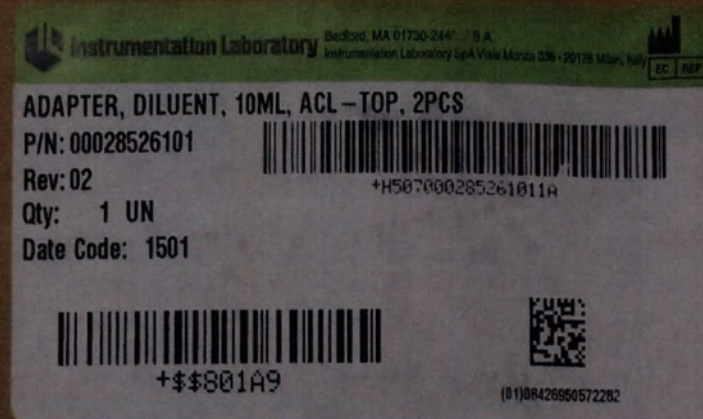

Адаптеры для штатива с разбавителями на 20 мл - 20ml Diluent Rack Adaptor





Каталожный номер: _____

Наименование: _____

Производитель: «Инструментэйшн Лаборатори Ко.», США

Instrumentation Laboratory Co., 180 Hartwell Road, Bedford, MA 01730-2443, USA

Регистрационное удостоверение: _____

Назначение: _____

Состав: см. на оригинальной упаковке.

Лот: см. на оригинальной упаковке.

Хранение: _____

Срок годности: см. на оригинальной упаковке.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией.

«Только для диагностики *in vitro*»

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЦКТ», 109004, г. Москва, Пестовский пер., дом 12, Тел: +7 (495)228-04-77

Макет маркировки

ПРОШУТО И
ПРОНУМЕРАВАНО
24.08.2018 г. ЛИСИТА/ОВ

