



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ASR-
6150С И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

129343, Москва, проезд Серебрякова д.2, корпус 1;
Тел. (495) 221-06-50; Факс (495) 221-07-82;
E-mail: info@sm-labservice.ru
Интернет адрес: <http://www.sm-labservice.ru>




Рентгеновское штативное устройство




Рентгеновский штатив



Кожухи рентгеновского штативного устройства

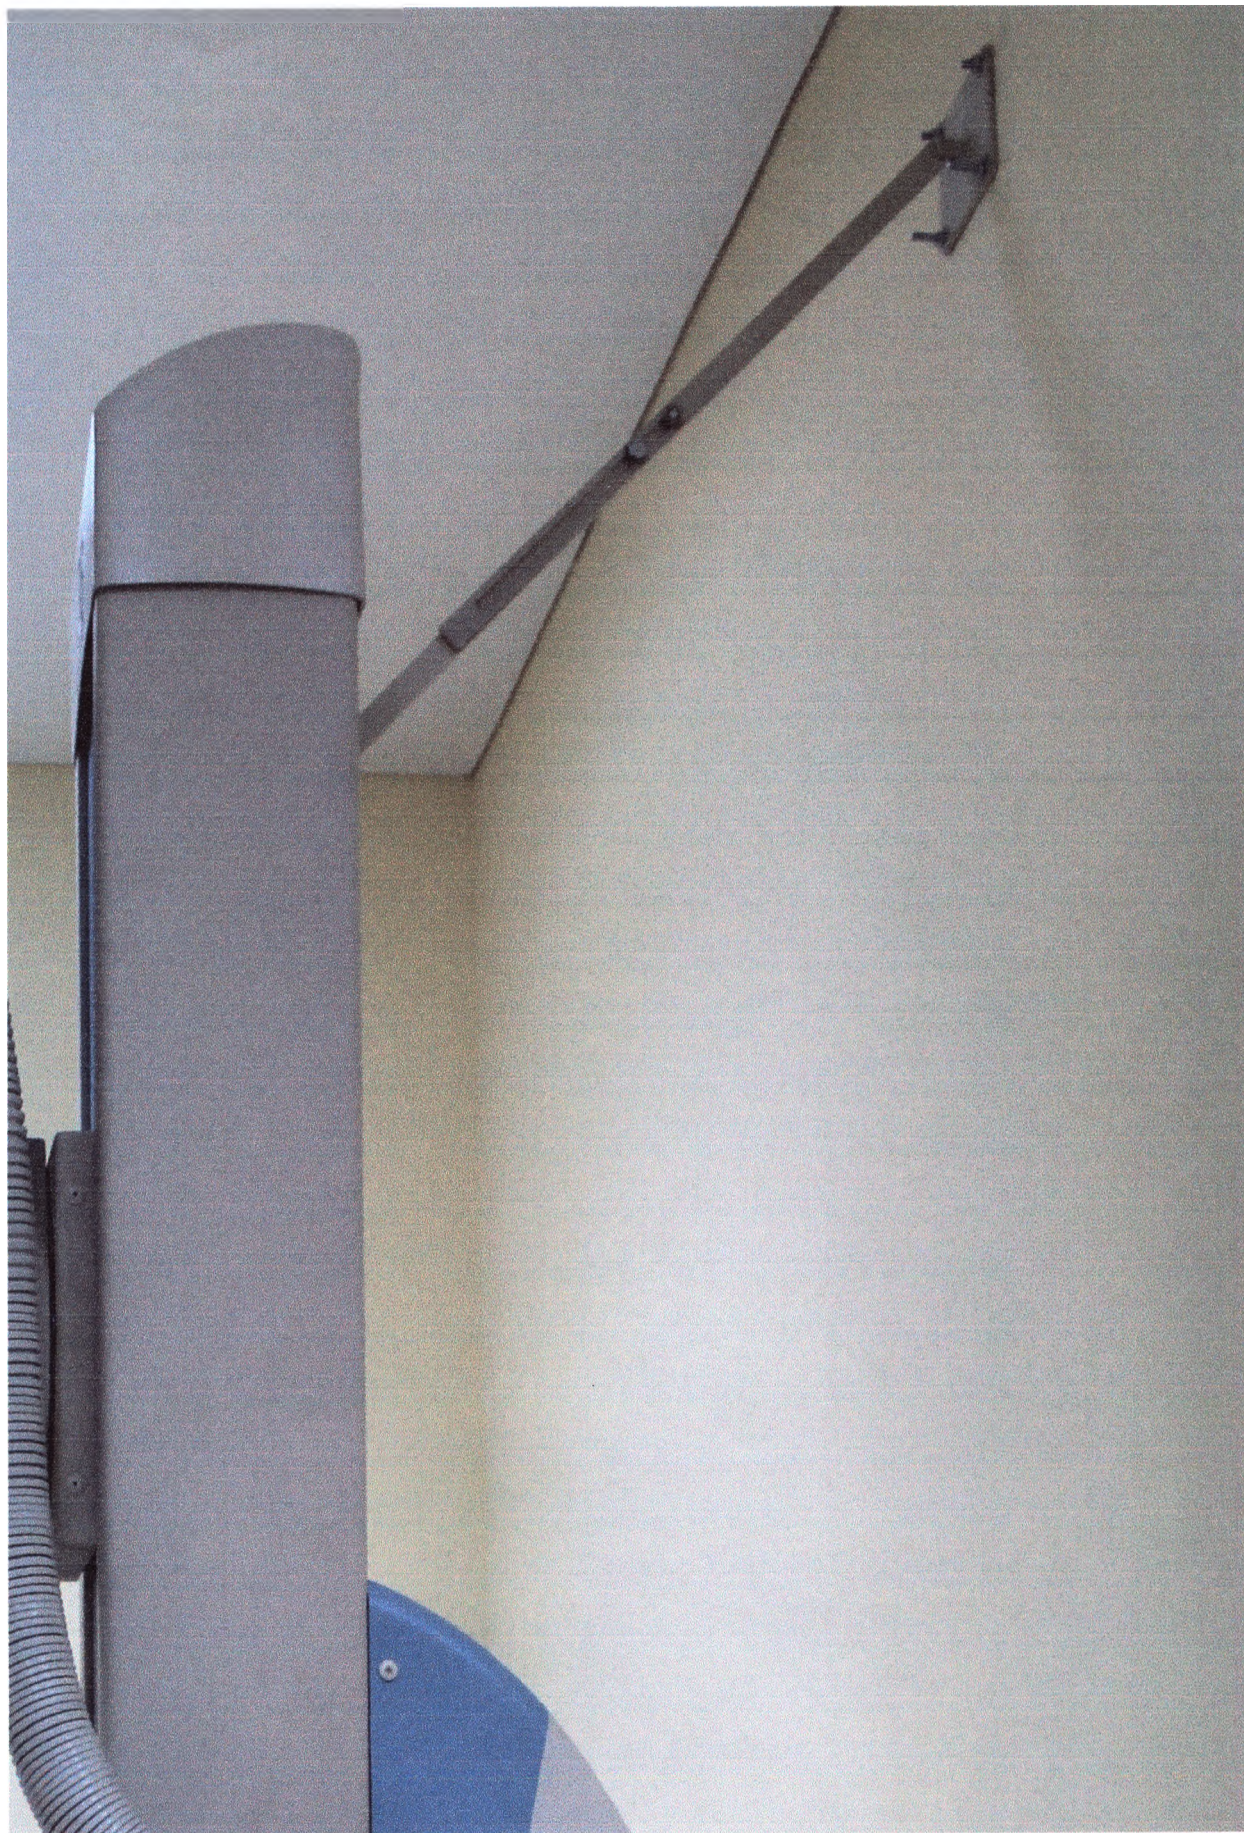


Кронштейн крепления рентгеновского аппарата

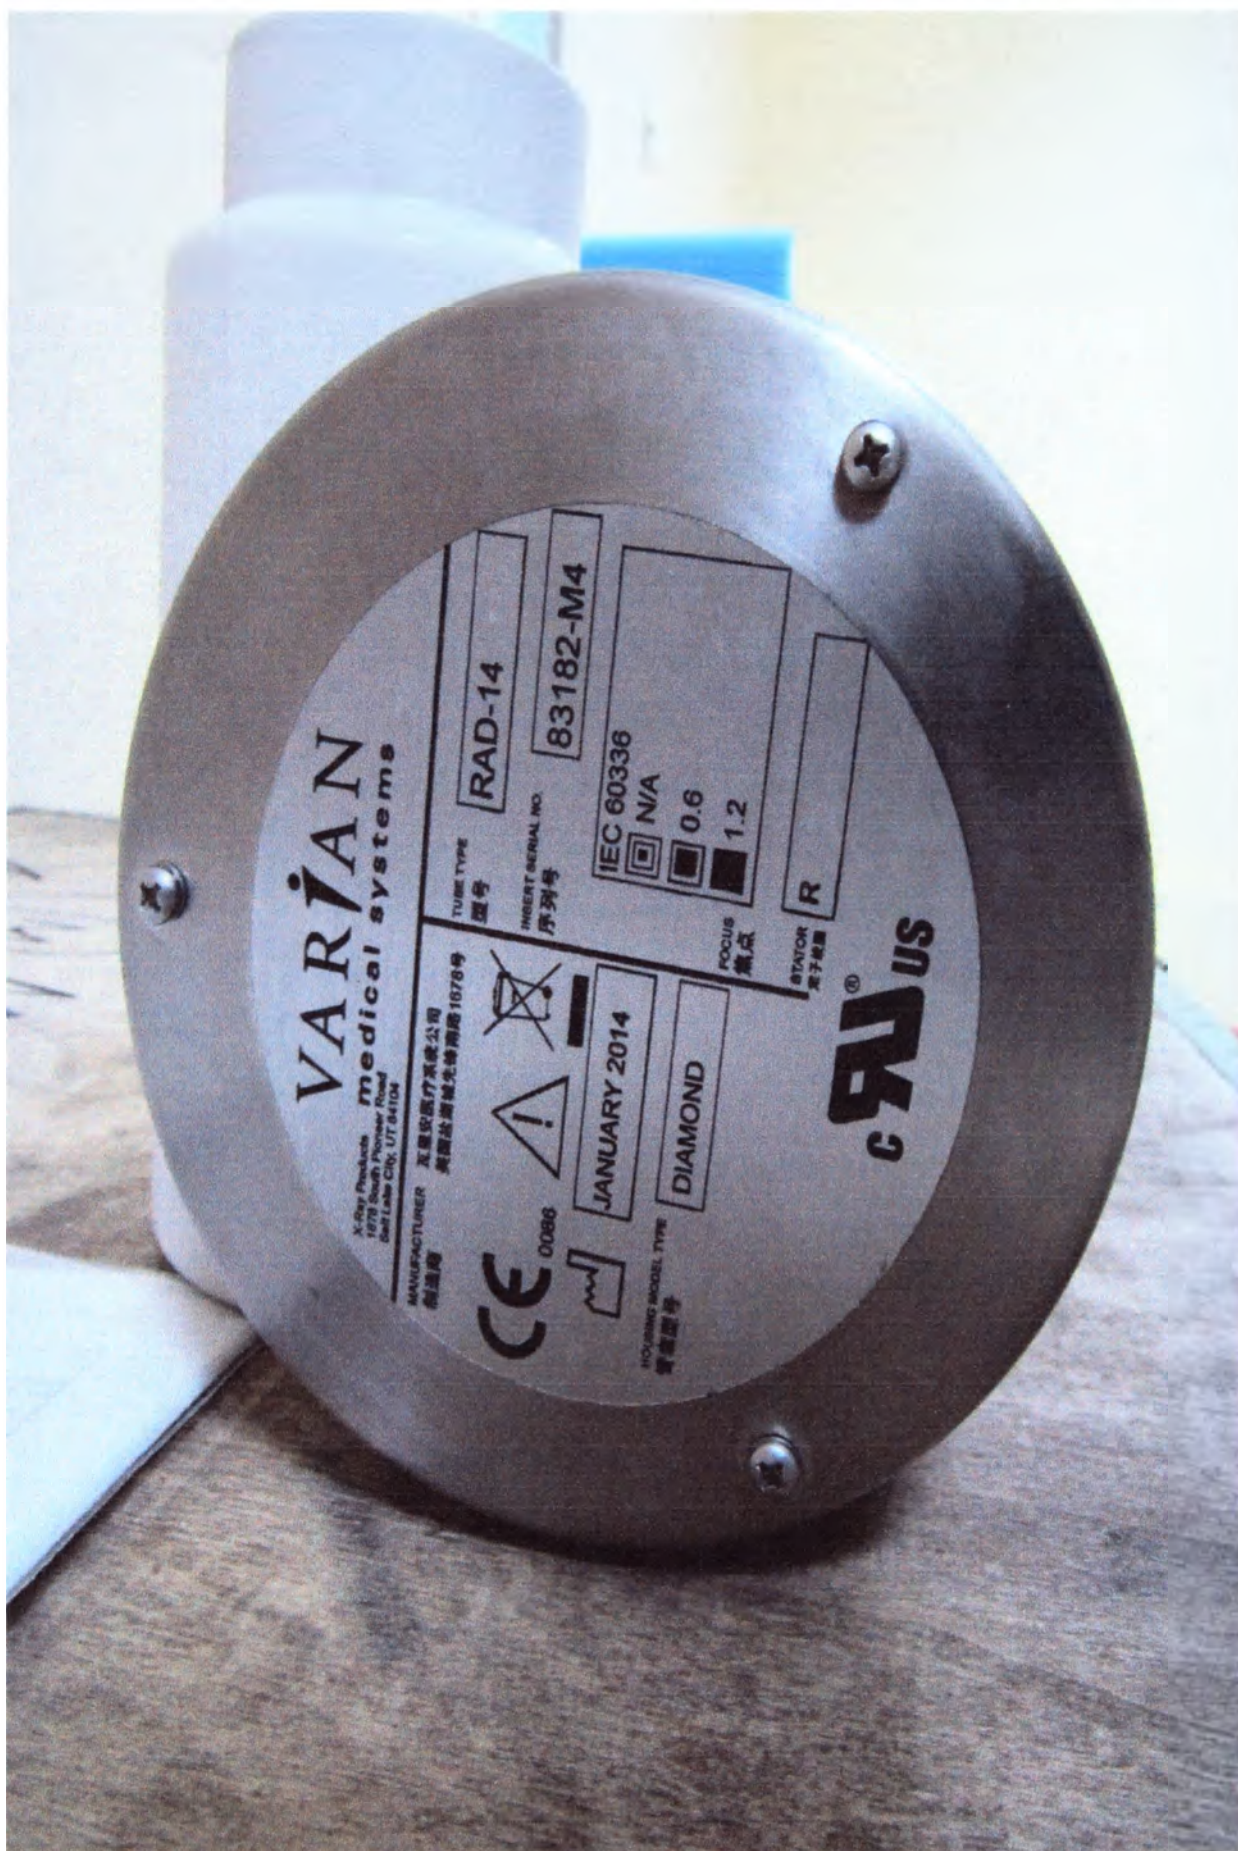

Рентгеновская трубка



Кожухи рентгеновской трубки

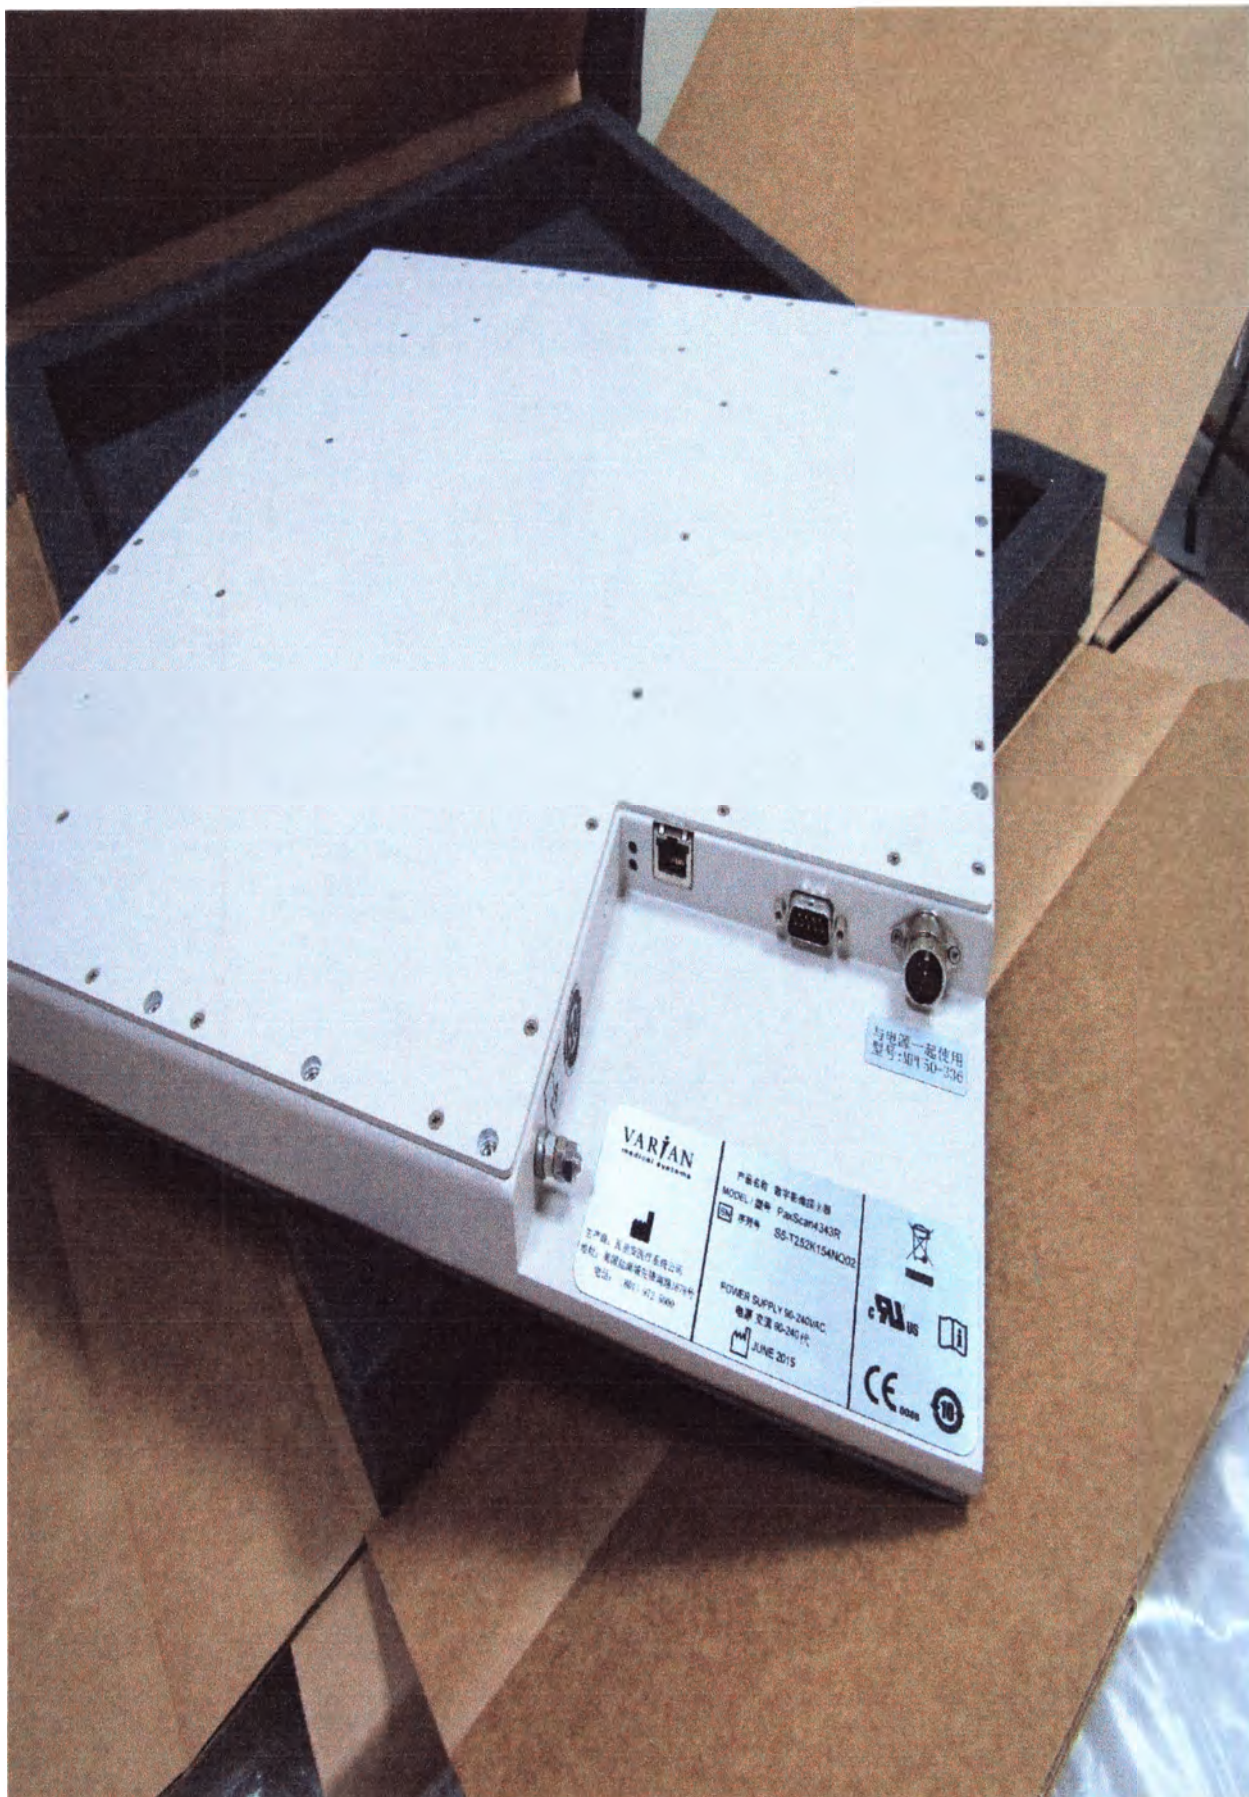

Детектор цифровой плоскостельный





**Защитный кожух детектора с креплением детектора и
камеры экспонометра**




ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

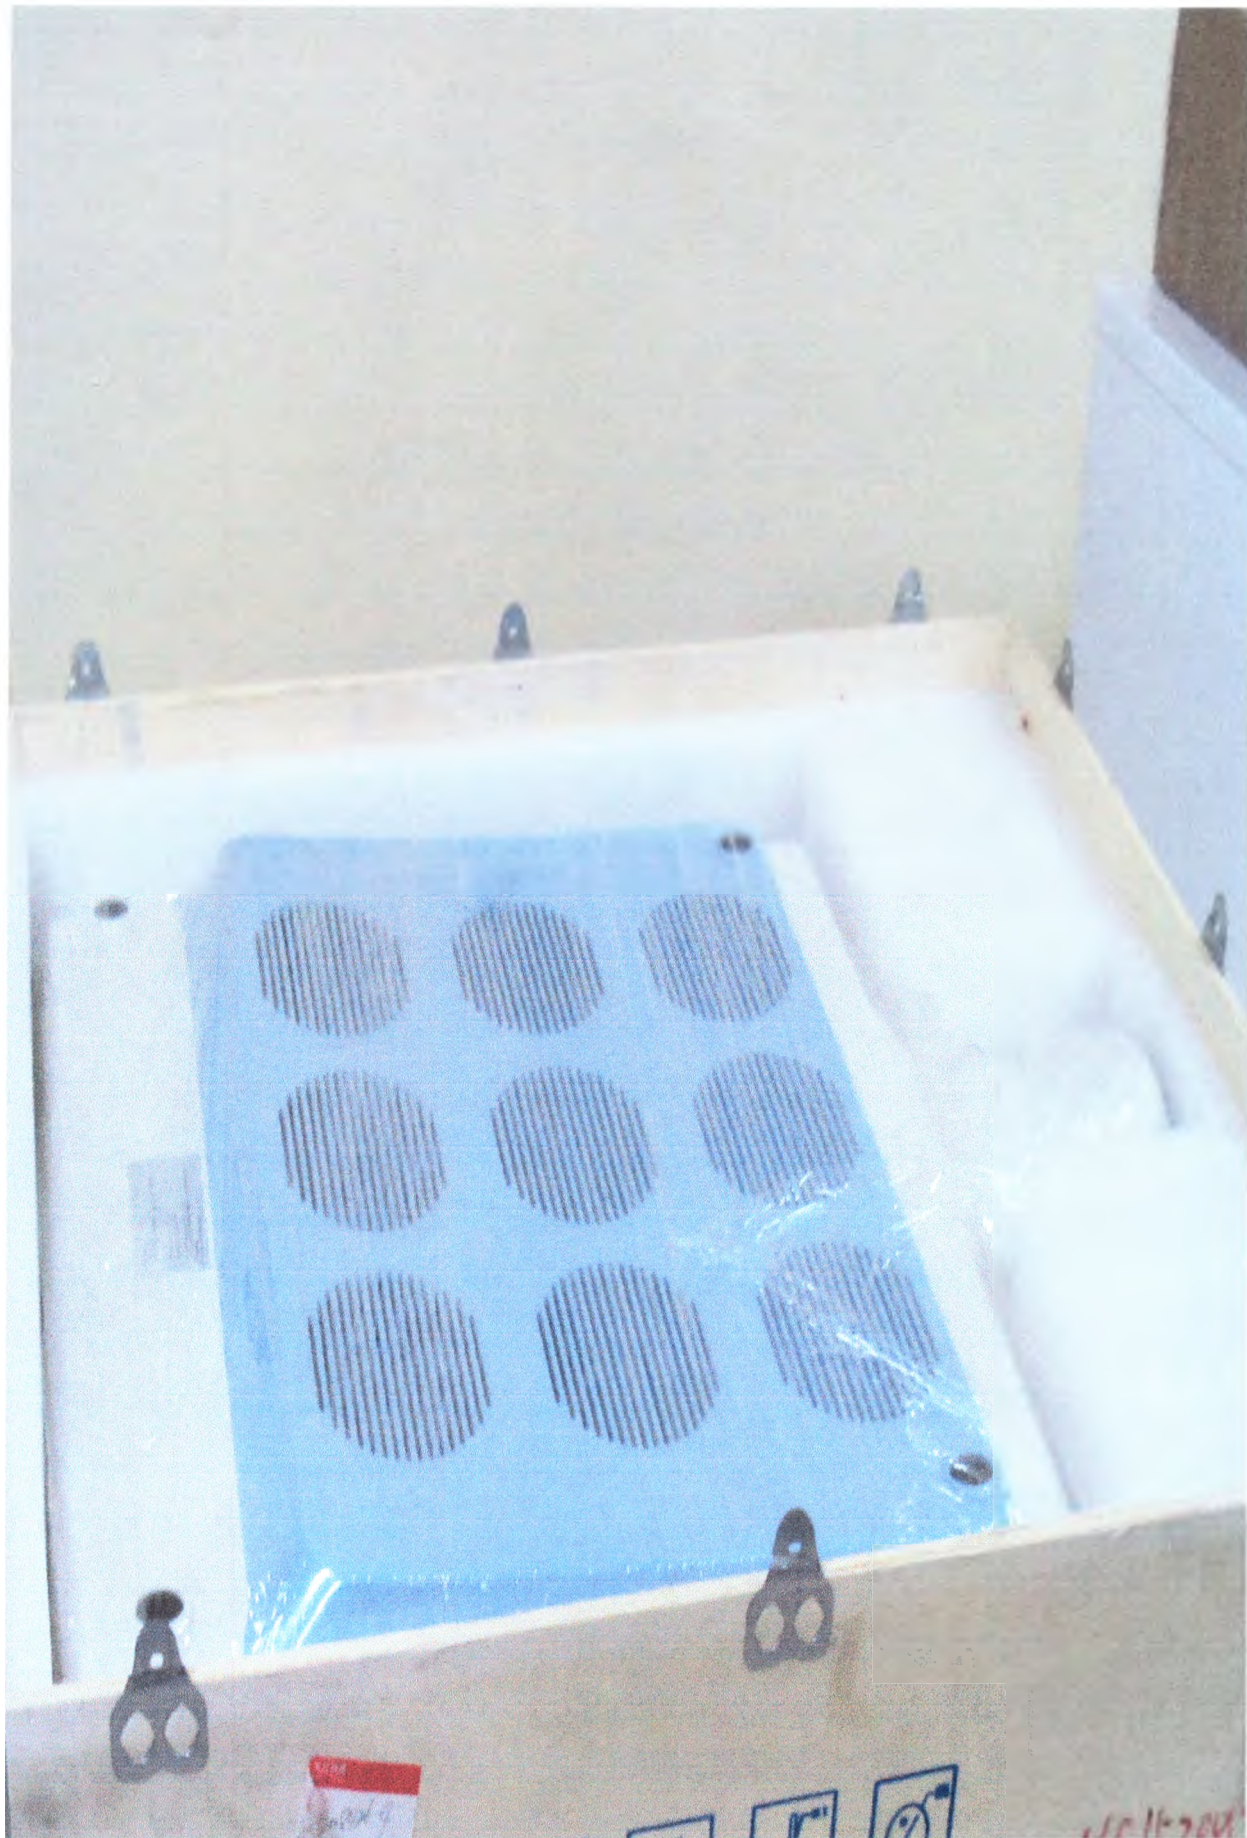

Кожухи детектора



Регулируемый рентгеновский коллиматор





Пульт управления рентгеновским аппаратом






Кабели питания для рентгеновского аппарата



Стол снимков



Генераторное устройство

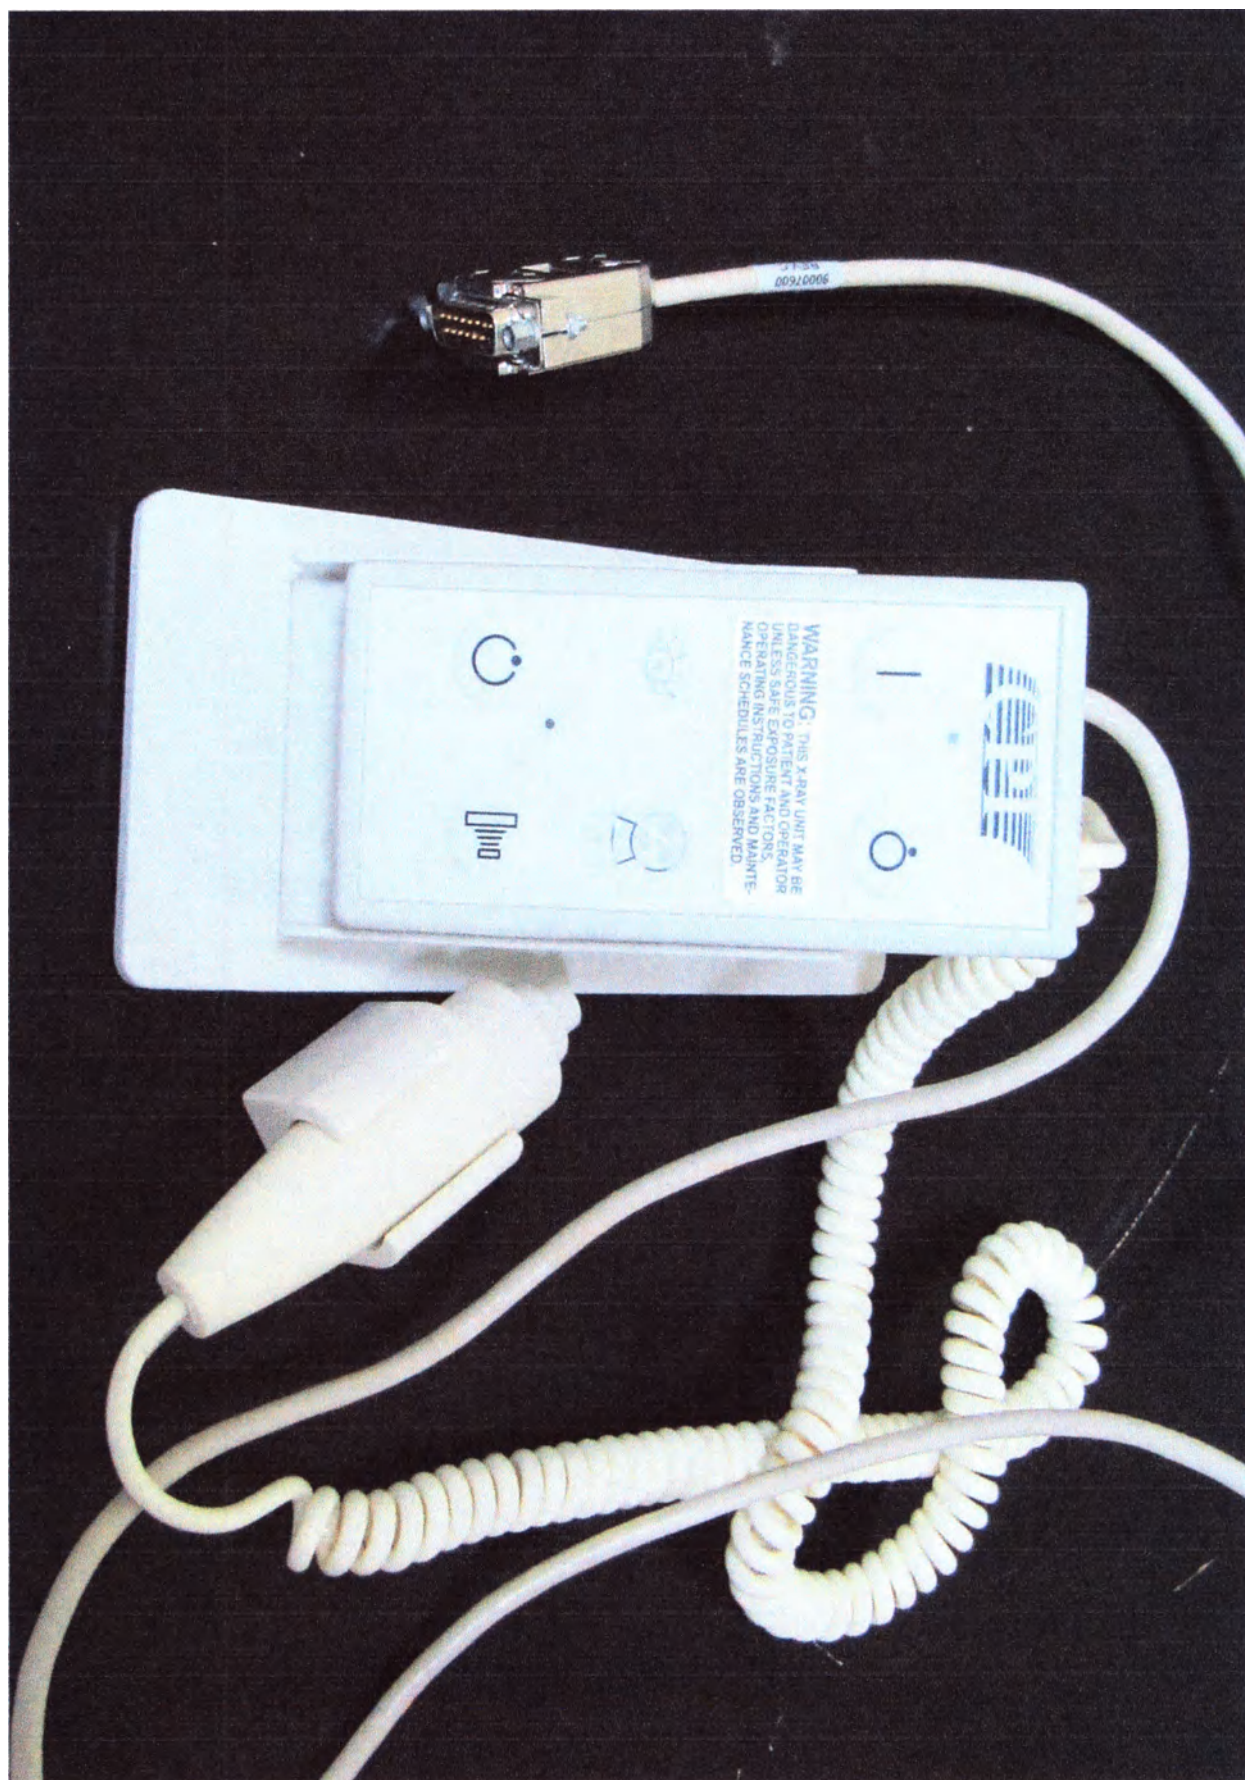


**Пульт управления генераторного устройства с кнопкой
включения высокого напряжения**



Кабели соединительные для генераторного устройства



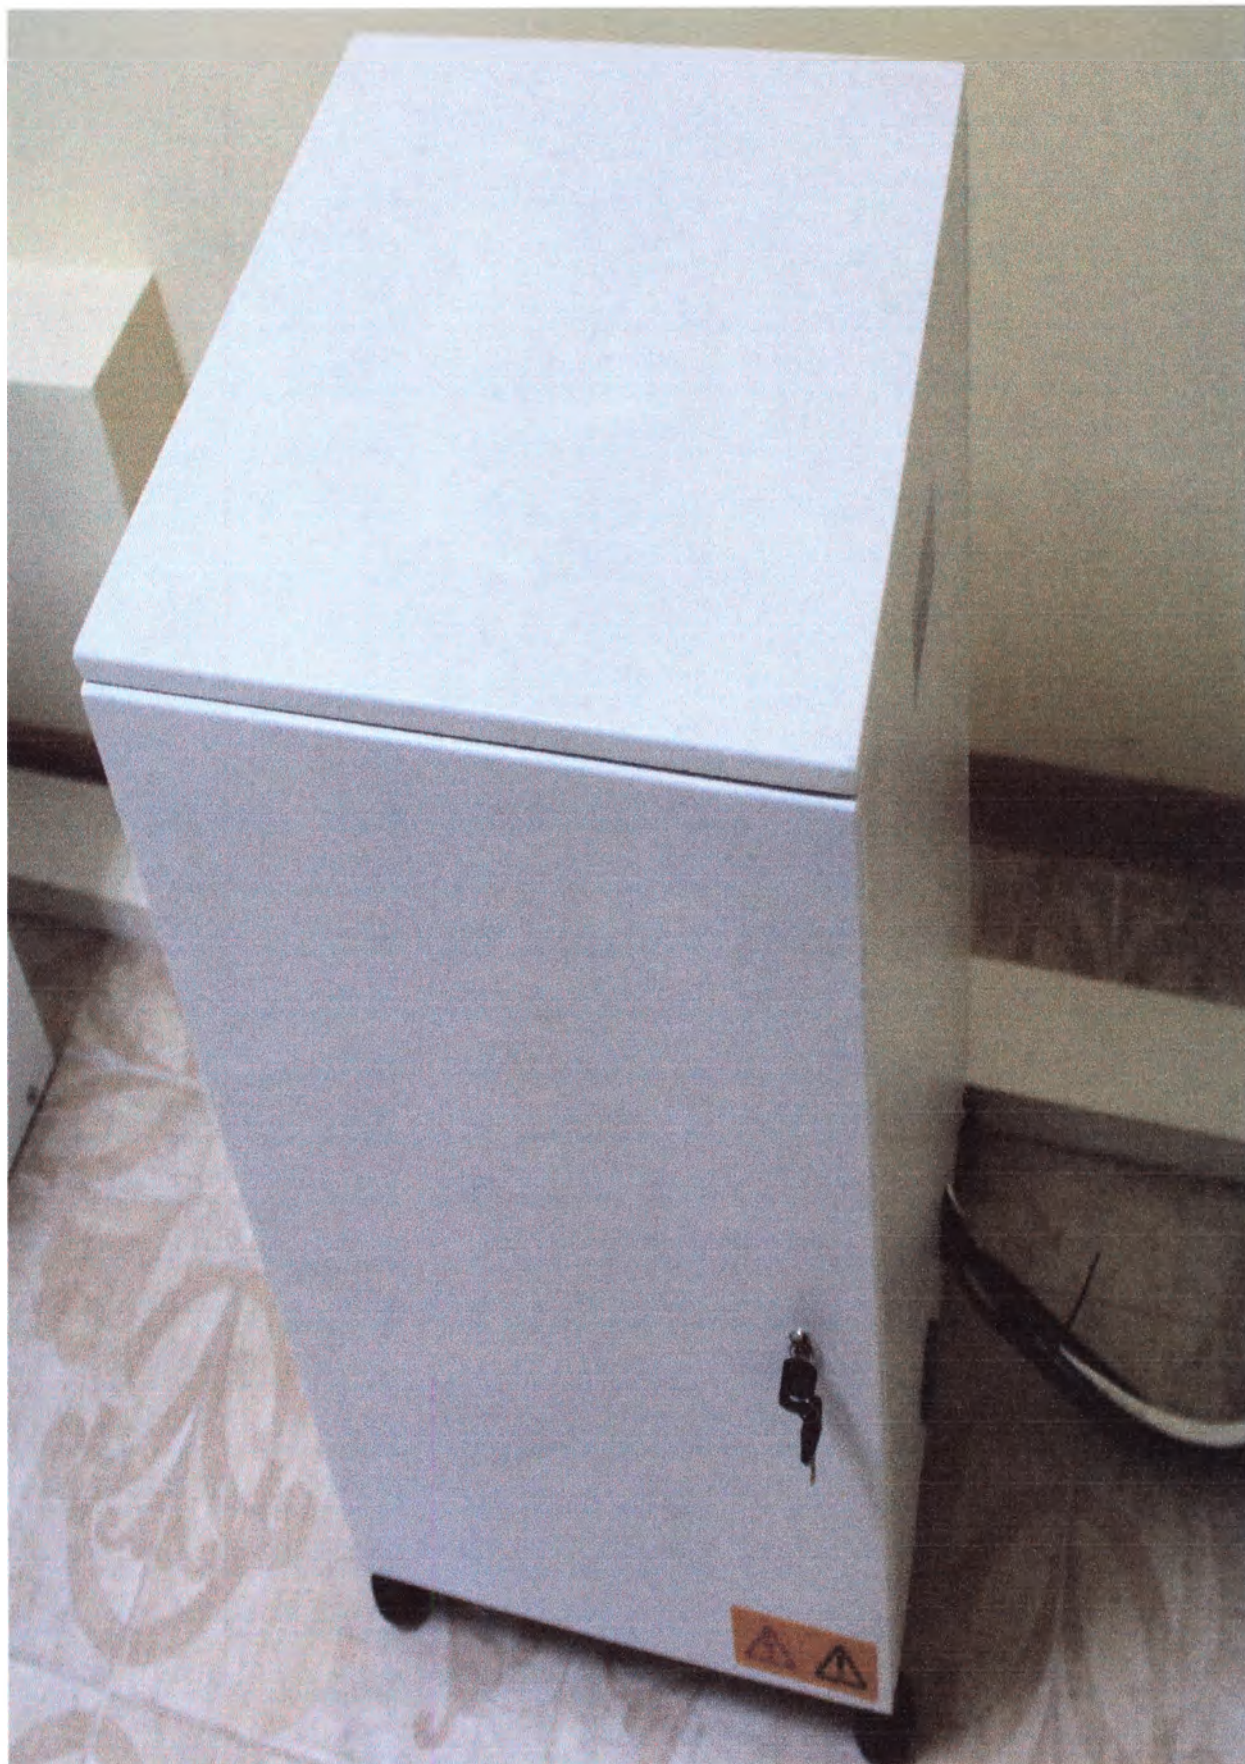

Рентгеновское питающее устройство




Щит распределительный






Устройство цифровой рентгенографии ASR-6150C
с причалтежностями
Руководство по эксплуатации
(Русская версия K1.0)

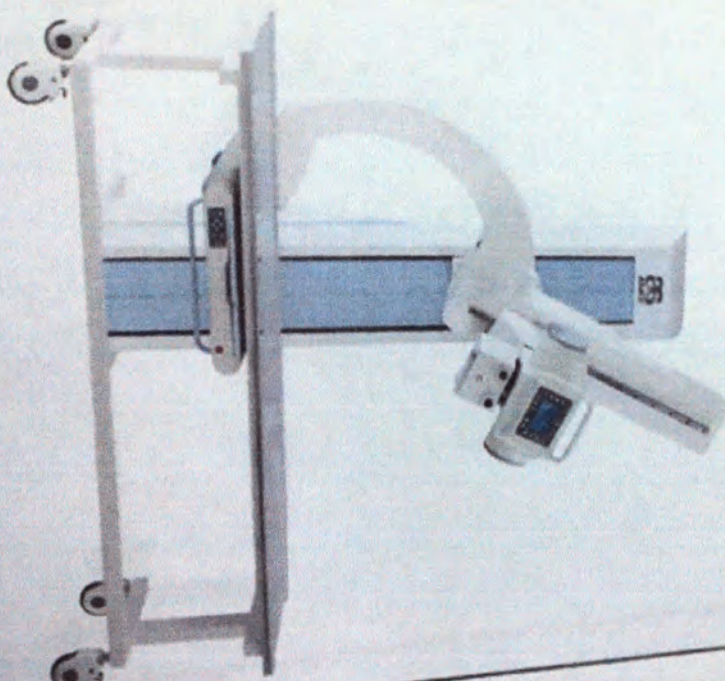

TECHNICAL DOCUMENTATION

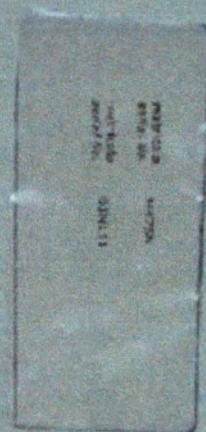


ANKER
Устройство цифровой рентгенографии ASR-6150C
с причалтежностями
Руководство по эксплуатации
(Русская версия K1.0)

Эксплуатационные и технические документы




Рабочая станция оператора для обработки цифровых изображений: персональный компьютер, монитор высокого разрешения, клавиатура, манипулятор типа

«МЫШЬ»

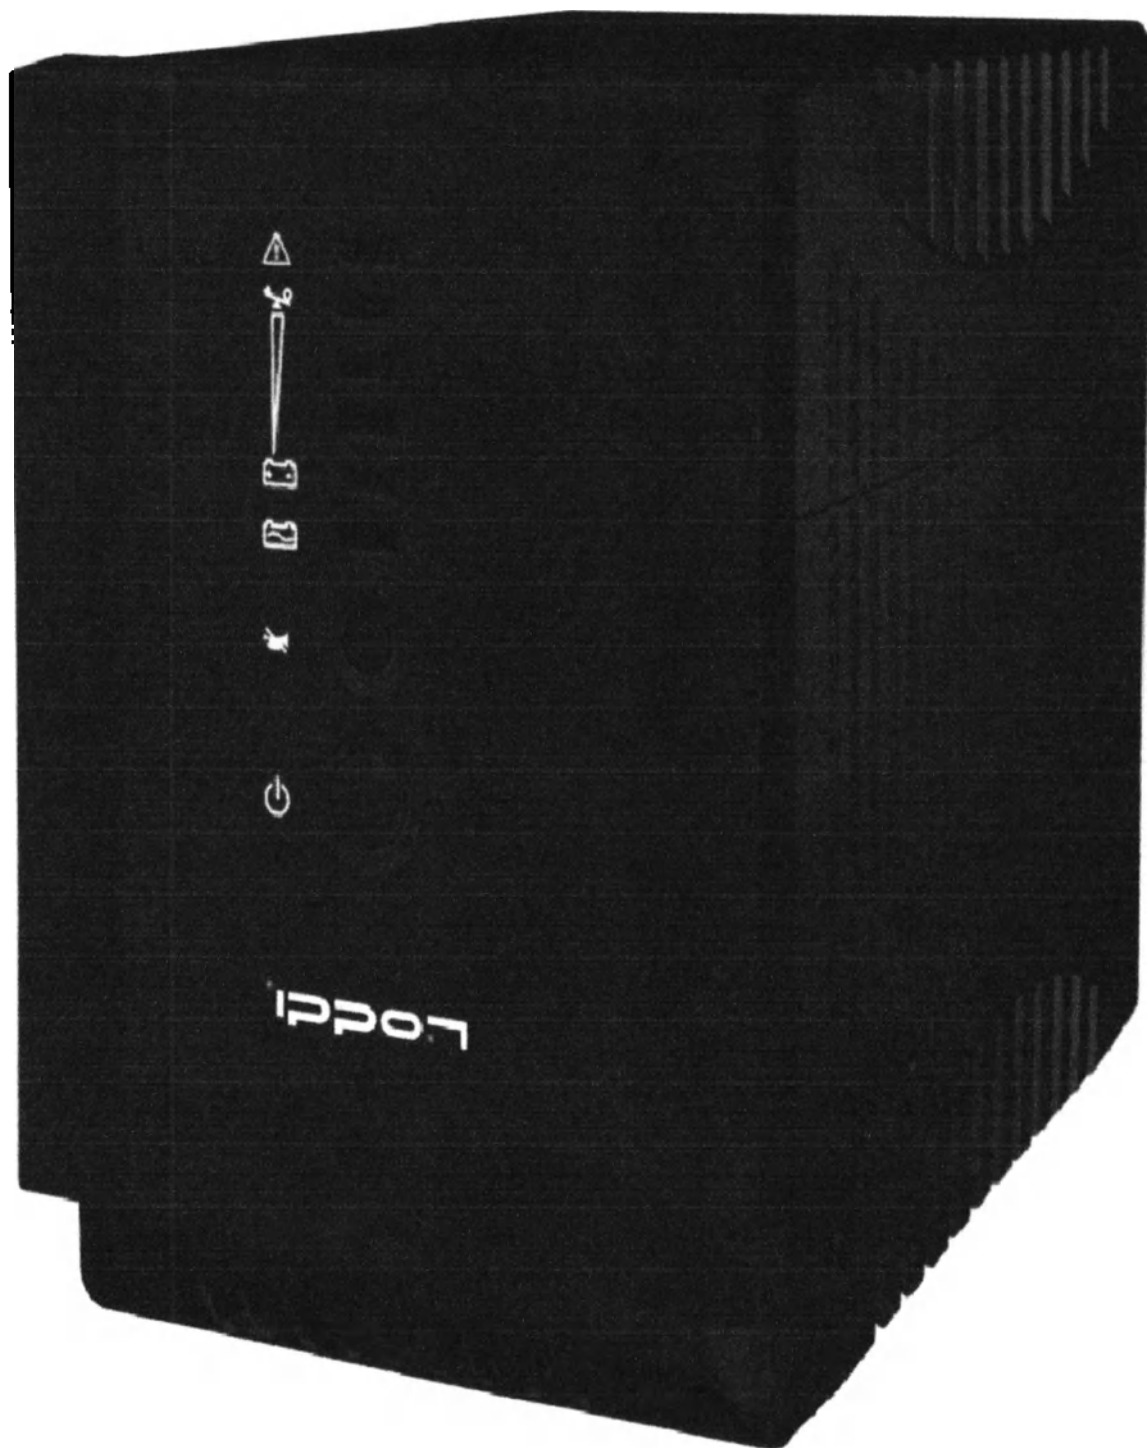


Источник бесперебойного питания


Предустановленное программное обеспечение:

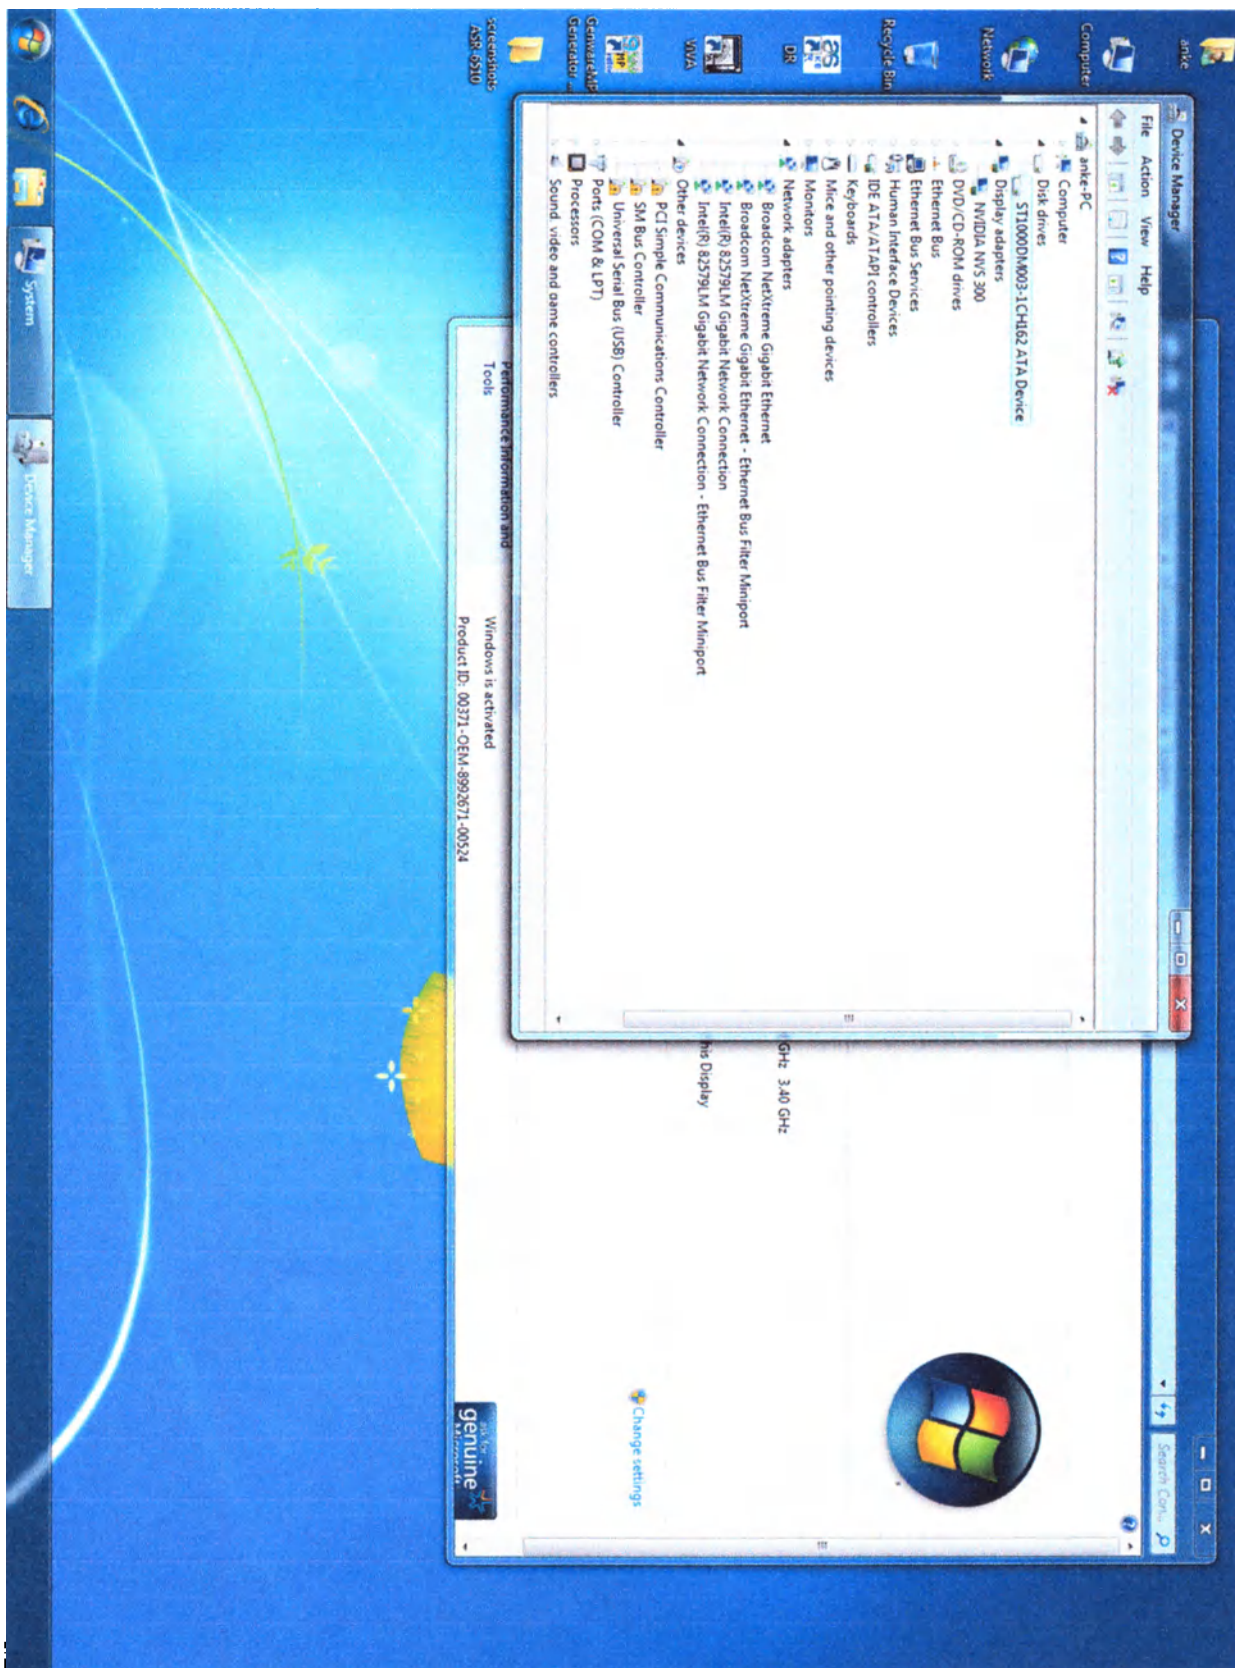


Базовая операционная система Windows 7 32-bit или более поздняя версия

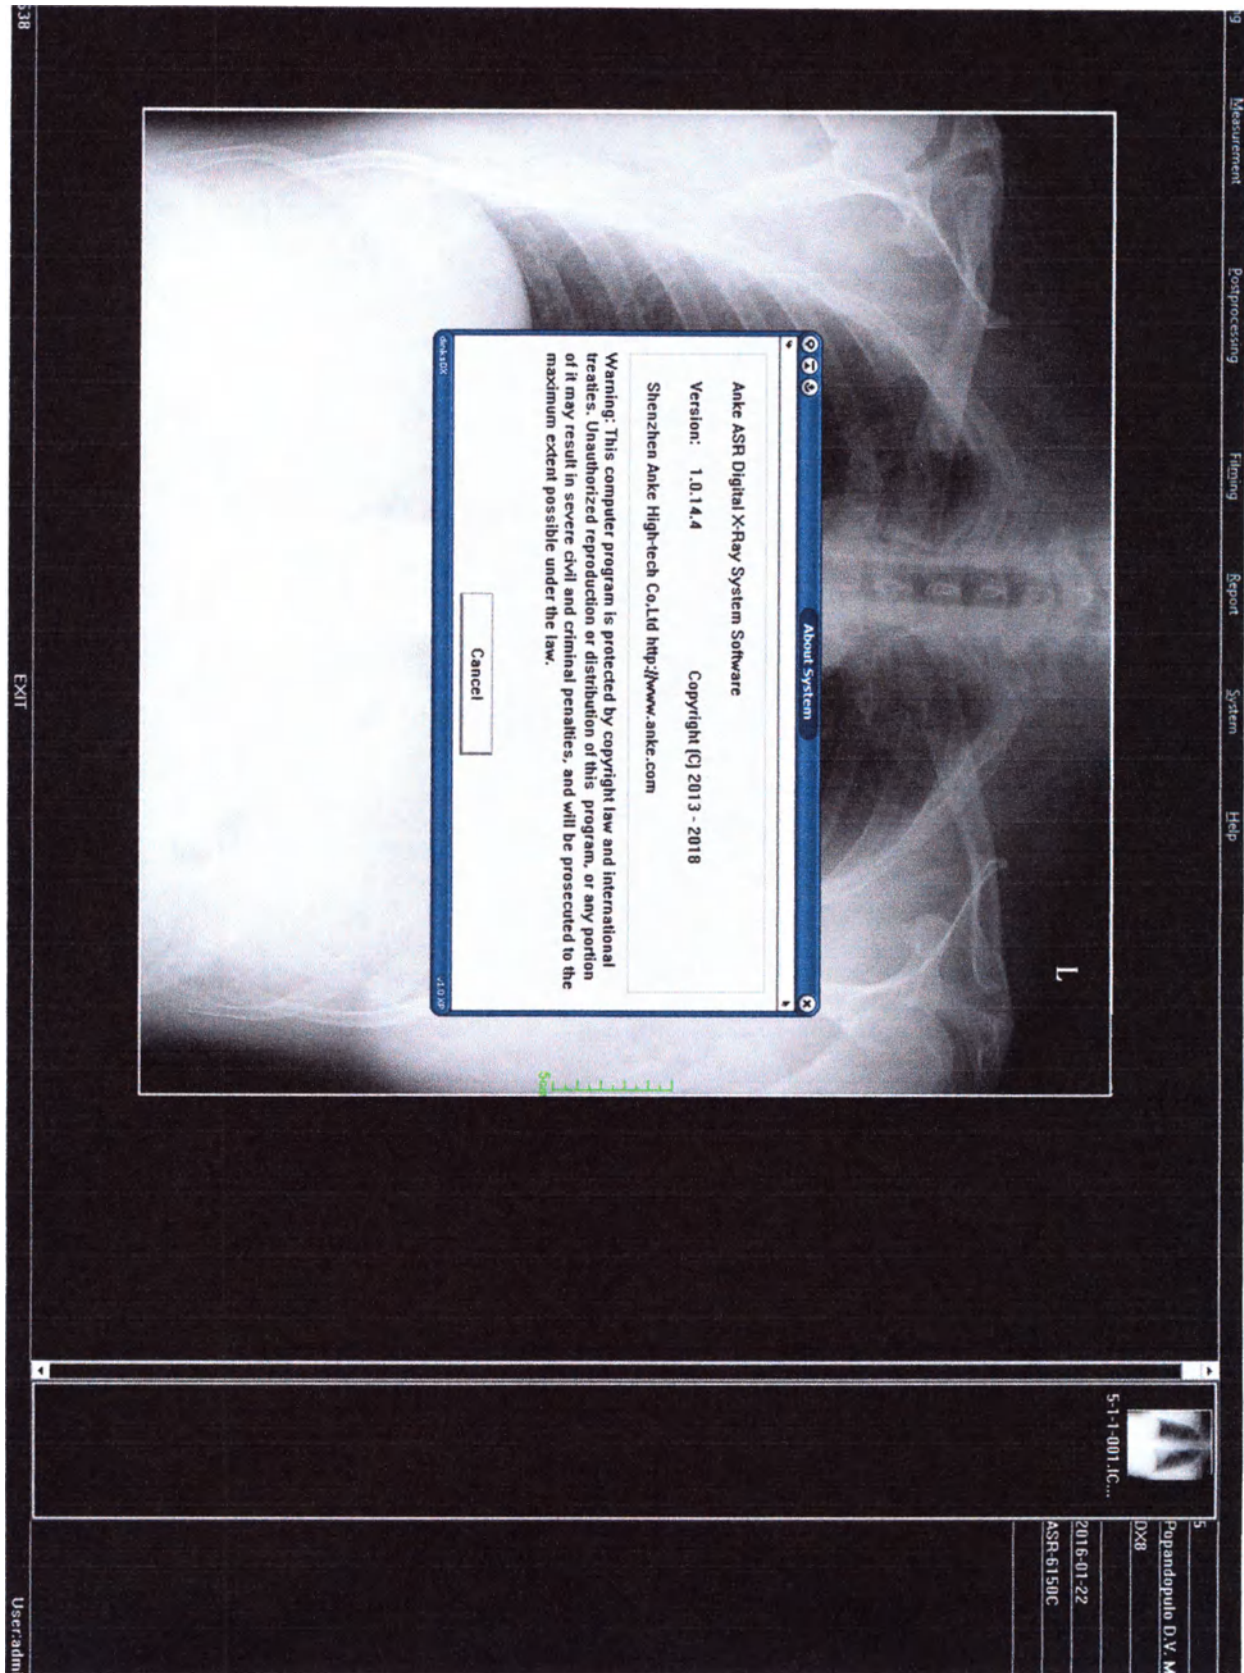

**Программное обеспечение для управления настройками
экспозиции, обработки и хранения цифровых
изображений Anke ASR Digital X-Ray System Software
версии 1.0.14.4 (26.10.2015 г.)**

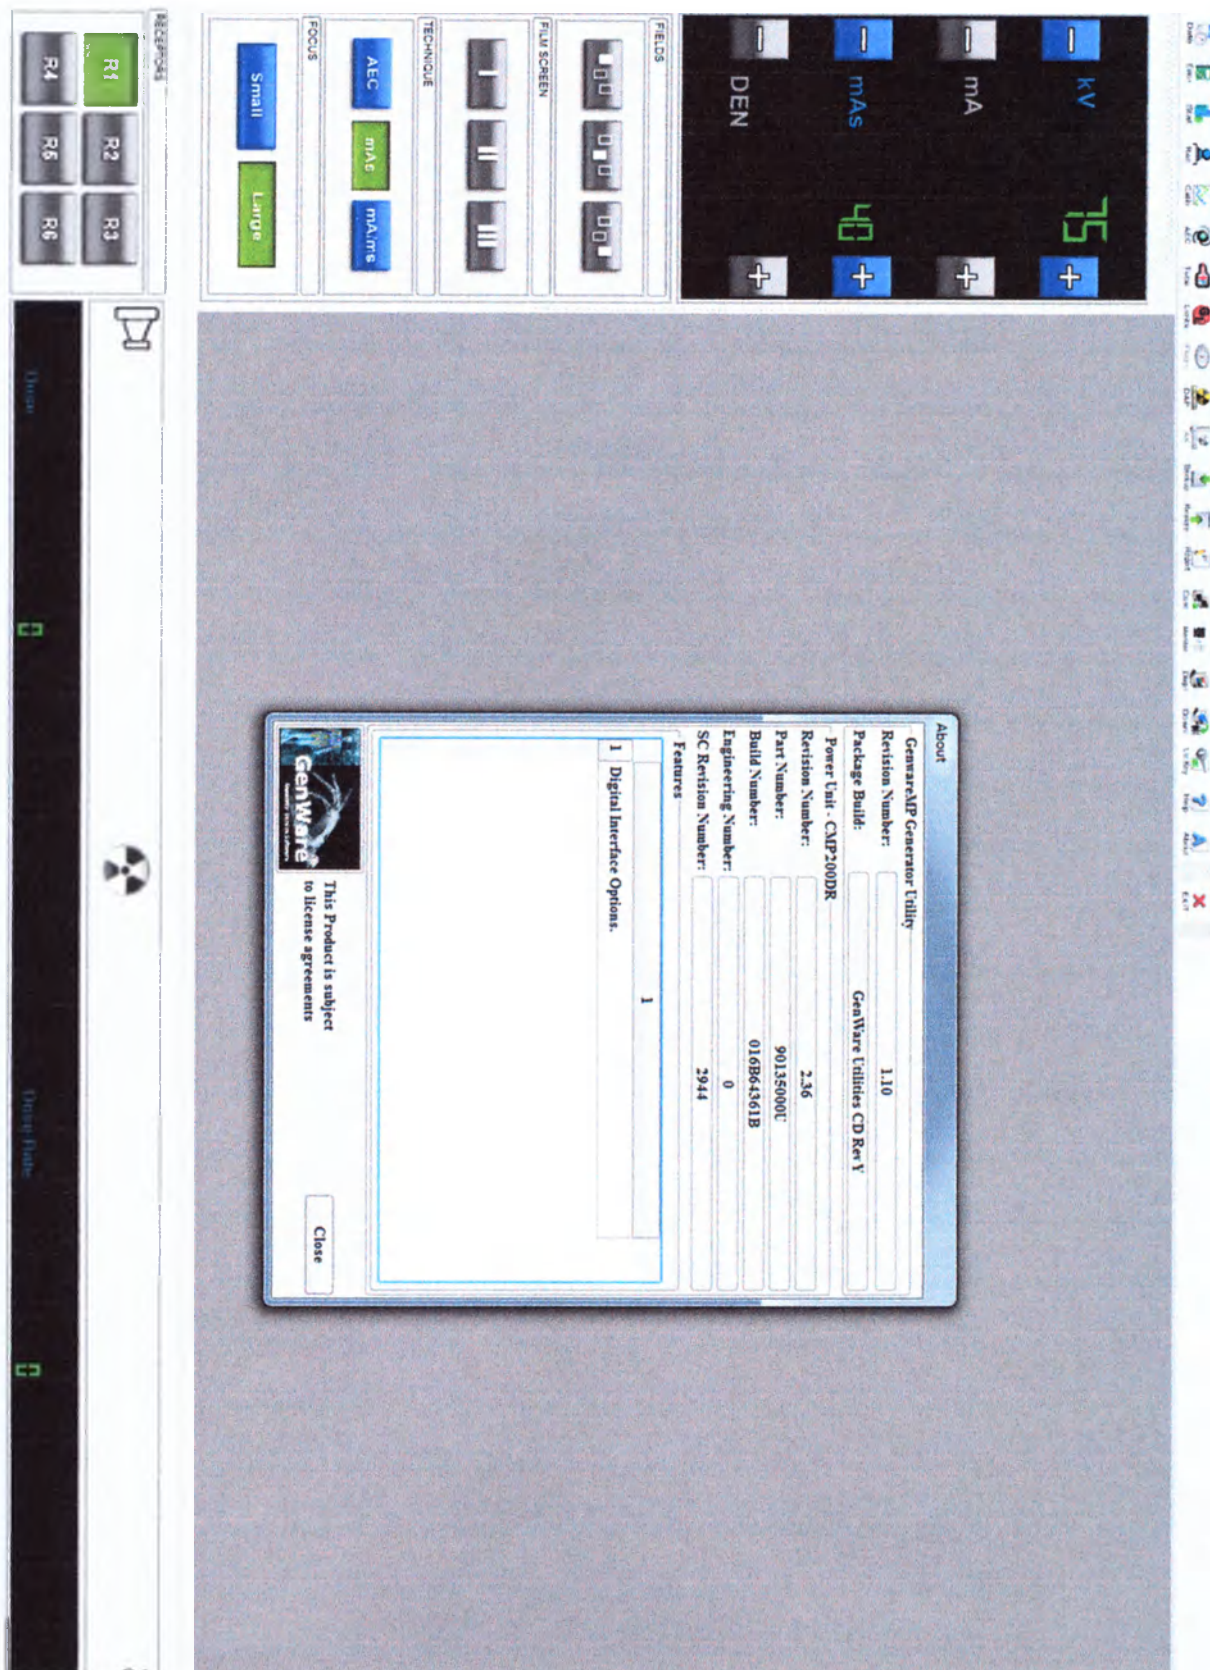

**Программное обеспечение для управления настройками
генераторного устройства GenwareMP Generator
Software версии 1.10 (16.05.2012 г.)**

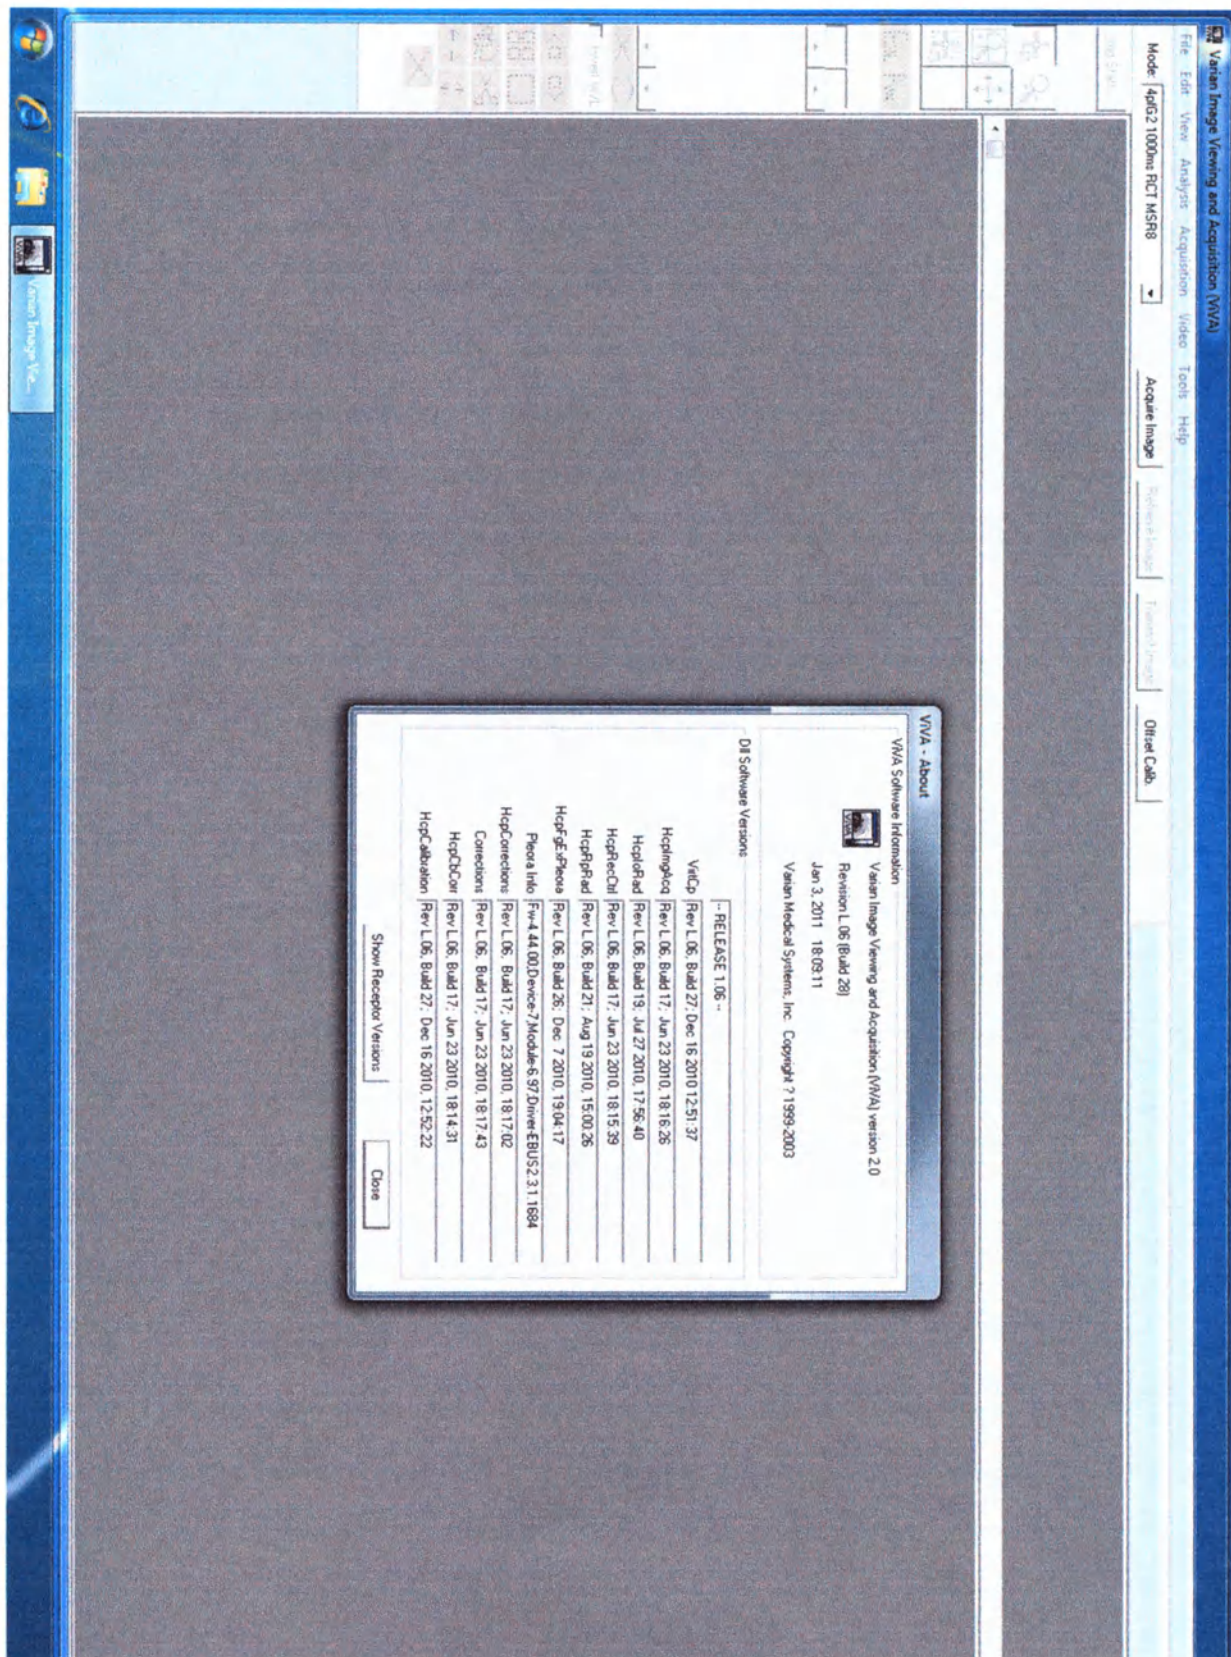

**Программное обеспечение для управления настройками
детектора Viva (Varian Image Viewing and Acquisition
Software) версии 2.0 (3.01.2011 г.)**




Дозиметр рентгеновского излучения клинический


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Рабочая станция врача для обработки цифровых изображений: персональный компьютер, монитор высокого разрешения, клавиатура, манипулятор типа «МЫШЬ»

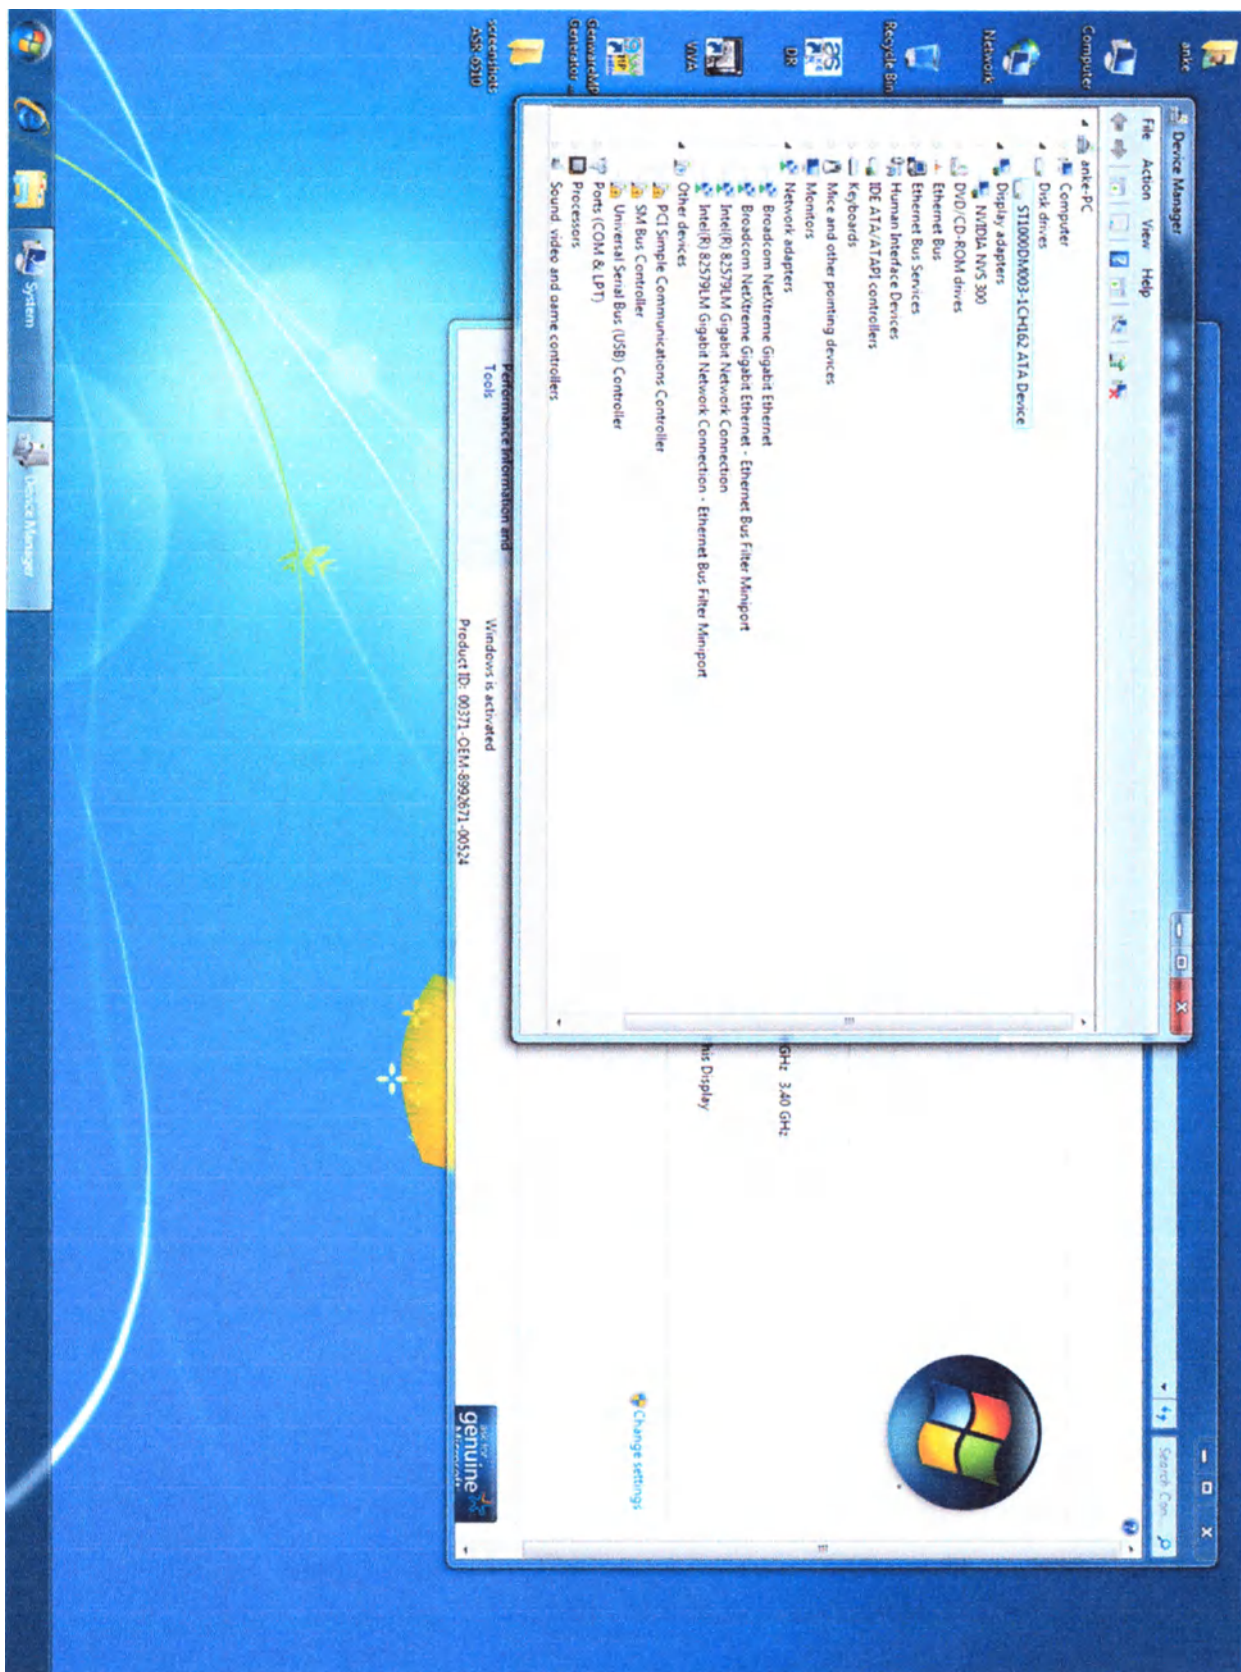

Базовая операционная система Windows 7 32-bit или более поздняя версия

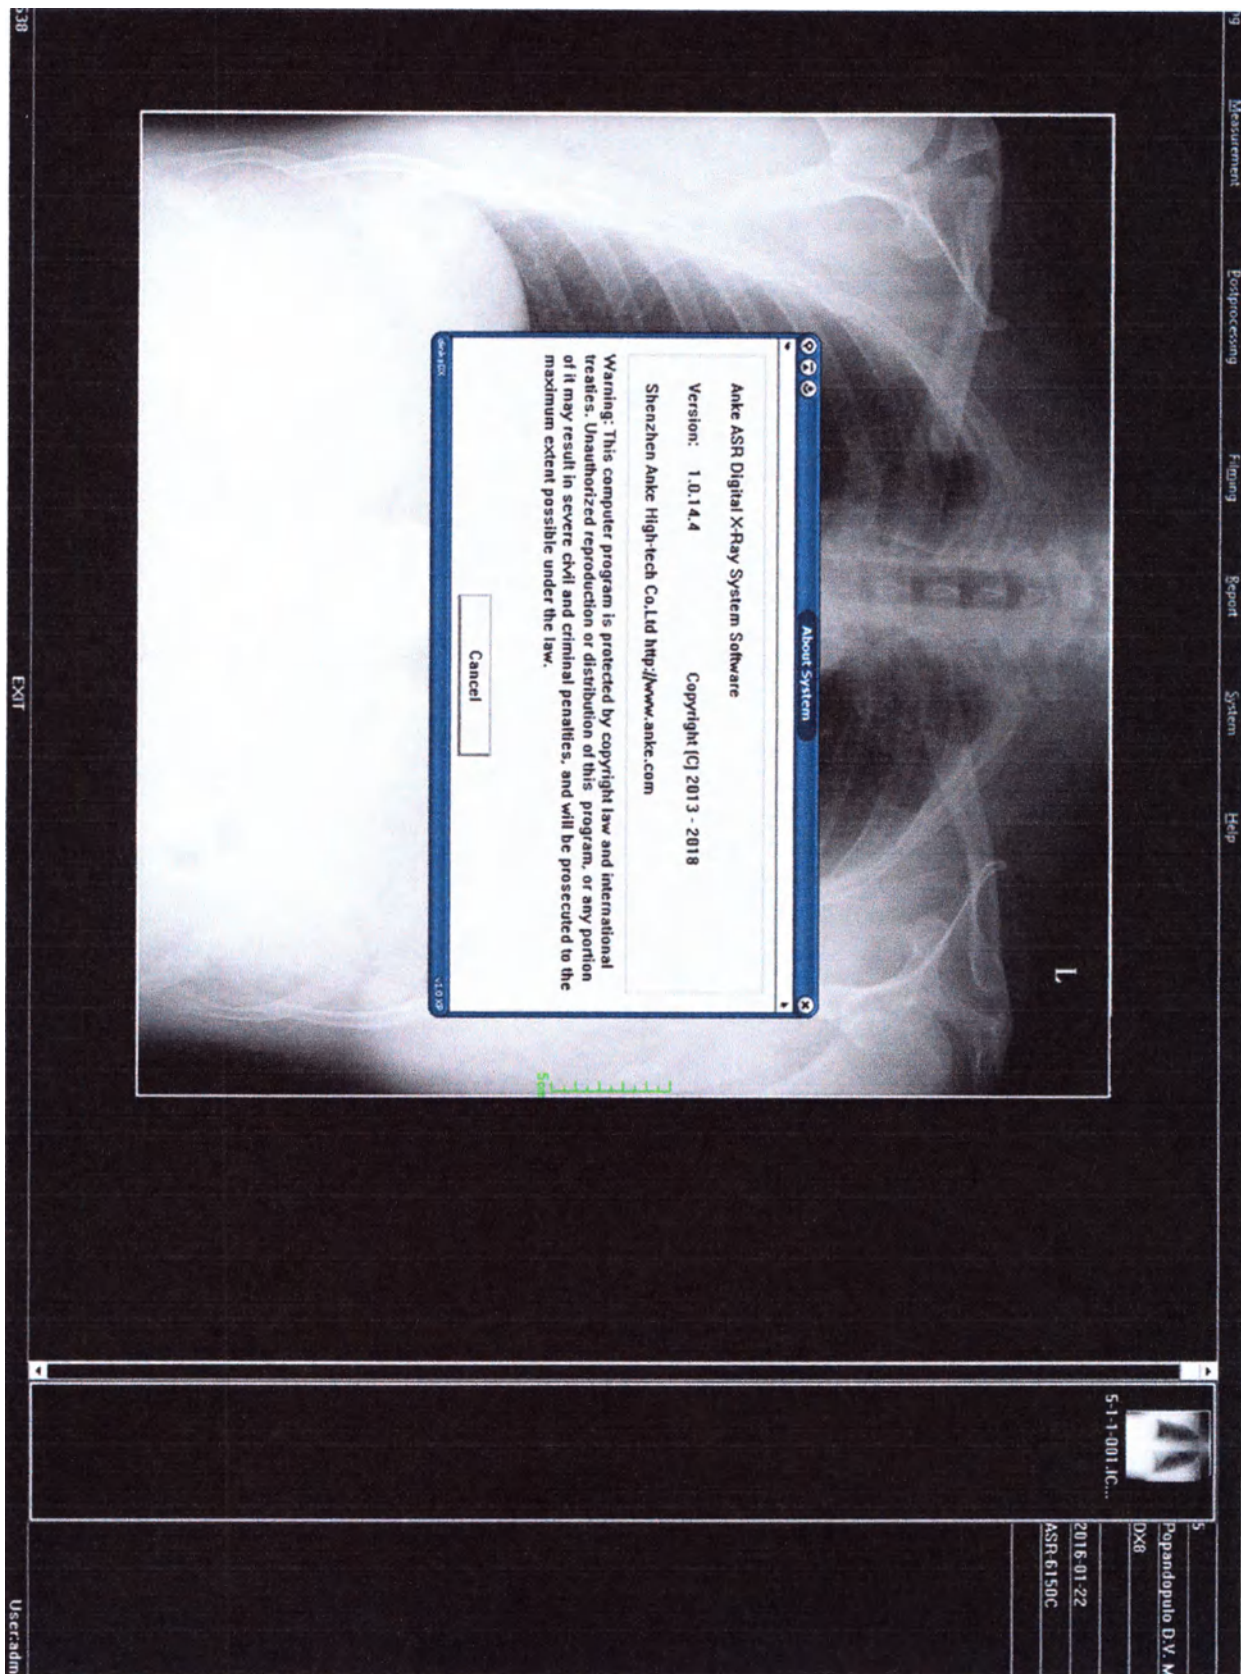

**Программное обеспечение для управления настройками
экспозиции, обработки и хранения цифровых
изображений Anke ASR Digital X-Ray System Software
версии 1.0.14.4 (26.10.2015 г.)**



Рентгеновский отсеивающий растр

ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
36 ЛИСТОВ

