


Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид слева




Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид справа

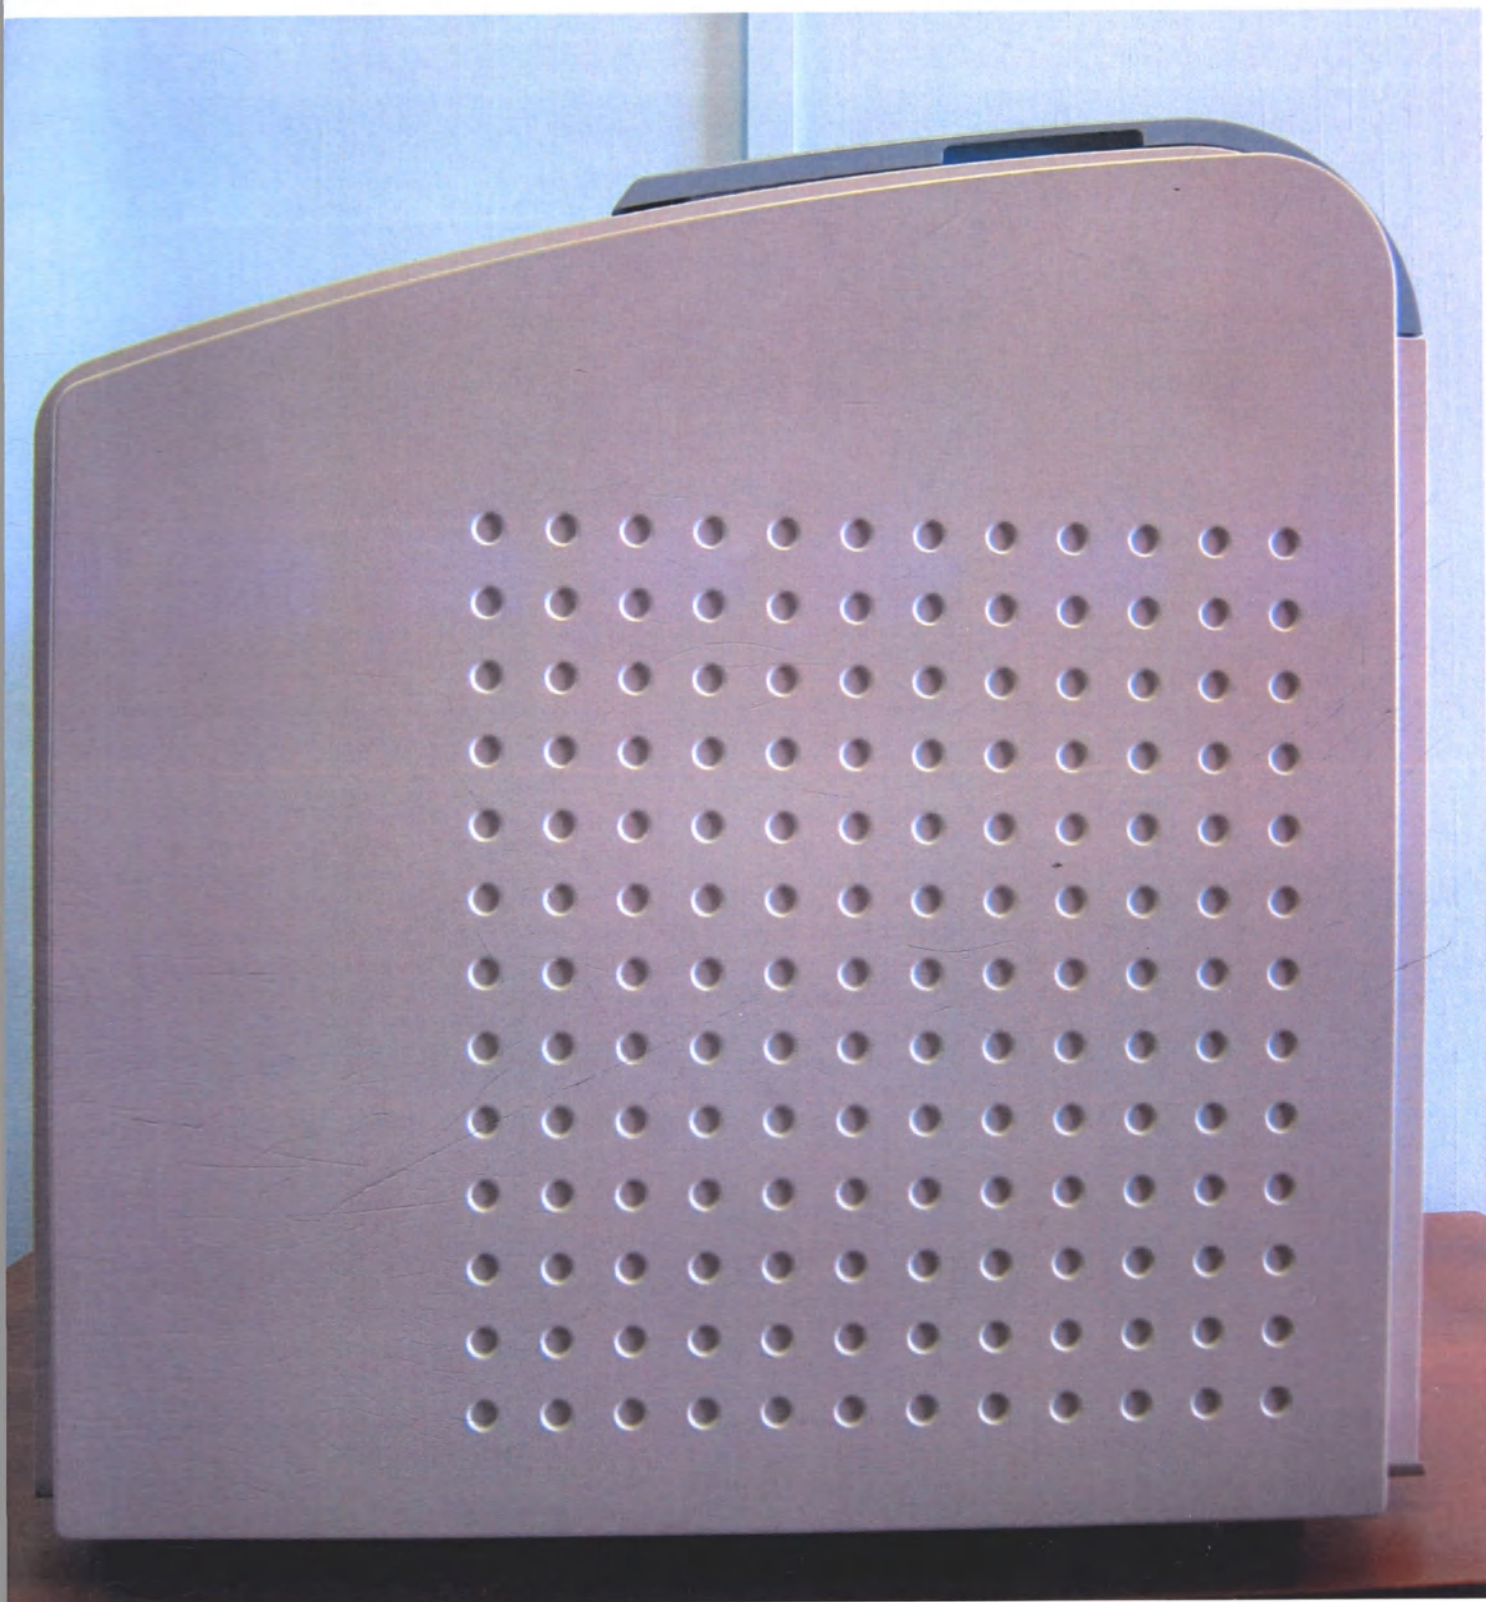


Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид снизу




Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид сверху

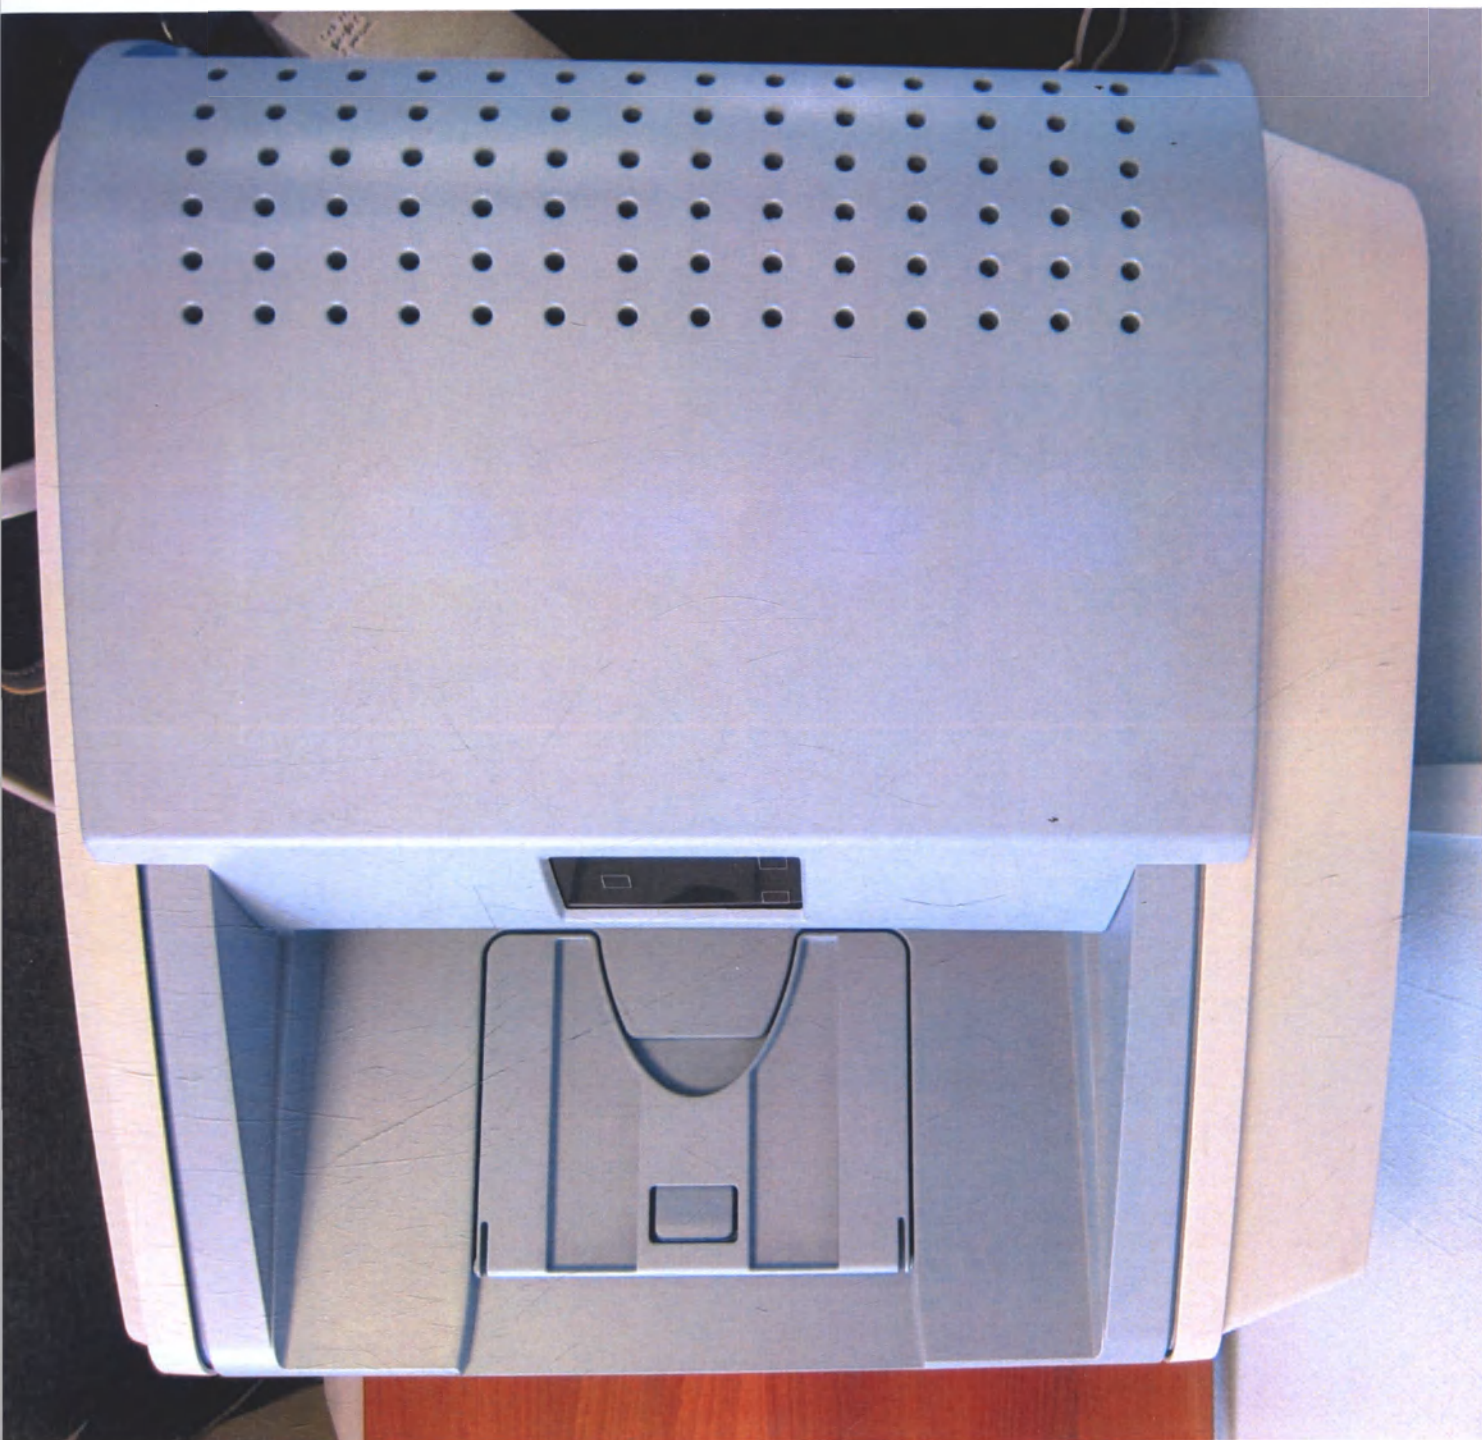


Камера лазерная мультиматная, модель DRUPRO SIGMA 2 – вид сзади

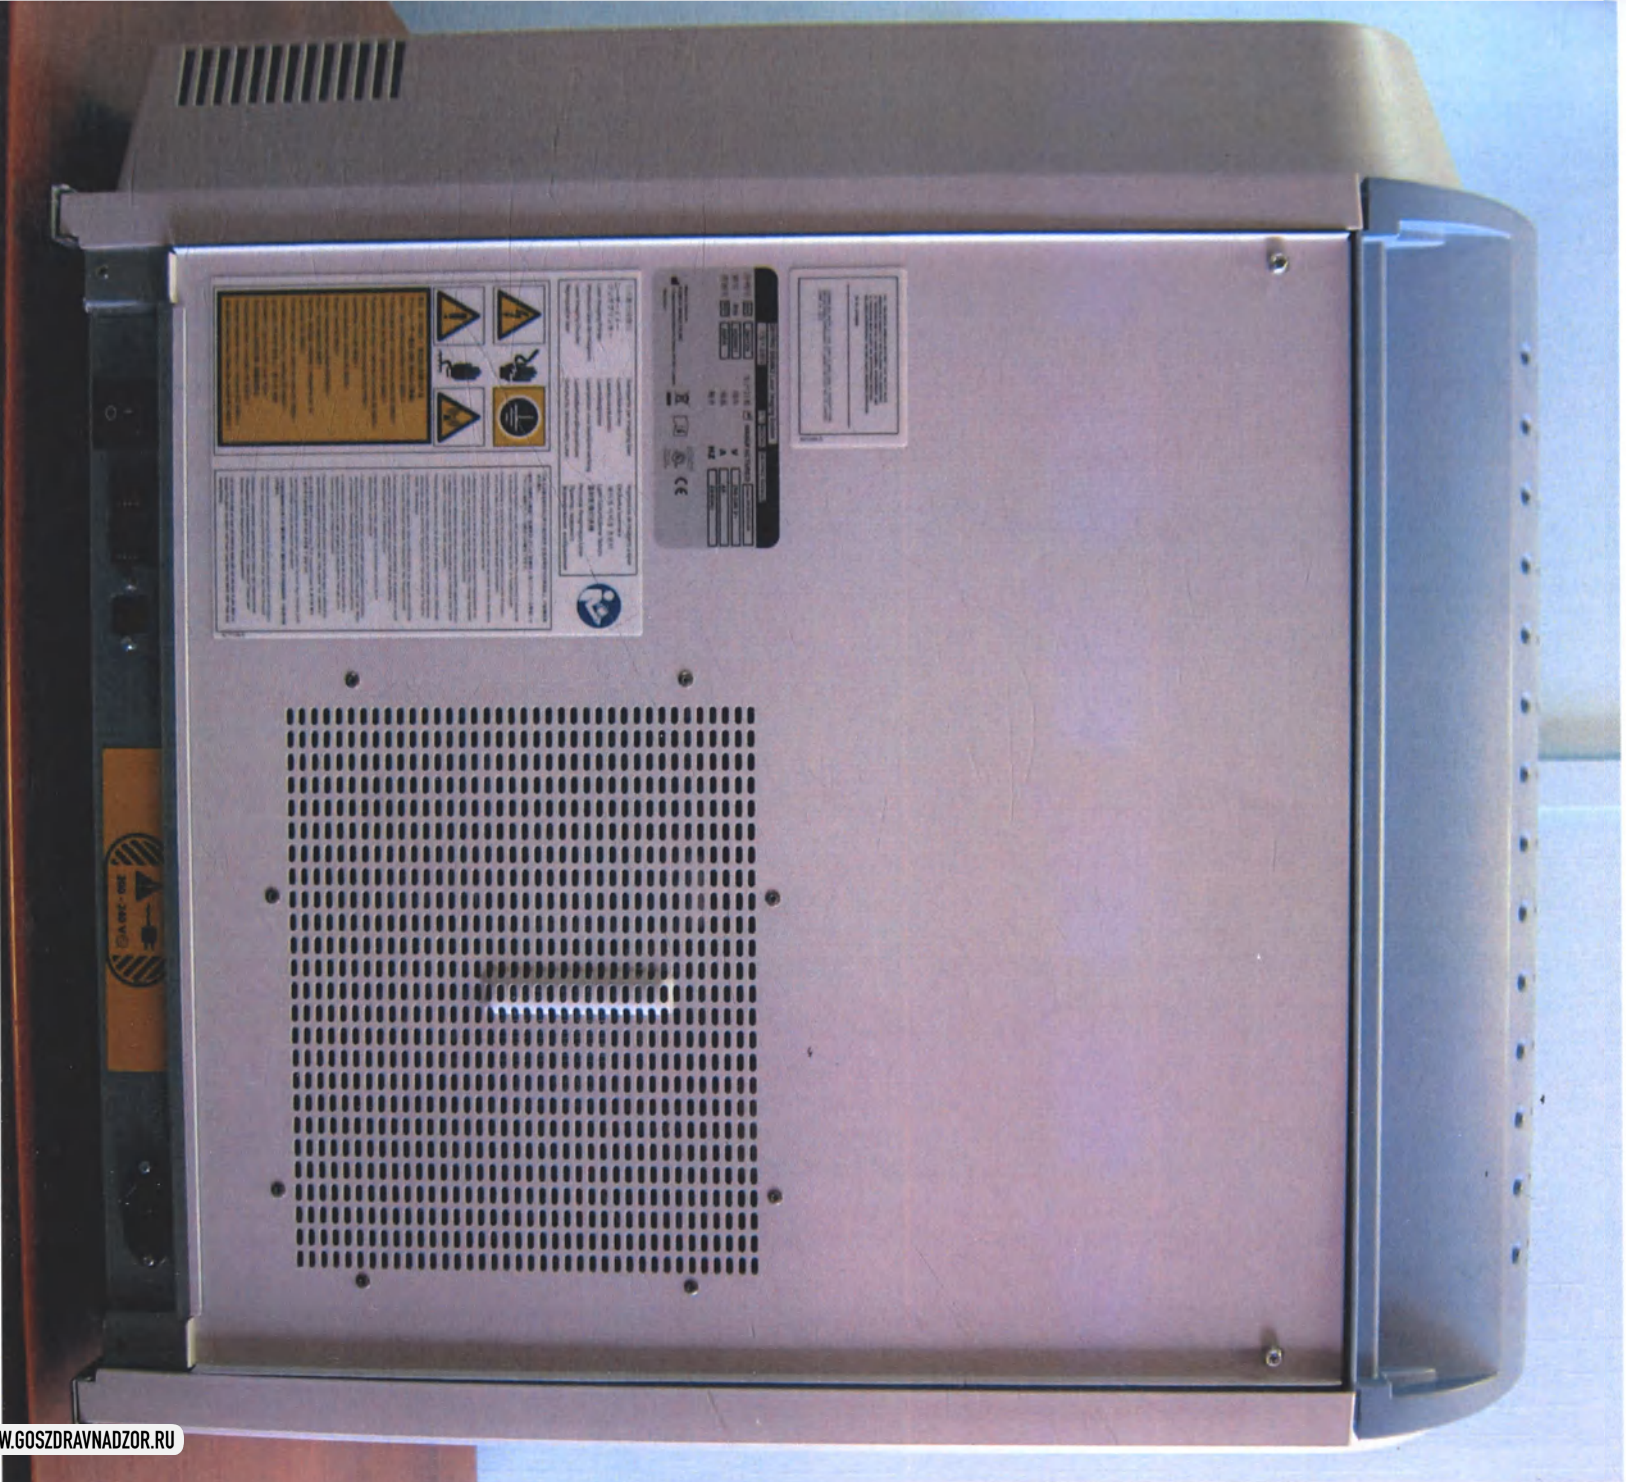

Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид панели управления

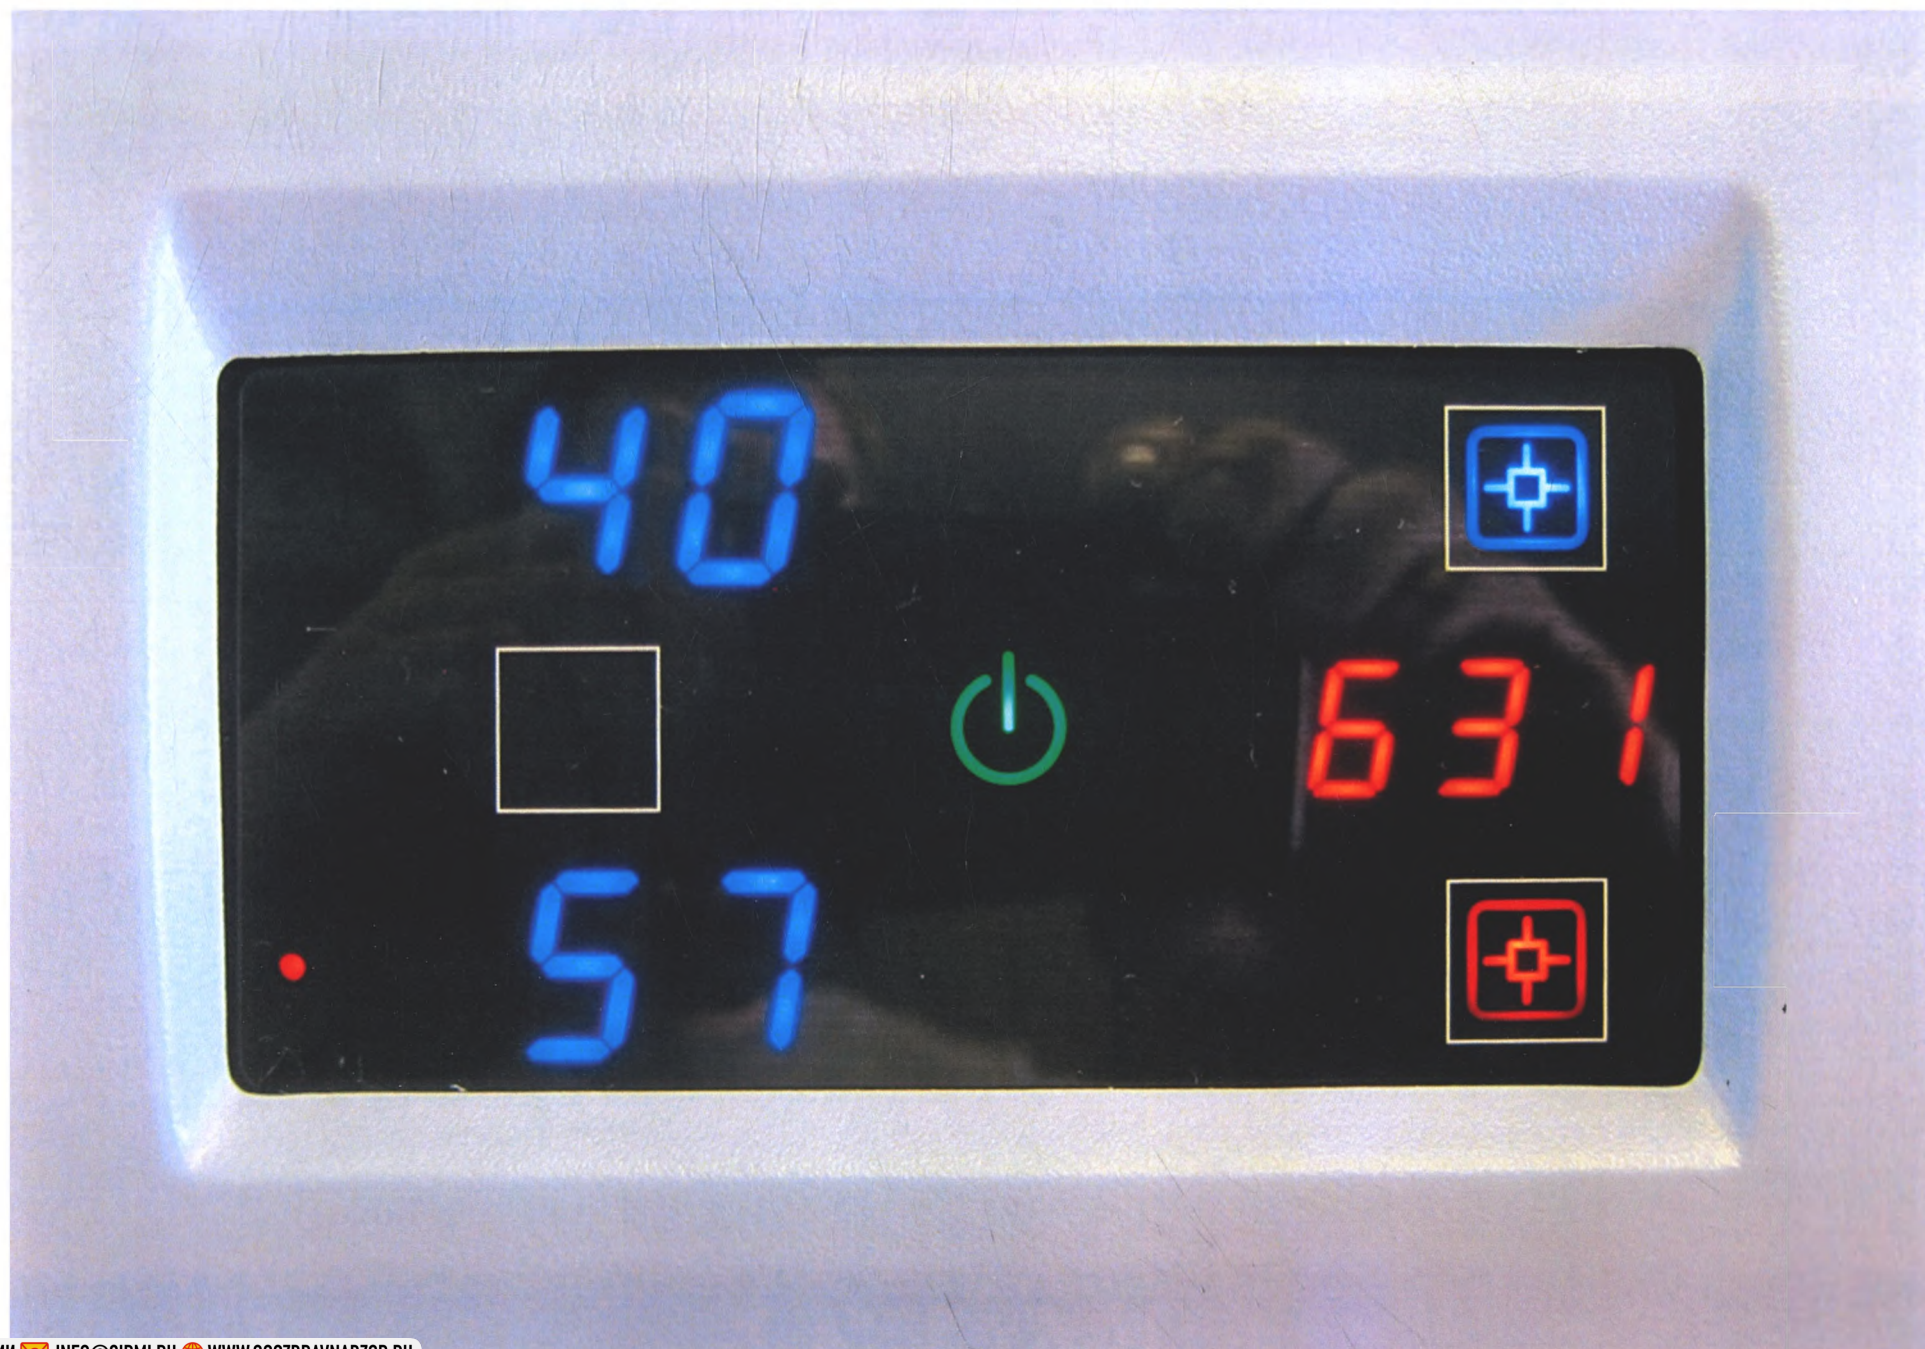

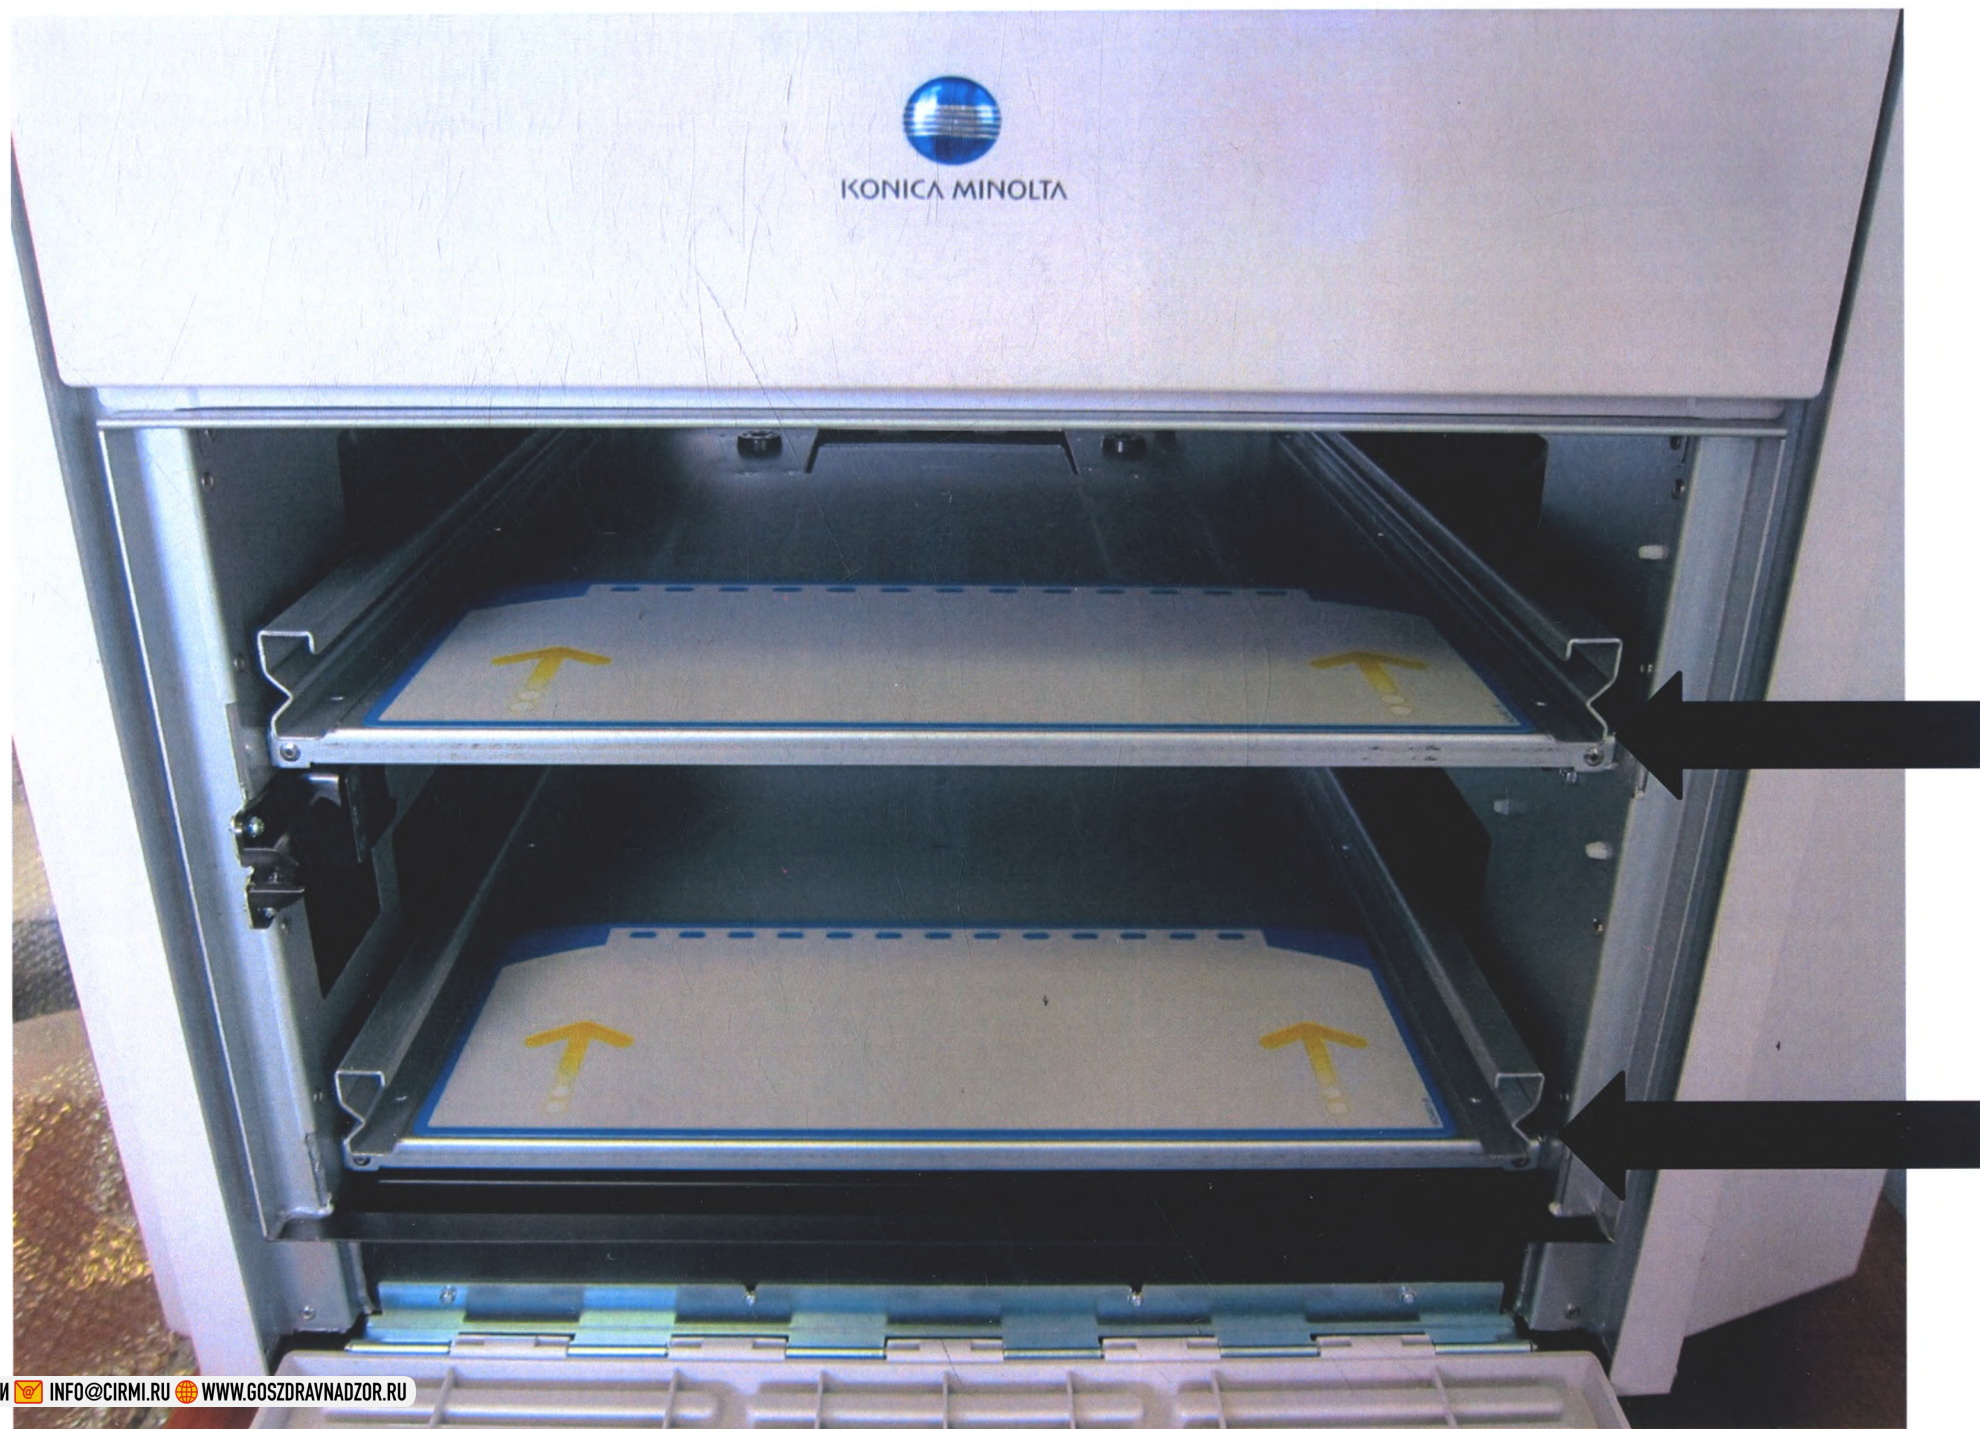

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

FCC: THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES,
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

FCC ID: U725950

COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR
DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE NO. 50, DATED
JUNE 24, 2007

AD3499.A

Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид маркировки
на задней панели камеры – продолжение

DRYPRO SIGMA2 Laser Imaging System

干式激光成像仪

型号 MODEL DRYPRO SIGMA2

序列号 S/N 200129

生产日期  MANUFACTURED June-2016/2016-06

料号 P/N AD9001

电压 V 200-240 V~

类别号 REF A9R4

电流 A 4A

频率 HZ 50/60Hz

Made in China for
KONICA MINOLTA, INC.
 1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan
9G7538.H



FILE NO. CNT. NO.
E349063 23YA



Medical
Equipment



Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид маркировки на задней панели камеры – продолжение

干式激光成像仪

レーザーイメー
ジングプリンター

Laser Imaging Printer

Impresora láser de imágenes

Laser Imaging-Drucker

Reprographie laser

Stampante per imaging laser

Laserbildeskriver

Laserkuvaustulostin

Laserbilledprinter

Laserprinter voor beeldverwerking

Laserbildbehandlungsskriver

Εκτυπωτής αλεκόνισης Laser

Impressora de imagens a laser

Drukarka laserowa

레이저 이미징 프린터

Lazer Görüntüleme Yazıcısı

雷射影像印表機

Pencetak Pengimejan Laser

Принтер лазерного
формирования изображения



符合 IEC 60825-1 规定的1类激光产品

クラス1レーザー製品 (IEC 60825-1 準拠)

Class 1 laser product according to IEC 60825-1

Producto láser clase 1 conforme a la norma IEC 60825-1

Laser-Produkt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1

Produit laser de classe 1 conforme à la norme IEC 60825-1

Prodotto laser di classe uno secondo IEC 60825-1

Laser klasse 1 i.h.t. IEC 60825-1

1.luokan lasertuote, luokitus IEC 60825-1

Klasse 1 laser IEC 60825-1

Klasse 1 laserproduct conform IEC 60825-1

Klass 1 laser enligt IEC 60825-1

Προϊόν λέιζερ κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1

Produto laser classe um, conforme norma IEC 60825-1

Produkt laserowy klasy 1 według IEC 60825-1

IEC 60825-1에 따른 클래스 1 레이저 제품

IEC 60825-1 uyarınca Sınıf 1 lazer ürünü

符合 IEC 60825-1 规定的第 1 类雷射产品

Produk laser Kelas 1 mengikut IEC 60825-1

Лазерное изделие класса 1 согласно IEC 60825-1

Sản phẩm laser Class 1 theo tiêu chuẩn IEC 60825-1

• 只有当设备连接到标有“医院使用”或“医用等级”的同等插座上,才能确保接地可靠性。

• 接地の信頼性は機器が「医療専用」または「医療用」と表示されている等価レセプタクルに接続されている場合のみ確保できます。

• Grounding reliability can only be achieved when the equipment is connected to an equivalent receptacle marked 'Hospital Only' or 'Hospital Grade'.

• La fiabilidad de la toma de tierra sólo puede garantizarse cuando el equipo está conectado a una toma equivalente de grado hospitalario.

• Damit eine zuverlässige Erdung erzielt wird, muss das Gerät an eine Steckdose mit Schutzkontakt angeschossen werden.

• La fiabilité de la mise à la terre ne peut être obtenue que si l'équipement est connecté à une prise électrique marquée « Hospital Only » (Usage hospitalier uniquement) ou « Hospital Grade » (Qualité hospitalière).

• Si può ottenere l'affidabilità della messa a terra solo quando l'apparecchiatura è collegata a una presa equivalente contrassegnata con 'Hospital Only' (Solo Ospedale) o 'Hospital Grade' (Grado ospedaliero).

• Påliteilig jording oppnås kun når utstyret er tilkoblet fast monterte stikkontakt.

• Luotettava maadoitus voidaan saavuttaa vain, kun laite liitetään vastaavaan pistorasiaan, jossa on merkintä "Hospital Only" (Vain sairaala) tai "Hospital Grade" (Sairaalataso).

• Det er kun muligt at opnå en sikker jordforbindelse, når apparatet er tilsluttet en tilsvarende stikkontakt mærket "Hospital Only" eller "Hospital Grade".

• Een betrouwbare aarding kan alleen worden bereikt als de apparatuur wordt aangesloten op een vergelijkbaar stopcontact met de aanduiding 'Ziekenhuisgebruik' of 'Ziekenhuisklasse'.

• Säker jording kan endast uppnås om utrustningen ansluts till ett nätströmsuttag för sjukhusbruk.

• Η αξιοπιστία της γείωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε ισοδύναμη πρίζα με την ένδειξη 'Hospital Only' (Μόνο για νοσοκομείο) ή 'Hospital Grade' (Κατηγορία νοσοκομειακής χρήσης).

• A confiabilidade do aterramento somente pode ser alcançada quando o equipamento está conectado receptáculo equivalente marcado como 'Somente hospital' ou 'Grade do hospital'.

• Niezawodne uziemienie można uzyskać jedynie podłączając urządzenie do odpowiedniego gniazda oznaczonego jako „tylko szpital” lub „szpitalne”.

• 겹치 안전성은 장비가 'Hospital Only' 또는 'Hospital Grade'로 표시된 해당 콘센트에 연결되었을 경우에만 보장할 수 있습니다.

• Topraklama güvenilirliği ancak ekipman 'Sadece Hastane' veya 'Hastane Sınıfı' işaretli eşdeğer bir prize takıldığında sağlanabilir.

• 只有當設備連接至標有“醫院專用”或“醫院等級”的同級插座時,才能提供穩定的接地。

• Keutuhan pembumian hanya boleh dicapai apabila peralatan disambungkan ke bekas yang setara yang bertanda 'Hospital sahaja' atau 'Gred Hospital'.

• Надежность заземления гарантируется только при подключении оборудования в эквивалентное гнездо с пометкой "Только для больниц" или "Для медицинского оборудования".


• Chỉ có thể nối đất an toàn khi thiết bị được kết nối với một ổ cắm điện có ký hiệu "Chỉ dành cho Bệnh viện" hoặc "Loại dành cho Bệnh viện" hoặc loại tương đương.

Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 – вид упаковки камеры





Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 - вид упаковки принадлежностей для камеры

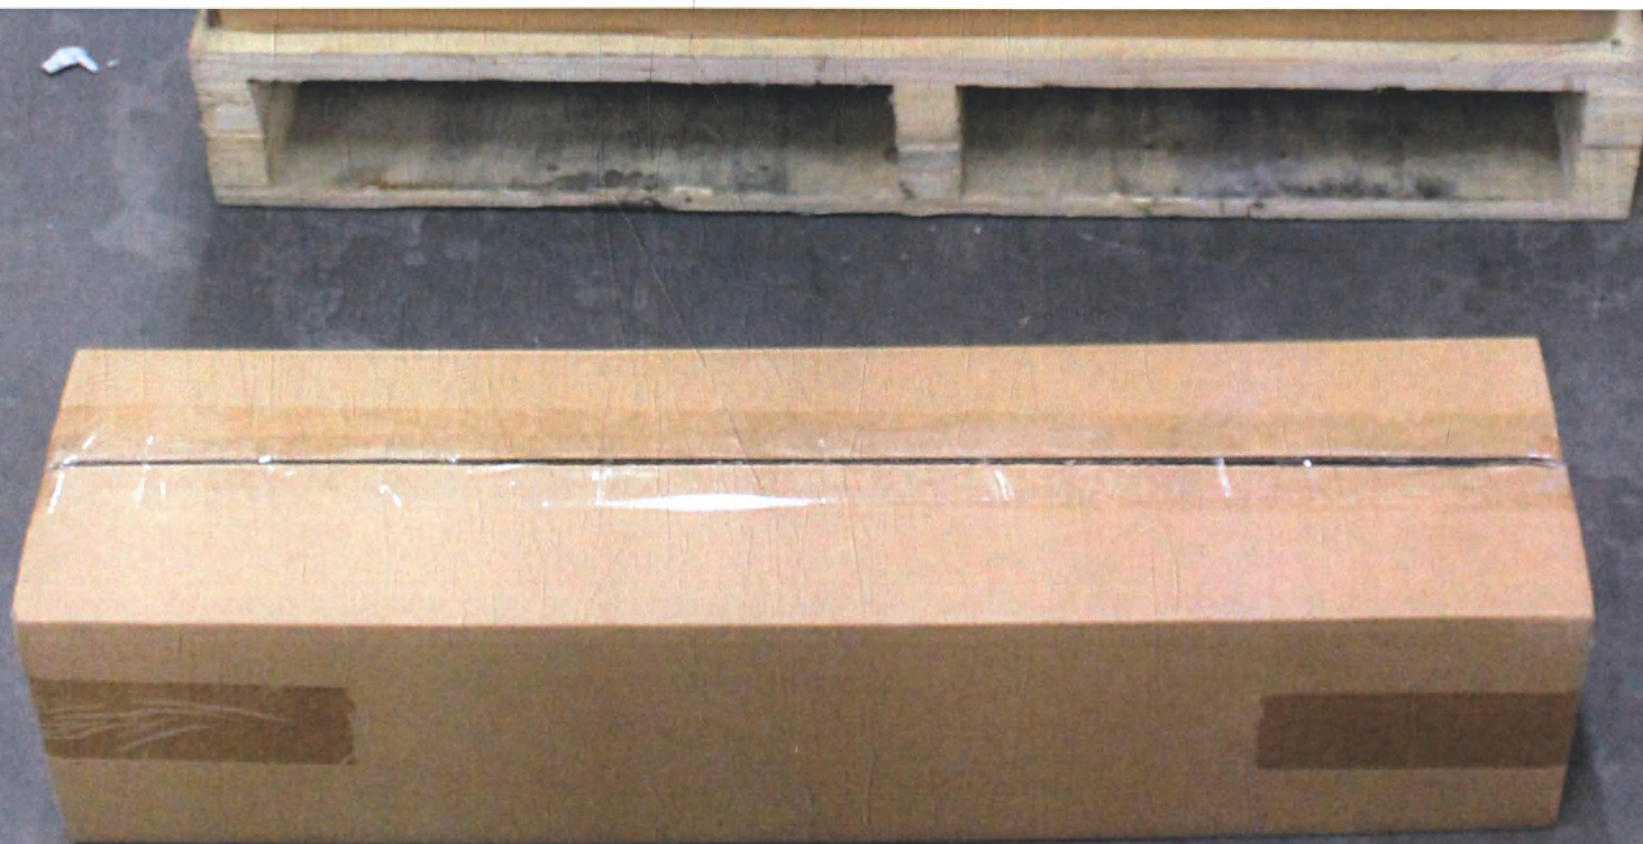

Прошито и
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР пронумеровано 12 листов
ТИМОФЕЕВ М.В.

