



Фотографические изображения медицинского изделия


**Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004**

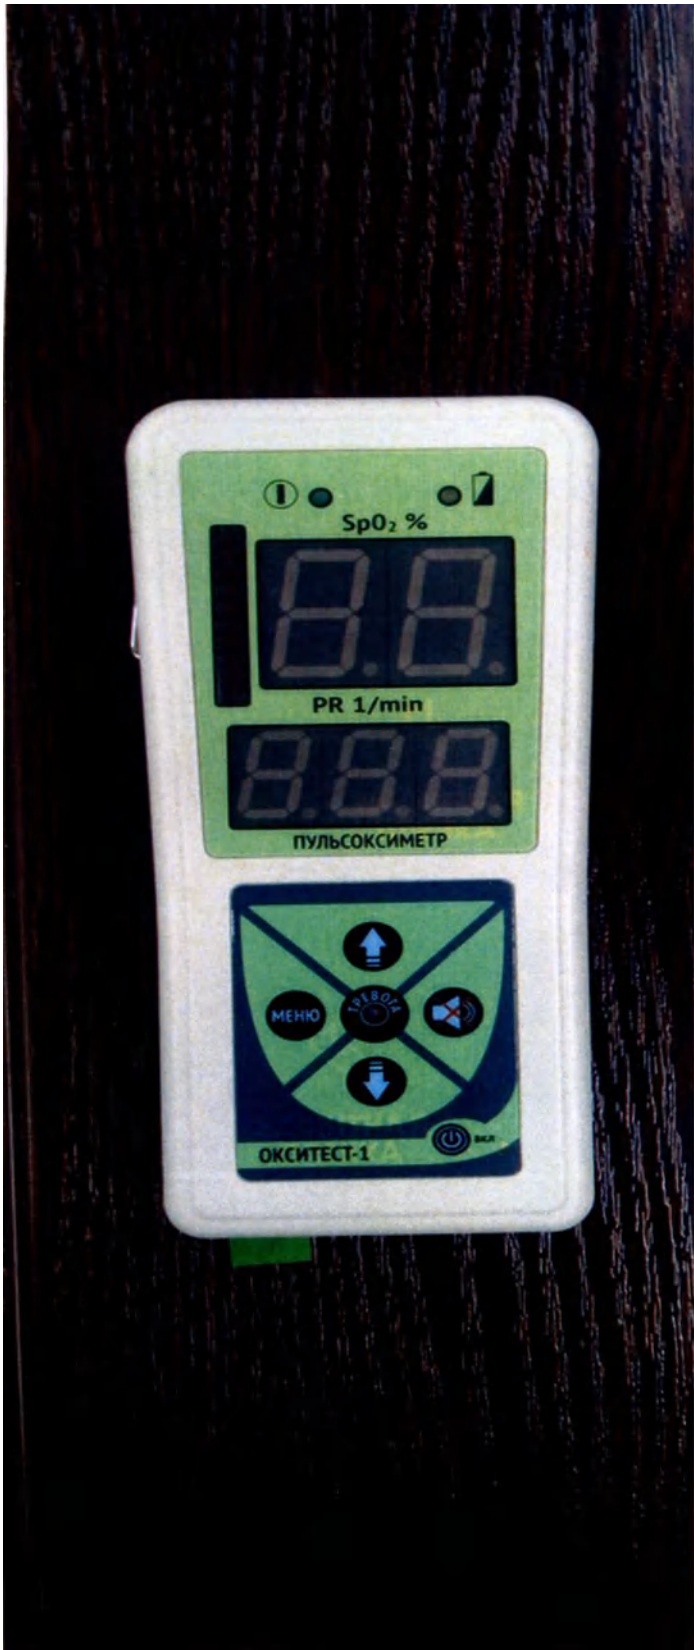

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1"

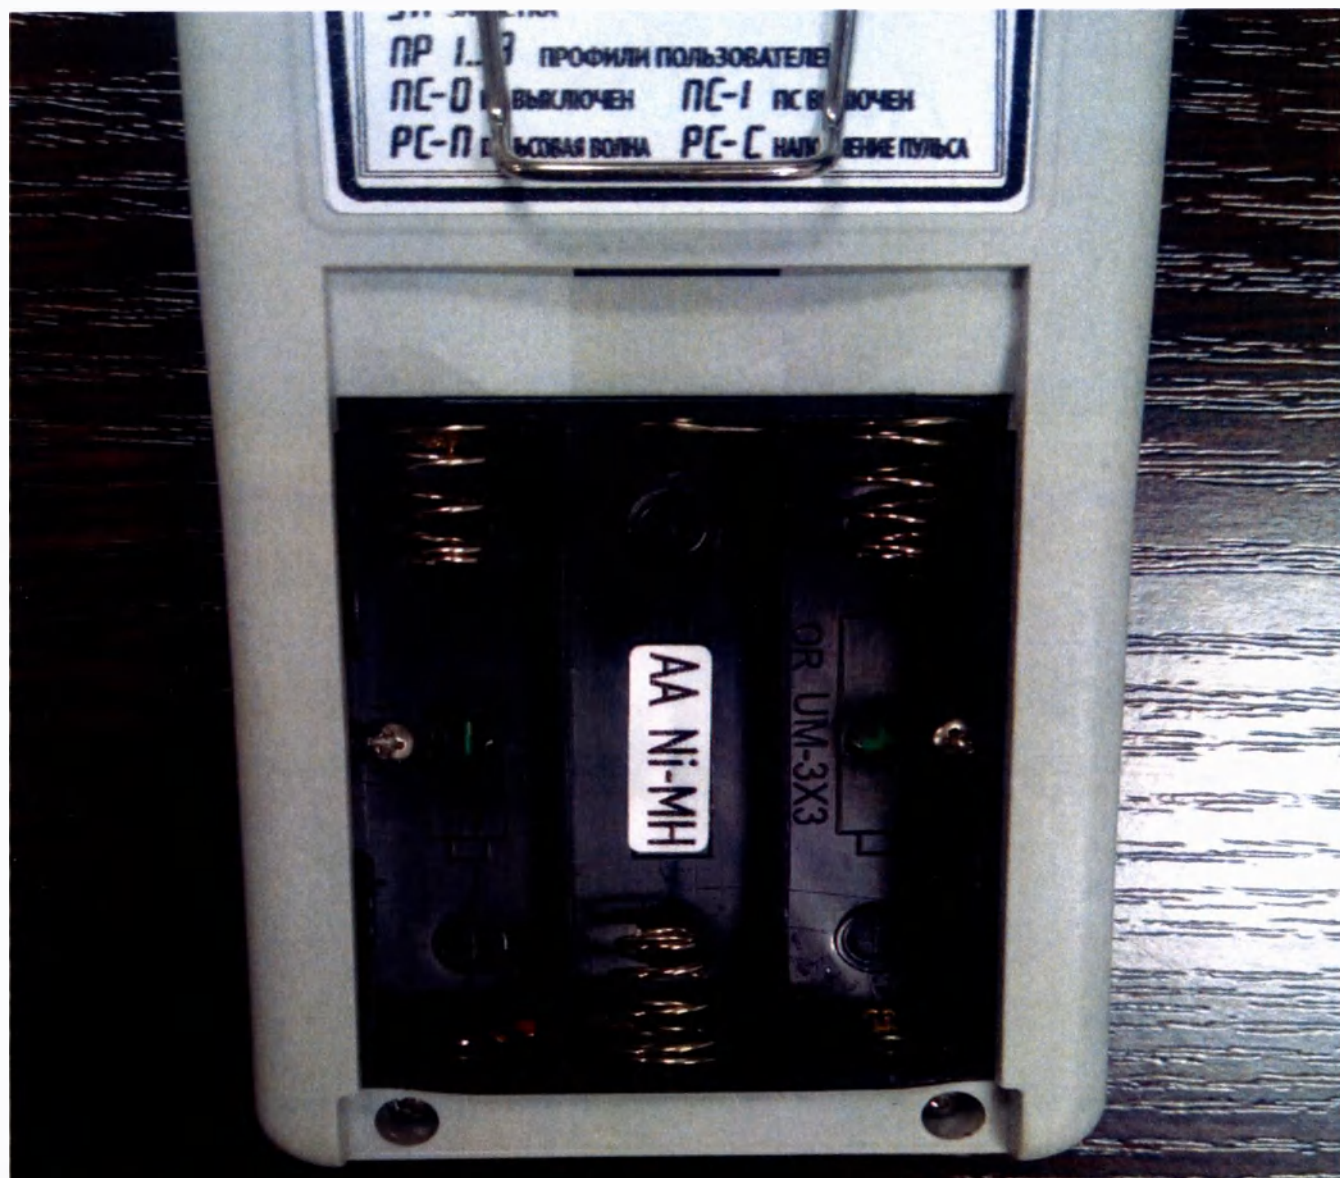

Маркировка Пульсоксиметра портативного с автономным питанием "Окситест-1"



Пульсоксиметр портативный
с автономным питанием «ОКСИТЕСТ-1»

— 8-18 В; 5 ВА

ТУ 26.20.12-011-18585567-2004 IP41

SN 000001.18

НД нет датчика

НП нет пиллента

НА настройка

ПС пиковый сигнал

СВ ситуационный порог верх

СН ситуационный порог нижн

ПВ пульса порог верх

ПН пульса порог нижн

ГП громкость пульса

ГА громкость аларма

ЗА заставка

ПР 1...8 профили пользователей

ПС-0 пс выключен

ПС-1 пс включен

РС-П пульсация доп


РС-С наполнение пульса





Маркировка Пульсоксиметра портативного с автономным питанием "Окситест-1"




Сетевой адаптер GSM06E12-P1J производства Mean Well Enterprises Co., Ltd., Китай и его маркировка

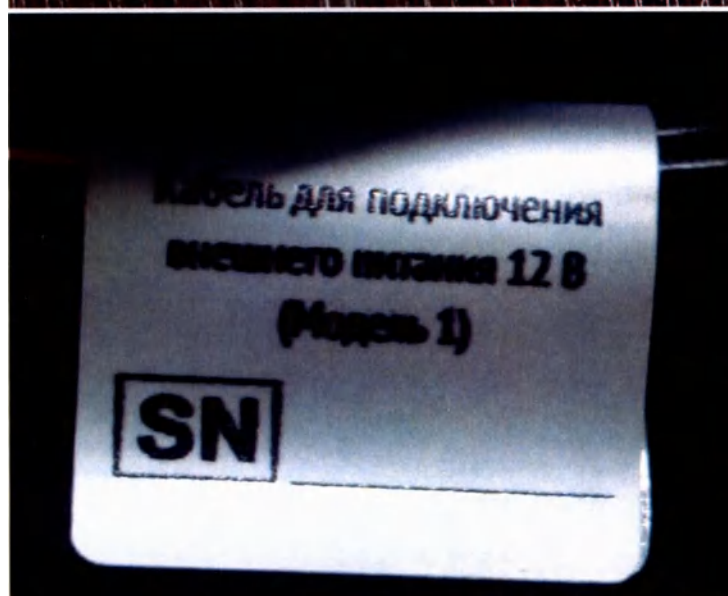


Кабель для подключения внешнего питания 12 В (Модель 1) и его маркировка

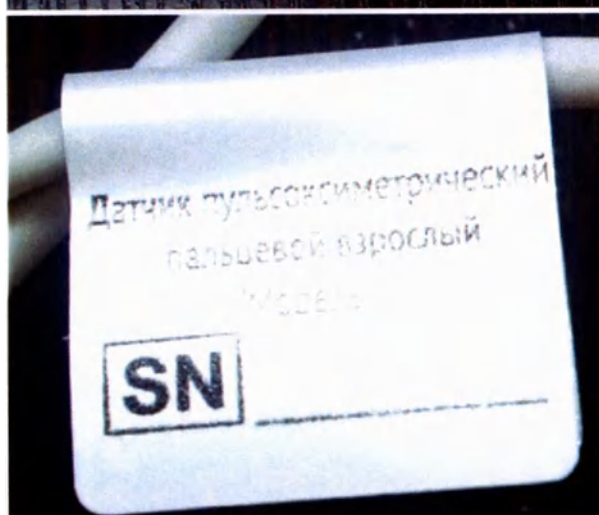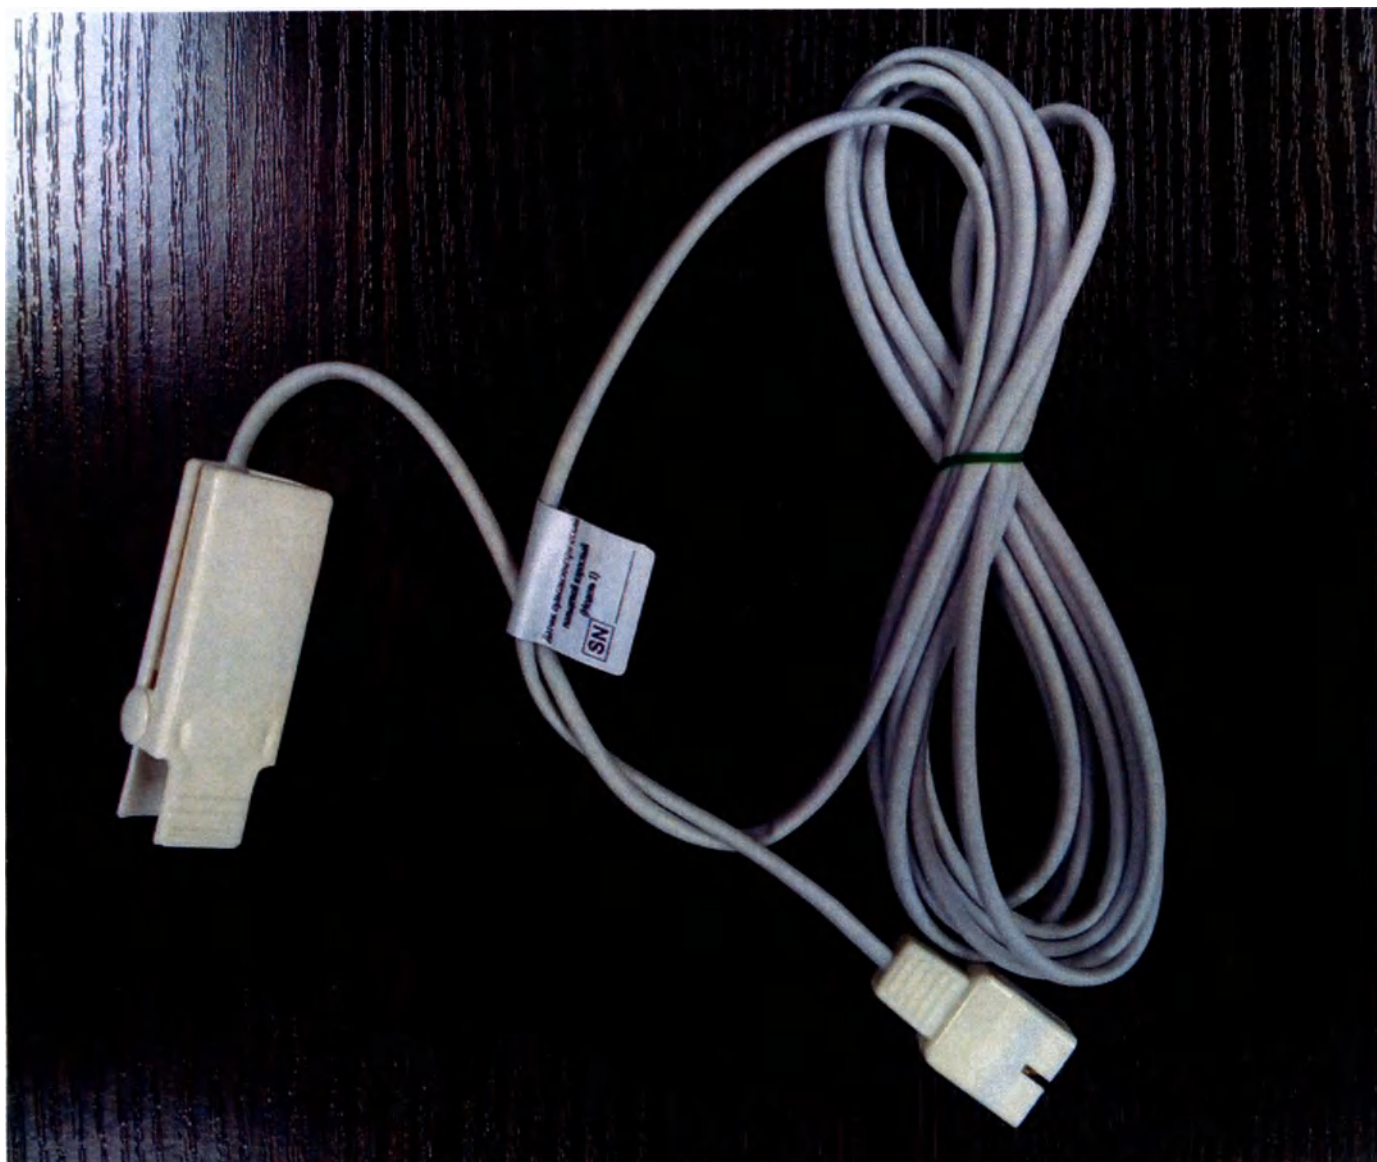

Датчик пульсоксиметрический пальцевый взрослый (Модель 1) и его маркировка

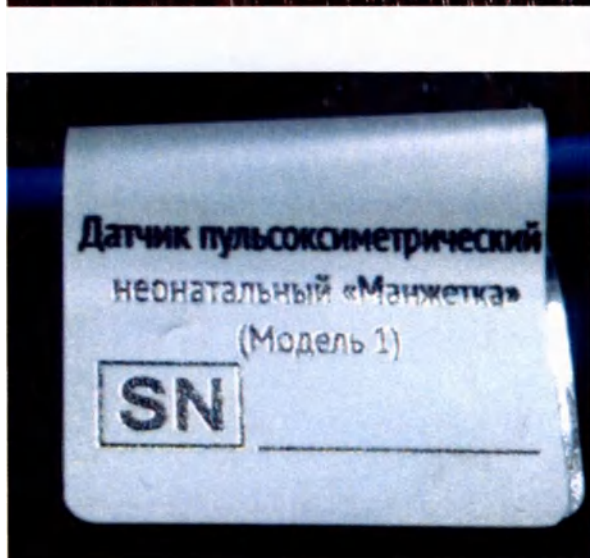

Датчик пульсоксиметрический неонатальный «Манжетка» (Модель 1) и его маркировка

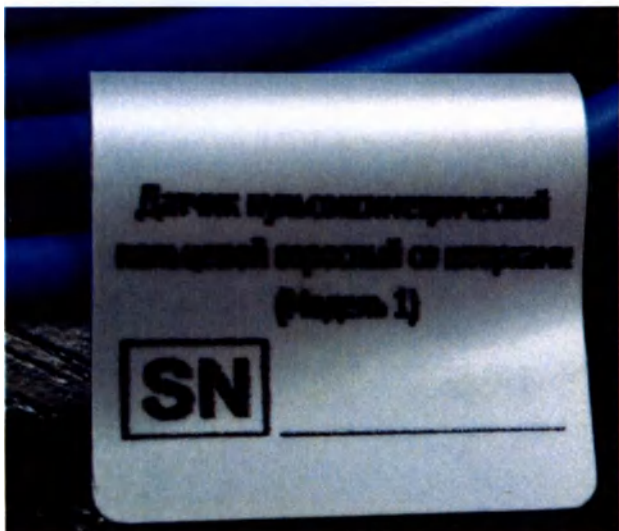

Датчик пульсоксиметрический пальцевый взрослый со шторками (Модель 1) и его маркировка



Чехол



Комплект крепления в салоне автомобиля в составе: скоба-держатель (1 шт.), саморез (4 шт.)



Упаковка изделия и ее маркировка

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 12

цифрами

(дедлант)
прописью

) листов

генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"
Хардина С.М.

подпись

