




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»


Горская О.А.



Фотографические изображения


«Система стента дренажного Exprel»

Производитель: «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США.
Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA


Система стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см в составе:

- стент нефроуретральный Expel – 1 шт;
- колпачок типа «Люэр» с заглушкой – 1 шт;
- гибкая поддерживающая катюля – 1 шт.;
- металлическая поддерживающая катюля – 1 шт.;
- выпрямитель типа «пигтэйл» – 1 шт;
- стержень для катюли – 1 шт;

Фотографическое изображение общего вида:

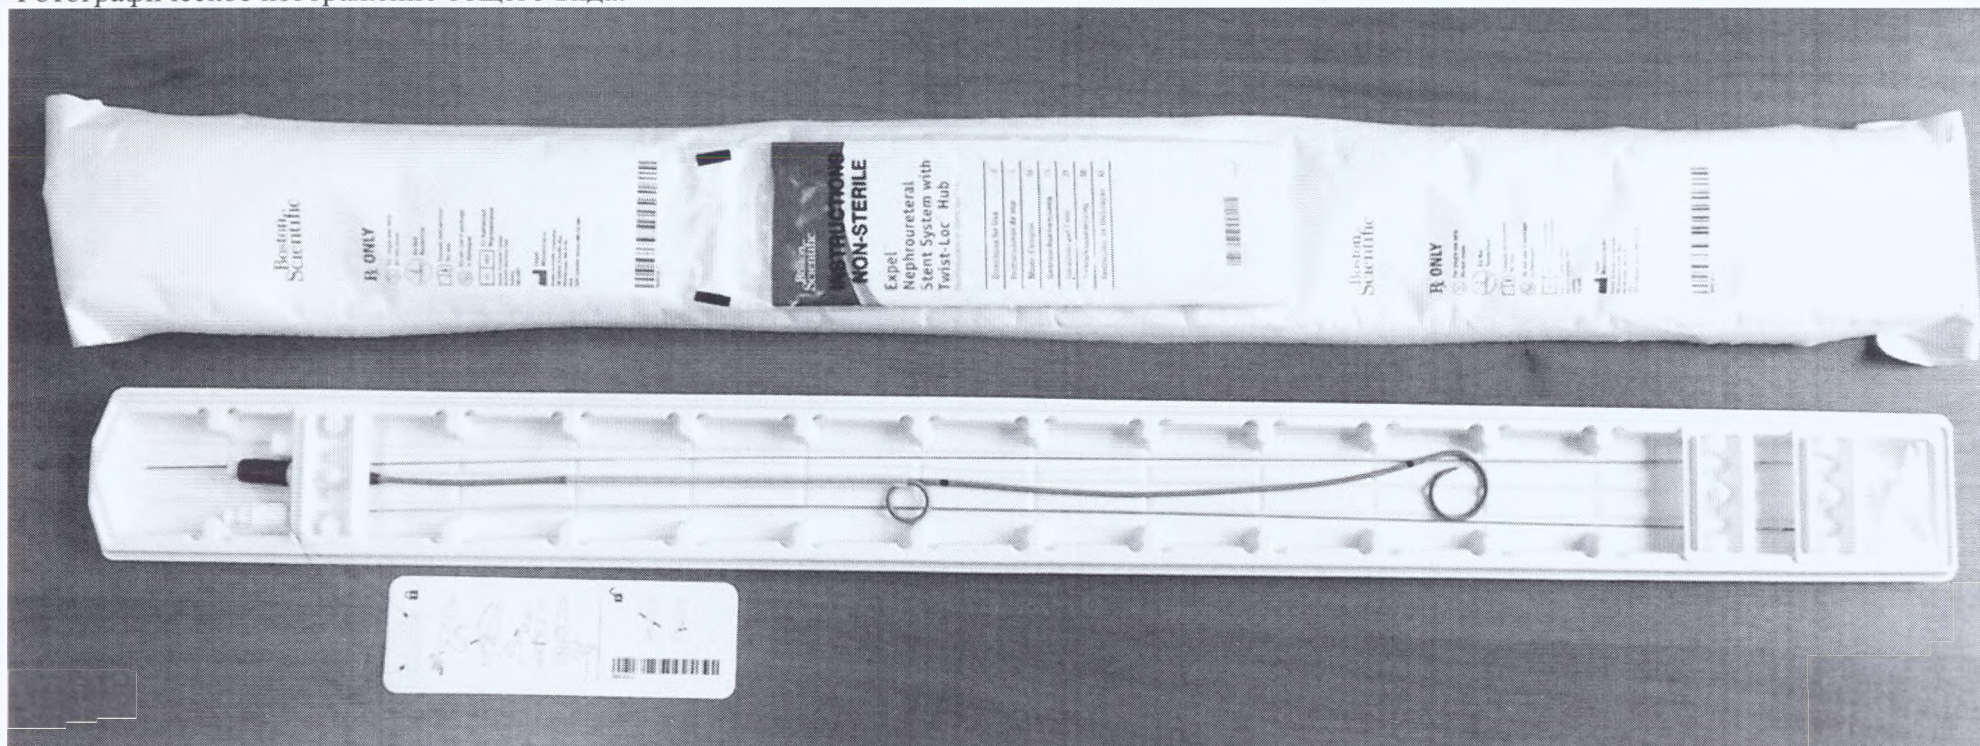

Система стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см
Общий вид маркировки изделия на лицевой и оборотной стороне:

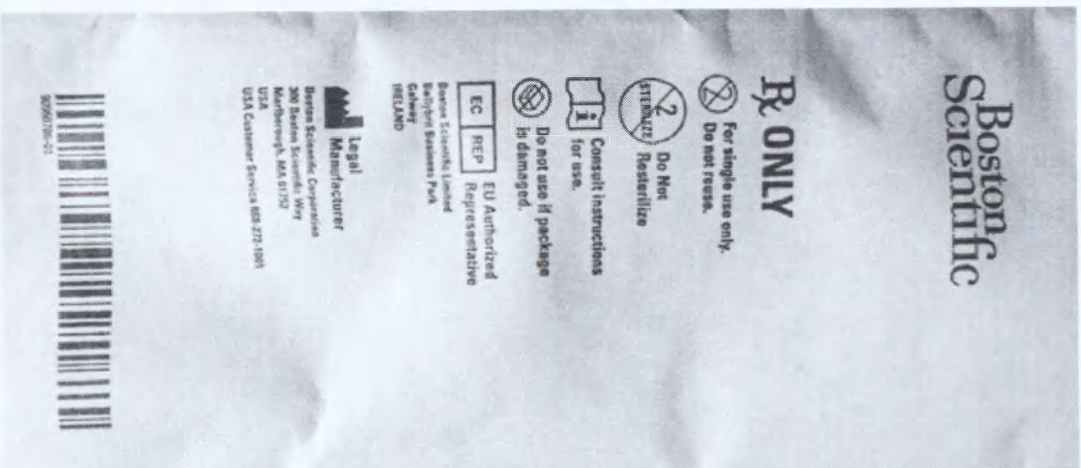

Система стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см
Этикетка производителя:

Boston Scientific

Exrel™ Nephroureteral Stent System with Twist-Loc™ Hub

NEPHROURETERAL STENT

8.3F x 22cm

Contents

(1) Exrel™ Nephroureteral Stent

(1) Luer Cap with Serpim

(1) Metal Softening Catheter

(1) Flexible Softening Catheter

(1) Pigtail Straightener

(1) Cathode Core

STERIL

REF

08714729860921

H7493935108220

Boston Scientific

Exrel™ Nephroureteral Stent System with Twist-Loc™ Hub

NEPHROURETERAL STENT

8.3F x 22cm

Contents

(1) Exrel™ Nephroureteral Stent

(1) Luer Cap with Serpim

(1) Metal Softening Catheter

(1) Flexible Softening Catheter

(1) Pigtail Straightener

(1) Cathode Core

STERIL

REF

08714729860921

H7493935108220

Дополнительные этикетки на русском языке:

Система стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см

РЭН 20XXXXXX от XX.XX.20XX

Москва представительство компании **Бостон Сайентифик**, 125064, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72к2


Email: info@bosc.com

Phone: +7 (495) 780-0000


Система стента дренажного Exrel

Содержимое (1)	Инструкция по использованию
Система нефроуретрального Exrel	Система нефроуретрального Exrel
Лuer Cap with Serpim	Катетер типа «Лuer» с заглушкой
Metal Softening Catheter	Металлическая подерживающая канюля
Flexible Softening Catheter	Гибкая подерживающая канюля
Pigtail Straightener	Выпрямитель типа «Пигтейл»
Cathode Core	Сверление для катетера
MP - cementation	MP - цементация
Recommended wire diameter (0.035" (0.89mm))	Рекомендуемый диаметр проволоки (0.035" (0.89мм))
Observe the instructions for use	Обратитесь к инструкции по использованию
Do not use if the catheter is damaged	Не используйте, если катетер поврежден
Temperature range: from +17°C to +27°C	Температурный диапазон: от +17°C до +27°C
Antiseptic	Антисептик
Non-toxic	Нетоксично
STERIL	Стерилизованный
REF	№ по катетеру
08714729860921	Стерилизованный с использованием этиленоксида
H7493935108220	Использовать до
18774743	Только для однократного применения
18774743	Не использовать повторно
18774743	Не стерилизовать повторно
18774743	Исключительно для одноразового использования

- стент нефроуретральный Exrel, входящий в состав системы стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см

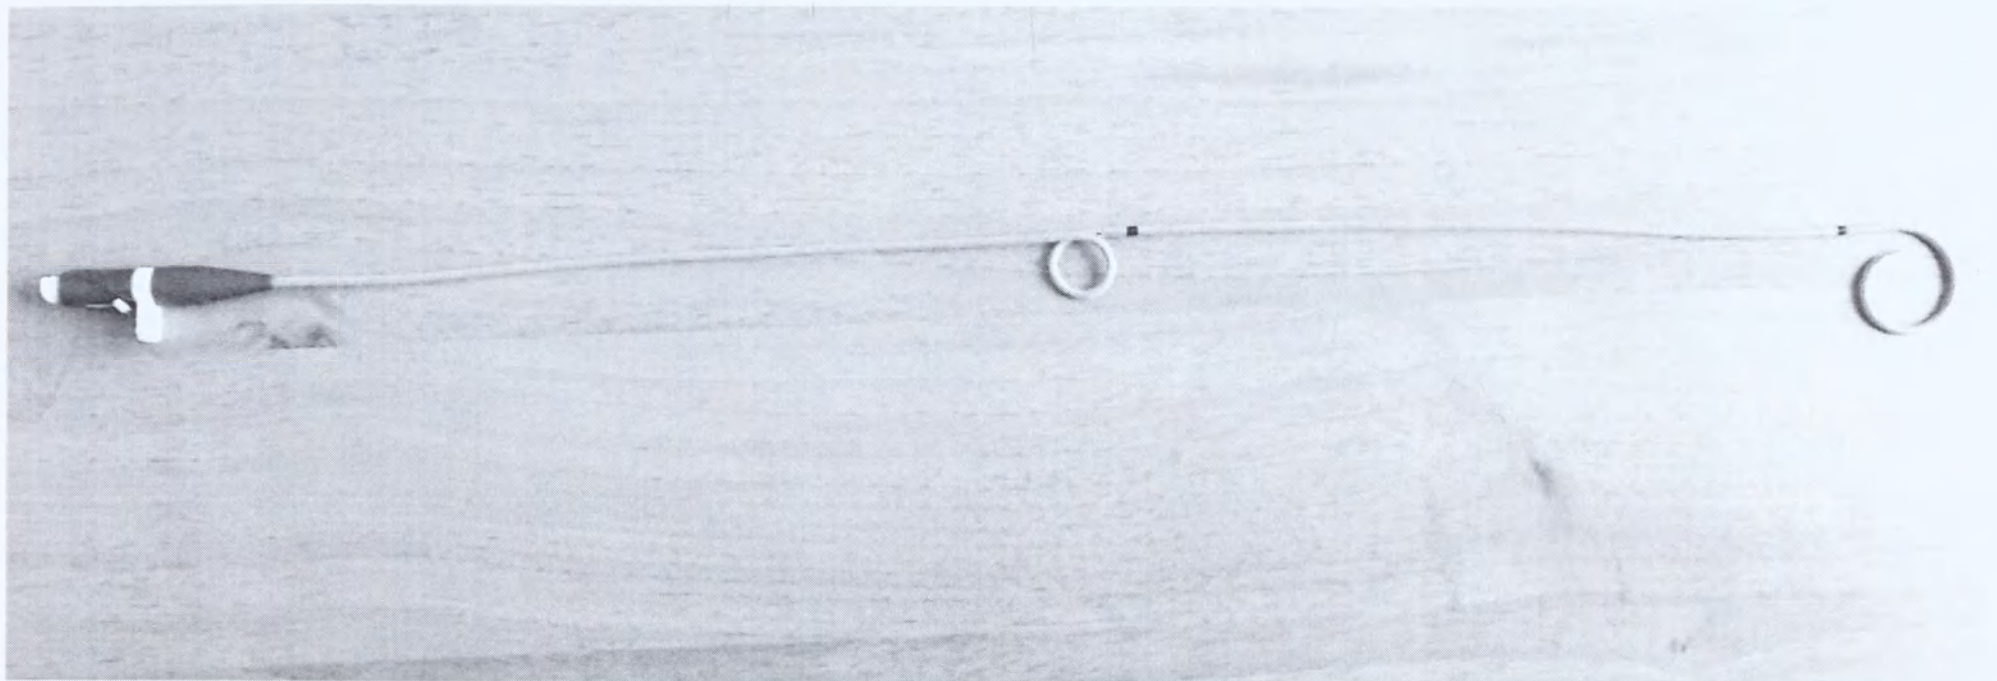


- колпачок типа «Люэр» с заглушкой, входящий в состав системы стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см

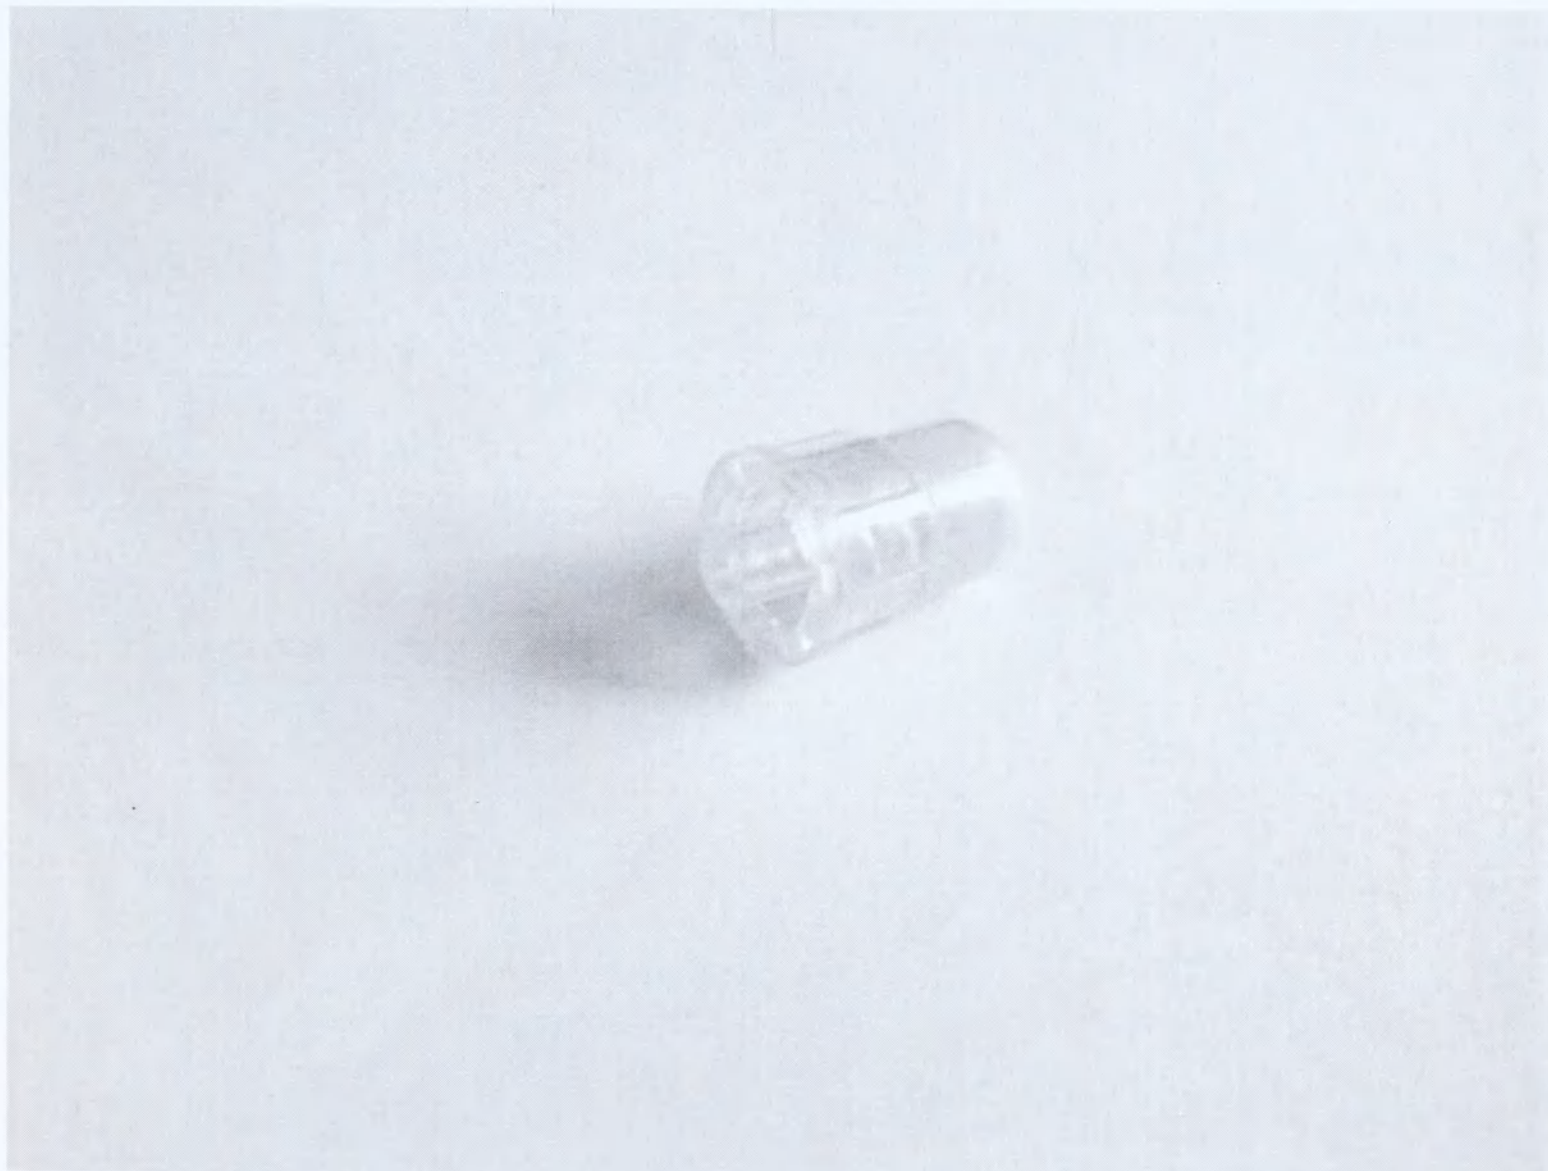

- гибкая поддерживающая канюля, входящая в состав системы стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см




- металлическая поддерживающая канюля, входящая в состав системы стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см

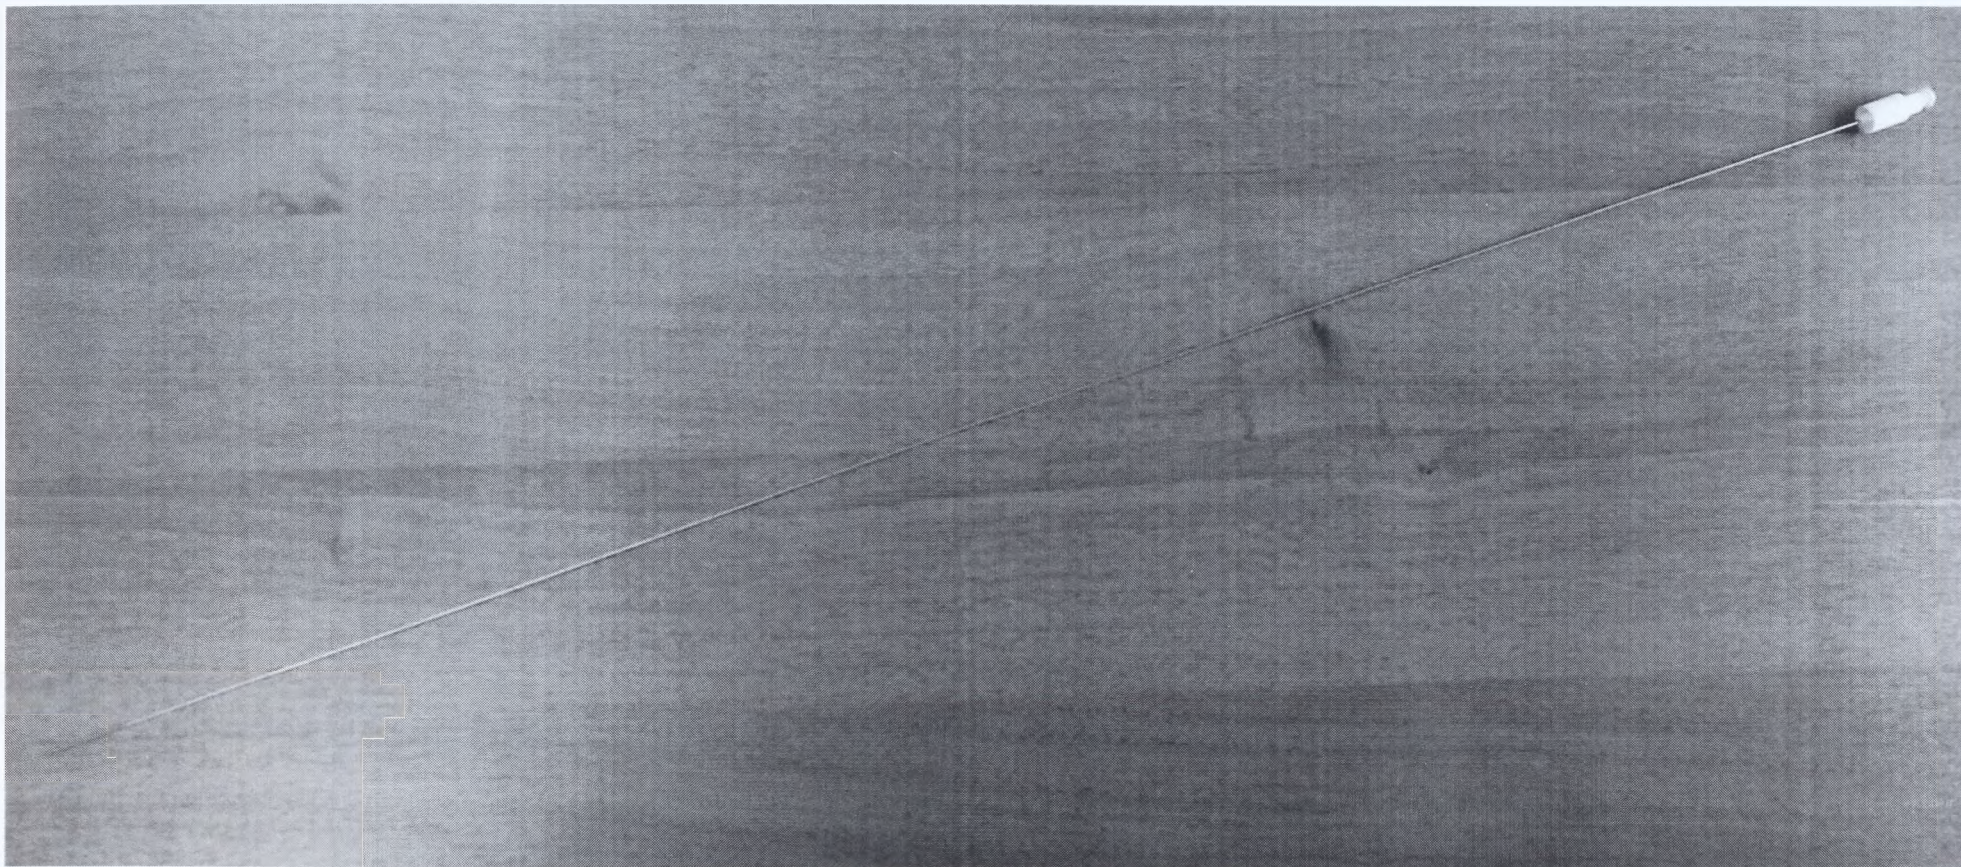

- выпрямитель типа «пигтэйл», входящий в состав системы стента нефроуретрального Expe1, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см




- стержень для канюли, входящий в состав системы стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 8,3F(2,7мм), длиной 22 см

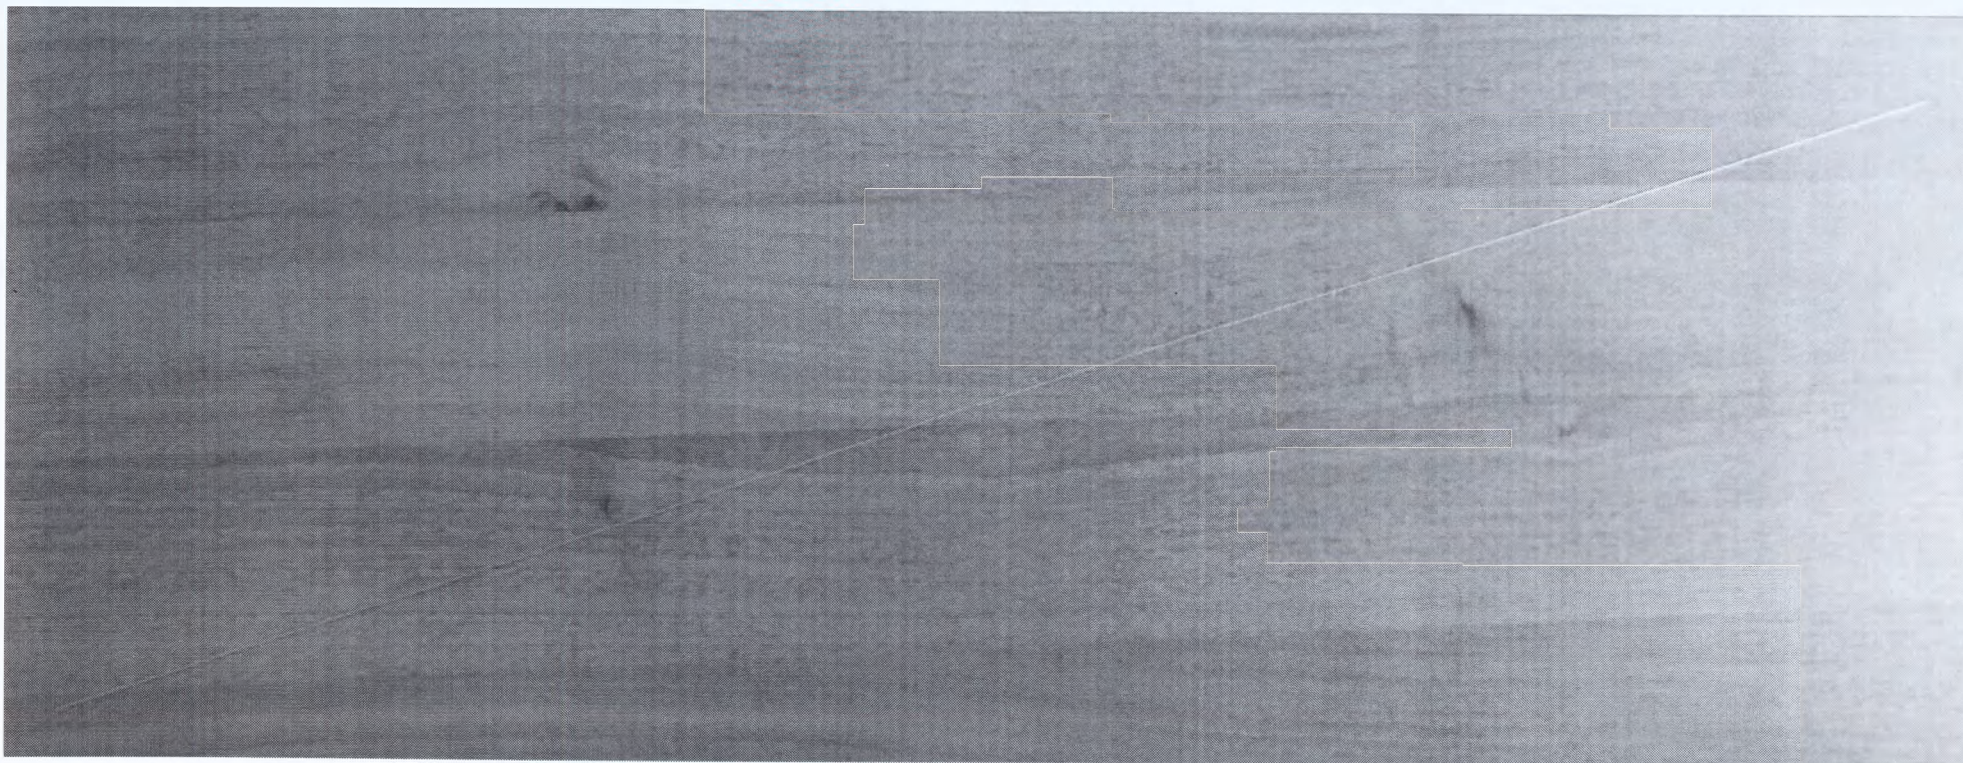

Система стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см, в составе:

- стент нефроуретральный Exrel – 1 шт;
- колпачок типа «Люэр» с заглушкой – 1 шт;
- гибкая поддерживающая канюля – 1 шт.;
- металлическая поддерживающая канюля – 1 шт.;
- выпрямитель типа «пигтэйл» – 1 шт;

Фотографическое изображение общего вида

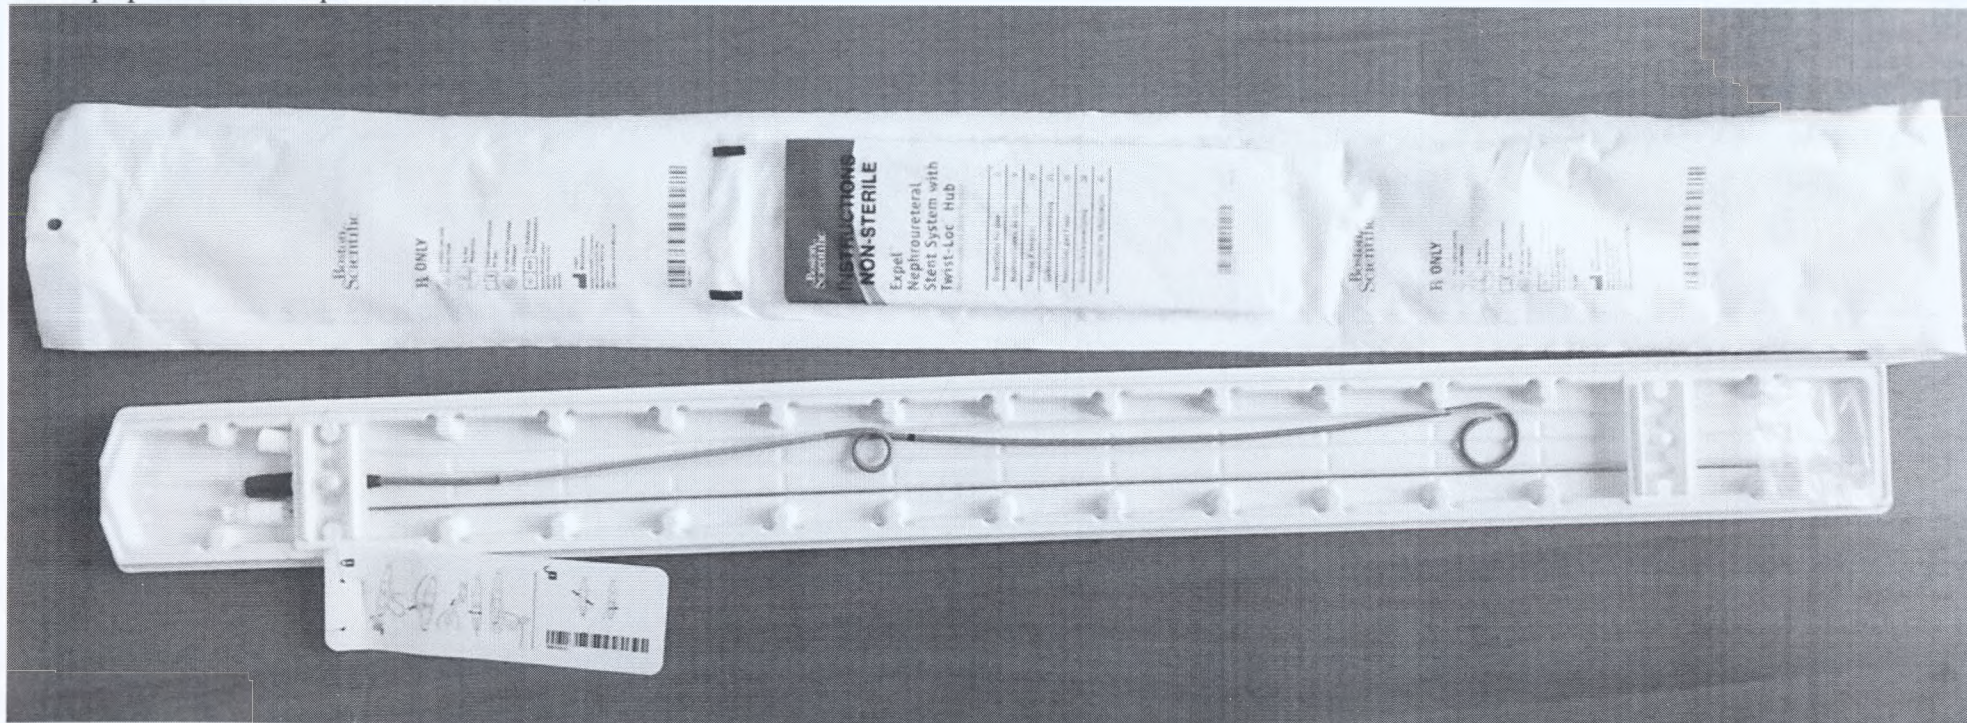

[illegible]

**Boston
Scientific**

R_x ONLY

 For single use only.
Do not reuse.

 Do Not
STERILIZE
Resterilize

 Consult instructions
for use.

 Do not use if package
is damaged.


EC	REP
----	-----

 EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballyphit Business Park
Galway
IRELAND


 Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001



88860716-01


- стент нефроуретральный Exrel, входящий в состав системы стента нефроуретрального Exrel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см

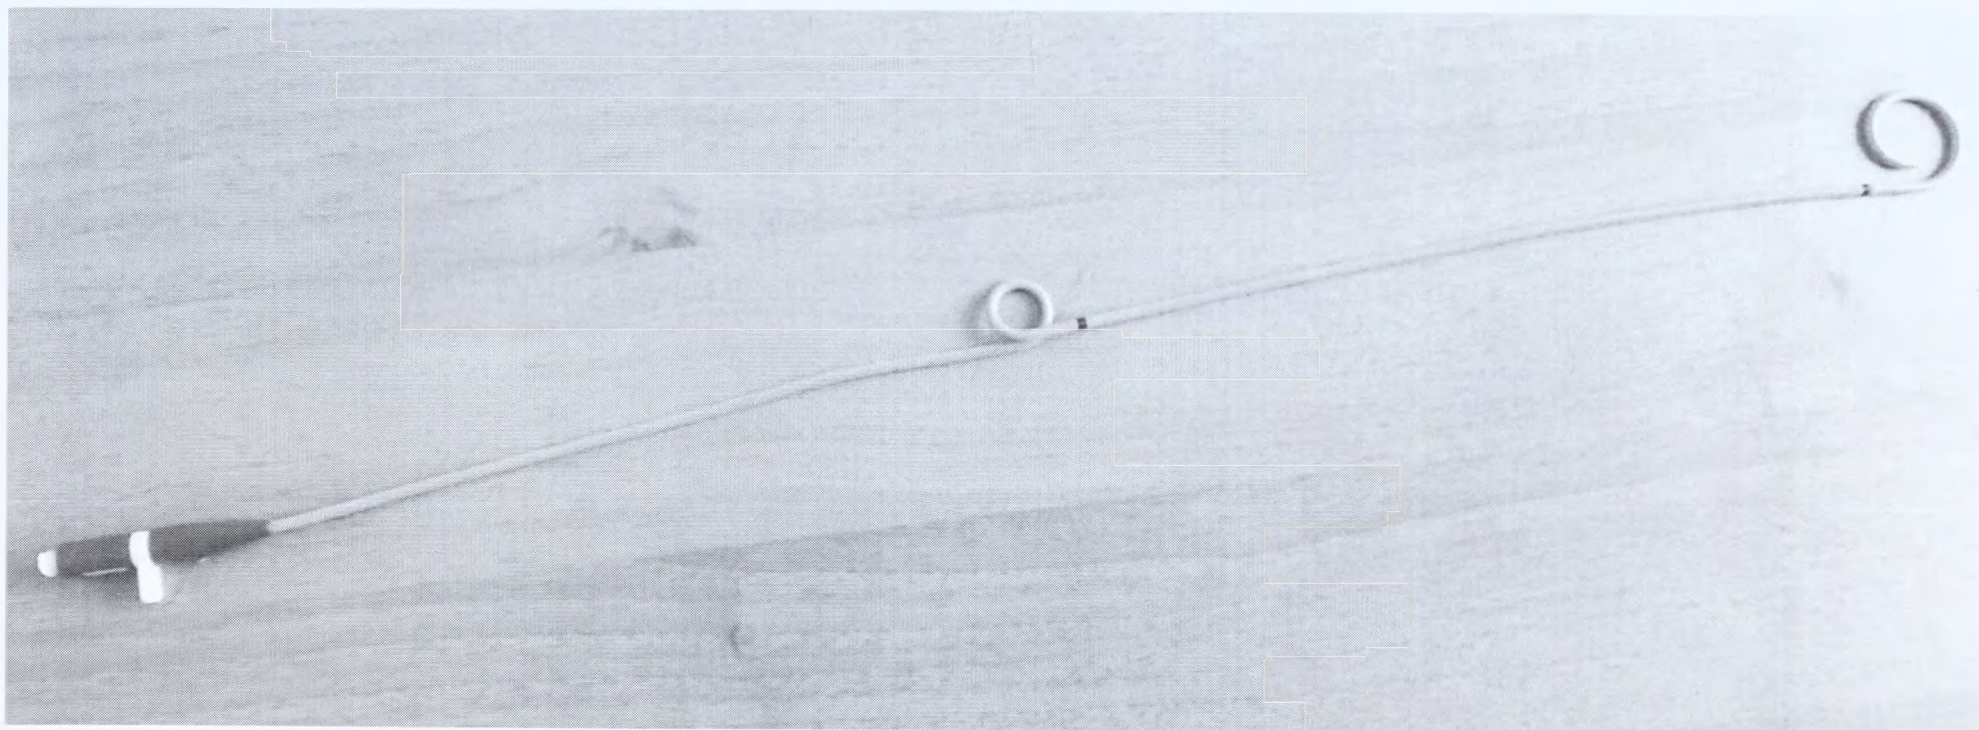


- колпачок типа «Люэр» с заглушкой, входящий в состав системы стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см




- гибкая поддерживающая канюля, входящая в состав системы стента нефроуретрального Expel, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см

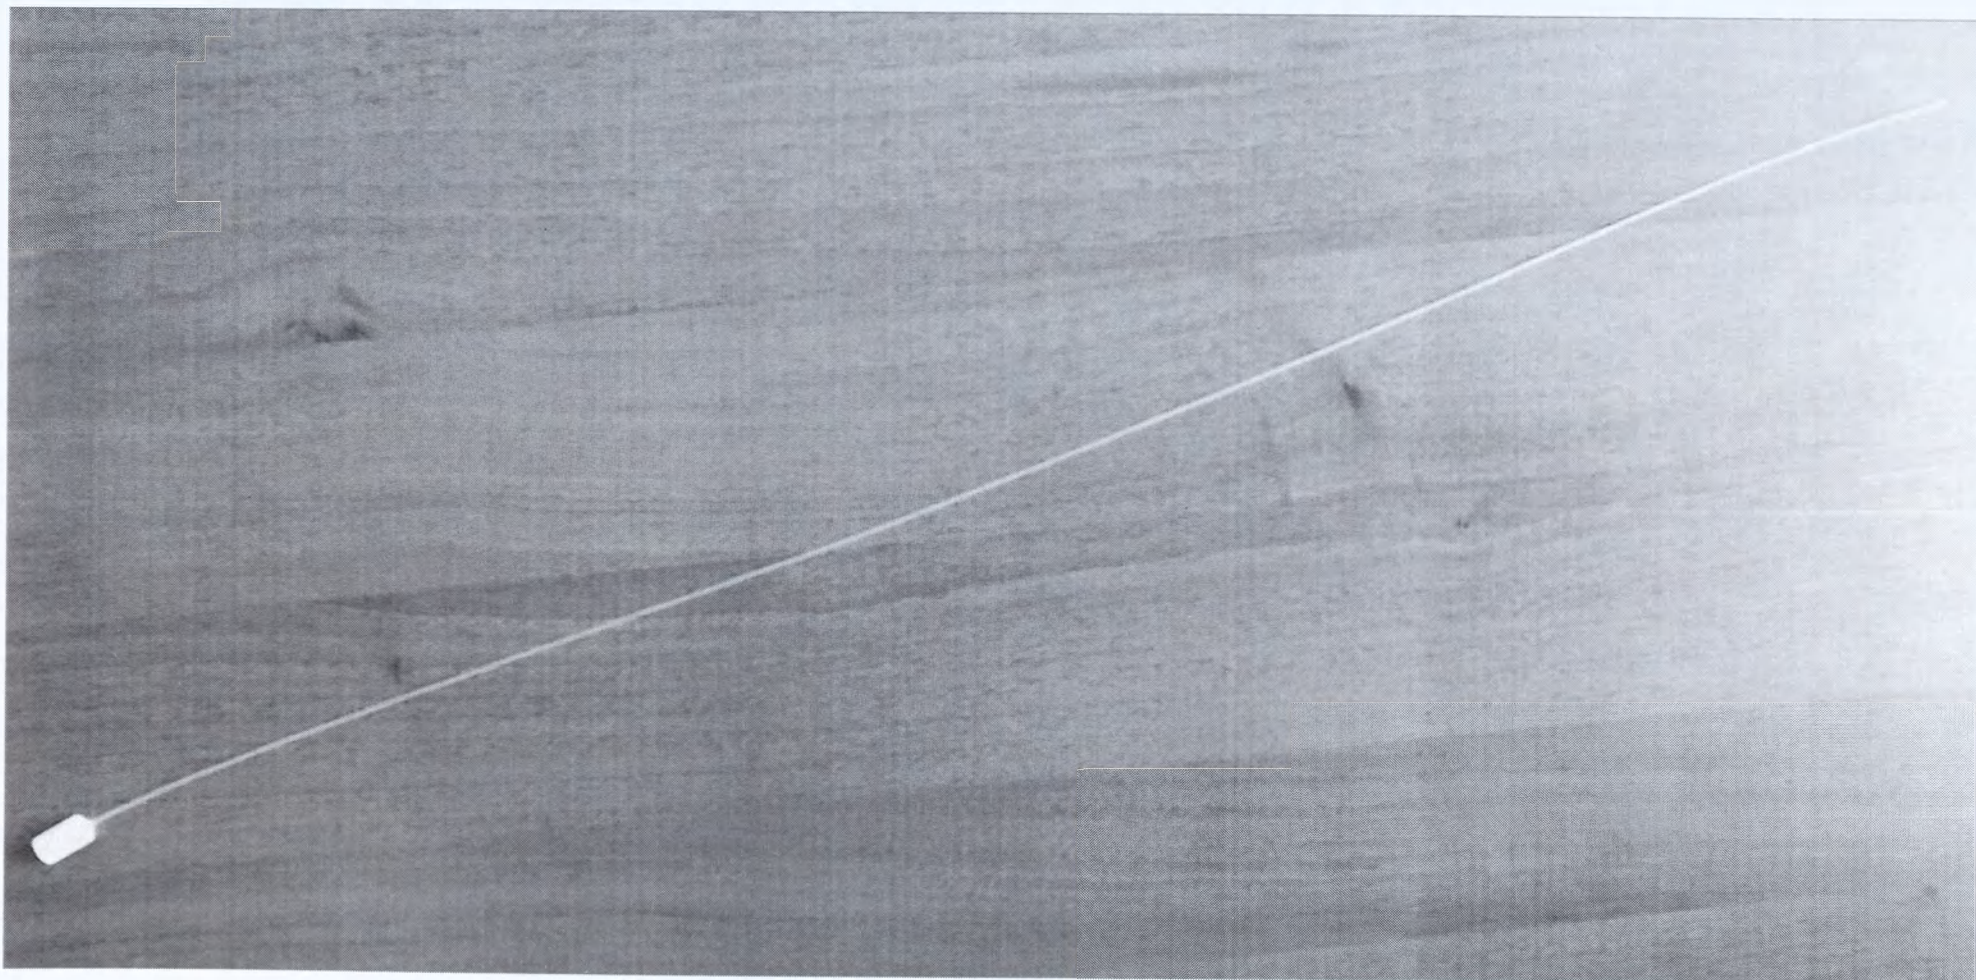

- металлическая поддерживающая канюля, входящая в состав системы стента нефроуретрального Expe1, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см

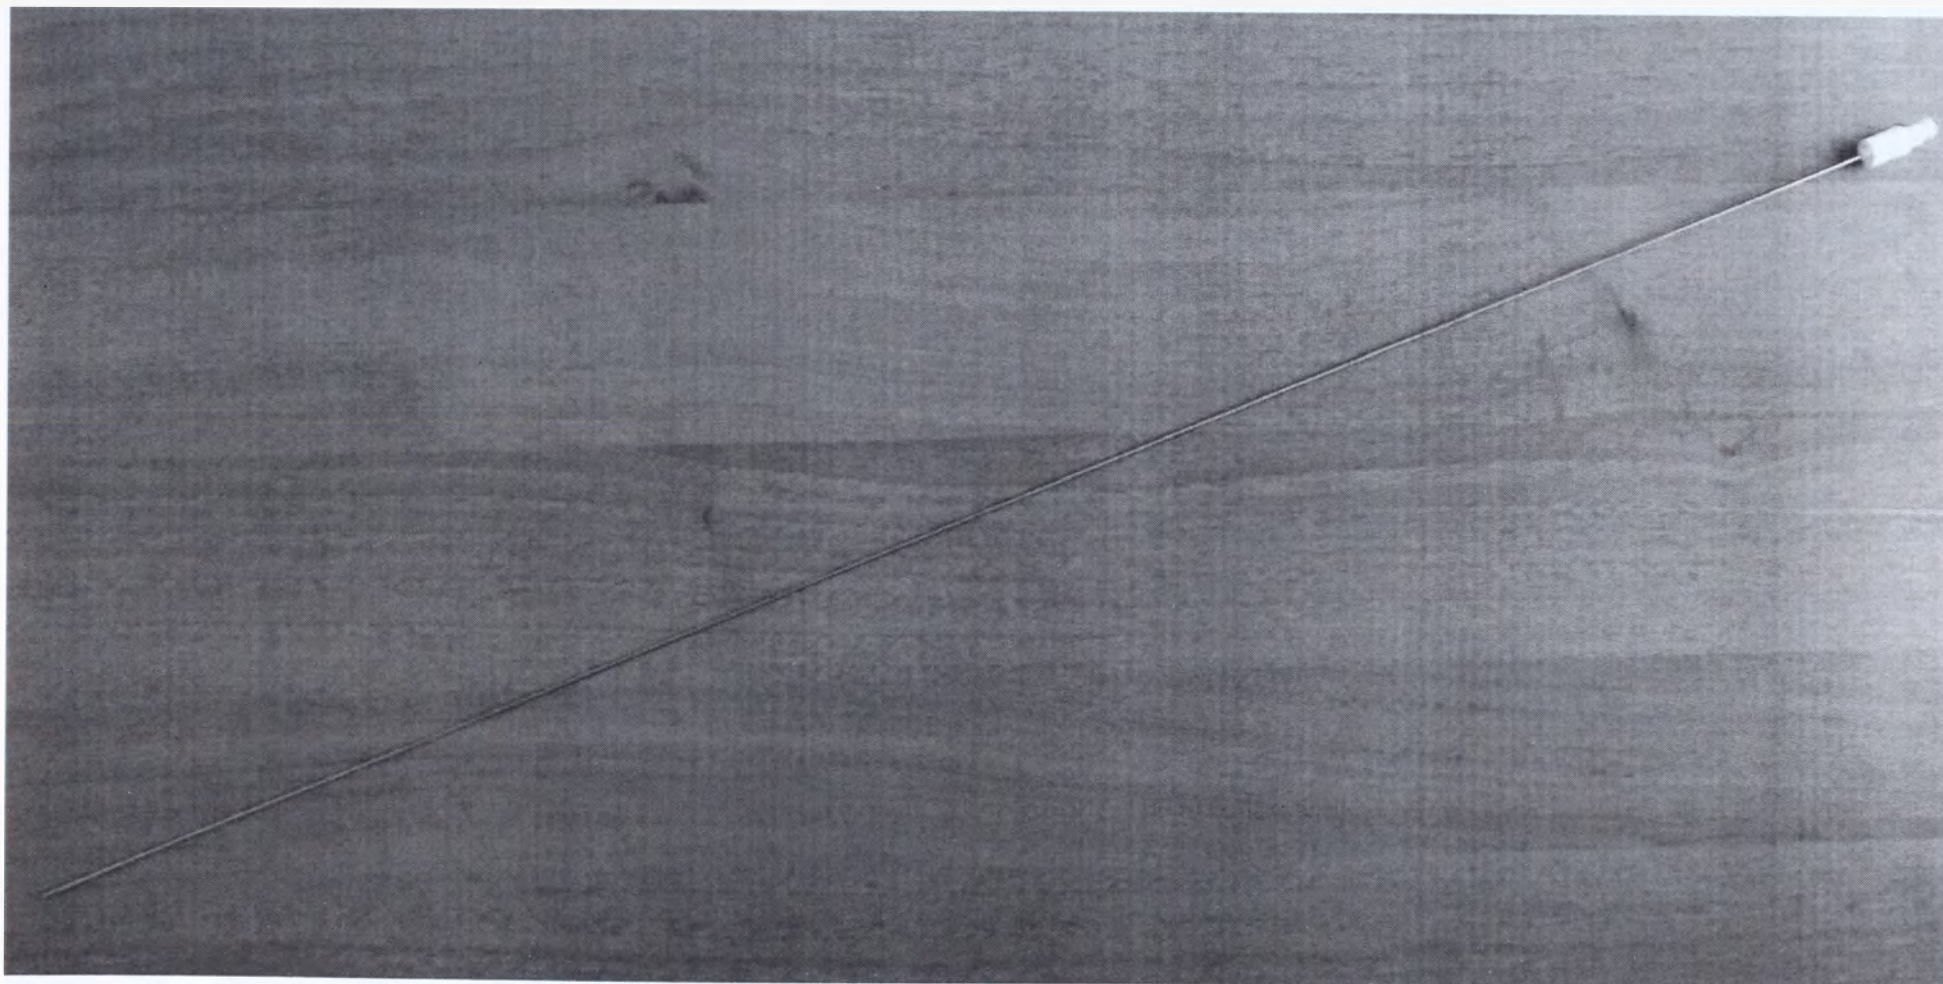


- выпрямитель типа «пигтэйл», входящий в состав системы стента нефроуретрального Expe1, с замком типа "Twist-Loc", диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 26 см

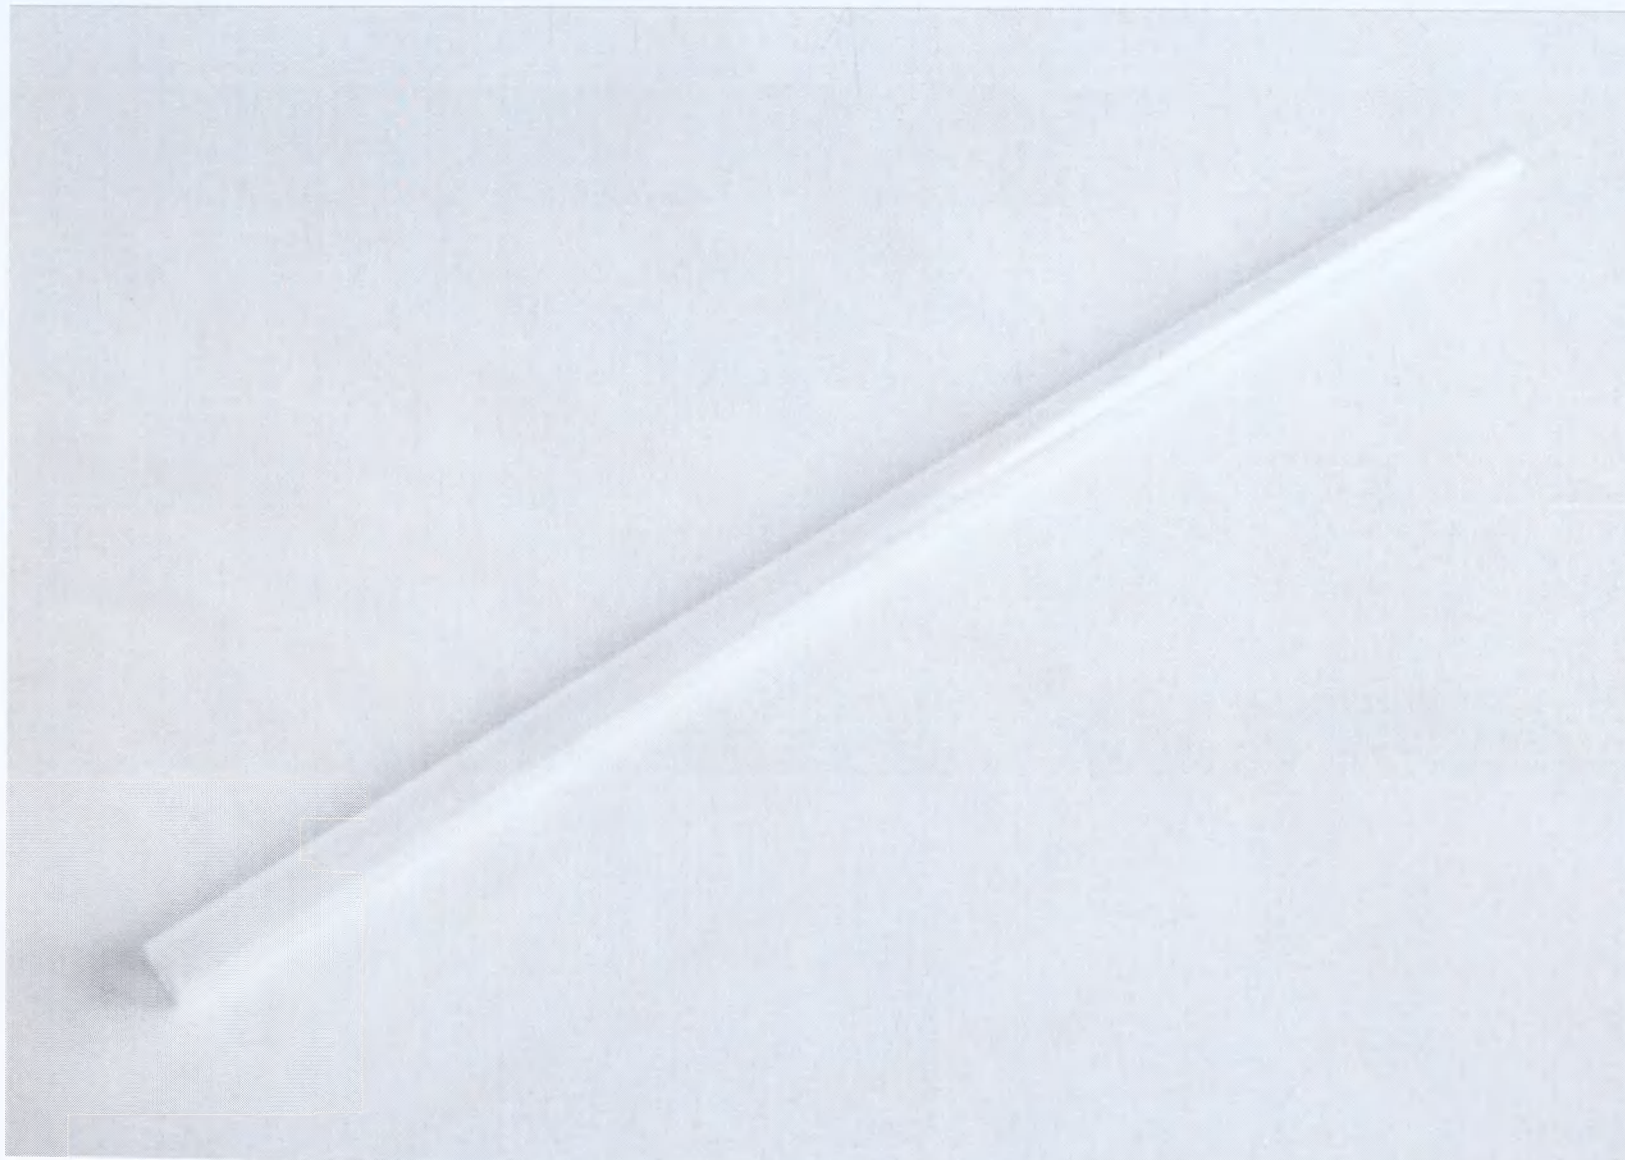


Система стента уретрального Expel, диаметром 6,3 F (2,1 мм), длиной 28 см, в составе:

- стент уретральный Expel – 1 шт;
- стабилизатор – 1 шт;

Фотографическое изображение общего вида

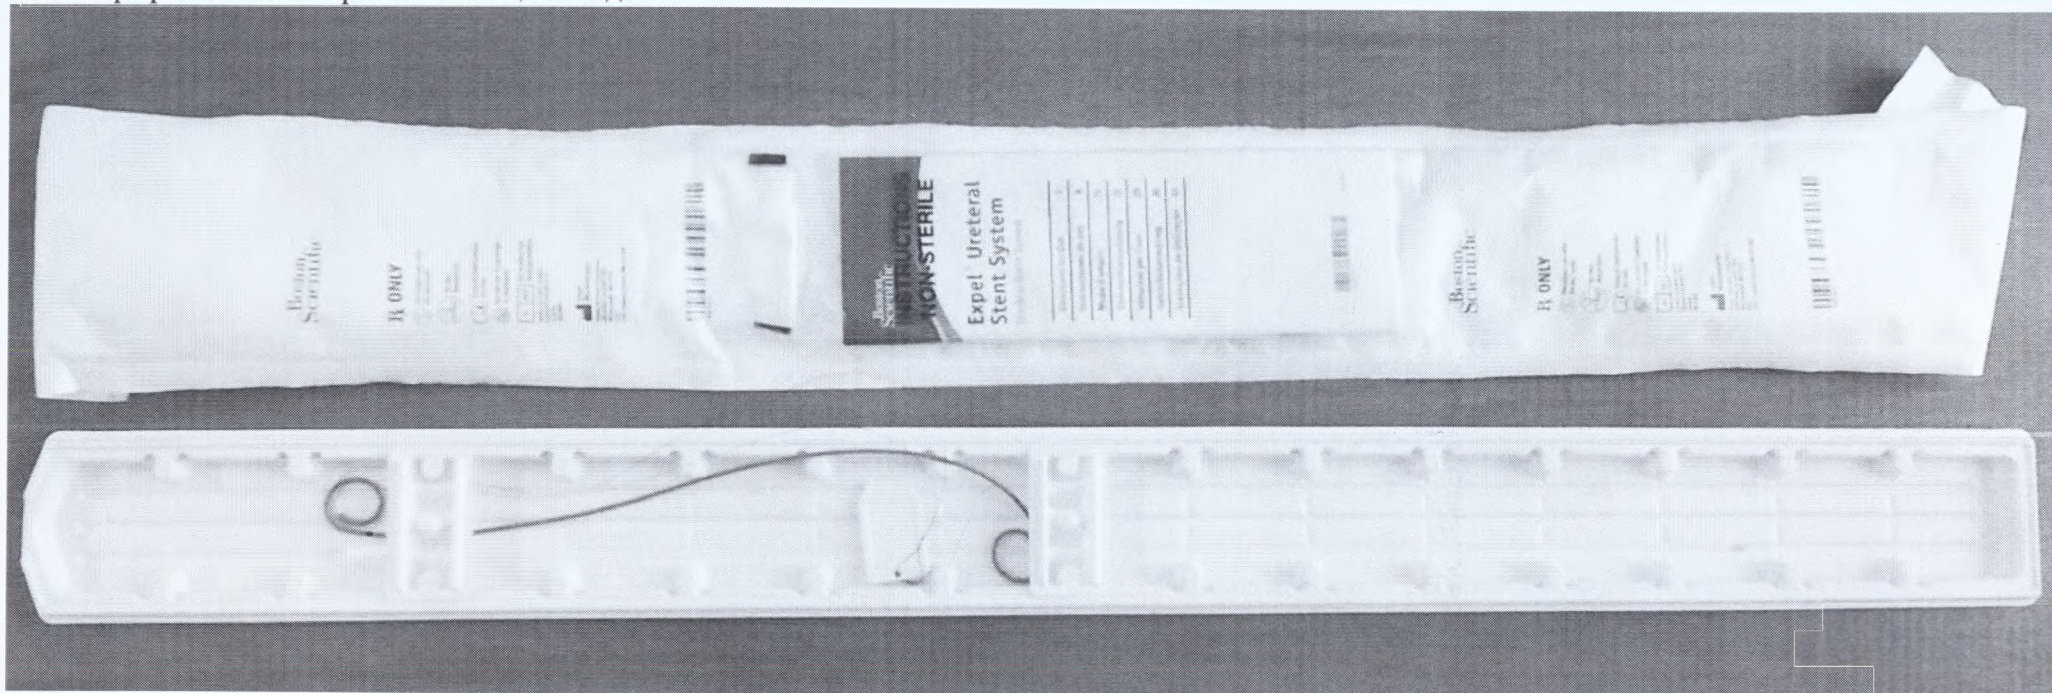

Система стента уретрального Exrel, диаметром 6,3 F (2,1 мм), длиной 28 см
Общий вид маркировки изделия на лицевой и оборотной стороне:

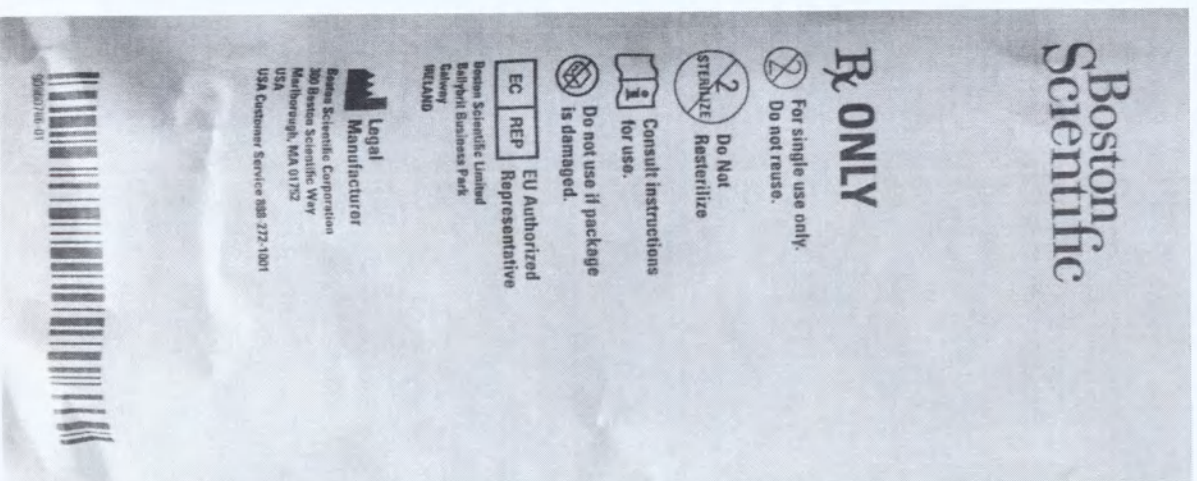

Система стента уретрального Expel, диаметром 6,3 F (2,1 мм), длиной 28 см.

Этикетка производителя:

Boston Scientific

6.3F x 28cm

Expel™ Ureteral Stent System

URETERAL STENT

Ureteral Stent System
Sistema de stent ureteral, Système de stent urétéral, Ureterstentsystem, Sistema di stent ureterale, ureterstentsysteem, 尿管用ステント・システム, Ureterstentsystem, Συστήμα ουρητήριας ενδοπρόθεσης (stent), Sistema de Stent Ureteral, Ureterstentsystem, Urétersztentrendszer, System uretrálního stentu, System stentu moczowodowego, Ureterstentsystem, Ureteral Stent System

Contents (1)

Magnetic Resonance Conditional (1) Expel™ Ureteral Stent

28cm

6.3F (2.1mm)

0.035in (0.89mm) Recommended Guidewire

(1) Stabilizer

GTIN 08714729861072

REF Catalog No. H7493936106280

Boston Scientific Expel™ Ureteral Stent System
6.3F x 28cm
GTIN 08714729861072
REF H7493936106280
LOT 19555567

Boston Scientific Expel™ Ureteral Stent System
6.3F x 28cm
GTIN 08714729861072
REF H7493936106280
LOT 19555567

Boston Scientific Expel™ Ureteral Stent System
6.3F x 28cm
GTIN 08714729861072
REF H7493936106280
LOT 19555567

CE 0086

2019-08-04

LOT 19555567

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propank
El Coyol, Alajuela COSTA RICA

Дополнительные этикетки на русском языке:

Система стента уретрального Expel, диаметром 6.3 F (2.1 мм), длиной 28 см

РУ № P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Московское представительство компании Бостон Сайентифик:
125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72к2
E-mail: Margarita.Boyarkina@bsci.com
Info-russia@bsci.com

Система стента дренажного Expel


Содержимое (1)	
Expel Ureteral Stent	Стент уретральный Expel
Stabilizer	Стабилизатор
	МР-совместимый
	Рекомендуемый проводник 0.035" (0.89мм)
	Обратитесь к инструкции по использованию
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Температура хранения: от +17°C до +27°C
	Апирогенно
	Нетоксично
	Штриховой код товара
	№ по каталогу
	Стерилизовано с использованием этиленоксида
	Использовать до
	Только для однократного применения
	Не использовать повторно
	Не стерилизовать повторно
	Исключительно для практикующих специалистов

Это изделие может быть защищено одним или несколькими патентами. Информацию о патентах см. на веб-сайте <http://www.bostonscientific.com/patents>


Ответственный производитель	Уполномоченный представитель в ЕС
«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 300 Бостон Сайентифик Уэй Мэдьюор, Массачусетс 01752, США Служба поддержки клиентов в США 888-727-1001	«Бостон Сайентифик Лимитед» Бэллбрик Бизнес Парк Голуэй, Ирландия

Сделано в Коста-Рике
2546 Ферст Стрит, Пропарк
Эль Койоль, Алахуэла Коста-Рика

- стент уретральный Exrel, входящий в состав системы стента уретрального Exrel, диаметром 6,3 F (2,1 мм), длиной 28 см

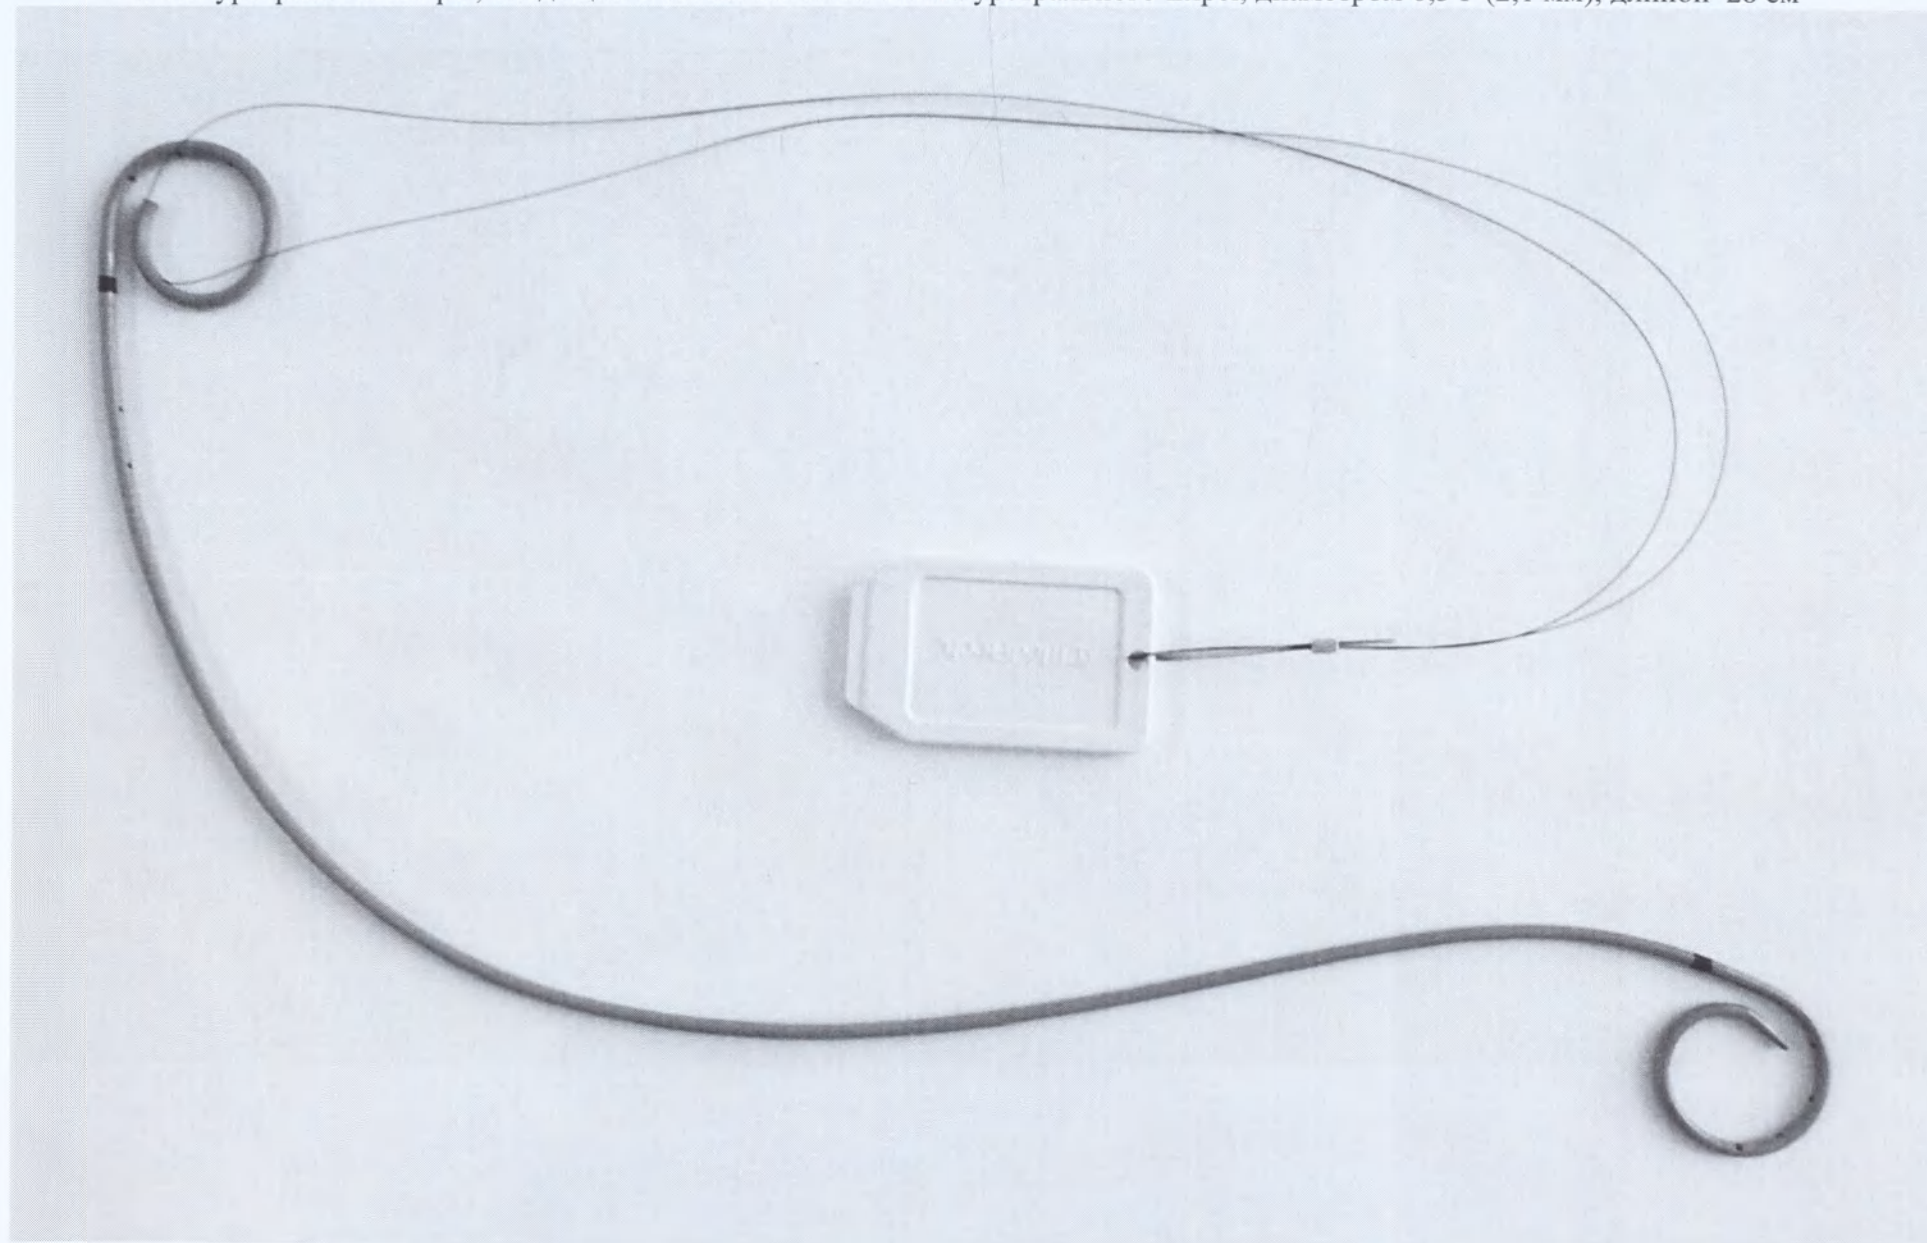

- стабилизатор, входящий в состав системы стента уретрального Exrel, диаметром 6,3 F (2,1 мм), длиной 28 см

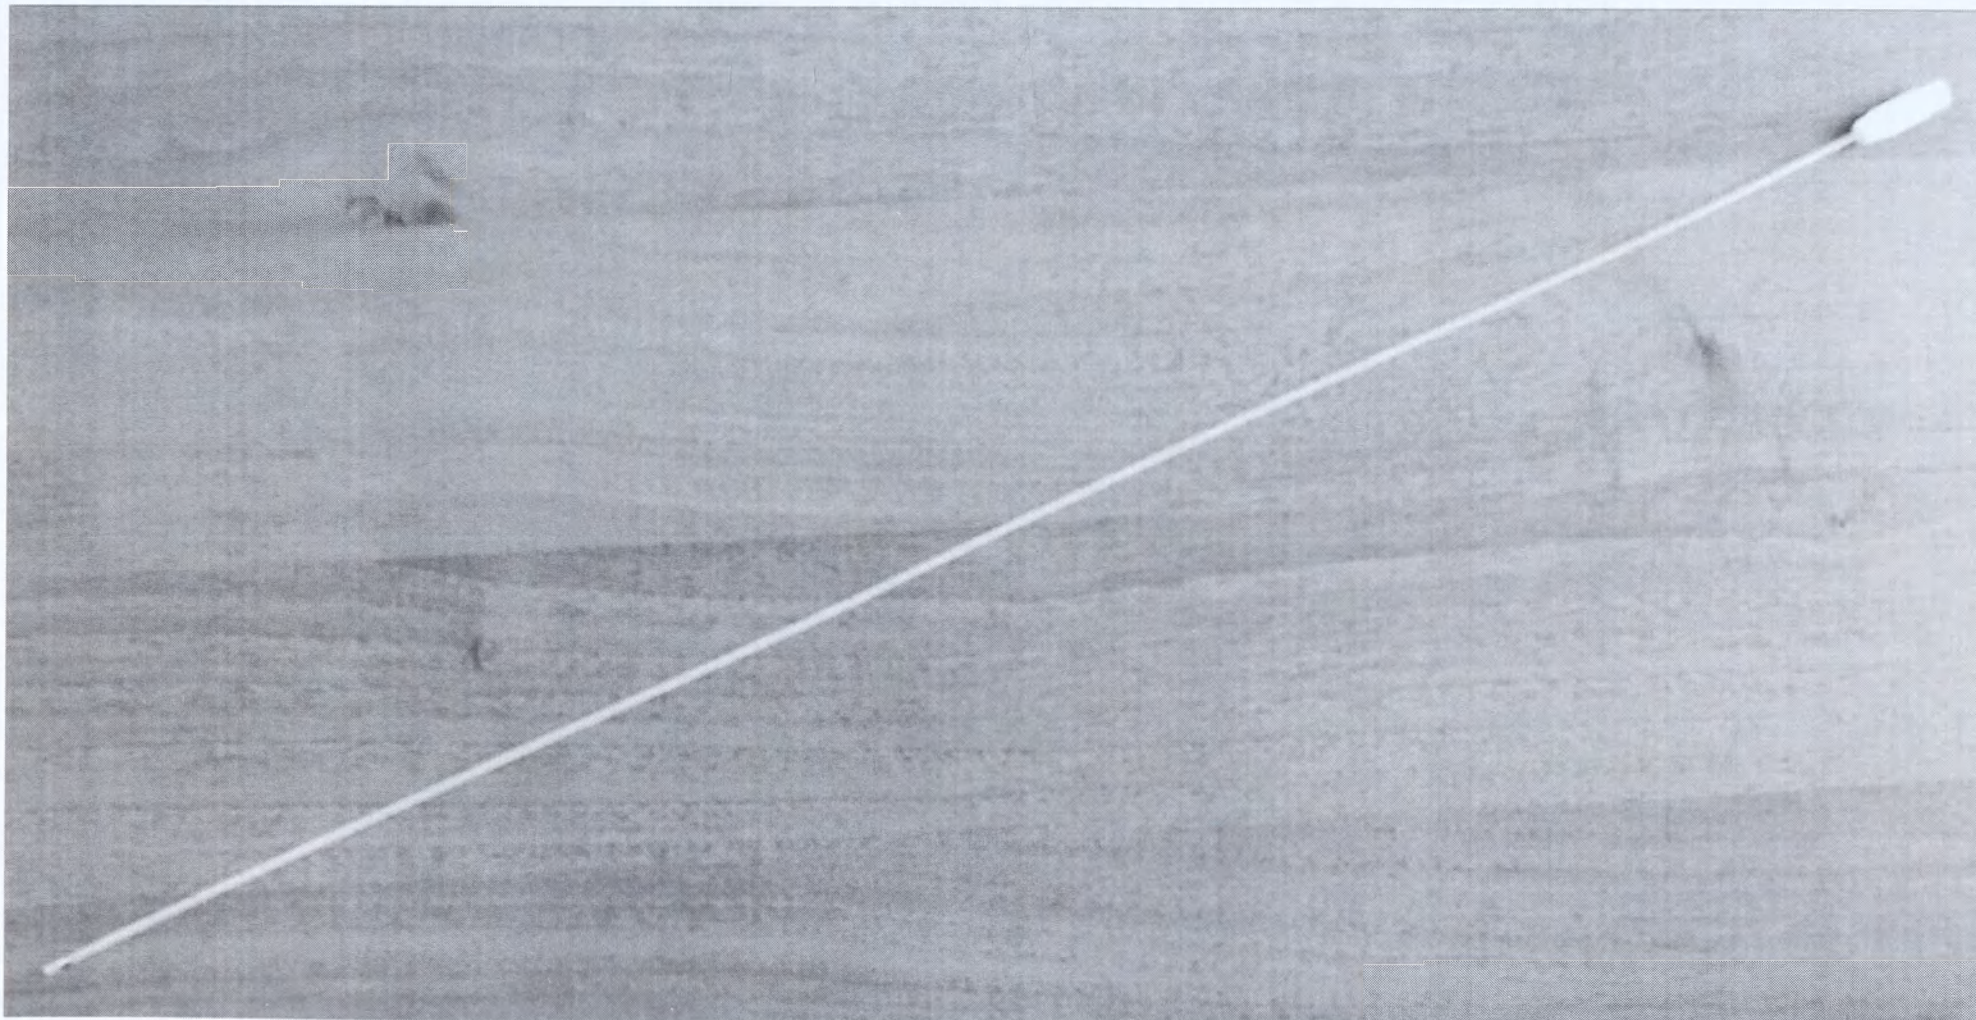



Система стента уретрального Expel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см, в составе:

- стент уретральный Expel – 1 шт;
- стабилизатор – 1 шт;
- выпрямитель типа «пигтэйл» – 1 шт;
- гибкая поддерживающая канюля – 1 шт.;

Фотографическое изображение общего вида



Система стента уретрального Expel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см
Общий вид маркировки изделия на лицевой и оборотной стороне:

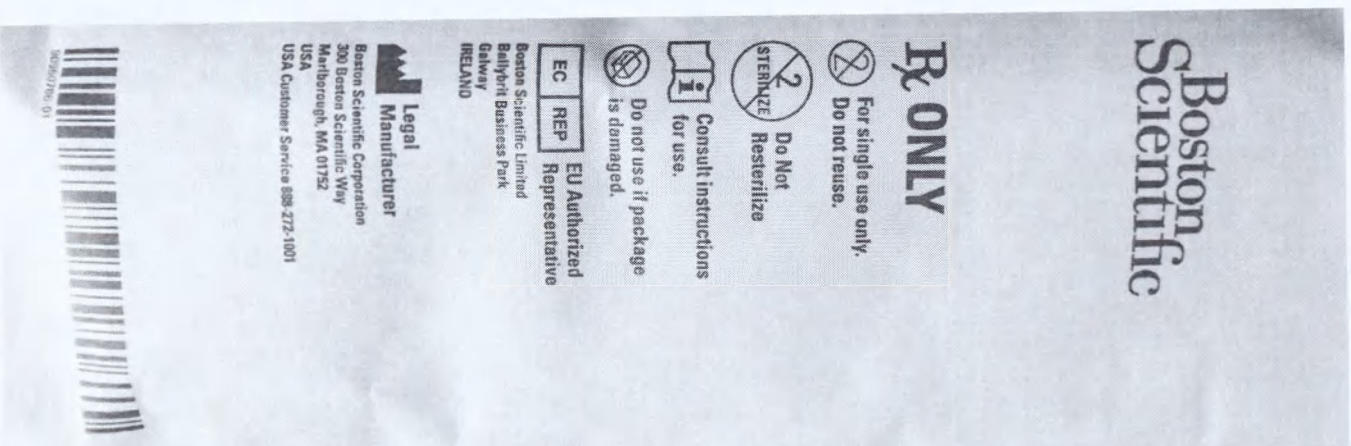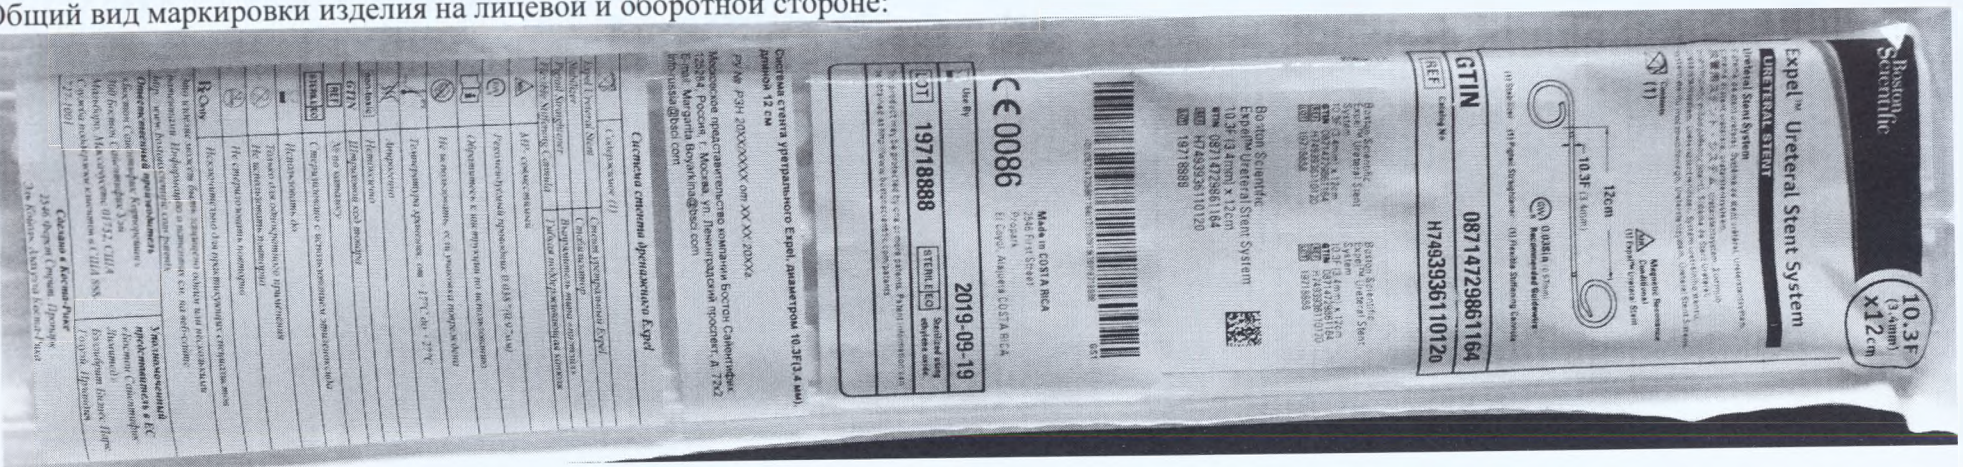

Система стента уретрального Expel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см
Этикетка производителя:

Boston Scientific

10.3F
(3.4mm)
x12cm

Expel™ Ureteral Stent System

URETERAL STENT

Ureteral Stent System

Sistema de stent ureteral, Système de stent urétéral, Ureterstentsystem, Sistema di stent ureterale, ureterstentsysteem, 尿管用ステント・システム, Ureterstentsystem, Ευατηρια ουρητηρική ενδοσκόπηση (stent), Sistema de Stent Ureteral, Ureterstentsystem, Ureterstentsystem, System uretrálního stentu, system stentu, moczwodowego, Ureterstentsystem, Ureteral Stent System




Contents
(1)



Magnetic Resonance
Conditional

(1) Expel™ Ureteral Stent

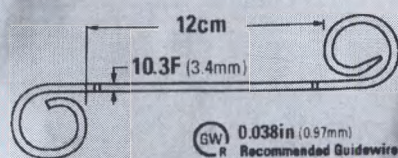

(1) Stabilizer (1) Pigtail Straightener (1) Flexible Stiffening Cannula

GTIN

08714729861164

REF

Catalog No

H7493936110120

Boston Scientific
Expel™ Ureteral Stent
System
10.3F (3.4mm) x 12cm
GTIN 08714729861164
REF H7493936110120
LOT 19718888

Boston Scientific
Expel™ Ureteral Stent
System
10.3F (3.4mm) x 12cm
GTIN 08714729861164
REF H7493936110120
LOT 19718888

Boston Scientific
Expel™ Ureteral Stent System
10.3F (3.4mm) x 12cm
GTIN 08714729861164
REF H7493936110120
LOT 19718888



(01108714729861164/17190919/1019718888 6S1

CE 0086

Made in COSTA RICA
2546 First Street
ProPark
El Coyoil, Alajuela COSTA RICA

Use By

2019-09-19

LOT

19718888

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Система стента уретрального Expel, диаметром 10.3F(3.4 мм),
длиной 12 см

ру № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Московское представительство компании Бостон Сайентифик
125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72к2
E-mail: Margarita.Boyarkina@bsci.com
Info-russia@bsci.com

Система стента дренажного Expel

Содержимое (1)	
Expel Ureteral Stent	Стент уретральный Expel
Stabilizer	Стабилизатор
Pigtail Straightener	Выпрямитель типа «пистэйл»
Flexible Stiffening Cannula	Гибкая поддерживающая канюля
	MP- совместимый
	Рекомендуемый проводник 0.038" (0.97мм)
	Обратитесь к инструкции по использованию
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Температура хранения: от +17°C до +27°C
	Антигенно
	Нетоксично
GTIN	Штриховой код товара
REF	№ по каталогу
STERILE EO	Стерилизовано с использованием этиленоксида
	Использовать до
	Только для однократного применения Не использовать повторно
	Не стерилизовать повторно
Rx Only	Исключительно для практикующих специалистов

Это изделие может быть защищено одним или несколькими
патентами. Информацию о патентах см. на веб-сайте
<http://www.bostonscientific.com/patents>


Ответственный производитель
«Бостон Сайентифик Корпорейшн»
360 Бостон Сайентифик Уэй
Мальборо, Массачусетс 01752, США
Служба поддержки клиентов в США 888-
727-1001

Уполномоченный представитель в ЕС
«Бостон Сайентифик
Лимитед»
Бэллибриг Бизнес Парк,
Голуэй, Ирландия


Сделано в Коста-Рике
2546 Ферст Стрит, Пропарк
Эль Койоиль, Алажуэла Коста-Рика

Дополнительные этикетки на русском языке:


- стент уретральный Ехреl, входящий в состав системы стента уретрального Ехреl, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см

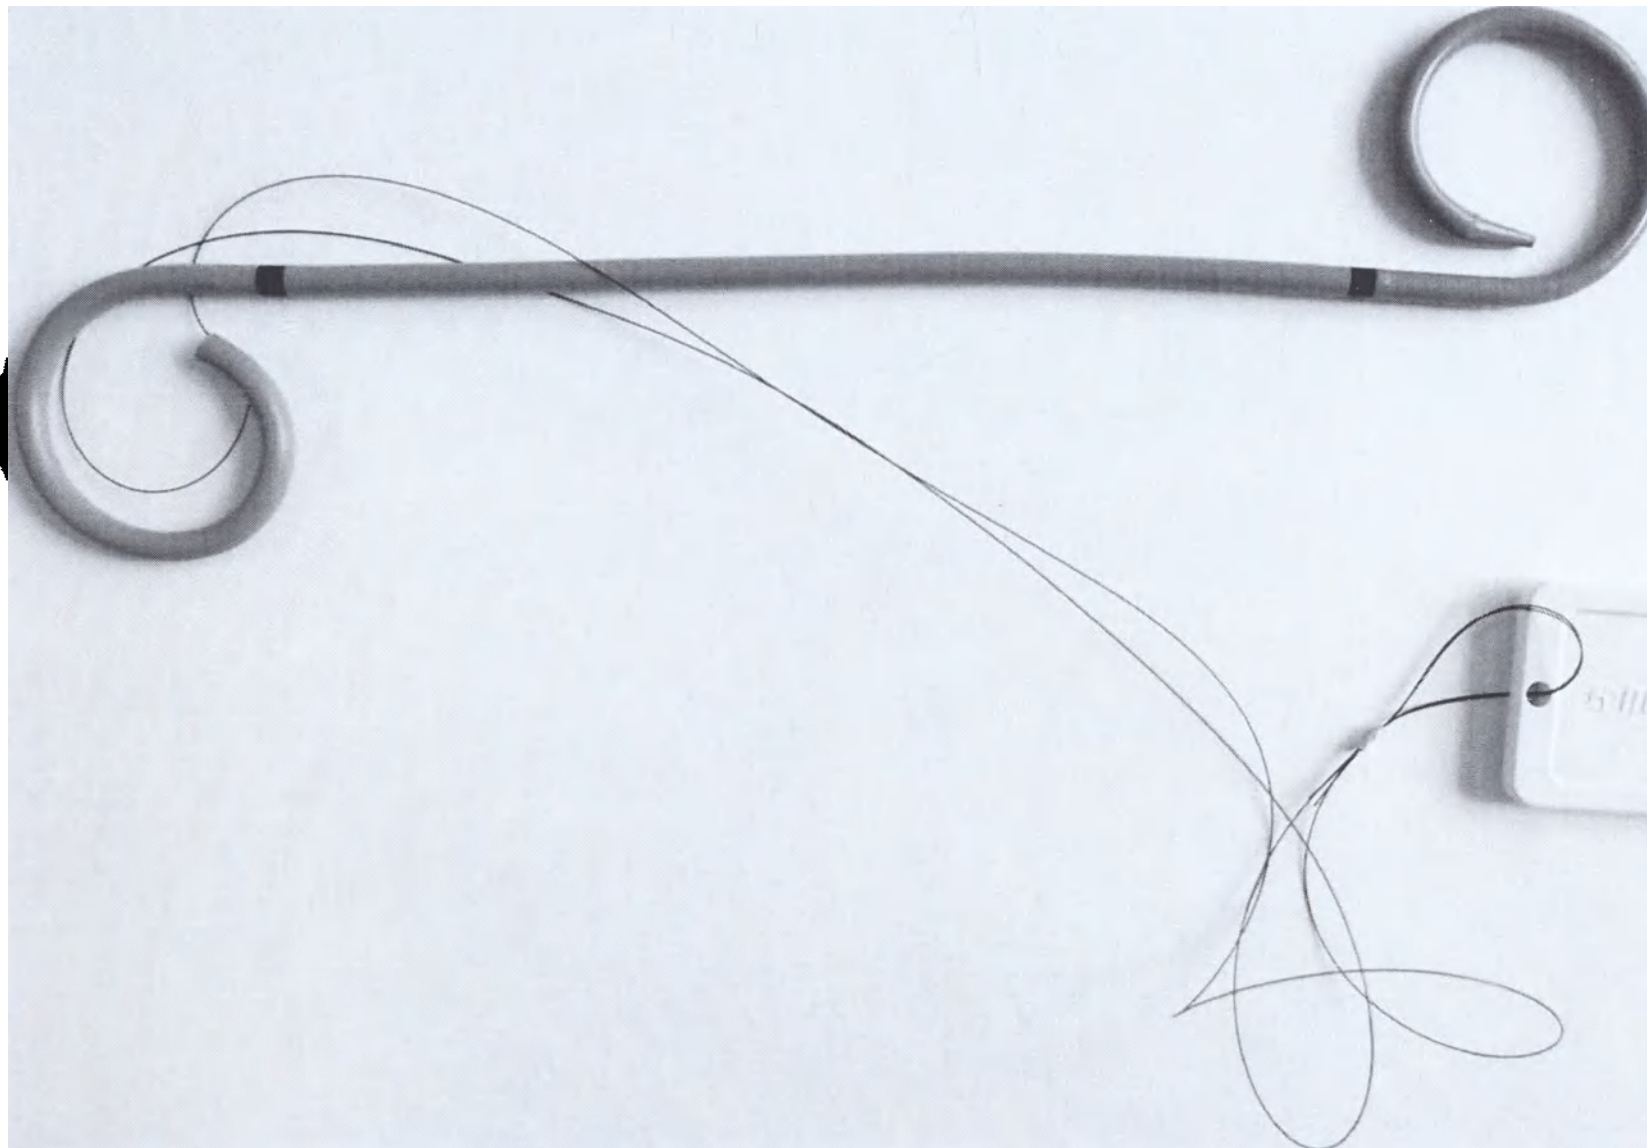


- стабилизатор, входящий в состав система стента уретрального Exrel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см

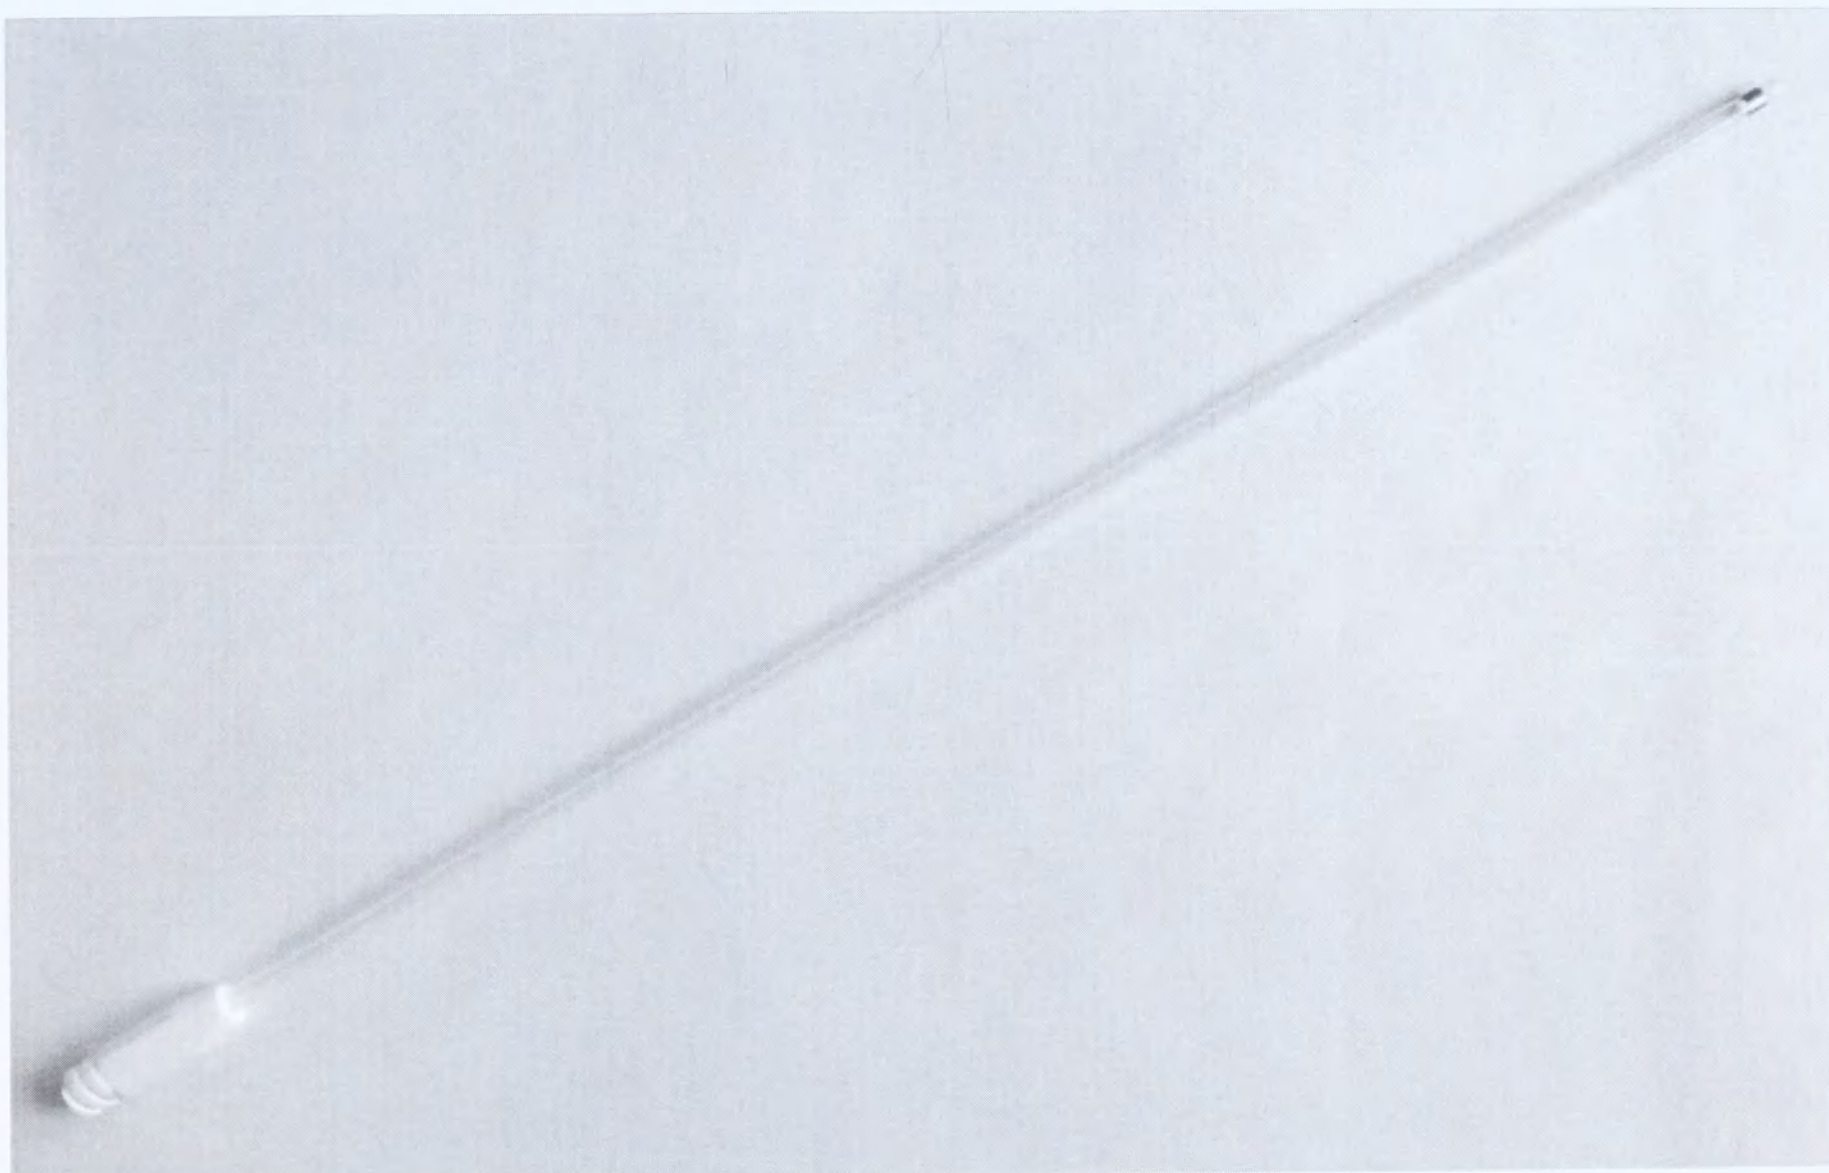

- выпрямитель типа «пигтэйл», входящий в состав системы стента уретрального Exprel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см

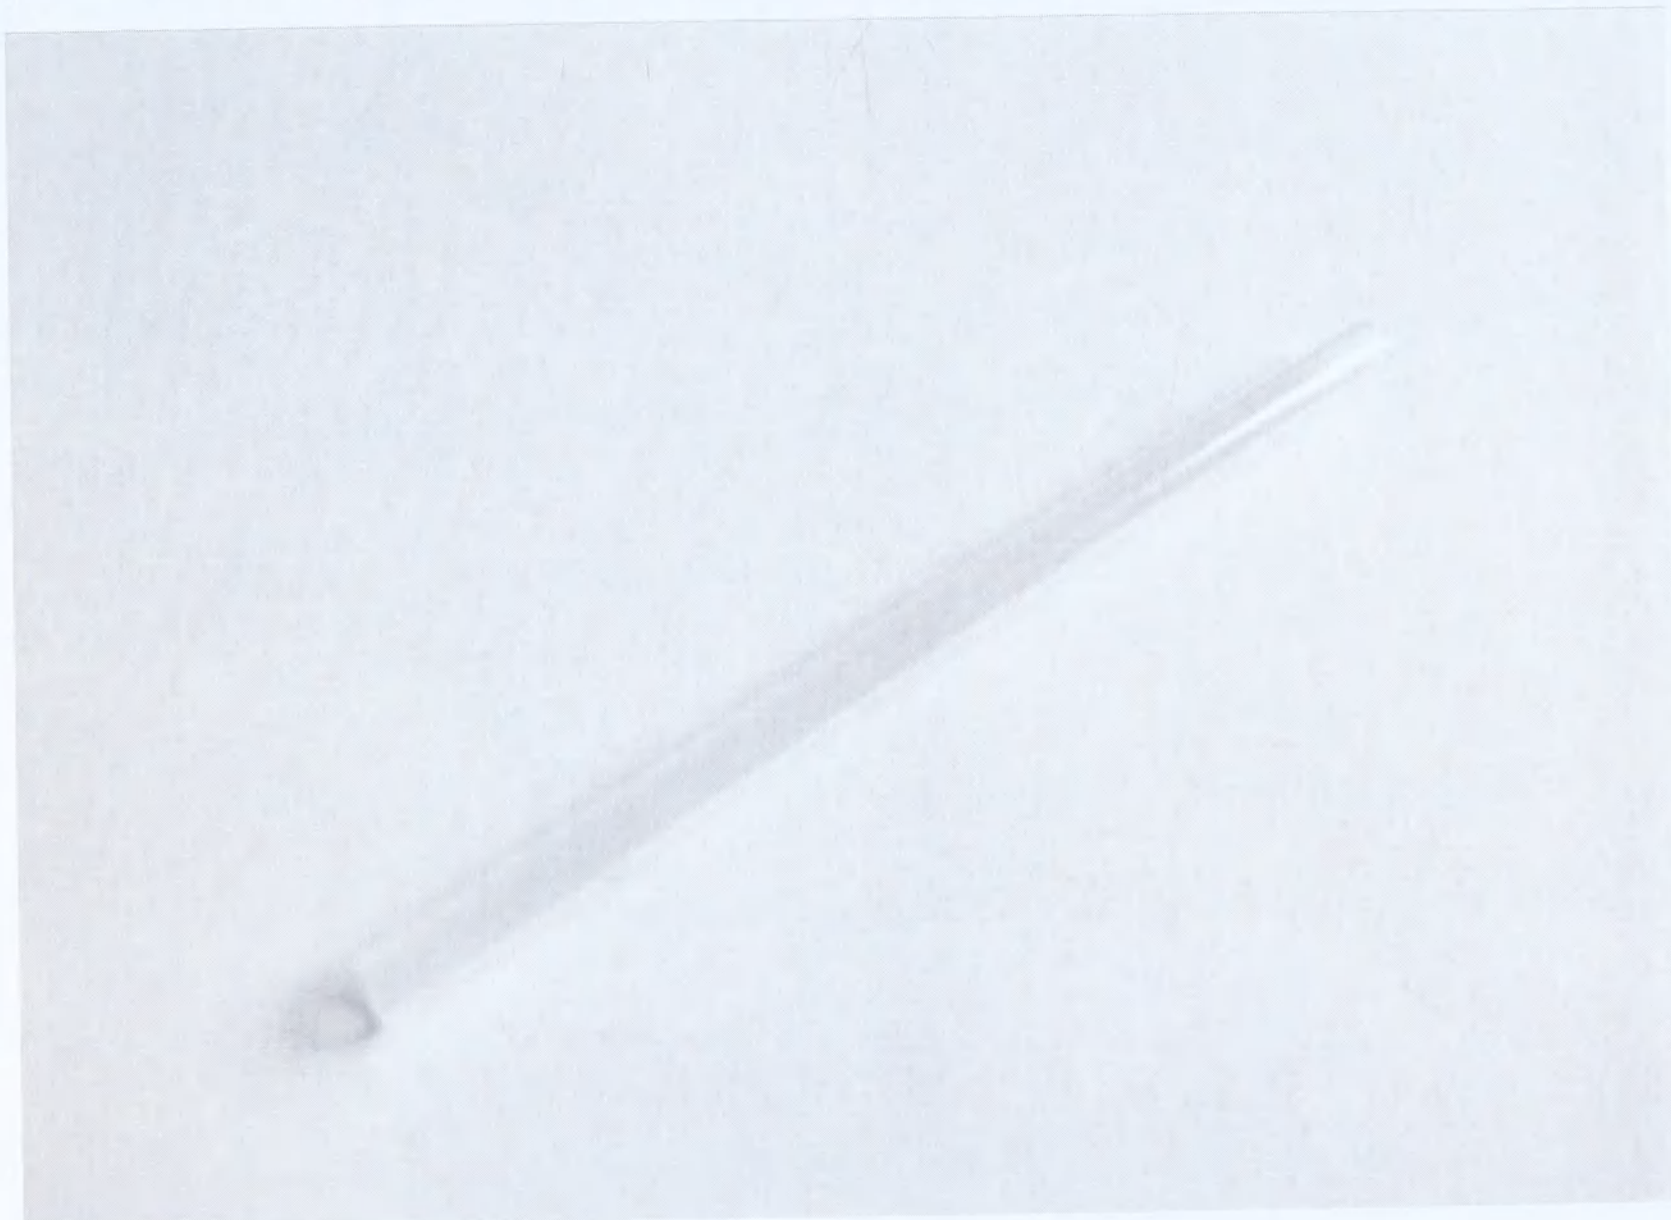

- гибкая поддерживающая канюля, входящая в состав системы стента уретрального Exrel, диаметром 10.3F (3,4 мм), длиной 12 см

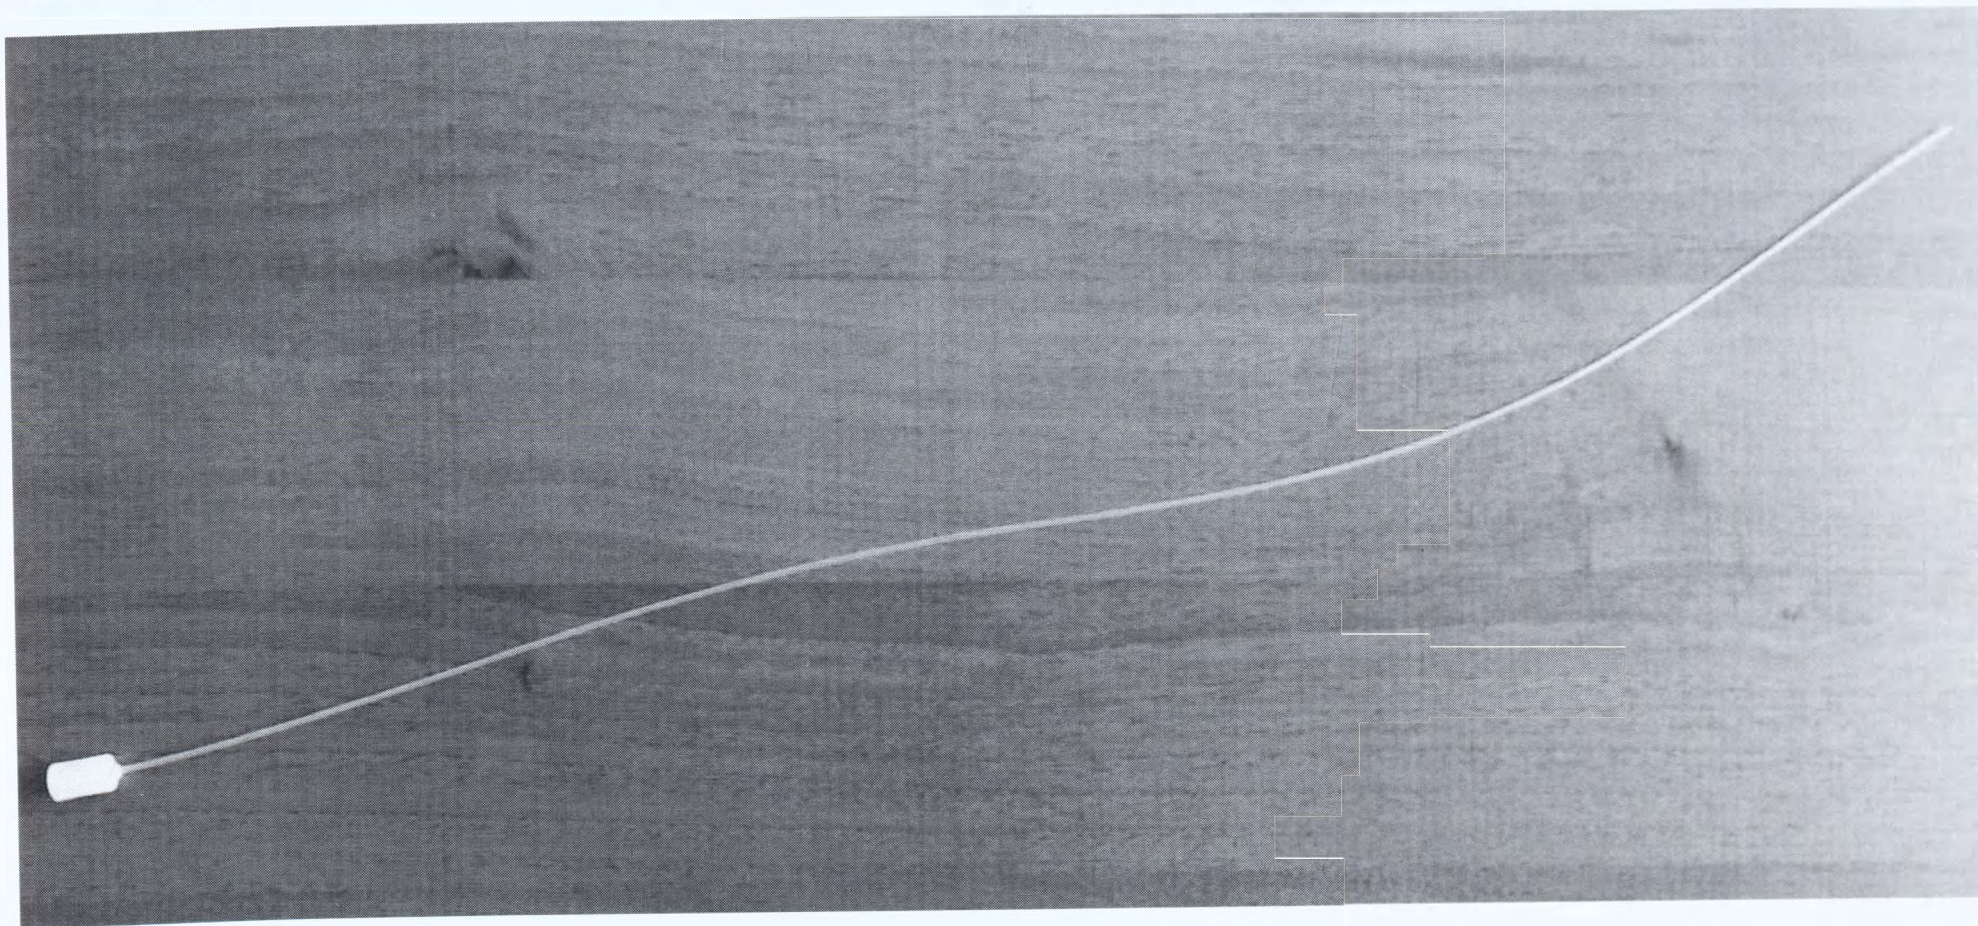



Прошито, пронумеровано
(30 лист(ов))
скреплено печатью

