

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Чэнь Син



Фотографические изображения изделия:
«Набор контрольных материалов ClinChem multi control для диагностики in vitro»

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай

Набор контрольных материалов ClinChem multi control для диагностики in vitro

P/N 105-009117-00

LOT 059317006



26-04-2019


REF MQ(ClinChem M)162



N59319041700600087

Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1)

антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



8 °C



Беречь от света



Для профессионального применения
Номер регистрационного удостоверения _____



Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Миндрей Медикал Рус», 129090, город Москва, Проспект
Олимпийский, дом 16, строение 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А

Состав:

Материал контрольный ClinChem multi control (уровень 1) – 10 флаконов по 5 мл;

Инструкция по применению;

Таблица результатов для системы BS компании Mindray для набора контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1)

Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1), в исполнении MQ(ClinChem M)162

Набор контрольных материалов ClinChem multi control для диагностики in vitro

P/N 105-009118-00

LOT 059417004



30-11-2018


REF MQ(ClinChem M) 262



N59418111700400293

Материал контрольный ClinChem multi control (уровень 2)

антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



8°C



Беречь от света

CONTROL



Для профессионального применения

Номер регистрационного удостоверения _____



Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Миндрей Медикал Рус», 129090, город Москва, Проспект
Олимпийский, дом 16, строение 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А



Состав:

Материал контрольный ClinChem multi control (уровень 2) – 10 флаконов по 5 мл;



Инструкция по применению;

Таблица результатов для системы BS компании Mindray для набора контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 2)

Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 2), в исполнении MQ(ClinChem M)262

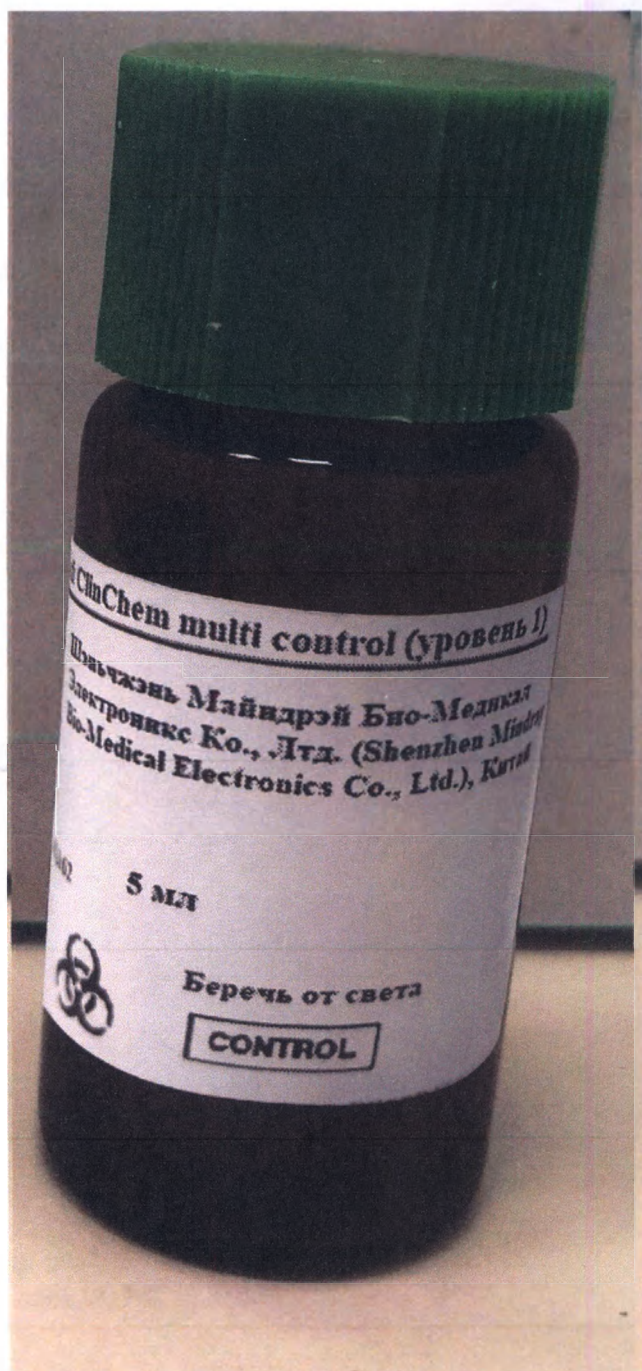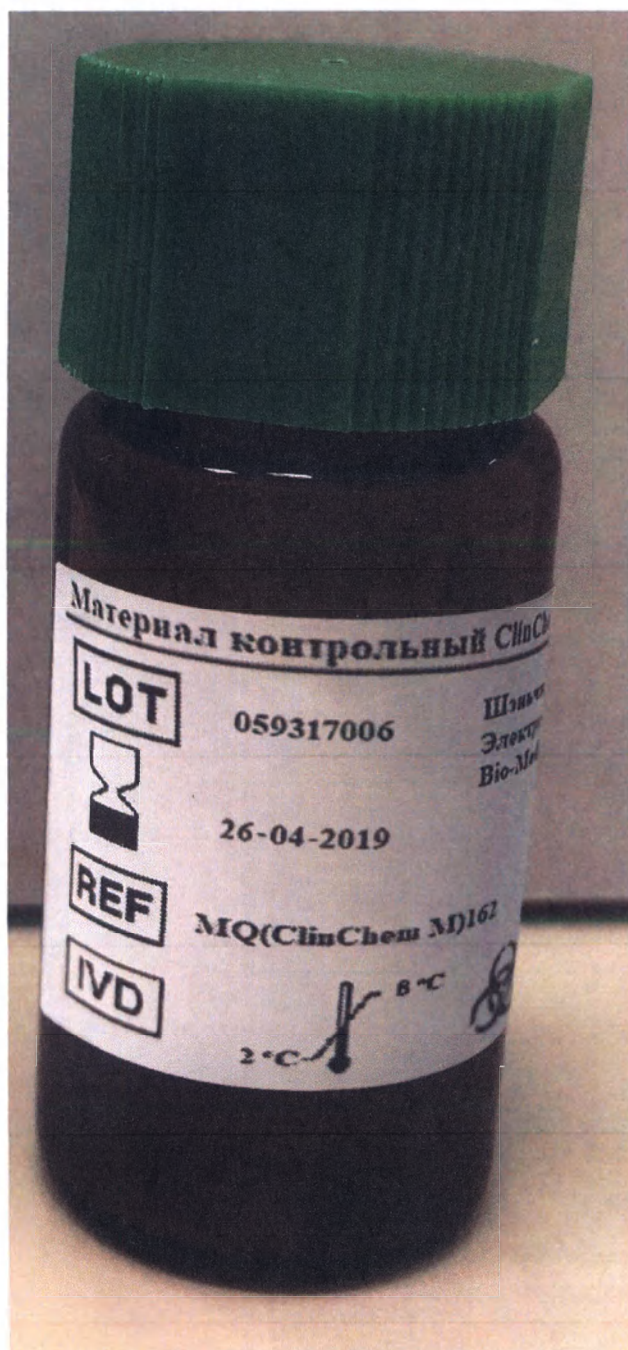

Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1),
в исполнении MQ(ClinChem M)162

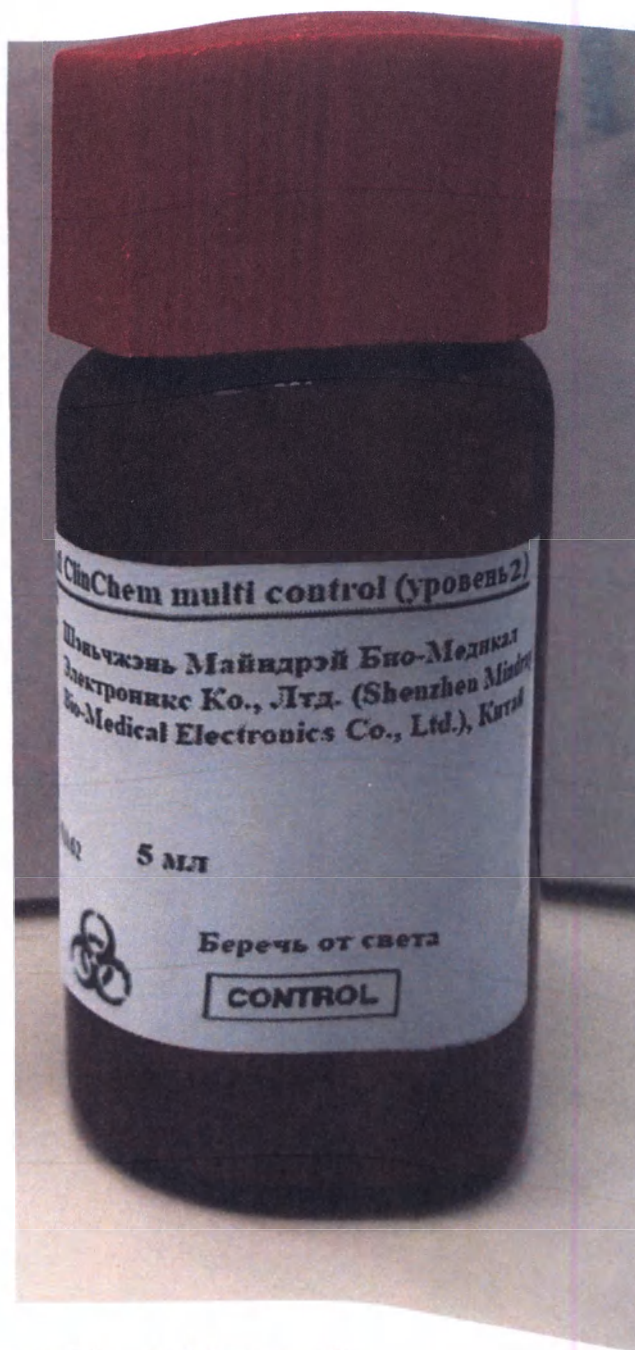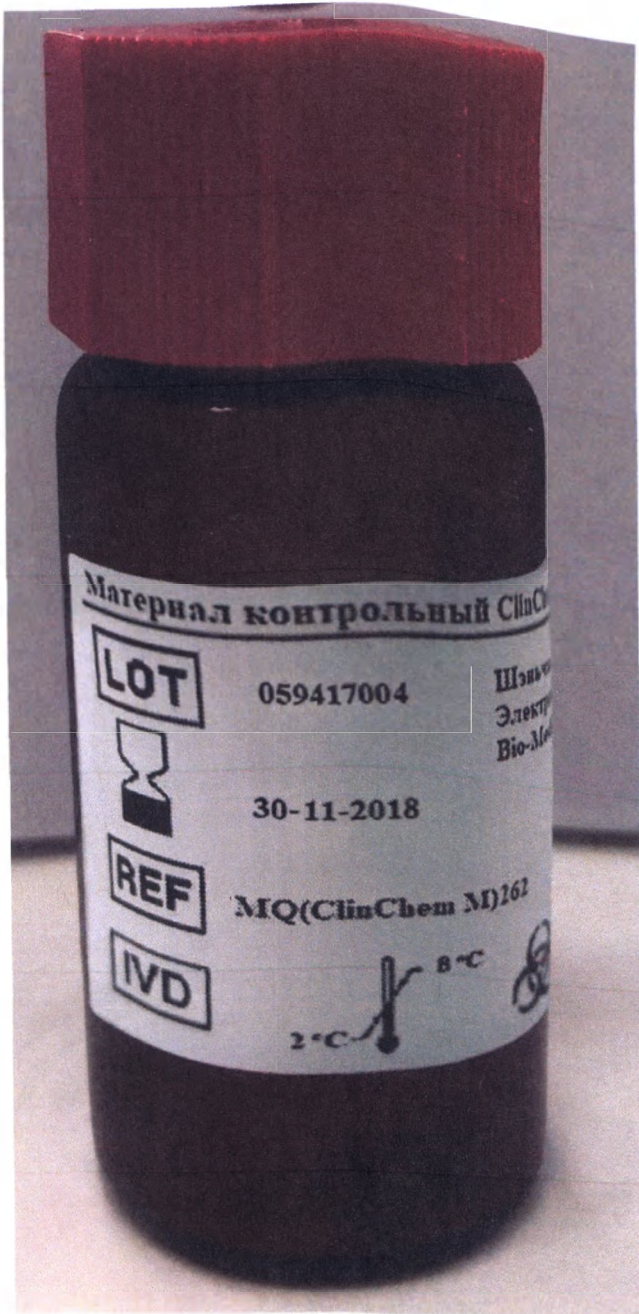

Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 2),
в исполнении MQ(ClinChem M)262

листа (-ов) Чэнь Си

Генеральный Директор _____ Чэнь Син
М.П.