

Фотографические изображения
медицинского изделия


Имплантаты стоматологические DURAVIT
с принадлежностями.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НИК ЛИБОСТОМ»
Булалов Б.В.



2018 г.


Имплантат стоматологический DURAVIT Ø от 3,5 мм до 5,5 мм с высотой от 4,0 мм до 20,0 мм с шагом 0,5 мм

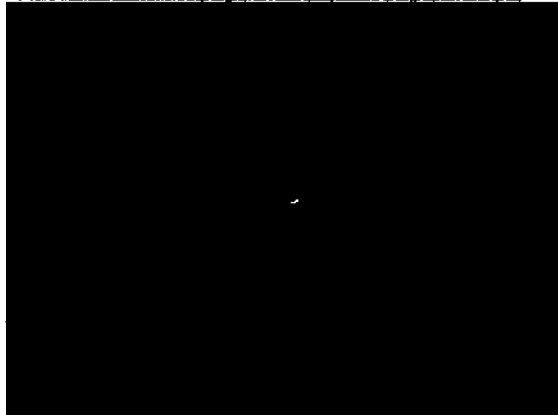


Имплантат стоматологический DURAVIT Ø от 3,5 мм до 5,5 мм с высотой от 4,0 мм до 20,0 мм с шагом 0,5 мм



Имплантат стоматологический DURAVIT Ø от 3,5 мм до 5,5 мм с высотой от 4,0 мм до 20,0 мм с шагом 0,5 мм

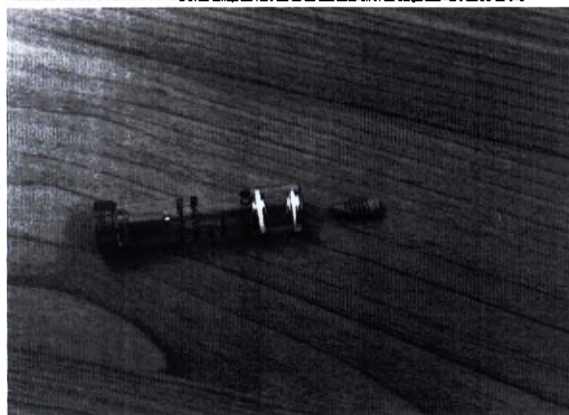

Имплантат стоматологический DURAVIT Ø от 3,5 мм до 5,5 мм с высотой от 4,0 мм до 20,0 мм с шагом 0,5 мм; (в увеличении)

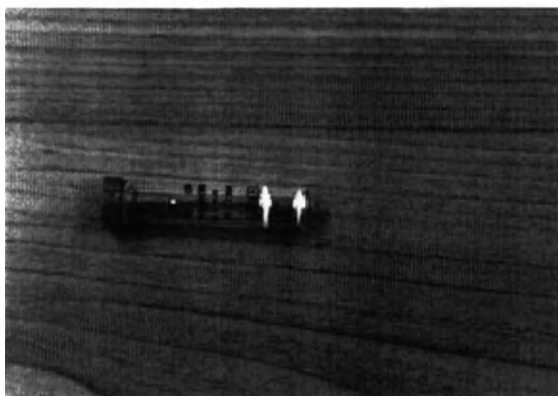

Вент-капсула, Ø от 1,0 мм до 3,0 мм, высотой от 1,0 мм до 4,0 мм



Формирователь дентин стандартный, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, высотой от 1,0 мм до 7,0 мм




Формирователь дентин 770A, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, высотой от 1,0 мм до 7,0 мм




Формирователь дентин 770B, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, высотой от 1,0 мм до 7,0 мм



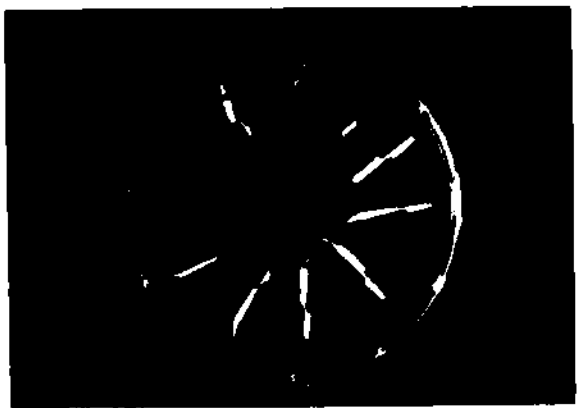


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

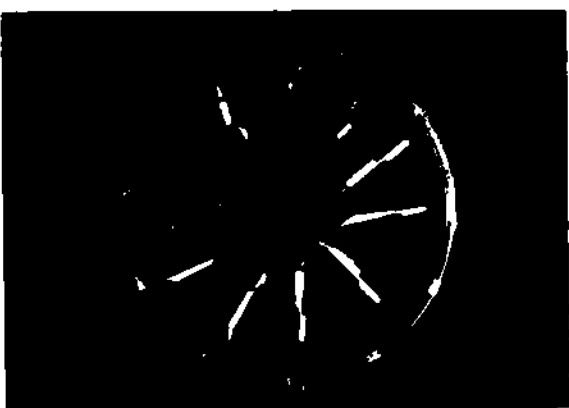


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм




Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

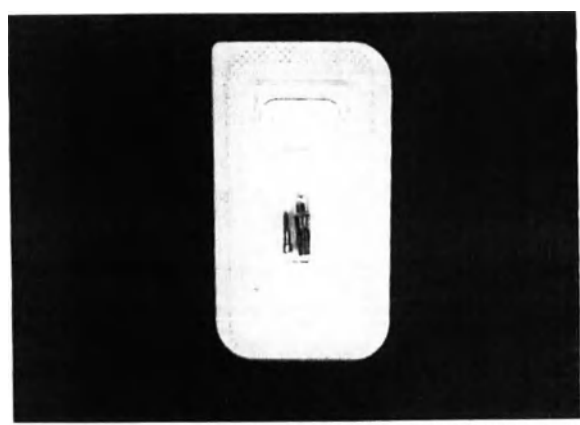


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

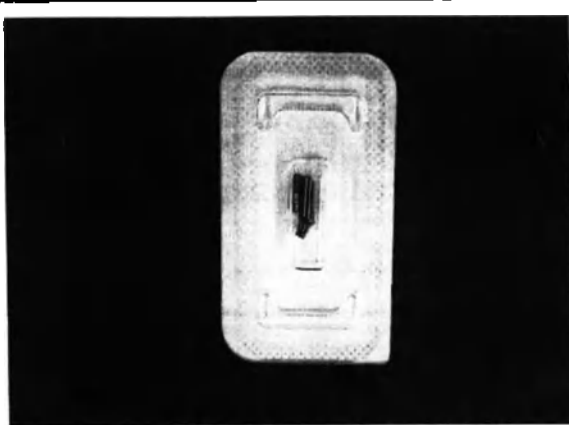


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

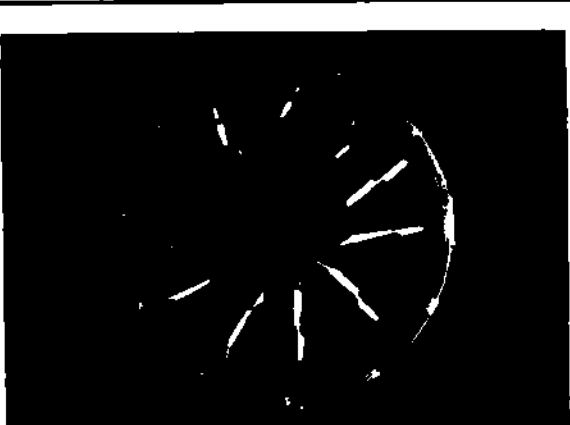


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

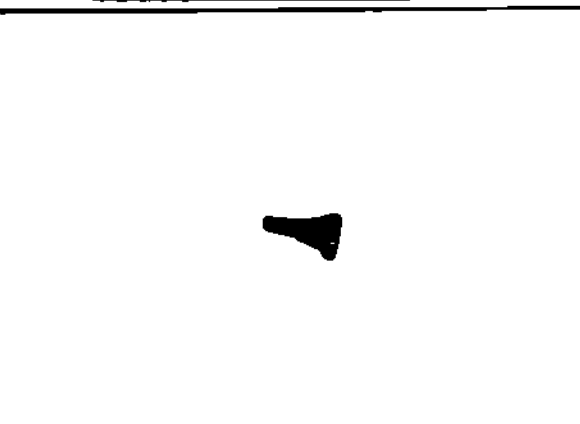


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

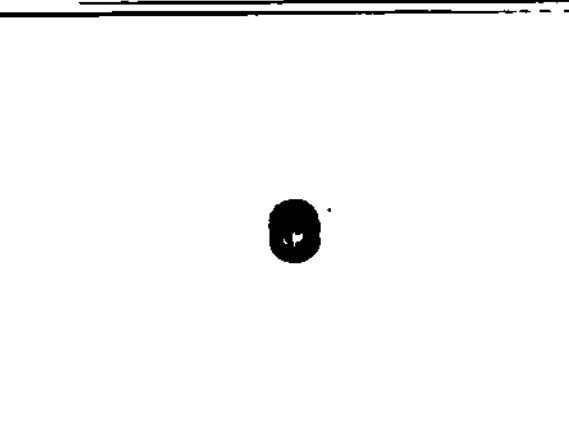


Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

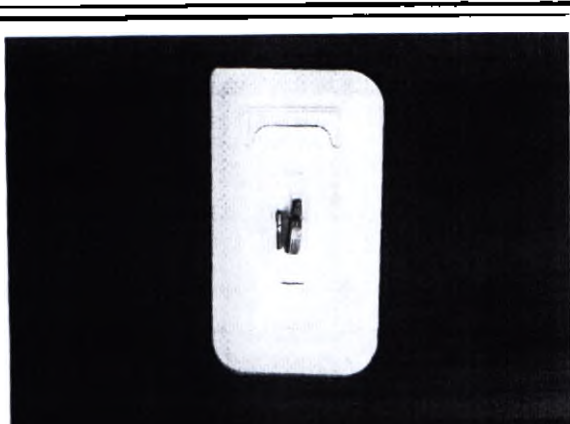

Алюминиевый диск колеса 15", диаметр 150 мм, ширина обода 15 мм, диаметр 150 мм

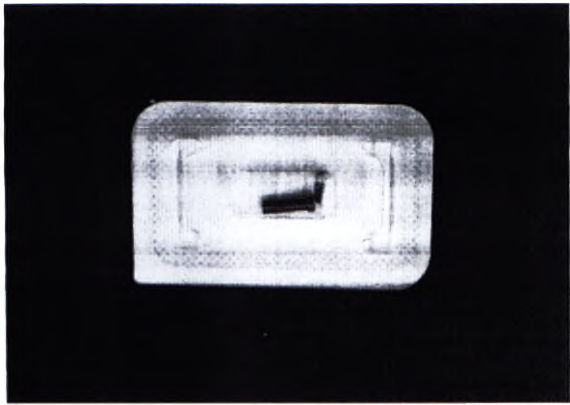

Адгезив UCLA для промежуточного адгезирования



Адгезив UCLA для промежуточного адгезирования



Адгезив Clearfil-Bond Plus



Адгезив Clearfil-Bond Plus




Адгезив Clearfil-Bond Plus



Адгезив Clearfil-Bond Plus



Адгезив Clearfil-Bond Plus

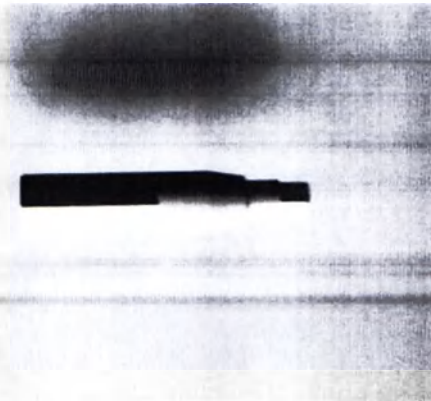


Адгезив Clearfil-Bond Plus



Адгезив Clearfil-Bond Plus


Сканирующее устройство



Абсолютный измерительный прибор, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.



Абсолютный измерительный прибор, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.

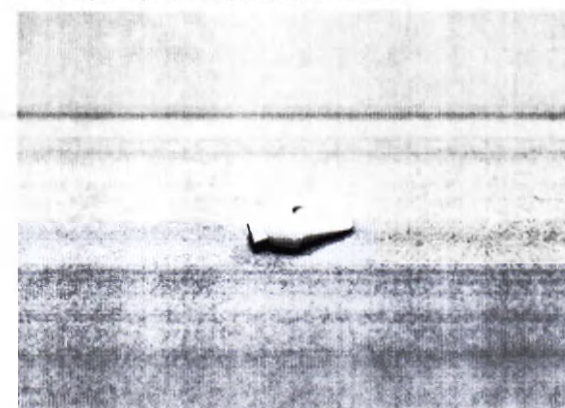

Абсолютный измерительный прибор, Ø от 1,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.




Абсолютный измерительный прибор, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.



Абсолютный измерительный прибор, Ø от 1,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.



Абсолютный измерительный прибор, Ø от 10 мм до 20 мм, длиной от 20 до 60 мм.

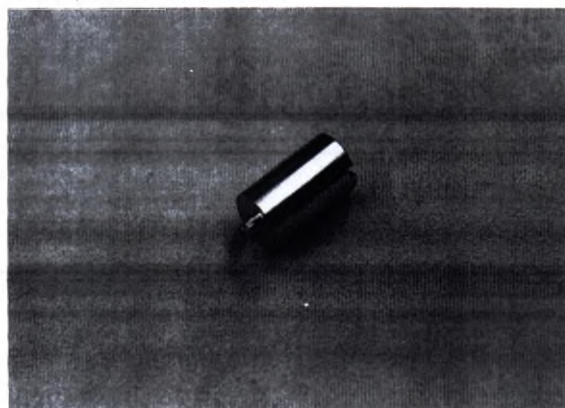

Абсолютный измерительный прибор, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.



Абсолютный измерительный прибор, Ø от 3,0 мм до 7,0 мм, длиной шкалы от 1,0 мм до 7,0 мм.






Аналог (сравнительно)




Имит. Ана. копирован элемент

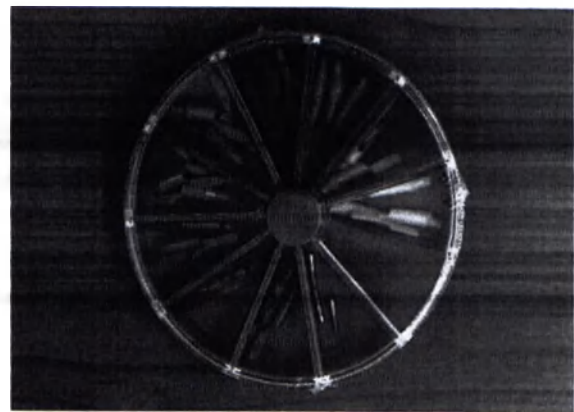

Аналог ТИ-024 в комплект 22", Ø 3,0 мм до 7 мм, диаметр болта 1,0 мм до 7 мм



Аналог SLIM

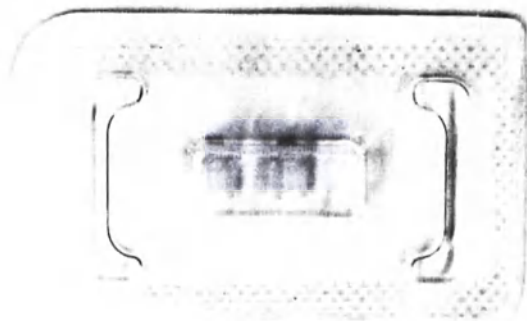


Аналог Ана. имитация элемента, Ø 1,0 мм до 7,0 мм, диаметр 1,0 мм до 7,0 мм



Имит. элемента (сравнительно)



Аналог WIDE

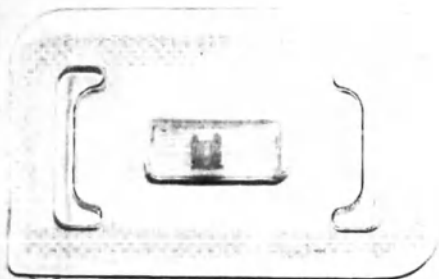

Аналог Ана. имитация элемента, Ø 1,0 мм до 7,0 мм, диаметр болта 1,0 мм до 7,0 мм



Имит. элемента (сравнительно)

Аналог MINI с круглой головкой.



Аналог MINI с квадратной головкой.



Аналог нового типа абетамета.




Аналог оформленного абетамета.



Аналог абетамета MUA.



Аналог FLAT.

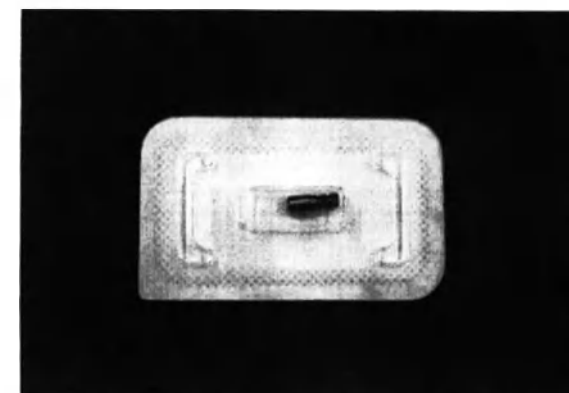

Аналог абетамета с отщипыванием.



Аналог абетамета Equator.




Внутрь запечатывается, Ø от 1,0 мм до 4,0 мм, длина от 2,0 до 14,0 мм






Band A: width 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm

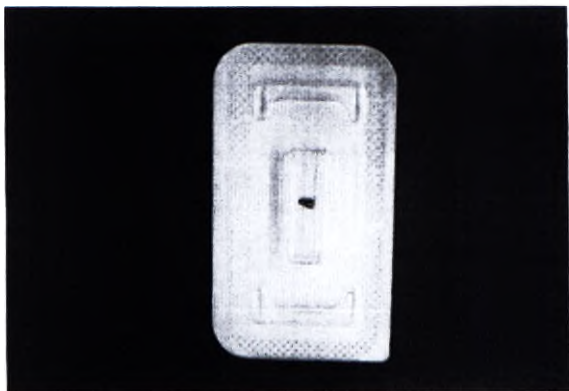


Band ME.A



Band: adhesive bandage with adhesive film, 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm

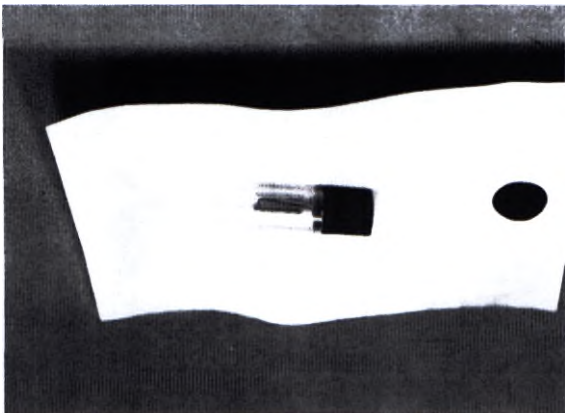

Band A: width 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm

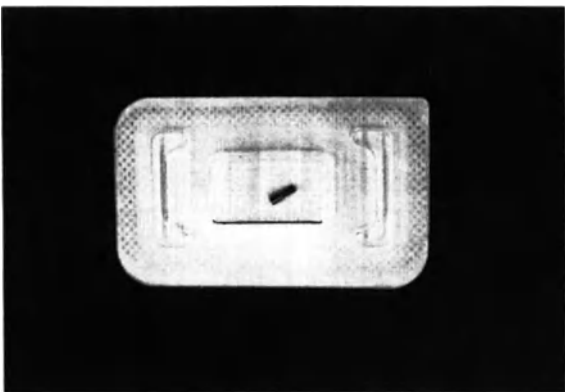

Band FLAT




Band: adhesive bandage with adhesive film, 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm



Band: width 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm



Band SLIM

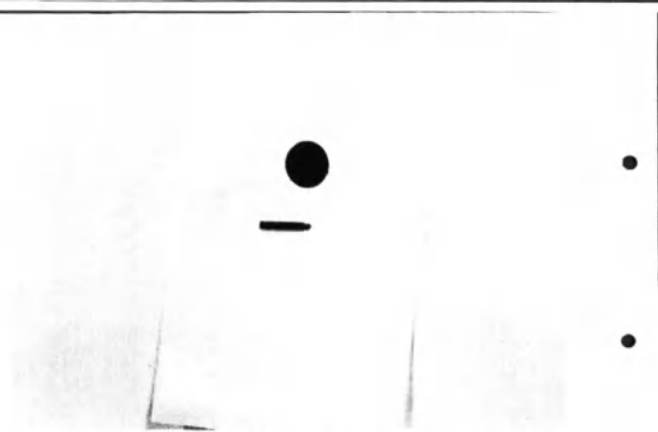

Band: adhesive bandage with adhesive film, 15 or 1.5 mm to 4.0 mm, length 20 to 20.0 mm



Взрывчатка (Vzr.)



Взрывчатка (Vzr.)



Взрывчатка (Vzr.)



Взрывчатка (Vzr.)




Взрывчатка (Vzr.)




Взрывчатка (Vzr.)




Взрывчатка (Vzr.)

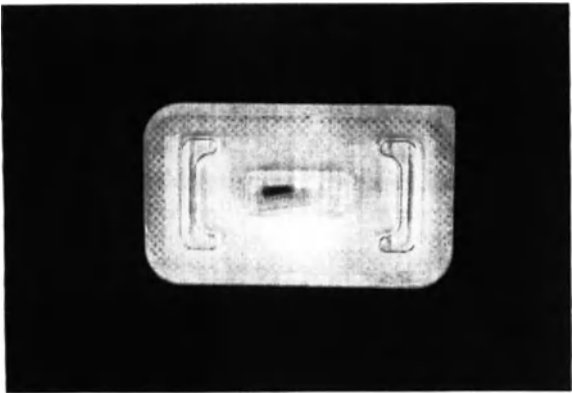

Взрывчатка (Vzr.)

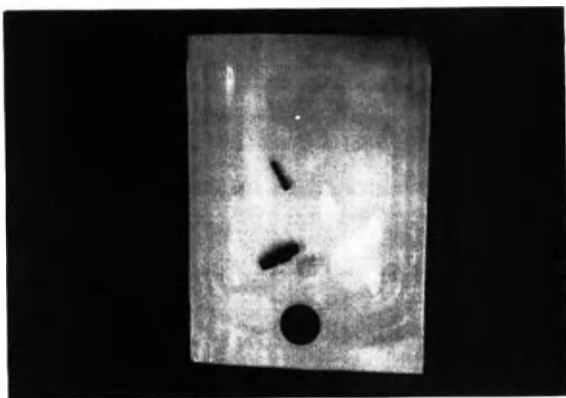

Металл-картонный для крепления в стене из пористого бетона

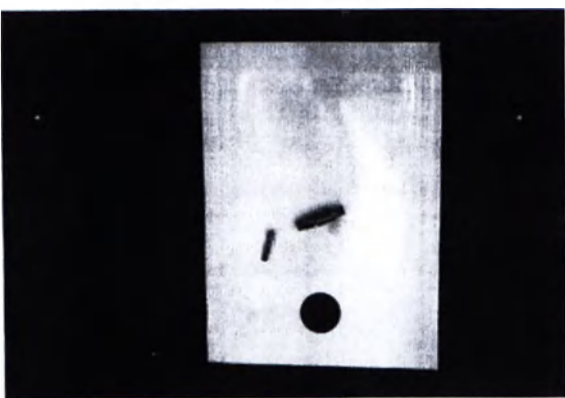

Металл-картонный для крепления в стене из пористого бетона, алюминий



Металл-картонный для крепления в стене из пористого бетона




Втулка для крепления в бетоне, Ø от 1,8 мм до 7,0 мм, алюминий от 1,0 мм до 30,0 мм



Втулка для крепления в бетоне, Ø от 1,8 мм до 7,0 мм, алюминий от 1,0 мм до 7,0 мм



Анкеры из нержавеющей стали, Ø от 1,0 мм до 7,0 мм, алюминий от 1,0 мм до 7,0 мм

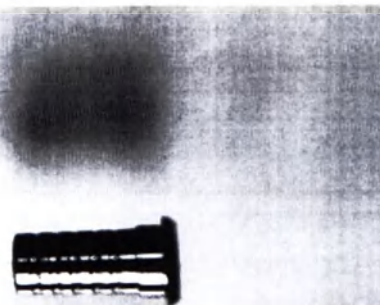


Втулка из нержавеющей стали



Втулка из нержавеющей стали




Втулка из нержавеющей стали

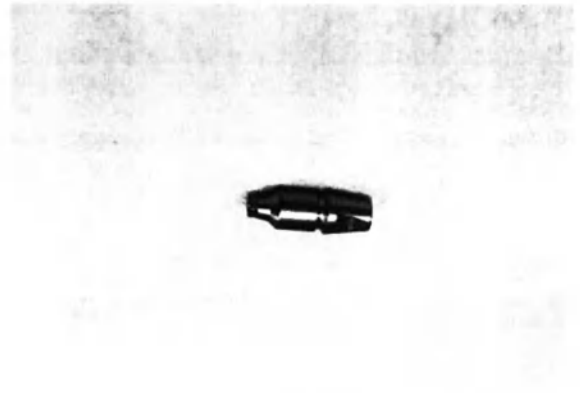


Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла




Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла

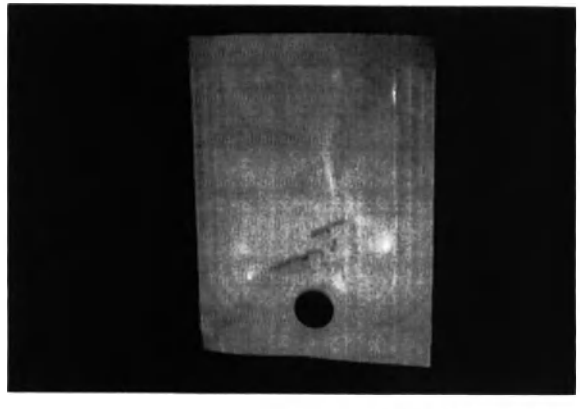

Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла

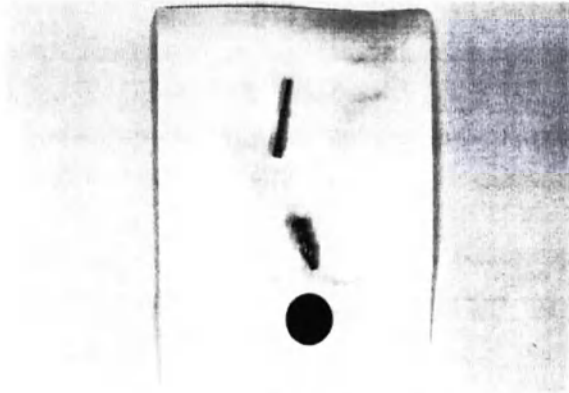


Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла

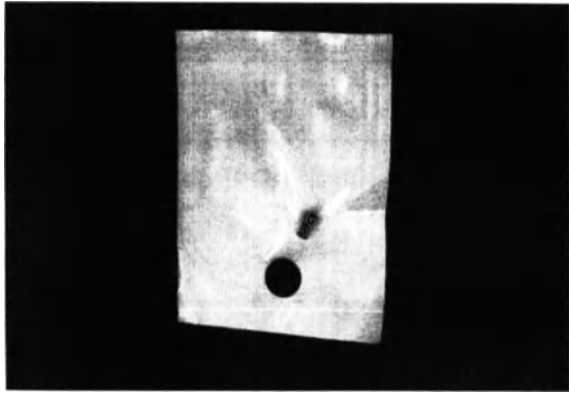


Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла



Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла

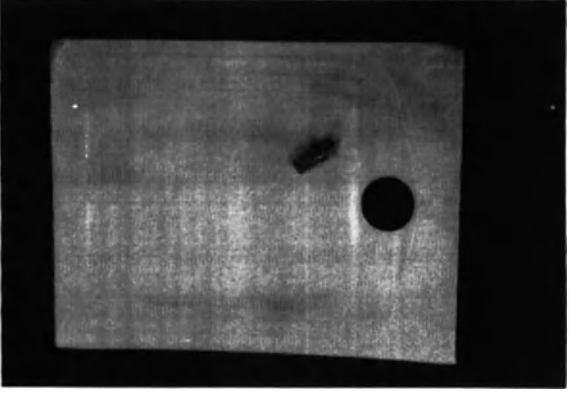

Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла

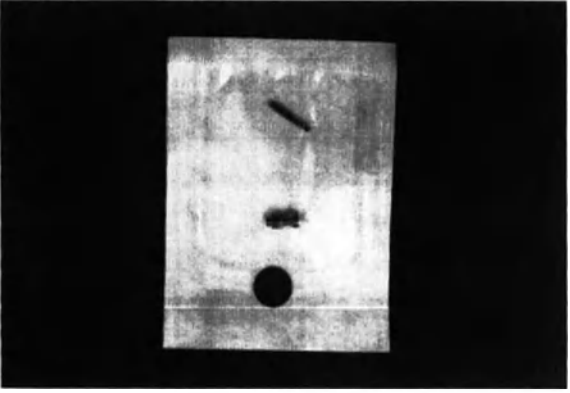

Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла



Микрофотография сечения металла для исследования структуры металла



Микрофотография поверхности имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении




Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении




Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении



Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении

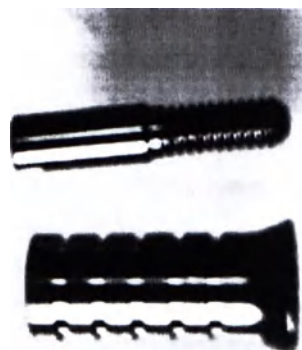


Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении




Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении



Микрофотография поверхности имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении

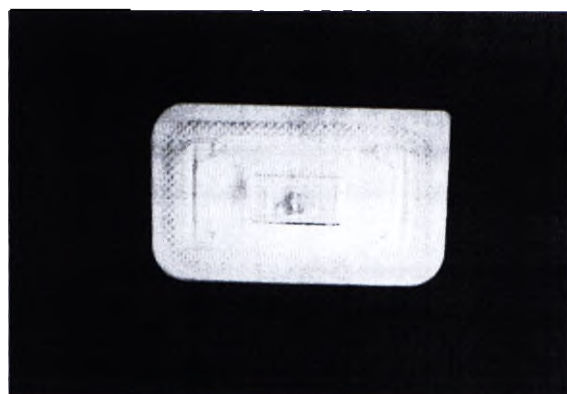

Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении

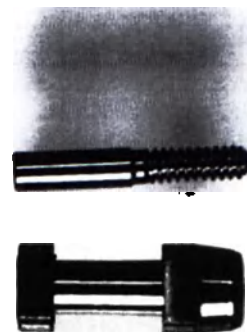

Вид имплантата, покрытого гидроксиапатитом, при 100x увеличении




Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.




Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.




Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

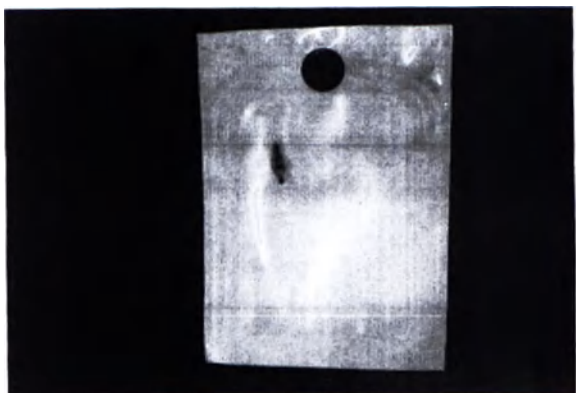


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

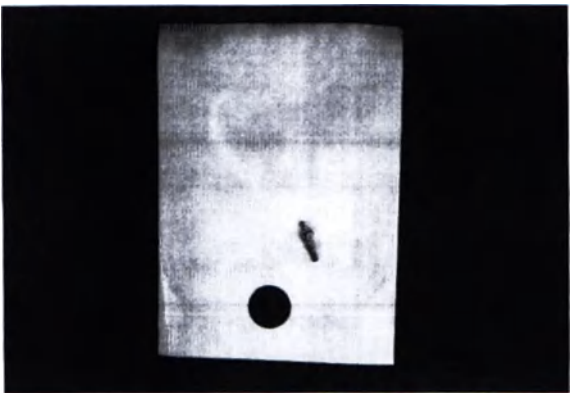


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

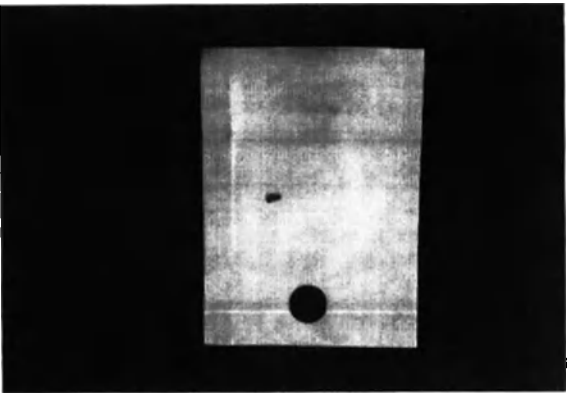


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

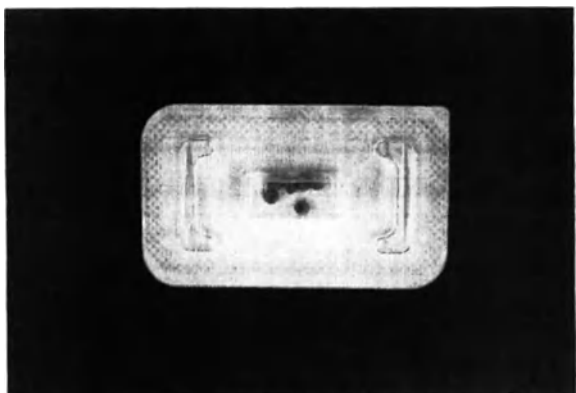


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

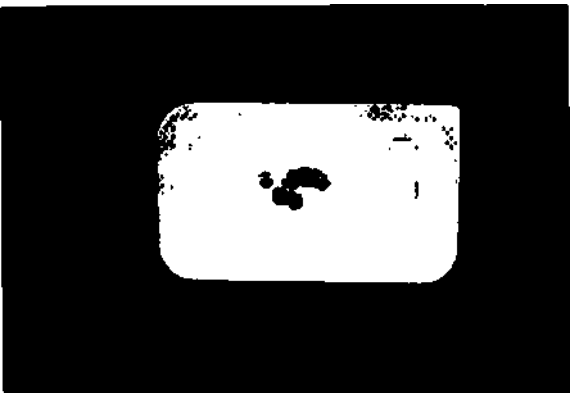


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

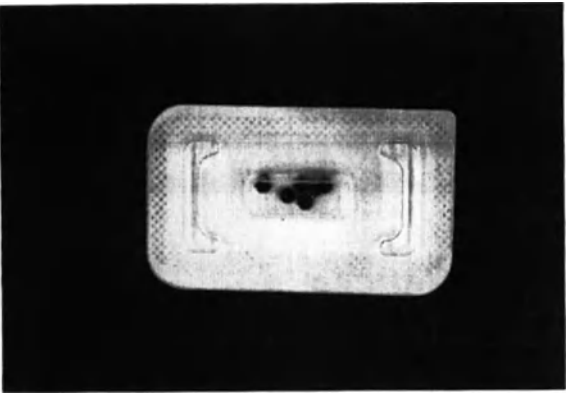


Административный штраф, в размере 10 000 руб. за нарушение правил использования медицинских изделий, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 руб.

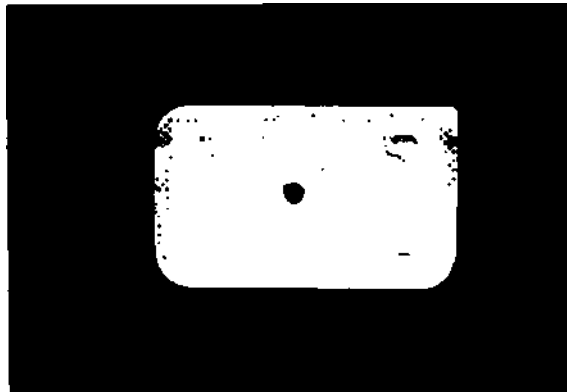[illegible]


© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

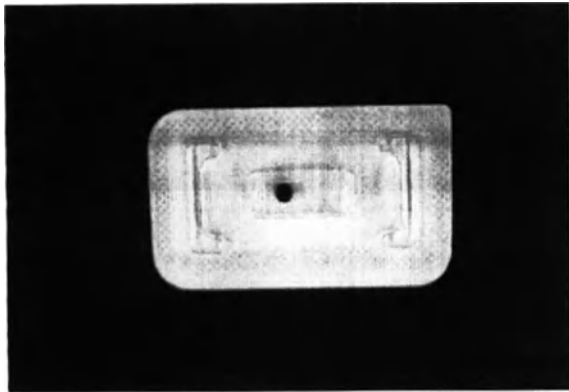


Abstract

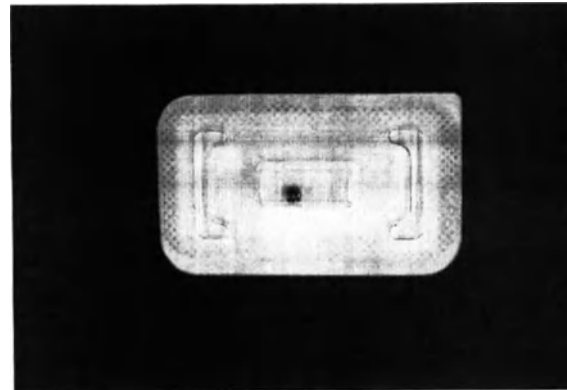


© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

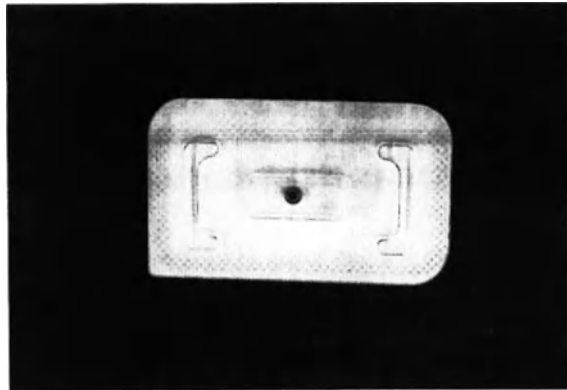


உதவித் தலைவர்: தலைவர் அவர்களே, கிராமப்புறங்களில் கட்டிடக்கலைத் துறையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களைப் பற்றித் தகவல் என்ன?

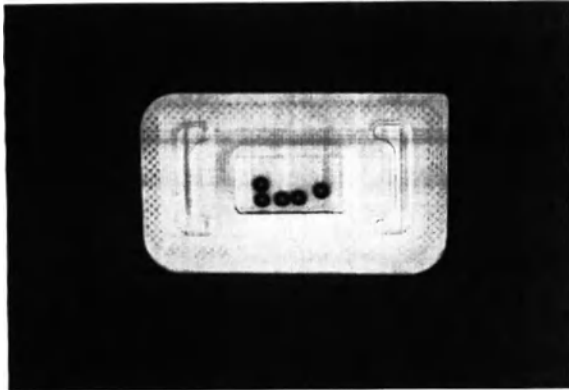


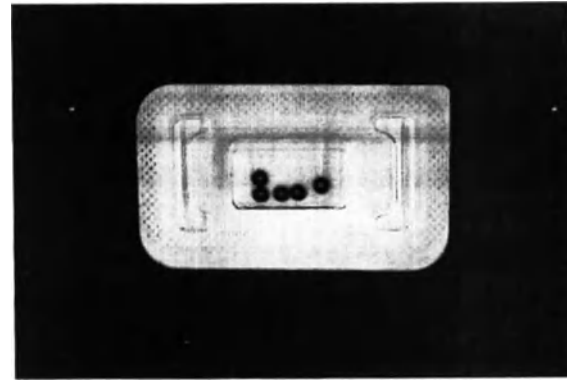[illegible]


Admission: \$10.00. Free for children under 12. Free for seniors 65 and over.

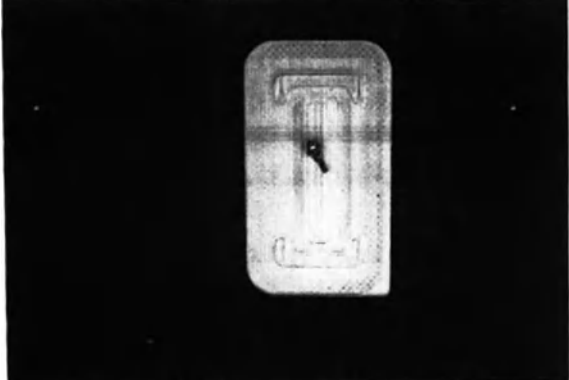[illegible]

Результат ММА, при давлении 30%, Ø от 1,0 мм до 2,0 мм, диаметр оплетки от 1,0 мм до 2,0 мм

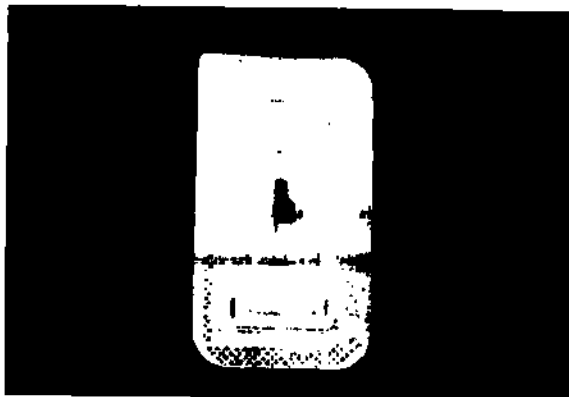

Белая выделка, длиной от 2,0 мм до 80,0 мм

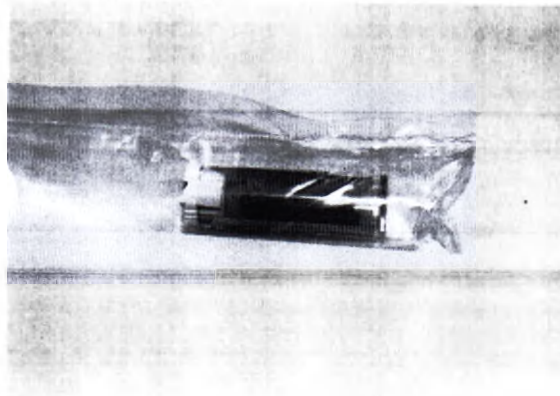

Детальное изображение



Полученный класс А



Полученный класс В



Безопасный контейнер



Класс средней степени

CAPPETTE E CLIP RITENTIVE



Descrizione del dispositivo e prestazioni previste: La cappetta e clip ritentive sono elementi elastici di collegamento tra la protesi e gli attacchi Round3 di seguito elencati: OT Cap, OT Strategy, Store Single, Perm in mano, Store Care e Store Single, Sphero Block - Flex, OT Bar, Ot Cap Tacta e OT Vertical. Precauzioni: La scelta della cappetta o clip e il carico dell'odontotecnico o dell'odontologo in base al tipo di progetto previsto. Sicurezza responsabilità del sistema da attacco a Round3 Store3 entro periodo di garanzia in anni.



Класс низкой степени

CAPPETTE E CLIP RITENTIVE

Descrizione del dispositivo e prestazioni previste: La cappetta e clip ritentive sono elementi elastici di collegamento tra la protesi e gli attacchi Round3 di seguito elencati: OT Cap, OT Strategy, Store Single, Perm in mano, Store Care e Store Single, Sphero Block - Flex, OT Bar, Ot Cap Tacta e OT Vertical. Precauzioni: La scelta della cappetta o clip e il carico dell'odontotecnico o dell'odontologo in base al tipo di progetto previsto. Sicurezza responsabilità del sistema da attacco a Round3 Store3 entro periodo di garanzia in anni.

