


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материалы расходные к анализаторам газов и электролитов крови серии EasyBloodGas®, EasyLyte®, EasyStat® для лабораторной диагностики in vitro

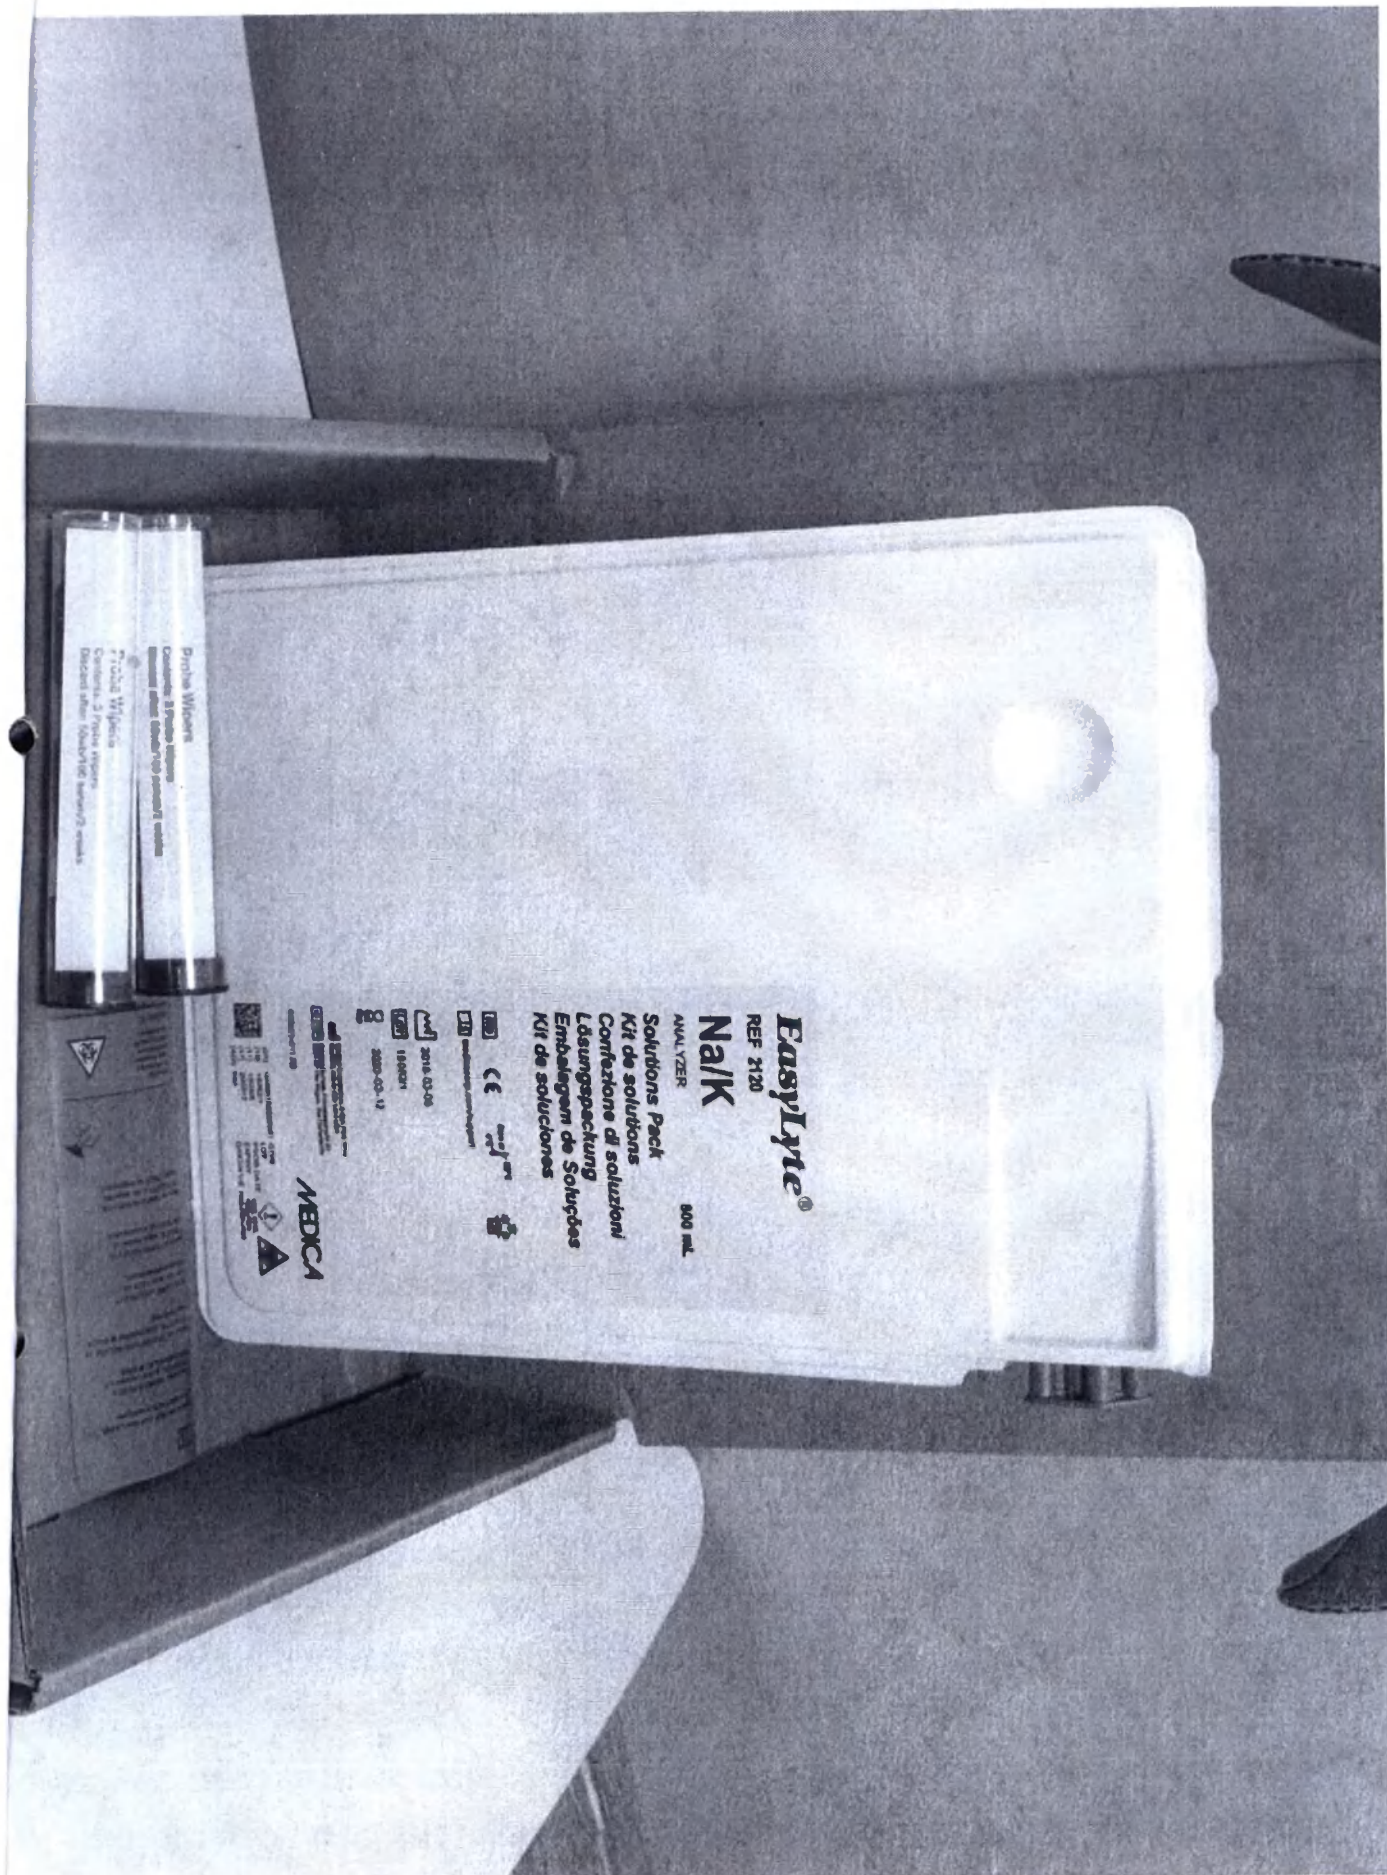

кет с растворами Na/K (EasyLyte® Na/K Solutions Pack) с осушителями зонда (2 тубуса по 3 шт./тубус)

EasyLyte® PLUS

REF 2121

Na/K/Cl

ANALYZER

800 mL

Solutions Pack

Kit de solutions

Confezione di soluzioni

Lösungspackung

Embalagem de Soluções

Kit de soluciones



mediacorp.com/support



2018-04-12



18121/1



2020-04-19

Medica Corporation, 8 Oak Park Drive
Terrence, MA 01230-1413 USA

Medica Europe, Pöschelweg 10
55116 Bad Neuenahr, Germany

010021-012 R0

MEDICA



(01)	00388100003009	GTIN
(10)	18121/1	LOT
(11)	180412	PROD DATE
(17)	200419	EXPIRY
(40)	540	ORIGIN US



Probe Wipers

Contents: 3 Probe Wipers
Discard after: 50wets/100 serum/2 weeks

Probe Wipers

Contents: 3 Probe Wipers
Discard after: 50wets/100 serum/2 weeks



Remove the RED CAP and LABEL,
then install PACK in analyzer.

Remove the TAPPO ROSSO e
L'ETICHETTA, quindi installare il
PACK nell'ANALIZZATORE.

Retirer la COUVERTURE ROUGE et
l'ETIQUETTE, puis installer le PACK
dans l'analyseur.


RETE KAPPE und ETIQUETT
entfernen, dann PACK im
Analysegerät installieren.

Remo los TAPON ROJO y la
ETIQUETA, luego instala el
CARTUCHO en el analizador.


Remo os TAPPA VERMELHA
e a ETIQUETA, e, em seguida,
instale o PACK no analisador.



г с растворами Na/K/Cl (EasyLyte® Plus Na/K/Cl Solutions Pack) с осушителями зонда (2 тубуса по 3 убуc)

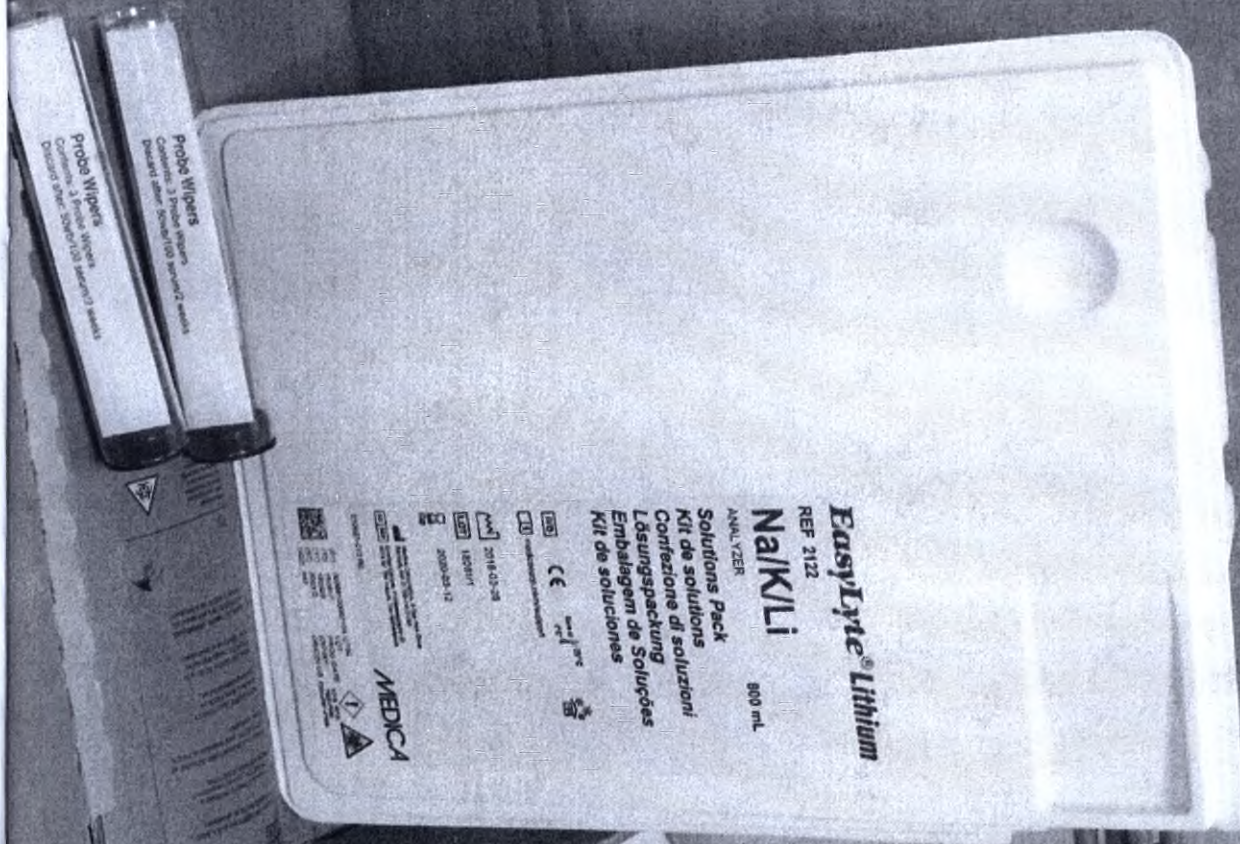

дет с растворами Na/K/Li (EasyLyte® Lithium Na/K/Li Solutions Pack) с осушителями зонда (2 тубуса
3 шт./тубус)

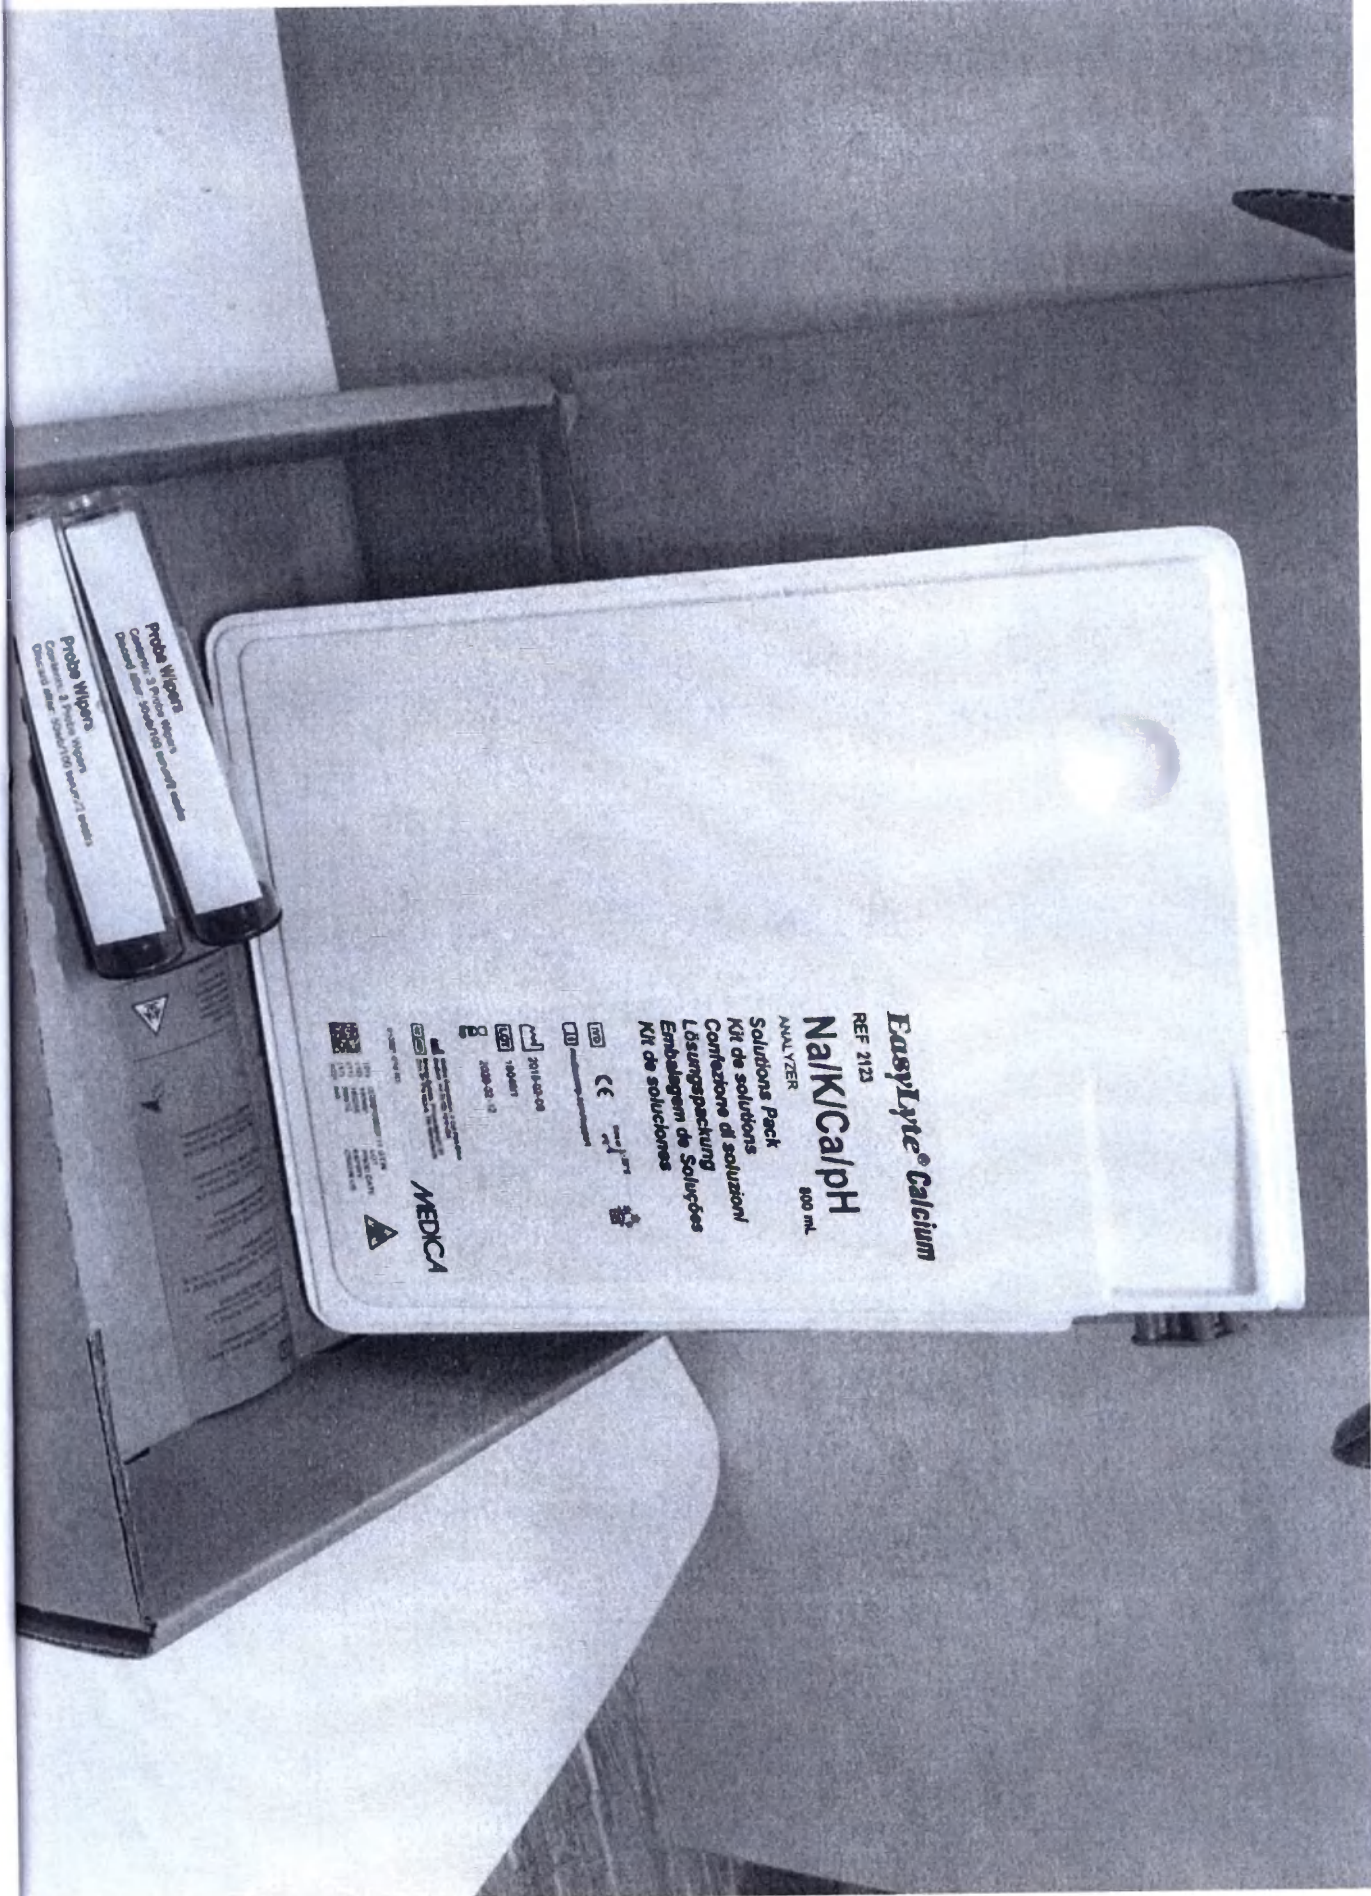

т с растворами Na/K/Ca/pH (EasyLyte® Calcium Na/K/Ca/pH Solutions Pack) с осушителями зонда (2
са по 3 шт./тубус)

EasyLyte®

REF 2124

Na/K/Cl/Ca/Li

ANALYZER

800 mL

Solutions Pack

Kit de solutions

Confezione di soluzioni

Lösungspackung

Embalagem de Soluções

Kit de soluciones



Store at $+25^{\circ}\text{C}$
 $\pm 2^{\circ}\text{C}$



mediascorp.com/support



2017-08-23



17240/1



2019-08-17

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

MEDICA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA

Medica Corporation, 100 Park Drive
Billerica, MA 01821, USA



Remove the RED CAP and LABELS.
Then insert PACK in analyzer.

Rimuovere il TAPPO ROSSO e
l'ETICHETTA, quindi inserire il
PACK nell'ANALIZZATORE.

Retirer les COUVERTURES ROUGES et
les ETIQUETTES, puis insérer le PACK
dans l'analyseur.

ROTE KAPPE und ETIQUETT
entfernen, dann PACK in
ANALYSATOR einstecken.

REMOUE O TAPON ROUGE e
ETIQUETA, depois insere o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, em seguida,
insira o PACK no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.


Retire as TAMPAS VERMELHAS
e as ETIQUETAS, depois insira o
CARTUCHO no analisador.

Probe Wipers
Discard after: 50 wets/100 serum/2 weeks

Probe Wipers

Discard after: 50 wets/100 serum/2 weeks

Пакет с растворами Na/K/Cl/Ca/Li (EasyLyte® Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack) с осушителями зонда (2 тубуса по 3 шт./тубус)

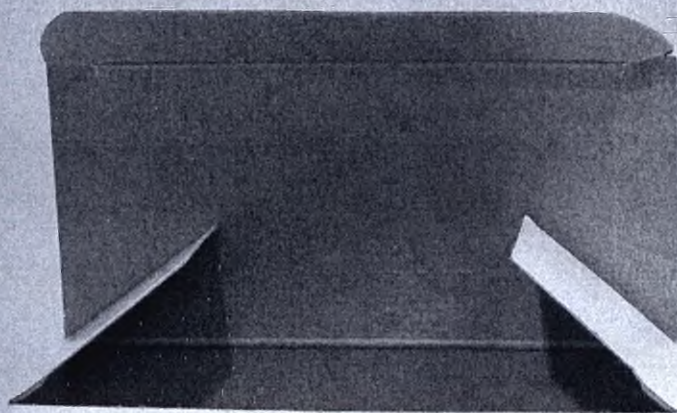

MEDICA

EasyLyte® EasyStat® EasyBloodGas™ EasyElectrolytes™

REF 2118

Daily Rinse/Cleaning Solution Kit

Kit de solution de rinçage et de nettoyage quotidien
Kit di soluzione per pulizia e risciacquo giornalieri
Satz für tägliche Spül- und Reinigungsarbeiten
Kit con soluzione para lavado/limpieza diarios
Kit de solução de limpeza diária/lavagem diária
Günlük Temizleme/Temizleme Solüsyon Kit

LOT 17159

2019-05-23

2017-06-06

(01) 00386100002398
(10) 17159
(11) 170906



Store at 25°C
4°C

For use with Medica Analyzers.
Contenuto: 1 bottle, 50 ml, daily rinse/cleaning diluent;
6 bottles, 0.50 g pepsin.
Pour l'usage avec des analyseurs de Medica.
Per uso con gli analizzatori di Medica.
Für Gebrauch mit Medica Analysatoren.
Para uso con los analizadores de Medica.
Para o uso com analisadores de Medica.
EasyLyte-analizatorları ile kullanılm içi.



DANGER

GTIN

H315, H319, H334, H335
P281, P284, P286, P289,
P304+P340, P305+P351+
P338, P332+P313,
P308+P313

MEDICA

EasyLyte® EasyStat® EasyBloodGas™

50 mL

Daily Rinse/Cleaning Diluent
Solution quotidienne de rinçage et de nettoyage
Soluzione per pulizia e risciacquo giornalieri
Satz für tägliche Spül- und Reinigungsarbeiten
Kit con solución para lavado/limpieza diarios

LOT 17157

2019-05-23

2017-06-06

(01) 00386100002398
(10) 17157
(11) 170906
(17) 190523
(422) 840

GTIN

LOT

PROD DATE

EXPIRY

ORIGIN US

CE

17157

170906

190523

840

GTIN

LOT

PROD DATE

EXPIRY

ORIGIN US

CE

17157

170906

190523

840

GTIN

LOT

PROD DATE

EXPIRY

ORIGIN US

CE

17157

170906

190523

840

GTIN

LOT

PROD DATE

EXPIRY

ORIGIN US

CE


17157

170906

190523

840

лабор реагентов для ежедневной промывки (Daily Rinse/Cleaning Solution Kit): разбавитель, 1 флакон x 50 мл; пепсин, 6 флаконов x 0,50 г

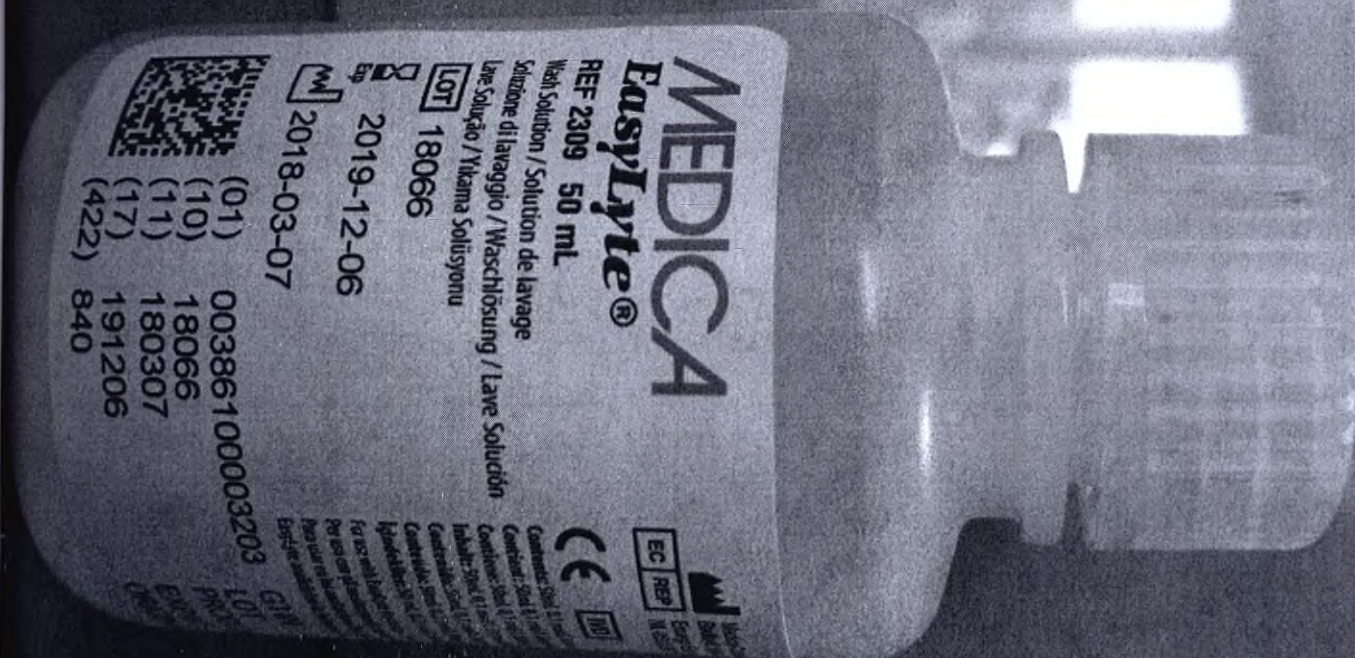

MEDICA
EasyLyte®

REF 2309 50 ml

Wash Solution / Solution de lavage
Soluzione di lavaggio / Waschlösung / Lave Solution
Lave Solução / Yıkama Solüsyonu


LOT 18066

EXP 2019-12-06

MM 2018-03-07



(01) 00386100003203
(10) 18066
(11) 180307
(17) 191206
(422) 840



CE
EC REP
MKT
G11
LOT
PVC
EVA
G11

твор промывочный (Wash Solution)

Кат. № 2109
Lot № 10066
Годен до: 12.2019
Материалы расходные и анализаторы газов и электролитов серии
EasyBloodGas®. EasyStat®, EasyStat® для лабораторной диагностики in vitro:
Раствор промывочный (Wash Solution)
Объем: 500 мл
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01710 USA
Транспортировка при температуре 4-25 °C. Хранить при температуре 4-25 °C
Не замораживать
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007.00513 от 22.11.2007 г.
Для лабораторной диагностики in vitro
Основные свойства и характеристики: состав, правила и условия использования: см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы
по товару доступны на сайте www.analytica.ru
Уполномоченный представитель в РФ
ООО "АНАЛИТИКА", 129143, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Раствор промывочный (Wash Solution)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2111 500 mL

Urine Diluent

Diluant d'urine

Diluyente di urina

Urin-Verdünnungsmittel

Diluyente de orina

Diluyente de urina

İdrar Dilüenti



18078



2019-06-27



2018-03-19



(01)

00386100003038

(10)

18078

(11)

180319

(17)

190627

(422)

840



For use with EasyLyte Analyzers.

Contents: 5.2 mmol/L magnesium acetate.

Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.

Contient: 5.2 mmol/l acétate de magnésium.

Per uso con gli analizzatori EasyLyte.

Contiene: 5.2 mmol/l acetato di magnesio.

Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.

Inhalt: 5.2 mmol/l Magnesiumacetat.

Para usar en los analizadores EasyLyte.

Contenido: 5.2 mmol/l de acetato de magnesio.

Para utilizar com analisadores EasyLyte.

Conteúdo: acetato de magnésio 5.2 mmol/l.

EasyLyte analizatorien an kottimies pika.

Isinduktori: 5.2 mmol/l magnesiumacetat.

GTIN


LOT

PROD DATE

EXPIRY

ORIGIN US

Дилуент мочи (Urine Diluent)

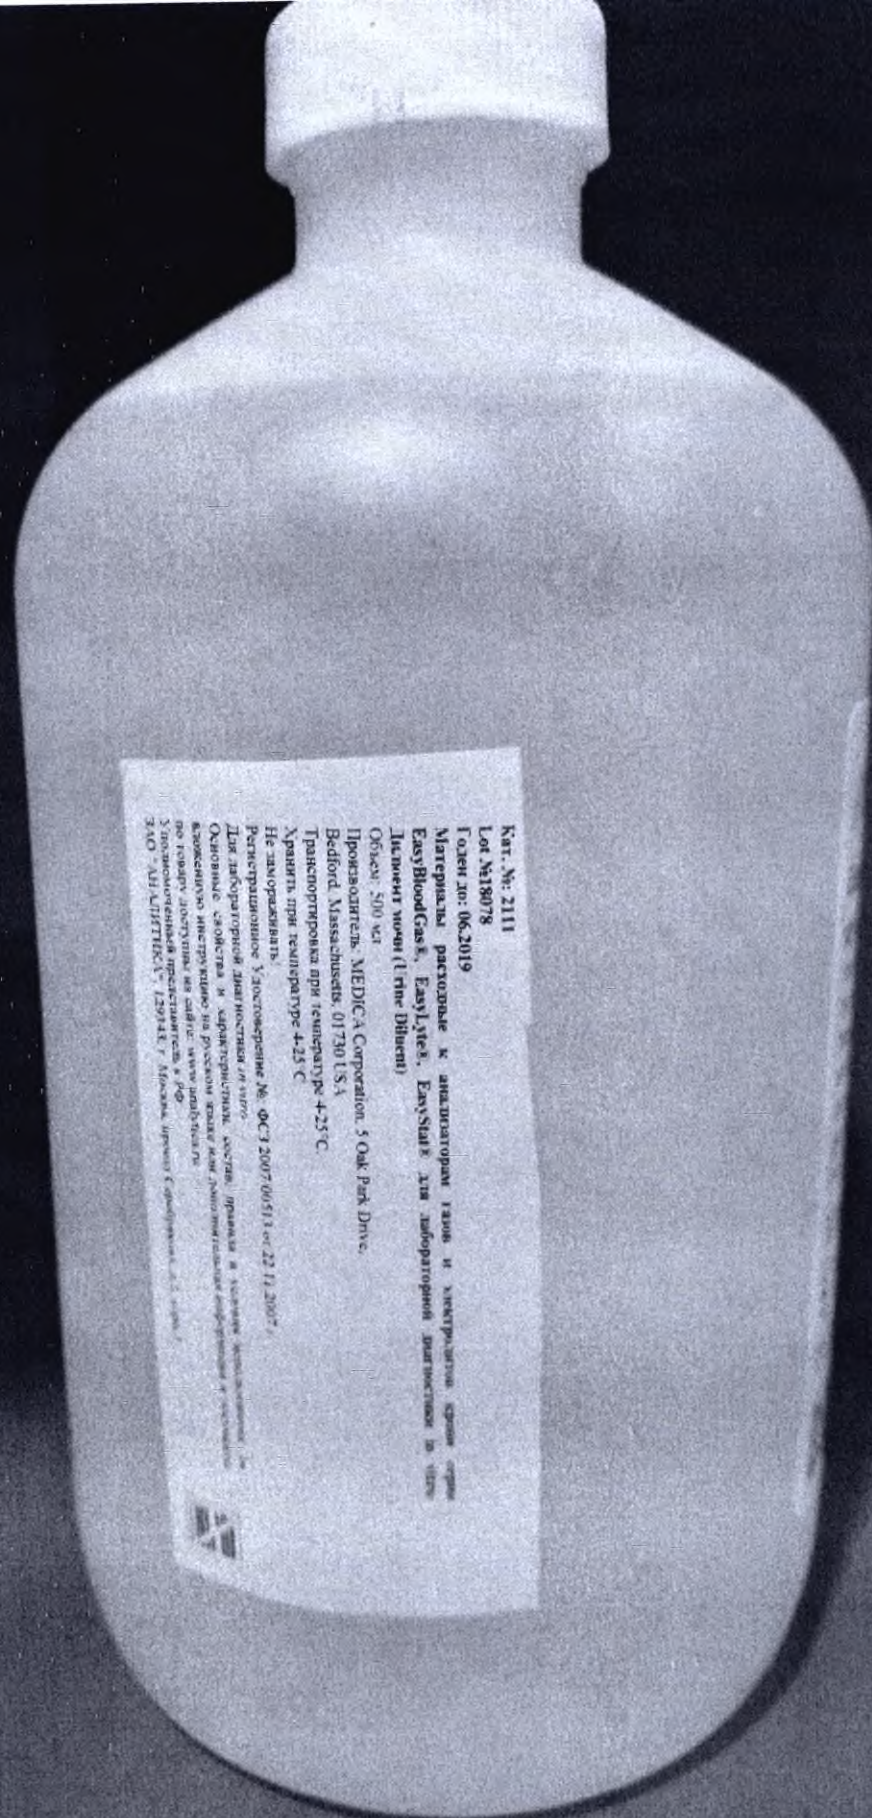

Кат. № 2111
Lot №18078
Годен до: 06.2019
Материалы расходуемые к анализаторам IAHB и микроустройства серии
EasyBloodGas®, EasyUrea®, EasyStat® для лабораторной диагностики *in vitro*
Исцеляет мочу (Urine Diluent)
Объем: 500 мл
Продавец: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA
Транспортная температура +25°C
Хранить при температуре +25°C
Не замораживать.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/06511 от 22.11.2007
Для лабораторной диагностики *in vitro*.
Основное устройство и комплектация: анализатор, программное обеспечение, анализатор,
комплектация: инструкция по русскому языку для лабораторной диагностики и инструкции
по технике безопасности из серии: инструкция по технике безопасности и инструкции
3-го издания. Издательство: 129143, г. Москва, проспект С. Островского, д. 1, стр. 1
ООО «АН ЛИТЕК»

Дилуэнт мочи (Urine Diluent)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2492

Internal Filling Solution

Solution de remplissage interne

Soluzione Riempimento Interno

interne Füll-Lösung

Solución de relleno interna

Solução de enchimento interno

Dahilli Doldurma Solüsyonu



18074



2019-06-28



2018-03-15



(01) 00386100003210
(10) 18074
(11) 180315
(17) 190628
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
EXPIRY
ORIGIN US

CE

For use with
Contact
Portuguese
Contact
Per use
Contact
For use
Contact
For use
Contact
For use
Contact
For use
Contact

Раствор для заполнения внутренней камеры (Internal Filling Solution)

Сер. № 1282
 Изд. № 19074
 Дата: 06.2019
 Материал: раствор для заполнения внутренней камеры и электролитом вольта-серен
 EasyFilling Solution, EasyFilling, для лабораторной электролитической ячейки
 Раствор для заполнения внутренней камеры (Internal Filling Solution)
 Состав: 1 л воды
 Препараты: EasyFilling, 5 Oak Park Drive
 01730 USA
 Температура при температуре 4-25 °C. Хранить при температуре 4-25 °C
 Не подвергать воздействию света
 Регистрационный номер: № 0123200710513 от 22.11.2007 г.
 Для лабораторной электролитической ячейки, применяя в условиях использования см.
 инструкцию по эксплуатации на русском языке и не предоставляя информации и документации
 на русском языке на сайте: www.easyfilling.ru
 Указательный продукт: EasyFilling, 2 л, версия 1



Раствор для заполнения внутренней камеры (Internal Filling Solution)

MEDICA
EasyLyte®

REF 2577 50 mL

Standard Solution, Urine / Solution étalon, urine
Soluzione titolata, Urina / Standard Lösung, Urin
Solución estándar, orina / Solução standard, urina

LOT

17886

Exp

2019-01-12

Exp

2017-10-10



(01)	00386100000440
(10)	17886
(11)	171010
(17)	190112
(422)	840

EC REP

CE

IVD

Na -160+/-8, K -60+/-3

For use with EasyLyte Analyzer
Pour l'usage avec des analyseurs
Per uso con gli analizzatori
Für Gebrauch mit EasyLyte
Para usar en los analizadores
Para utilizar com analisadores

GTIN
LOT
PROD
EXPIR
ORIG

Medica Corporation
Bedford, MA 01730
Emergo Europe
NL-2513 BA Zoetermeer

стандартный раствор мочи (Standard Solution Urine)

Кат. №: 2577
Lot №17886
Годен до: 01.2019
Материалы расфасованы в анализаторам газов и электролитов крови серии
EasyBloodGas®, EasyLyte®, EasyStat® для лабораторной диагностики *in vitro*:
Стандартный раствор мочи (Standard Solution Urine)
Объем: 50 мл
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA
Транспортировка при температуре 4-25°C. Хранить при температуре 4-25°C
Не замораживать.
Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2907/00513 от 22.11.2007 г.
Для лабораторной диагностики *in vitro*:
Основное свойство и характеристики: состав, правила и условия использования см.
кложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО "АНАЛИТИКА", 129143, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1

Стандартный раствор мочи (Standard Solution Urine)

MEDICA

EasyQC®

CONTROL



IVD

Store at
2°C - 8°C

Bi-Level Quality Control Kit

REF 2814

LEVEL 1

LEVEL 2

Contents: 10 mL Level 1 (Normal), 10 mL Level 2 (Abnormal High)

Contient: 10 mL Niveau 1 (Normal), 10 mL Niveau 2 (Anormalement élevé)

Contenuto: 10 ml Livello 1 (Normale), 10 ml Livello 2 (Eccezionalmente alto)

Inhalt: 10 ml Level 1 (normal), 10 ml Level 2 (anomal hoch)

Contenido: 10 ml Nivel 1 (normal), 10 ml Nivel 2 (anormal elevado)


Conteúdo: 10 ml Nível 1 (Normal), 10 ml Nível 2 (Anormal Elevado)

İçindekiler: 10 mL seviye 1 (normal), 10 mL seviye 2 (aşırı yüksek)

For use with Electrolyte Analyzers.



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, Massachusetts 01730-1413



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands

005547-001 R4

Материалы контрольных материалов (Easy QC® Bi-Level Quality Control Kit): раствор 1, 1 флакон x 10 мл;
раствор 2, 1 флакон x 10 мл

CONTROL 10 mL
Level 1: Normal • Niveau 1: Normal
Livello 1: Normale • Level 1: Normal
Nível 1: normal • Nivel 1: Normal
MEDICA **IVD**

Level 2 (Abnormal)
CONTROL 10 mL
Level 2: Abnormal High • Niveau 2: Haute
Livello 2: Eccezionalmente alto
Nível 2: anormal elevado • Nivel 2:
水平2 (高水準)
MEDICA **IVD**

Набор контрольных материалов (Easy QC® Bi-Level Quality Control Kit): раствор 1, 1 флакон x 10 мл;
раствор 2, 1 флакон x 10 мл

MEDICA
EasyQC®

CONTROL

CE

IVD

Store at
2°C

Tri-Level Quality Control Kit
REF 2815

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

Contents: 10 mL Level 1 (Normal), 10 mL Level 2 (Abnormal High), 10 mL Level 3 (Abnormal Low)

Contient: 10 mL Niveau 1 (Normal), 10 mL Niveau 2 (Anormalement élevé), 10 mL Niveau 3 (Anormalement faible)

Contenuto: 10 ml Livello 1 (Normale), 10 ml Livello 2 (Eccezionalmente alto), 10 ml Livello 3 (Eccezionalmente basso)

Inhalt: 10 ml Level 1 (normal), 10 ml Level 2 (anomal hoch), 10 ml Level 3 (anomal niedrig)

Contenido: 10 ml Nivel 1 (normal), 10 ml Nivel 2 (anormal elevado), 10 ml Nivel 3 (anormal bajo)

Conteúdo: 10 ml Nível 1 (Normal), 10 ml Nível 2 (Anormal Elevado), 10 ml Nível 3 (Anormal Baixo)

Içindekiler: 10 mL seviye 1 (normal), 10 mL seviye 2 (aşırı yüksek), 10 mL seviye 3 (aşırı düşük)

For use with Electrolyte Analyzers.




Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, Massachusetts 01730-1413

EC REP


Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands

005548-001 R4


Набор контрольных материалов (Easy QC® Tri-Level Quality Control Kit): раствор 1, 1 флакон x10 мл;
раствор 2, 1 флакон x10 мл; раствор 3, 1 флакон x10 мл

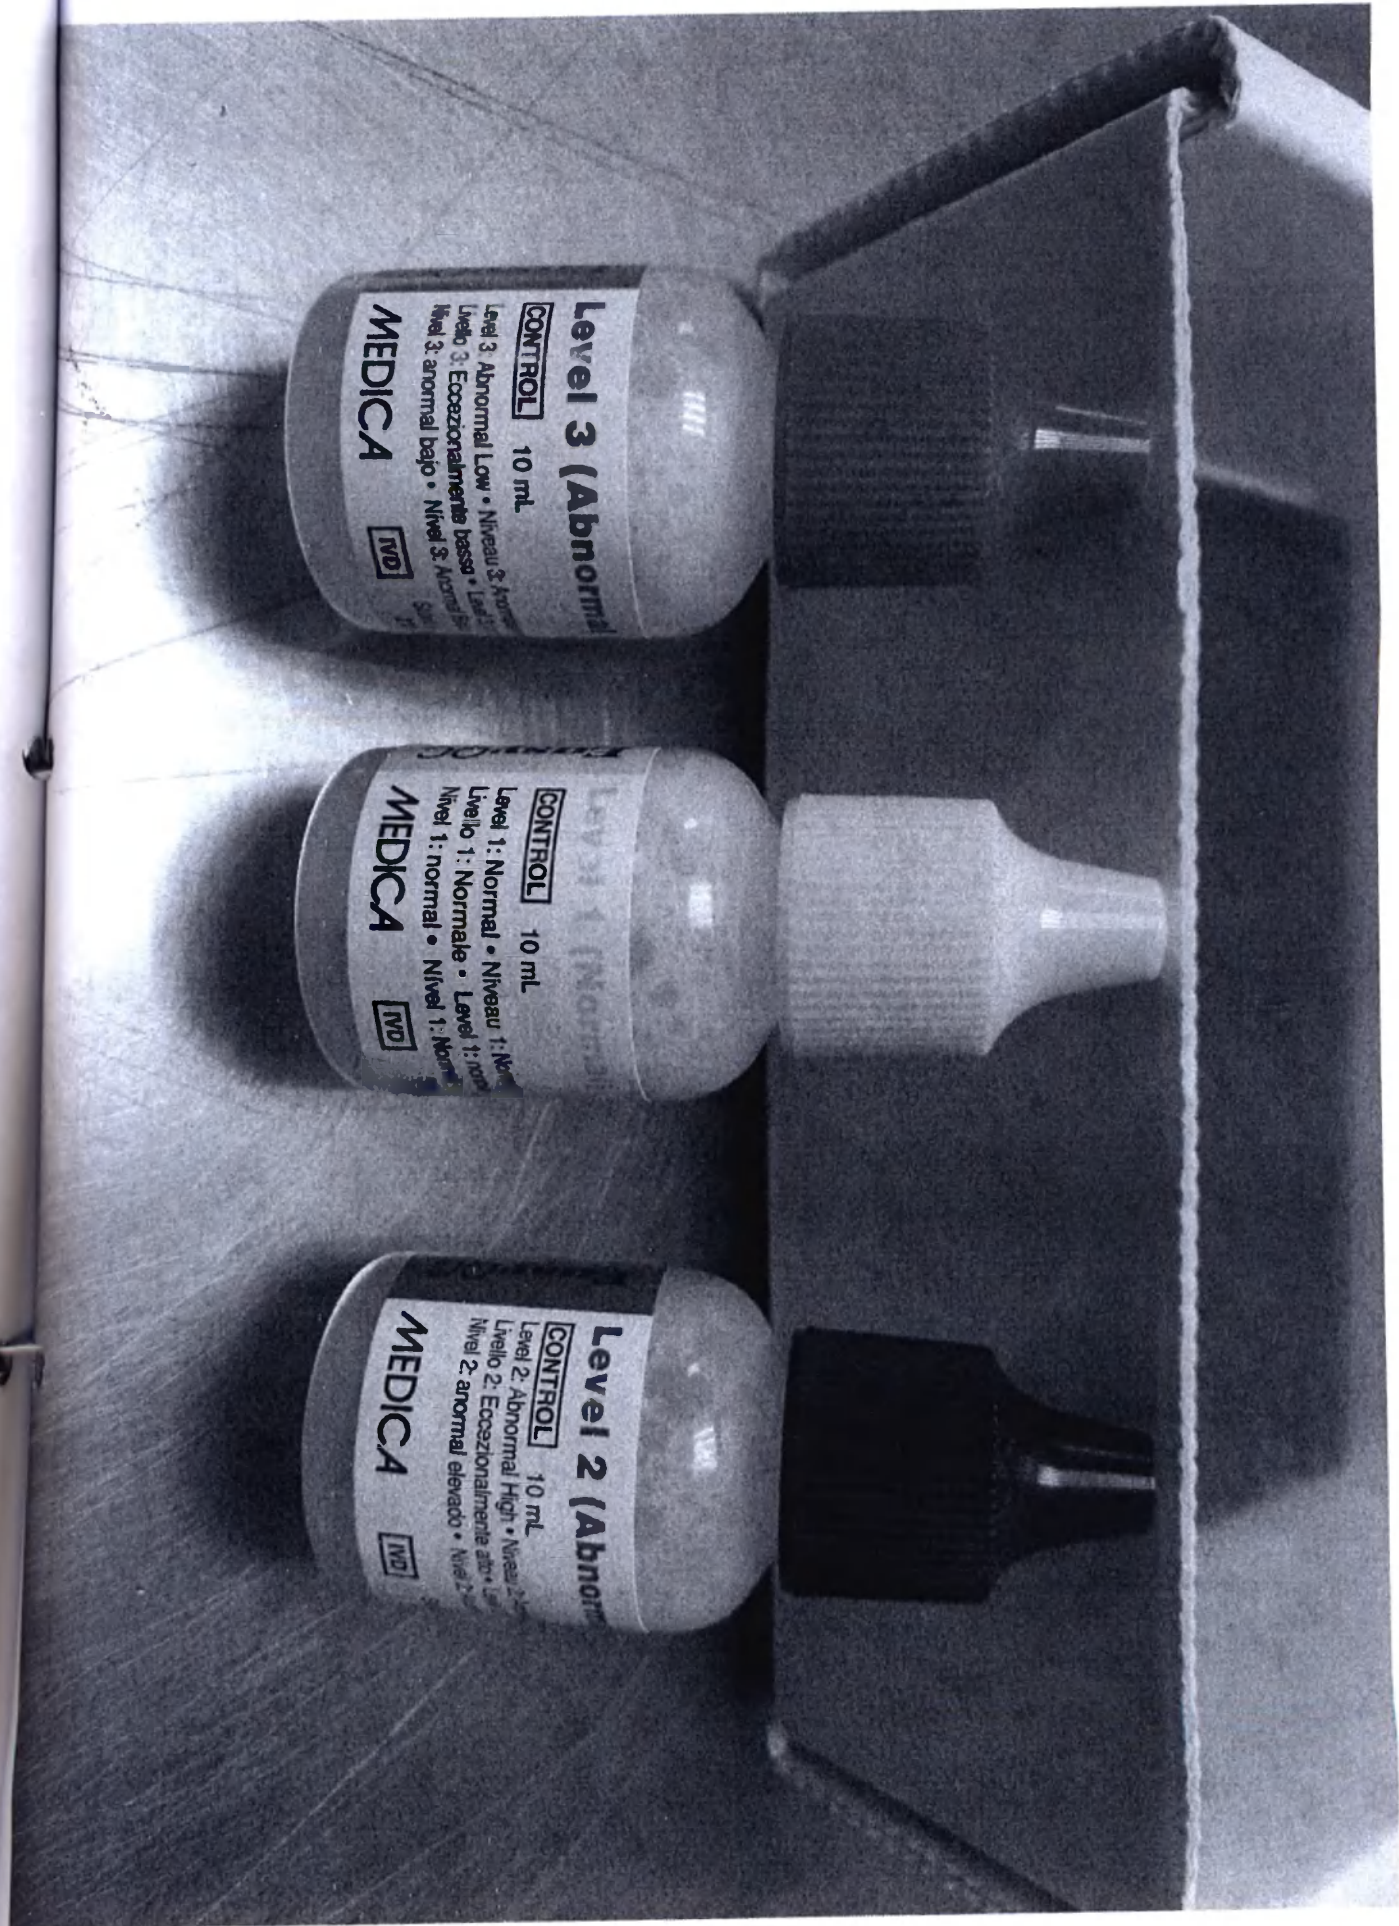


Набор контрольных материалов (Easy QC® Tri-Level Quality Control Kit): раствор 1, 1 флакон x10 мл; раствор 2, 1 флакон x10 мл; раствор 3, 1 флакон x10 мл

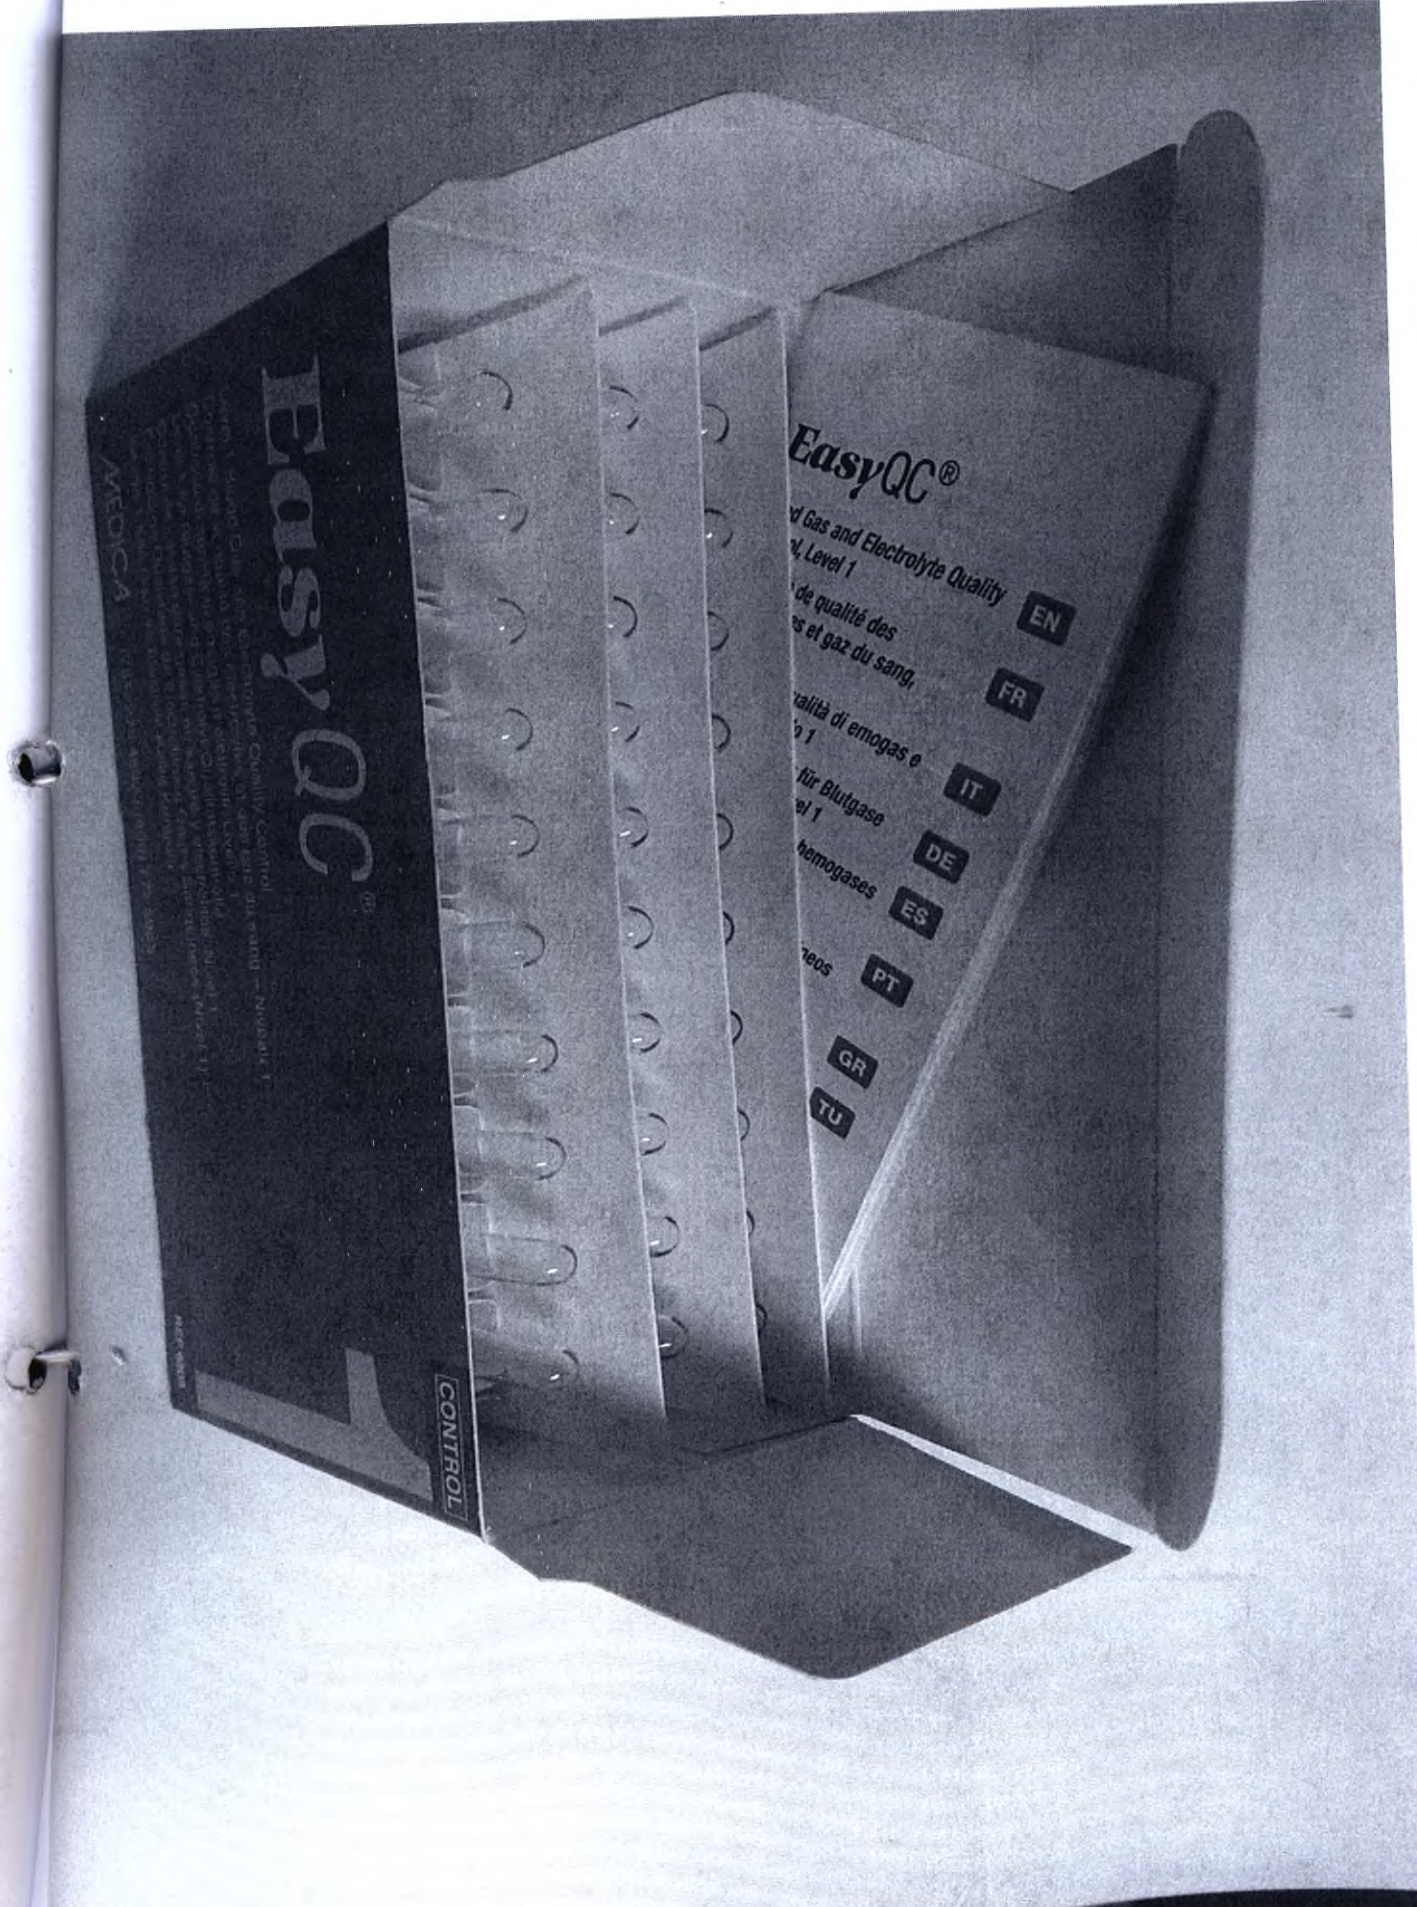

Набор контрольных материалов, уровень 1 (Easy QC® Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 1 уровня, 30 ампул x 1,7 мл

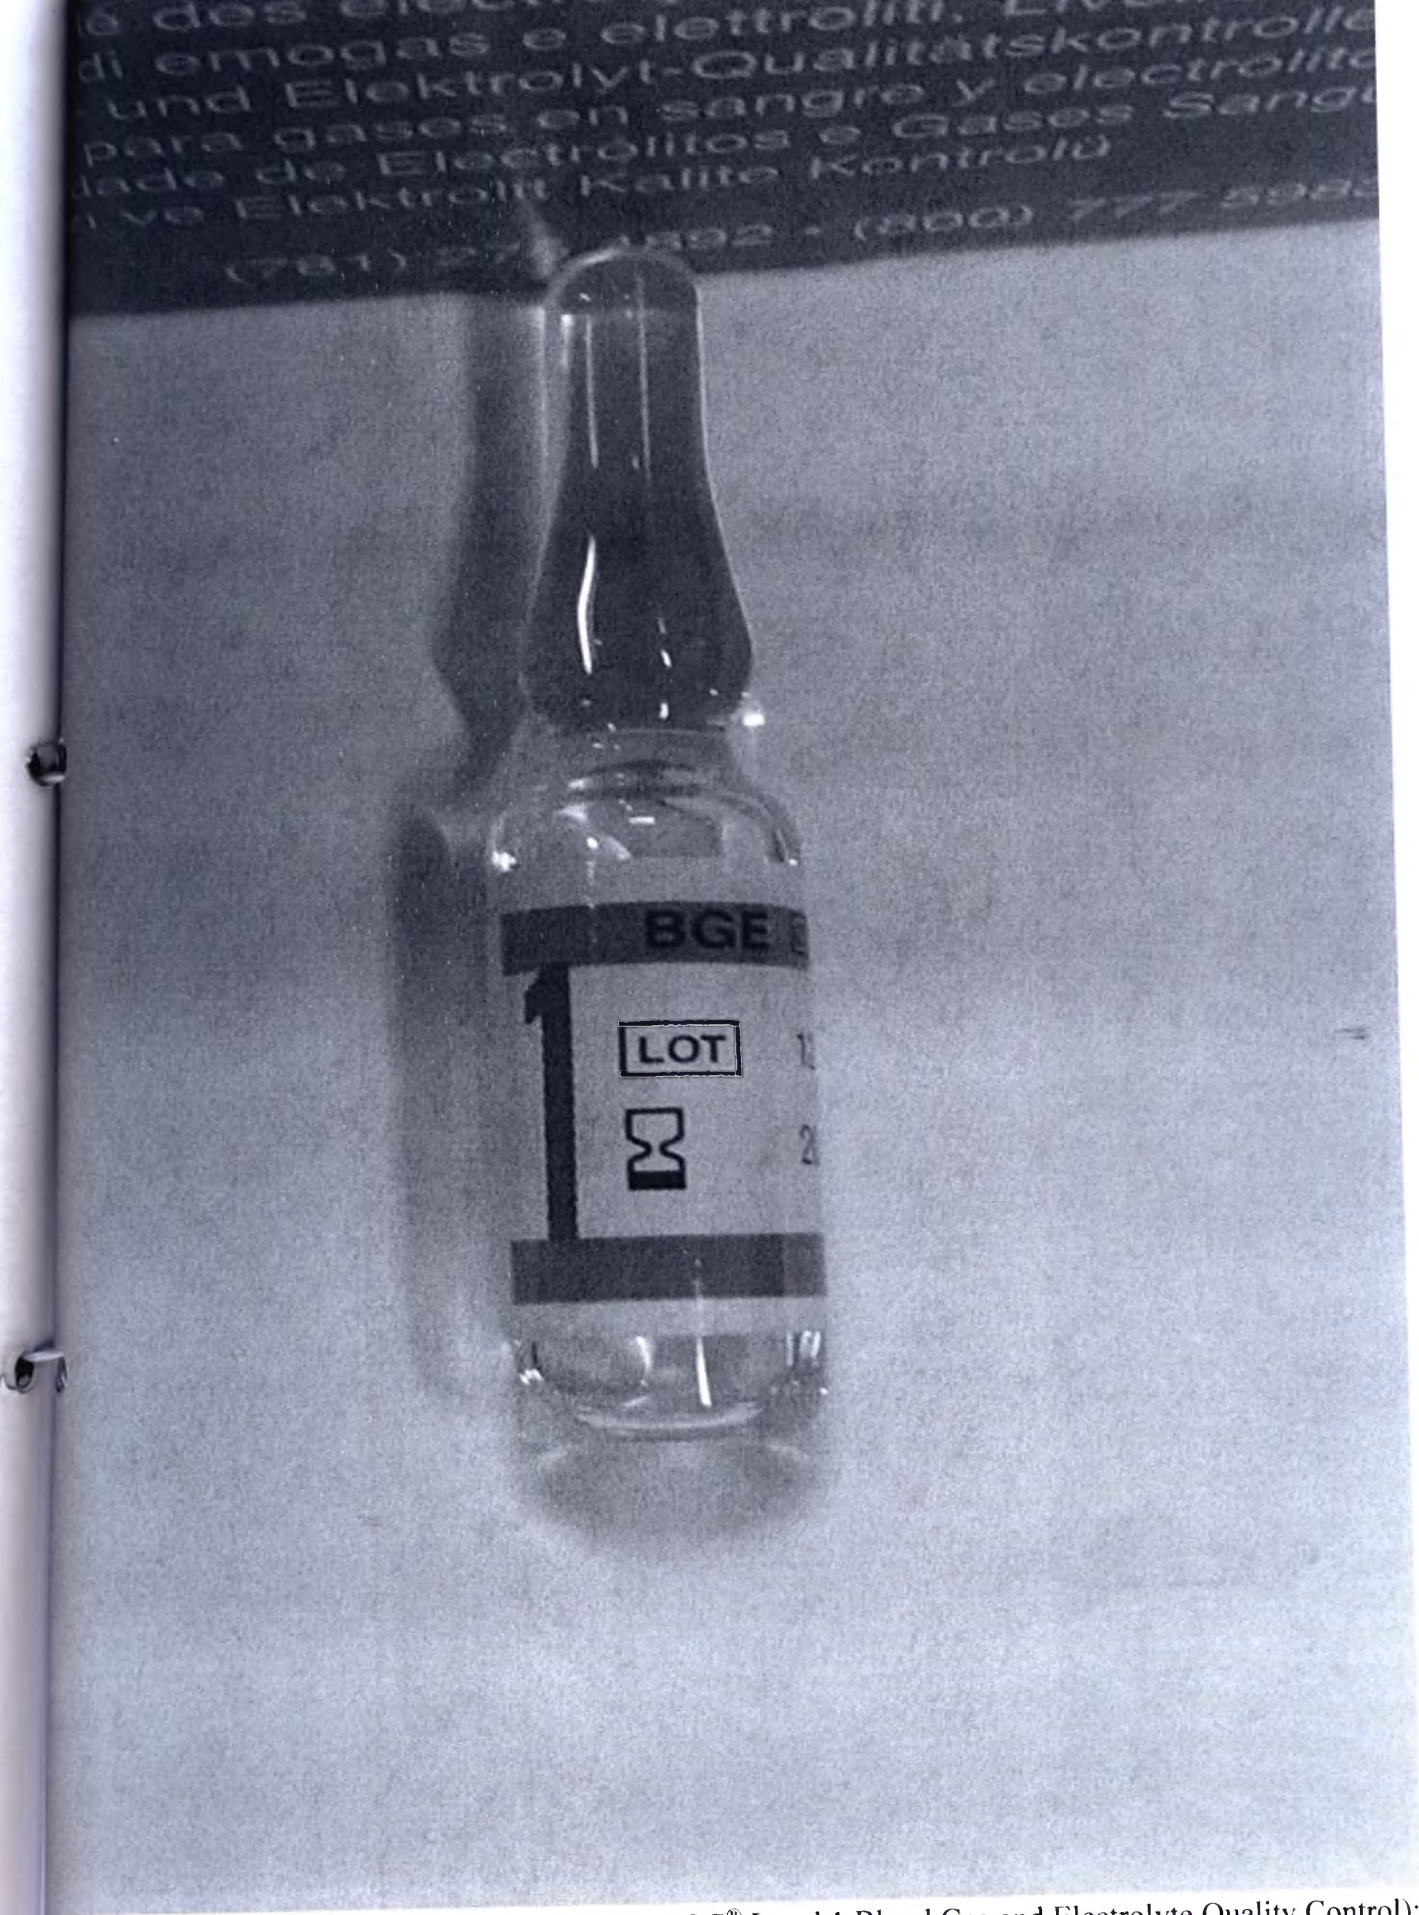

Набор контрольных материалов, уровень 1 (Easy QC[®] Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 1 уровня, 30 ампул x 1,7 мл

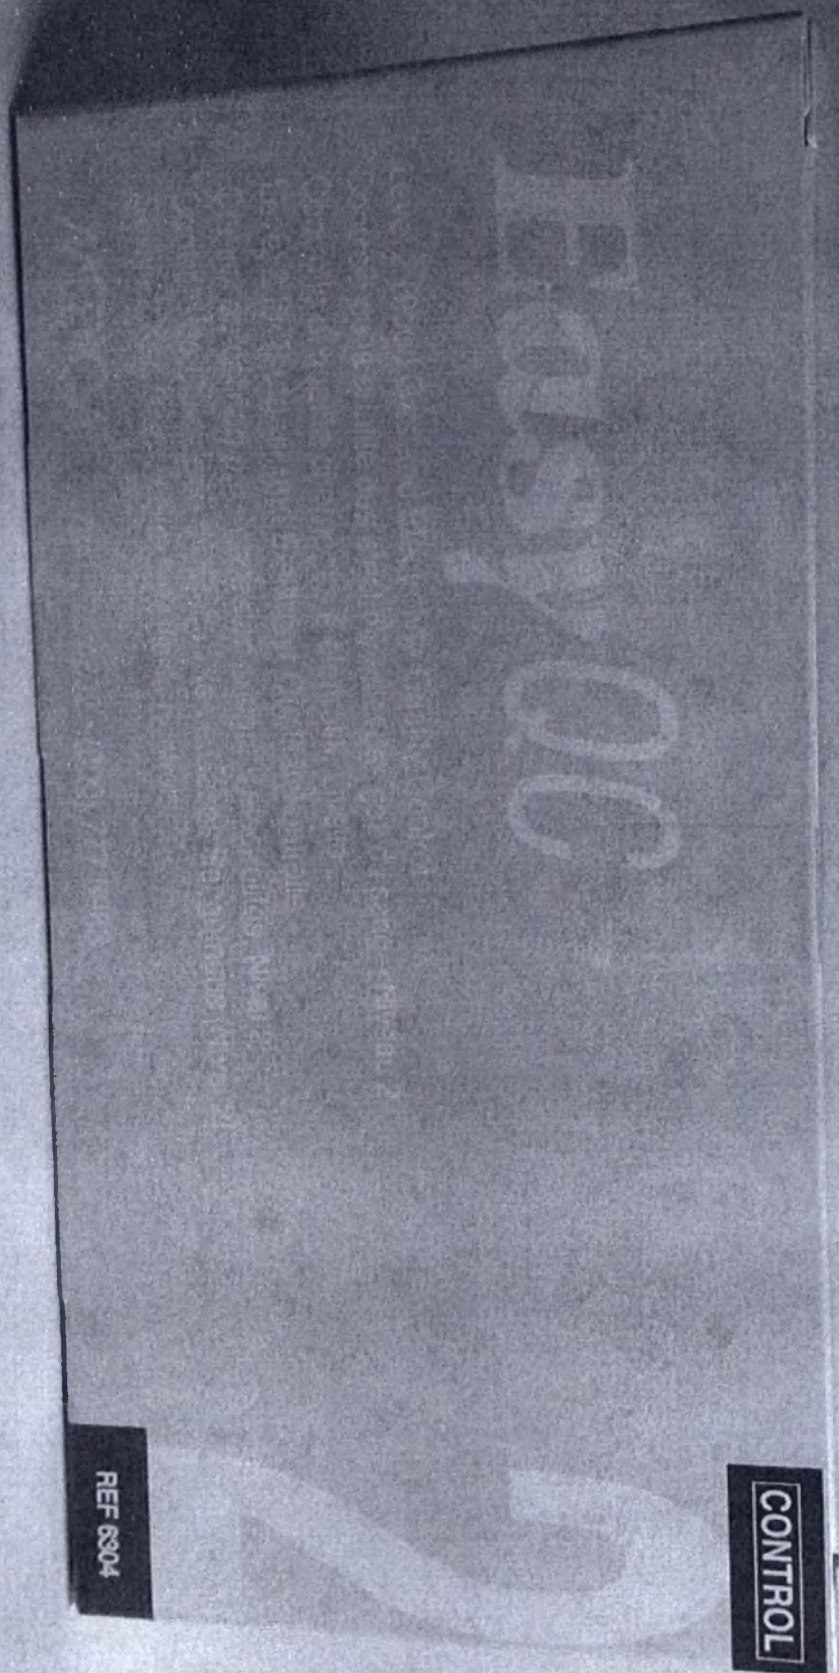

Набор контрольных материалов, уровень 2 (Easy QC® Level 2 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 2 уровня, 30 ампул x 1,7 мл



Набор контрольных материалов, уровень 2 (Easy QC[®] Level 2 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 2 уровня, 30 ампул x 1,7 мл

Easy QC®

Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control

Contrôle de la qualité des électrolytes et des gaz du sang – Niveau 3

Controllo di qualità di emogas e elettroliti, Livello 3

Level 3 für Blutgas- und Elektrolyt-Qualitätskontrolle

Control de calidad para gases en sangre y electrolitos, Nivel 3

Controlo de Qualidade de Electrólitos e Gases Sanguíneos (Nível 3)

Seviye 3 Kan Gazı ve Elektrolit Kalite Kontrolü

MEDICA


(781) 275 4892 • (800) 777 5983

CONTROL

REF 6305

Набор контрольных материалов, уровень 3 (Easy QC® Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 3 уровня, 30 ампул x 1,7 мл

Level 3
05 (Nivel 3)

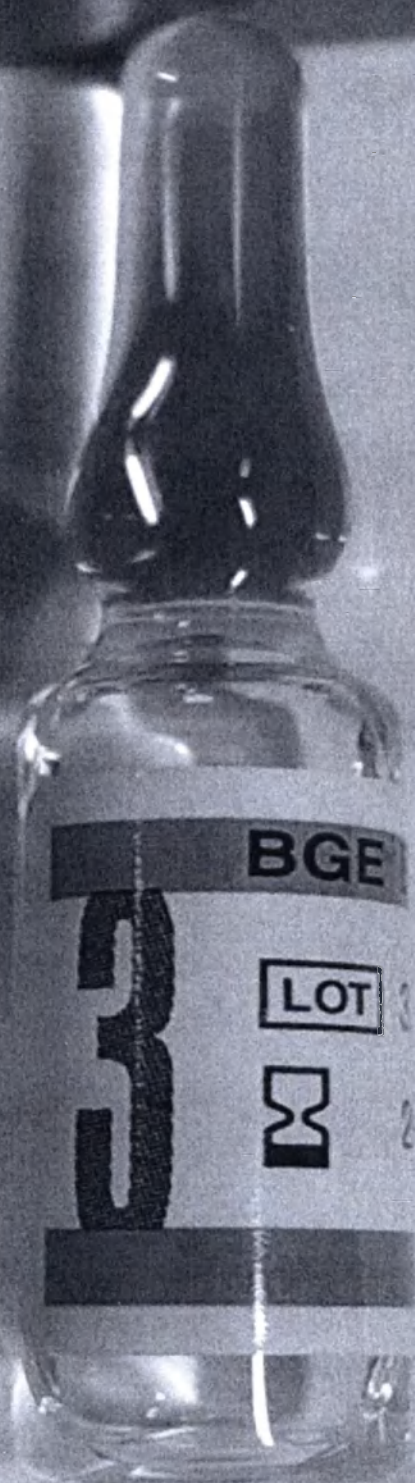

Набор контрольных материалов, уровень 3 (Easy QC[®] Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control):
контрольные растворы газов 3 уровня, 30 ампул x 1,7 мл

Easy QC[®]


Bi-Level Hematocrit Quality Control
Contrôle de la qualité de l'hématocrite à deux niveaux
Controllo di qualità dell'ematocrito, due livelli
Bi-Level-Qualitätskontrolle für Hämatokrit
Control de calidad del hematócrito a dos niveles
Controlo de Qualidade em Dois Níveis para Hematócrito
İki Seviye Hematokrit Kalite Kontrolü

MEDICA (781) 275 4892 • (800) 777 5983

CONTROL

REF 7309


Набор для контроля качества определения гематокрита (Easy QC[®] Bi-Level Hematocrit Quality Control):
контрольные растворы низкого уровня, 10 ампул x 1,7 мл; контрольные растворы высокого уровня, 10
ампул x 1,7 мл

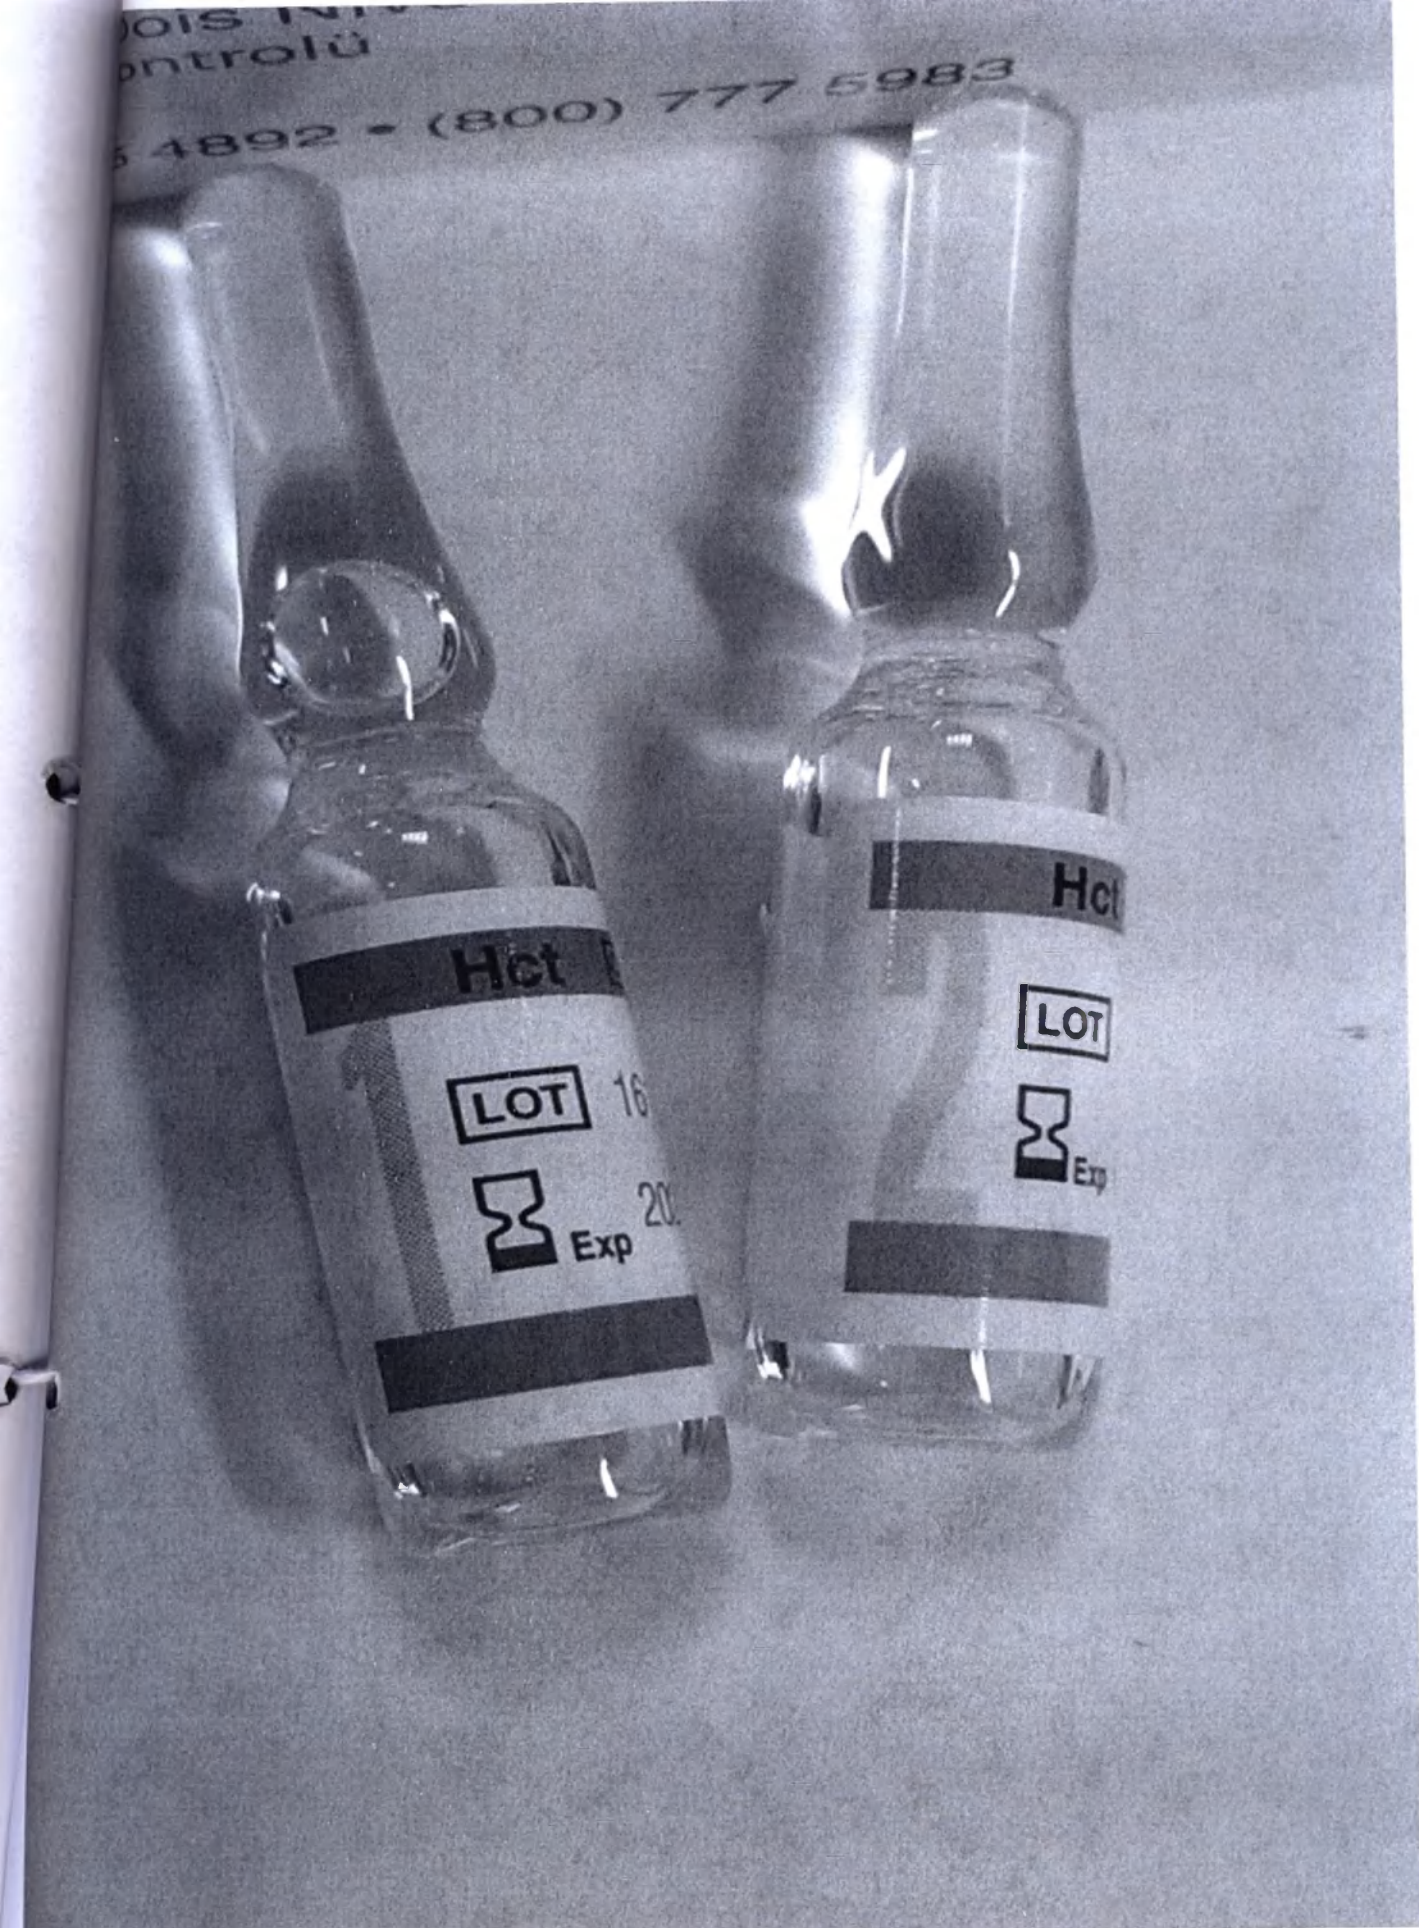

Набор для контроля качества определения гематокрита (Easy QC® Bi-Level Hematocrit Quality Control):
контрольные растворы низкого уровня, 10 ампул x 1,7 мл; контрольные растворы высокого уровня, 10
ампул x 1,7 мл



Тест-раствор окрашенный (Red Test Dye Solution)

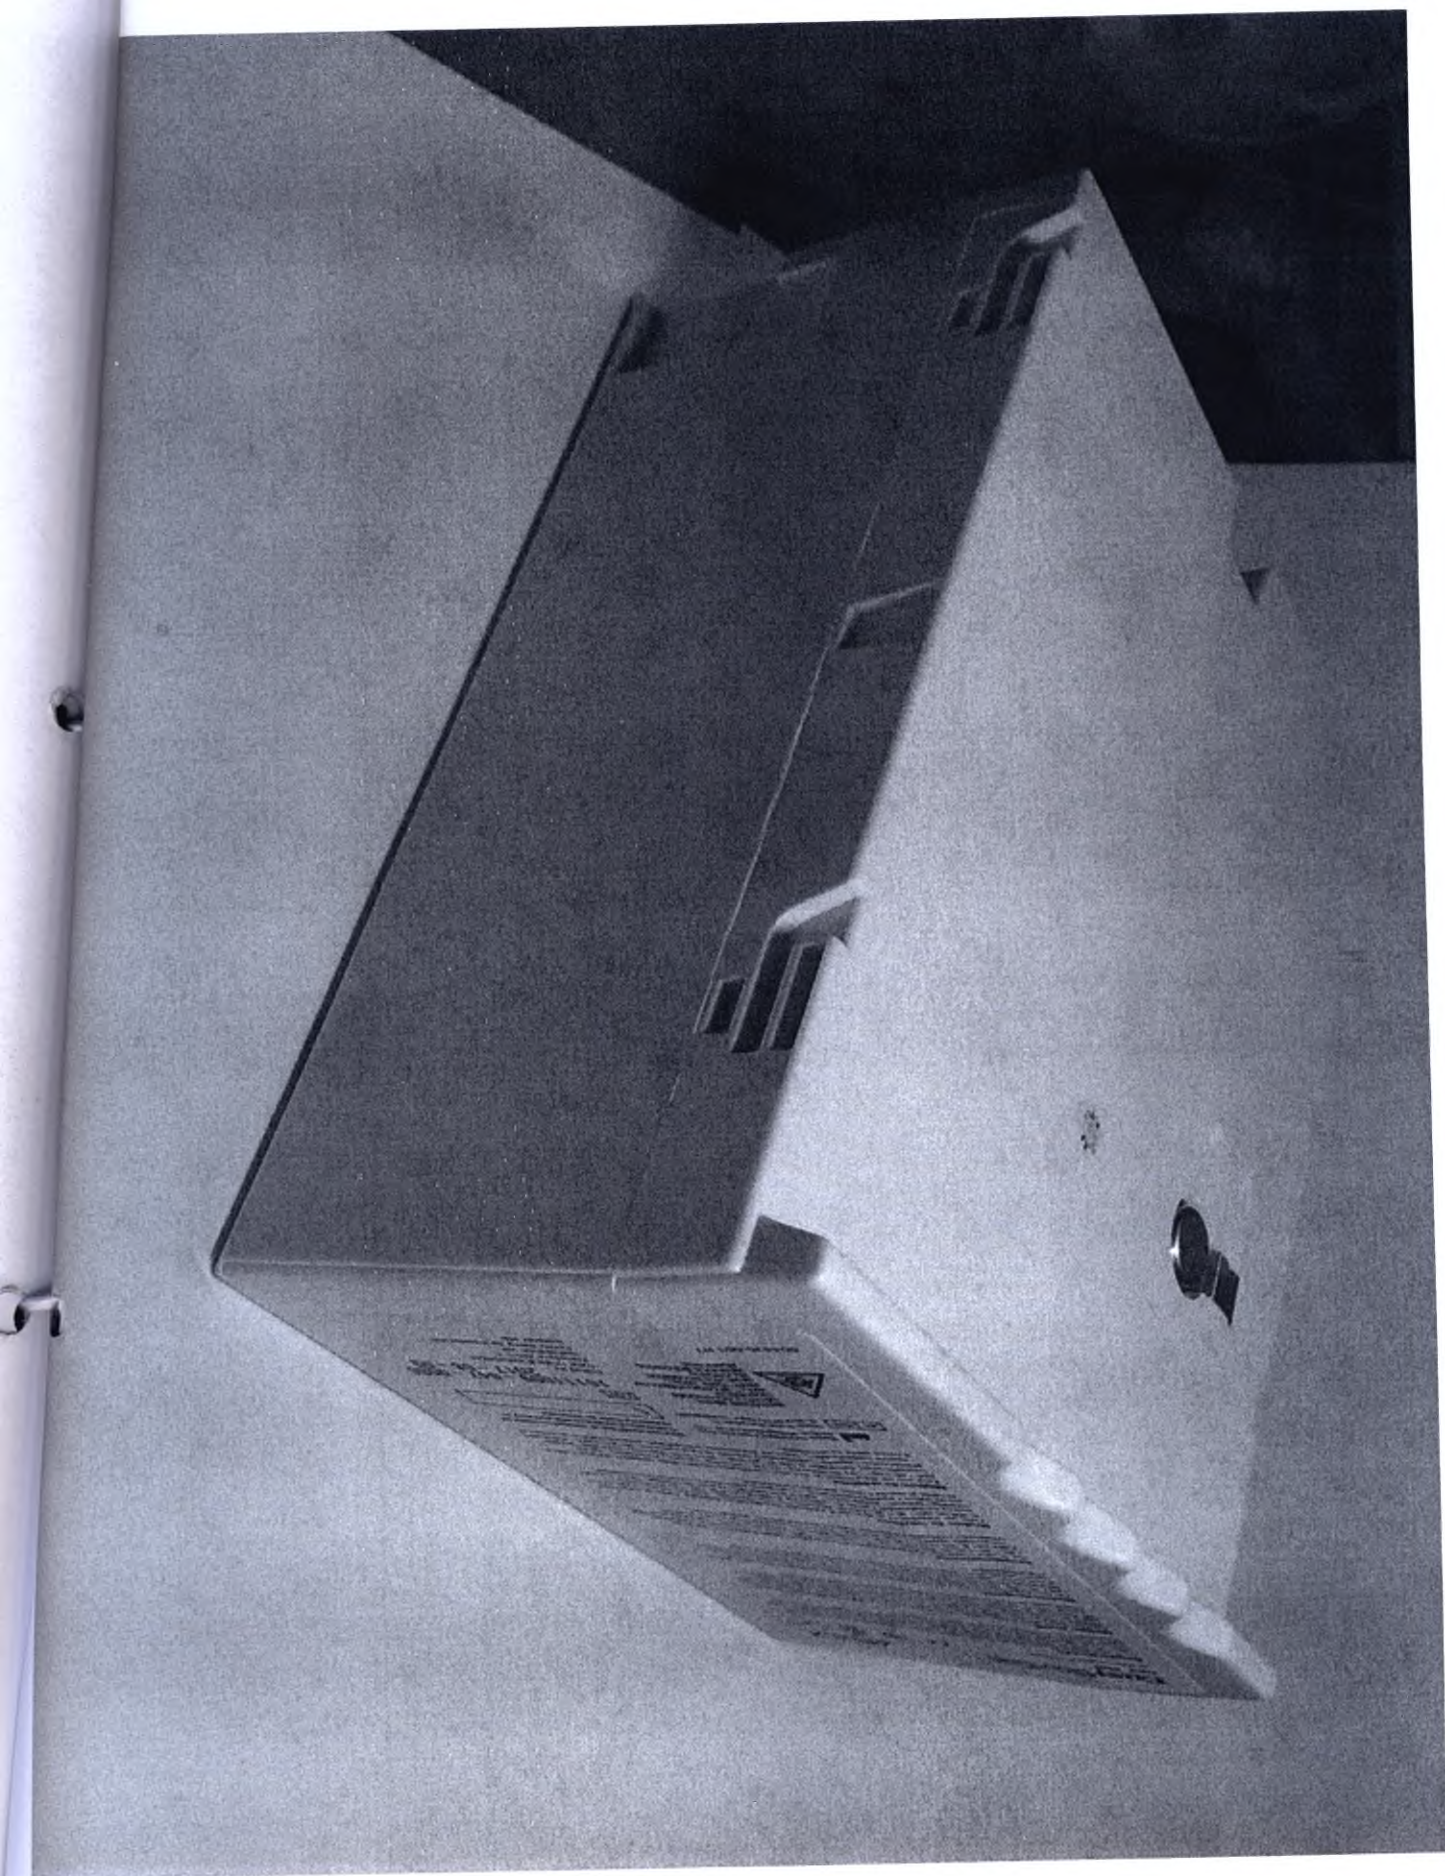

Модуль реагентный (EasyBloodGas[®] Reagent Module)

US 4808



MEDICA

EasyBloodGas®

REF 6101-0000

CE

IVD

Store at 25°C
4°C

pH/PCO₂/PO₂

For use with EasyBloodGas analyzer.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyBloodGas.
Per uso con gli analizzatori EasyBloodGas.
Für Gebrauch mit EasyBloodGas Analysator.
Para usar en los analizadores EasyBloodGas.
Para utilizar con analisadores EasyBloodGas.
EasyBloodGas Analyzörlerle kullanılmı için.

Reagent Module
Module de réactifs
Modulo Reagente
Reagens-Modul
Pack de reactivos
Módulo reagente
Reakti Paketi



18041087



2019-02-23



2018-04-27



(01) 00396100002343
(10) 18041087
(11) 180427
(15) 190223
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Europe: Europe, Netherlands 15
Nl 2019 04 The Hague
The Netherlands

002273-014 R6

Модуль реагентный (EasyBloodGas® Reagent Module)

EasyBloodGas®

REF 6101

U.S. Patents 5,983,734 6,178,832

MEDICA



Store at 4°C - 25°C

Reagent Module

For *in vitro* diagnostic use with the EasyBloodGas analyzer. Contains: Calibrant A, 550 mL (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • buffer • preservative • wetting agent); Calibrant B, 300 mL (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • buffer • preservative • wetting agent); Rinse Solution, 700 mL (buffer • preservative • wetting agent). Must be stored at room temperature for a minimum of 4 hours prior to installation.

Module réactif

Pour les diagnostics *in vitro*, utiliser ce module avec le l'analyseur EasyBloodGas. Contient: Solution d'étalonnage A, 550 mL (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • tampon • agent de conservation • agent mouillant); solution d'étalonnage B, 300 mL (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • tampon • agent de conservation • agent mouillant); Solution de rinçage, 700 mL (tampon • agent de conservation • agent mouillant). Doit être maintenu à la température de la pièce pendant au moins quatre heures avant l'installation.

Modulo Reagente

Per uso diagnostico *in vitro* con l'analizzatore EasyBloodGas. Contiene: Calibrante A, 550 mL (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • tampone • preservante • agente umettante); Calibrante B, 300 mL (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • tampone • preservante • agente umettante); Soluzione di risciacquo, 700 mL (tampone • preservante • agente umettante). Conservare a temperatura ambiente per almeno 4 ore prima dell'installazione.

Reagenzienmodul

Zur *in vitro* Diagnostik mit EasyBloodGas Analysesystem. Inhalt: Kalibrator A, 550 ml (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel); Kalibrator B, 300 ml (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel); Spüllösung, 700 ml (Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel). Muss vor Installation mindestens 4 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden.

Módulo de reactivos


Para uso diagnóstico *in vitro* con el analizador EasyBloodGas. Contiene: Patrón de calibración A, 550 mL (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • solución tampón • preservativo • agente humectante); Patrón de calibración B, 300 mL (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • tampón • preservativo • agente humectante); Solución de enjuague, 700 mL (tampón • preservativo • agente humectante). Es necesario almacenarlo a la temperatura ambiente durante al menos 4 horas antes de la instalación.

Módulo do reagente

Para uso em diagnóstico *in vitro* com o analisador EasyBloodGas. Contém: Calibrador A, 550 mL (pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40mmHg • O₂ 125-175mmHg • tampão • preservativo • agente humidificador); Calibrador B, 300 mL (pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76mmHg • O₂ 0mmHg • tampão • preservativo • agente humidificador); Solução de Enxaguamento, 700 mL (tampão • preservativo • agente humidificador). Deve ser armazenado à temperatura ambiente durante um mínimo de 4 horas antes da instalação.



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, Massachusetts 01730-1413



Emergo Europe, Molenvaart 15
NL-2513 BH The Hague The Netherlands



BIOHAZARD WASTE
DÉCHETS BIOLOGIQUES
DANGEREUX
RIFIUTI BIOLOGICI PERICOLOSI
INFECTIÖSER ABFALL
DESECHOS BIOLÓGICOS
PELIGROSOS
RESÍDUOS BIOLÓGICOS
PERIGOSOS

Date Installed/Data di installazione/Date de
l'installation/Installationsdatum/Fecha de
instalación/Data de instalação



LOT

18041087
2019-02-23

Install by:
Date limite d'installation :
Installare entro il:
Installation vor:
Fecha limite de instalación:
Instalar até:

Модуль реагентный (EasyBloodGas® Reagent Module)

Кат. №: 6101

Lot №18041087

Годен до: 02.2019

Материалы реагентов и индикаторов газов и детекторов крови серии EasyBloodGas®. EasyLact®, EasyBile® для лабораторной диагностики in vitro. Модуль реагентов (EasyMind® Reagent Module).
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730 U.S.A.

Транспортировка при температуре +25°C. Хранить при температуре +25°C. Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение № ФСЧ 2007-00513 от 22.11.2007г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Освоенные сведения и характеристики состав, правила и условия использования, а также инструкцию по применению на русском языке или равнозначной информации и доступности на интернет-портале на сайте www.abdiutils.ru

Удостоверение представлено в РФ

2/27 "АНАЛИТИКА", 129143 г. Москва, проезд Саввастьянов, д.2, корпус 1



Модуль реагентный (EasyBloodGas® Reagent Module)

EasyStat®

REF 7101

U.S. Patents 5,980,734 - 6,178,832

MEDICA



Store at 25°C
6°C

Reagent Module

For *in vitro* diagnostic use with the EasyStat analyzer. Contains: Calibrant A, 720 mL [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • buffer • preservative • wetting agent]; Calibrant B, 415 mL [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • buffer • preservative • wetting agent]; Calibrant C, 555 mL [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • buffer • preservative • wetting agent]. Must be stored at room temperature for a minimum of 4 hours prior to installation.

Module réactif

Pour les diagnostics *in vitro*, utiliser ce module avec l'analyseur EasyStat. Contient: Solution d'étalonnage A, 720 mL [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • tampon • agent de conservation • agent mouillant]; solution d'étalonnage B, 415 mL [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • tampon • agent de conservation • agent mouillant]; solution d'étalonnage C, 555 mL [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • tampon • agent de conservation • agent mouillant]. Doit être maintenu à la température de la pièce pendant au moins quatre heures avant l'installation.

Modulo Reagente

Per uso diagnostico *in vitro* con l'analizzatore EasyStat. Contiene: Calibrante A, 720 mL [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • tampone • conservante • agente umettante]; Calibrante B, 415 mL [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • tampone • conservante • agente umettante]; Calibrante C, 555 mL [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • tampone • conservante • agente umettante]. Conservare a temperatura ambiente per almeno 4 ore prima dell'installazione.

Reagenzienmodule

Zur *in vitro* Diagnostik mit EasyStat Analysesystem. Inhalt: Kalibrator A, 720 ml [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel]; Kalibrator B, 415 ml [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel]; Kalibrator C, 555 ml [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • Puffer • Konservierungsmittel • Netzmittel]. Muss vor Installation mindestens 4 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden.

Módulo de reactivos

Para uso diagnóstico *in vitro* con el analizador EasyStat. Contiene: Patrón de calibración A, 720 mL [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • solución tampón • preservativo • agente humectante]; Patrón de calibración B, 415 mL [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • tampón • preservativo • agente humectante]; Patrón de calibración C, 555 mL [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • tampón • preservativo • agente humectante]. Es necesario almacenarlo a la temperatura ambiente durante al menos 4 horas antes de la instalación.

Módulo do reagente

Para uso em diagnóstico *in vitro* com o analisador EasyStat. Contem: Calibrador A, 720 mL [pH 7.30-7.50 • CO₂ 30-40 mmHg • O₂ 125-175 mmHg • Na⁺ 135-145 mmol/L • K⁺ 3.5-4.5 mmol/L • Ca⁺⁺ 1.1-1.5 mmol/L • Cl⁻ 105-115 mmol/L • tampão • preservativo • agente humidificador]; Calibrador B, 415 mL [pH 6.80-7.00 • CO₂ 66-76 mmHg • O₂ 0 mmHg • Na⁺ 80-85 mmol/L • K⁺ 9-11 mmol/L • tampão • preservativo • agente humidificador]; Calibrador C, 555 mL [Ca⁺⁺ 2.4-3.1 mmol/L • Cl⁻ 32-38 mmol/L • tampão • preservativo • agente humidificador]. Deve ser armazenado a temperatura ambiente durante um mínimo de 4 horas antes da instalação.



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA



Emergo Europe, Molensstraat 15
NL-2513 BH The Hague, The Netherlands



BIOHAZARD WASTE
DECHETS BIOLOGIQUES DANGEREUX
INFILTRI BIOLOGICI PERICULOSI
INFECTIÖSER ABFALL
DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS
RESÍDUOS BIOLÓGICOS PERIGOSOS

Date Installed/Data di installazione/Date de
l'installation/Installationsdatum/Fecha de
instalación/Data de instalação



LOT

18051002
2019-03-09

Install by:
Date limite d'installation:
Installare entro il:
Installation vor:
Fecha límite de instalación:
Instalar até:

Модуль реагентный (EasyStat® Reagent Module)

US 4808



MEDICA

EasyStat®

REF 7101-0000

Reagent Module
Module de réactifs
Modulo Reagente
Reagens-Modul
Pack de reactivos
Módulo reagente
Reaktiv Modül

LOT 18051002

2018-03-09

2018-05-01



(01) 00366100002864 GTIN
(10) 18051002
(11) 180501
(15) 190309
(422) 840

LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europe, Molensstraat 15
NL-2513 BN The Hague
The Netherlands

CE



25°C
1°C

For use with EasyStat analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyStat.
Per uso con gli analizzatori EasyStat.
Für Gebrauch mit EasyStat Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyStat.
Para utilizar com analisadores EasyStat.
EasyStat analizatoreri he kullatnim kün.

006279-024 R7


congelado

EC REP

Emergo Europe, Molensstraat 15
NL-2513 BN The Hague, The Netherlands

UP

Модуль реагентный (EasyStat® Reagent Module)

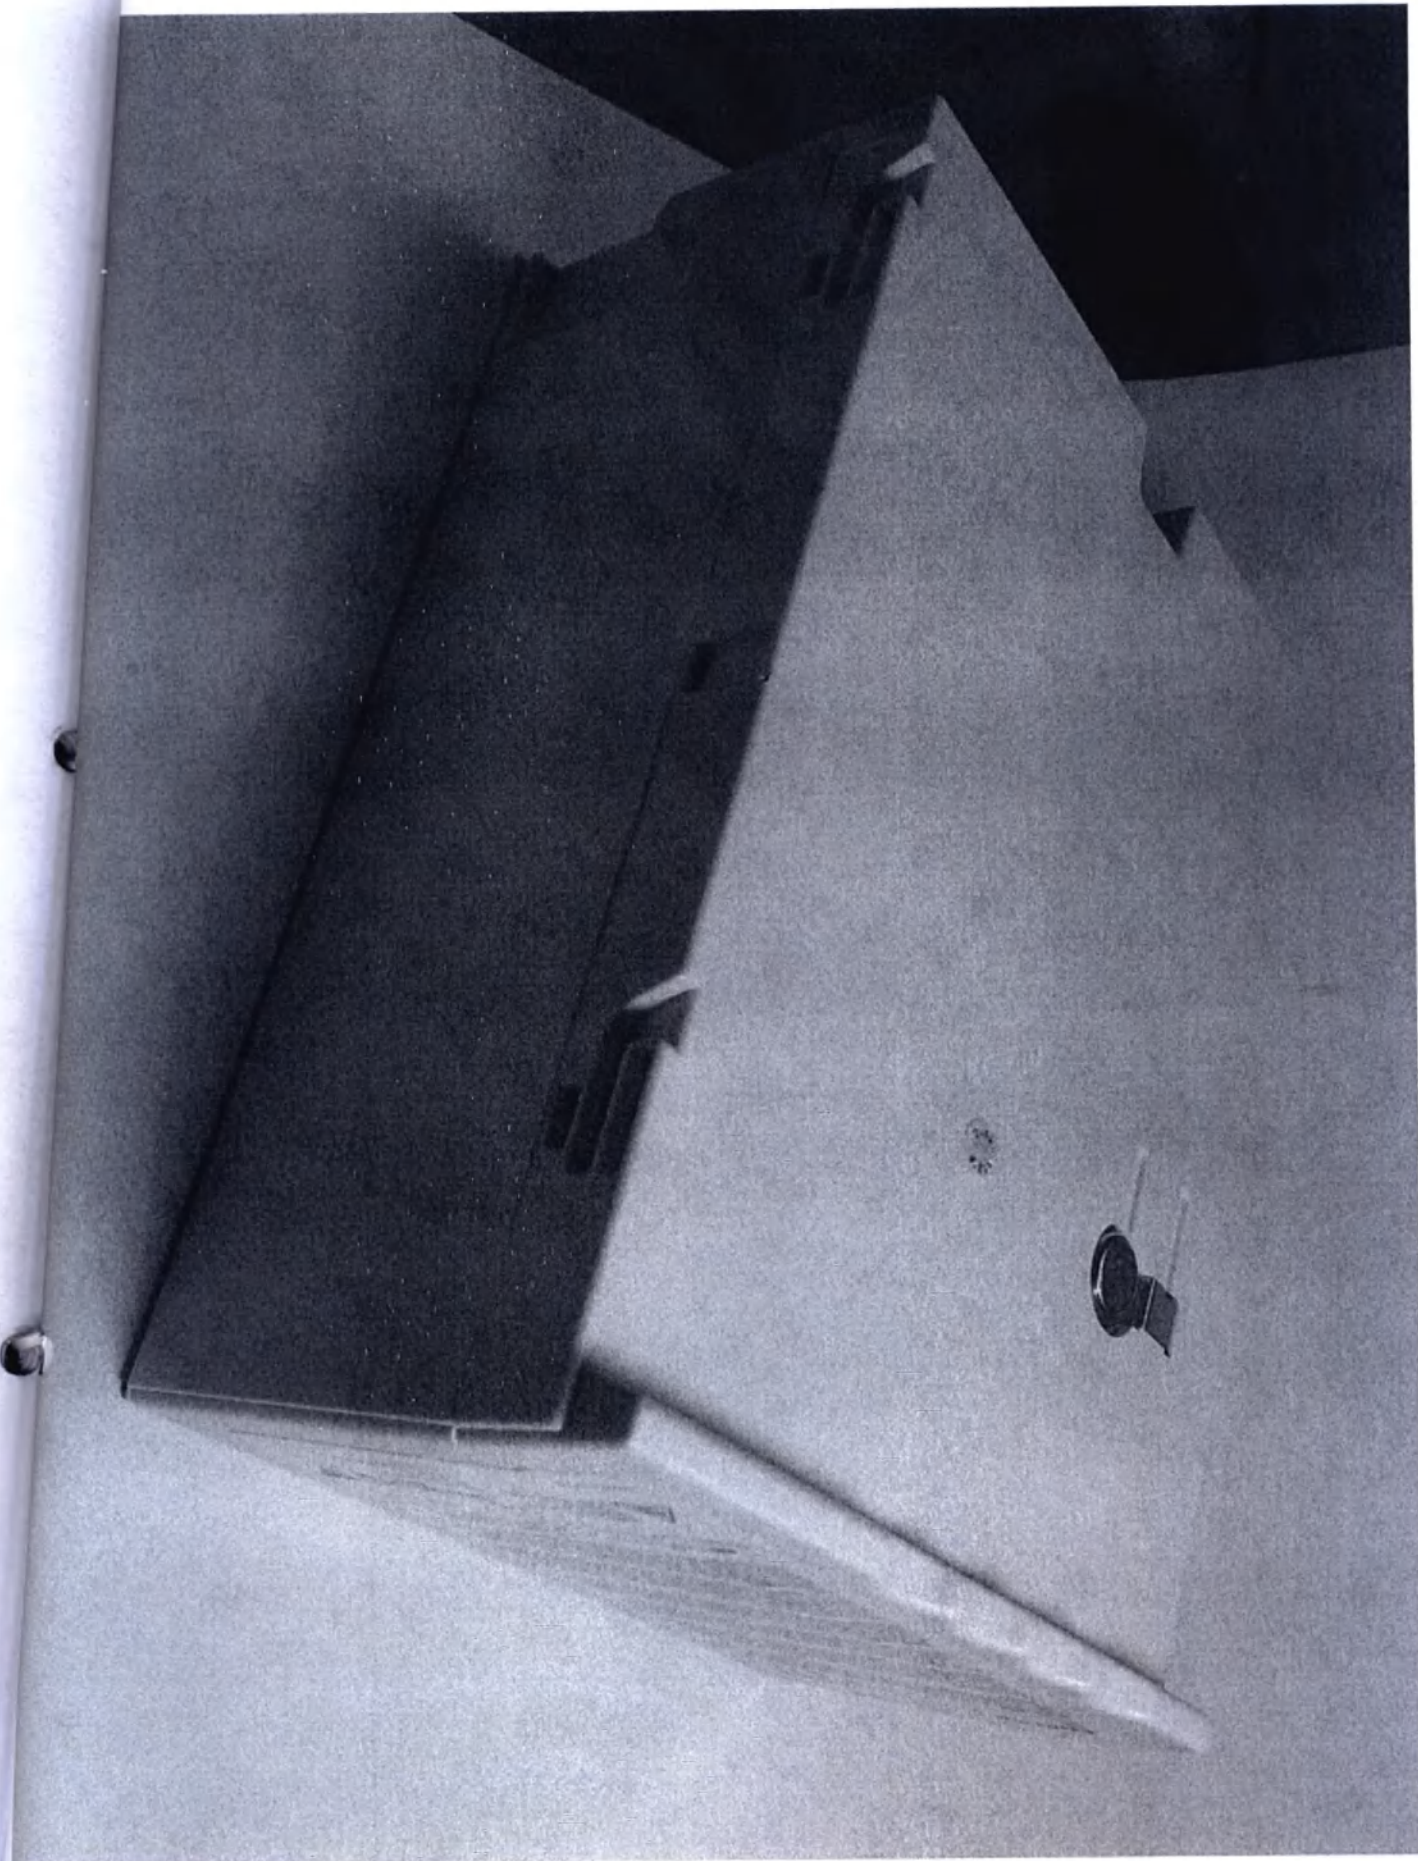

Модуль реагентный (EasyStat[®] Reagent Module)

Всего пронумеровано,
прощнуровано и скреплено
печатью 37 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.