



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro,
с принадлежностями**

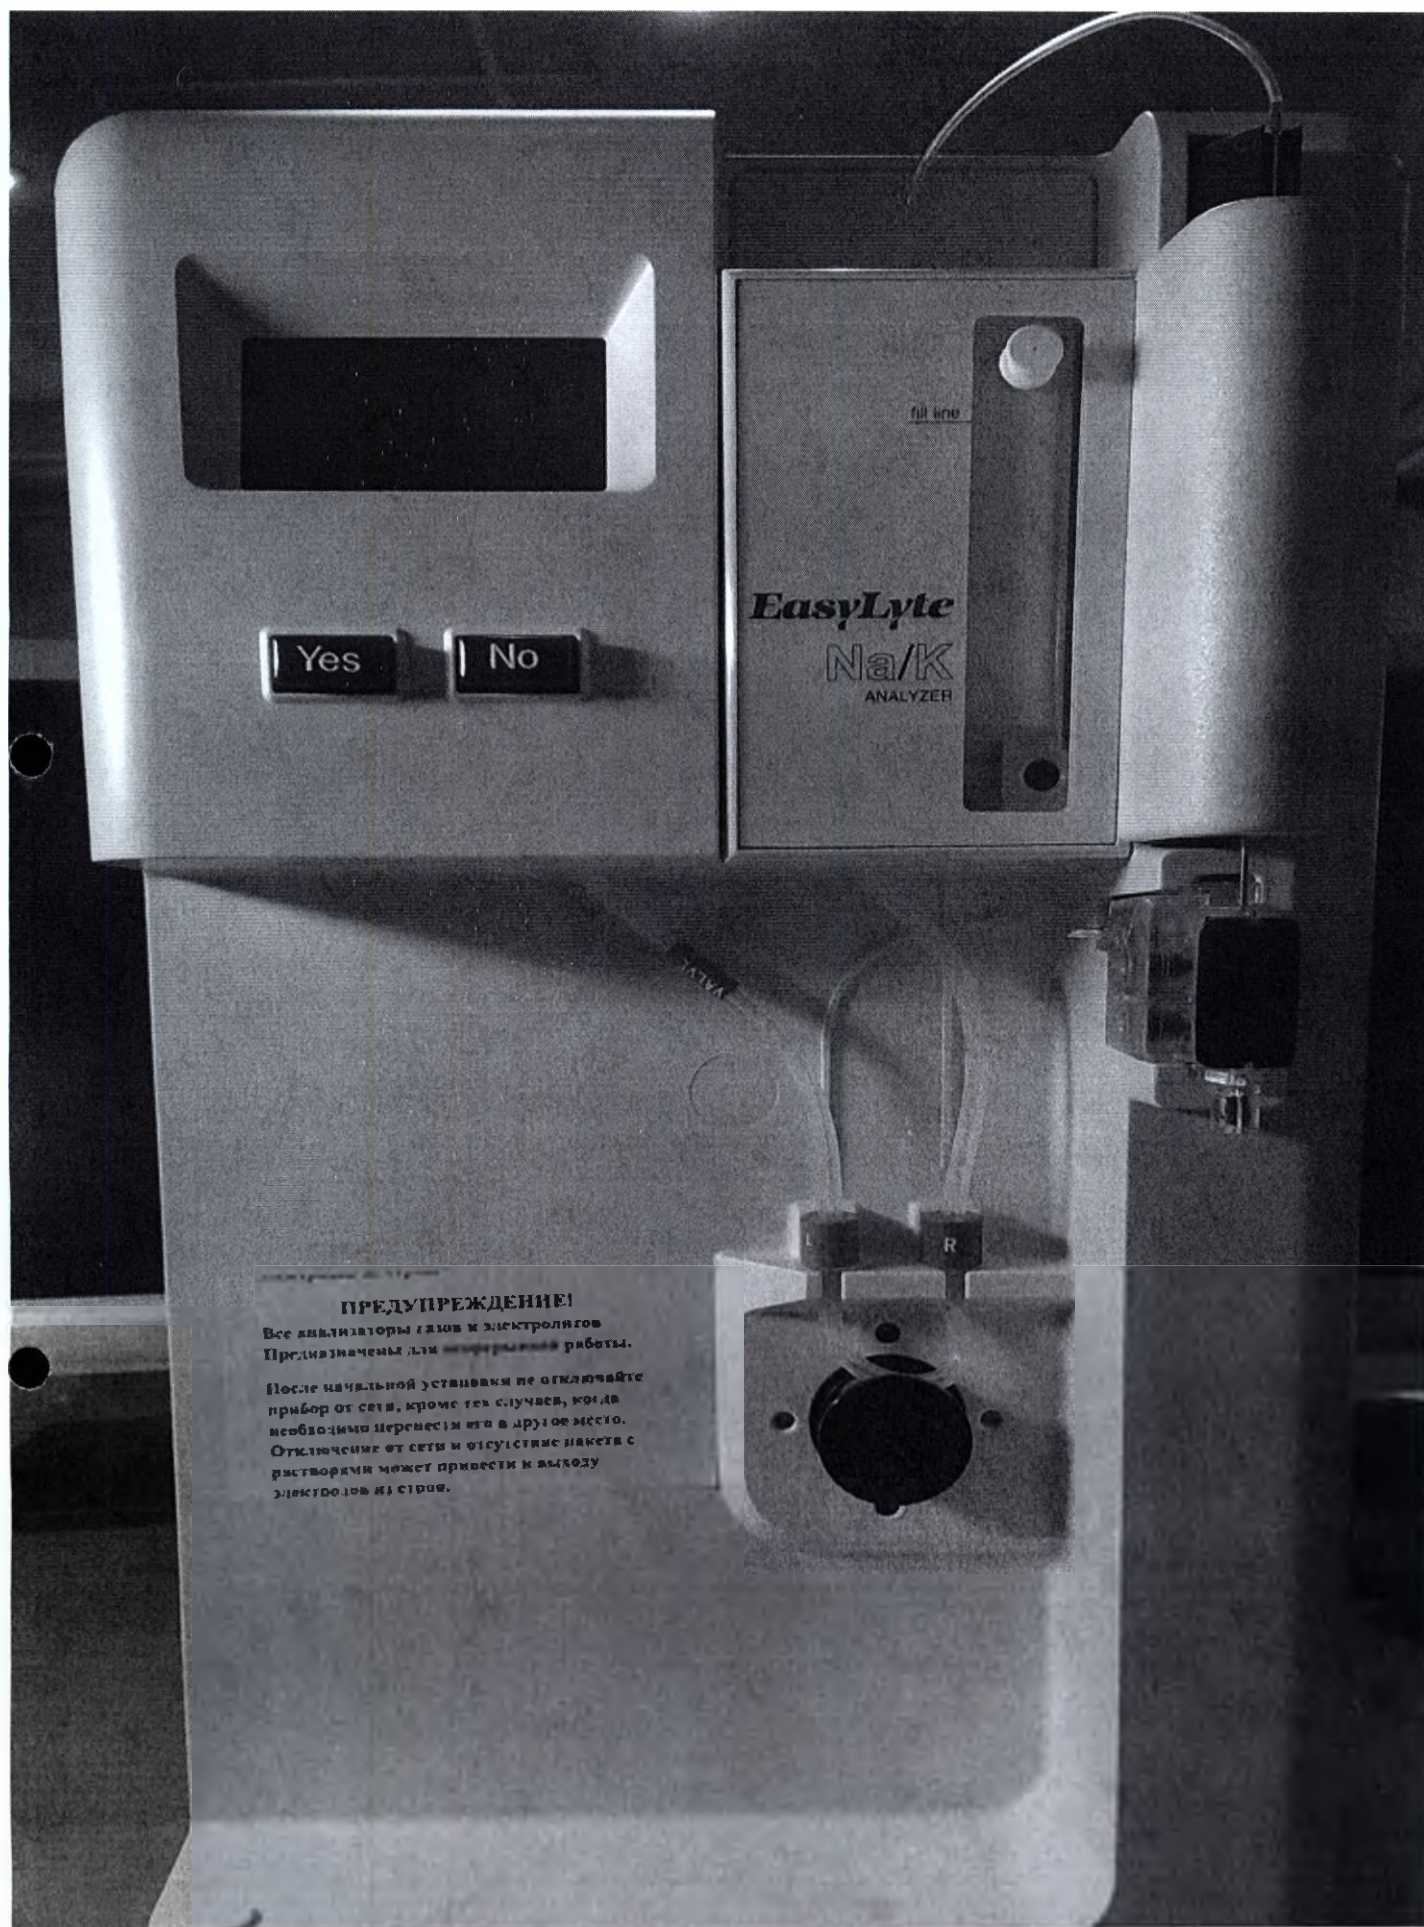

Общий вид: Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte® Na/K

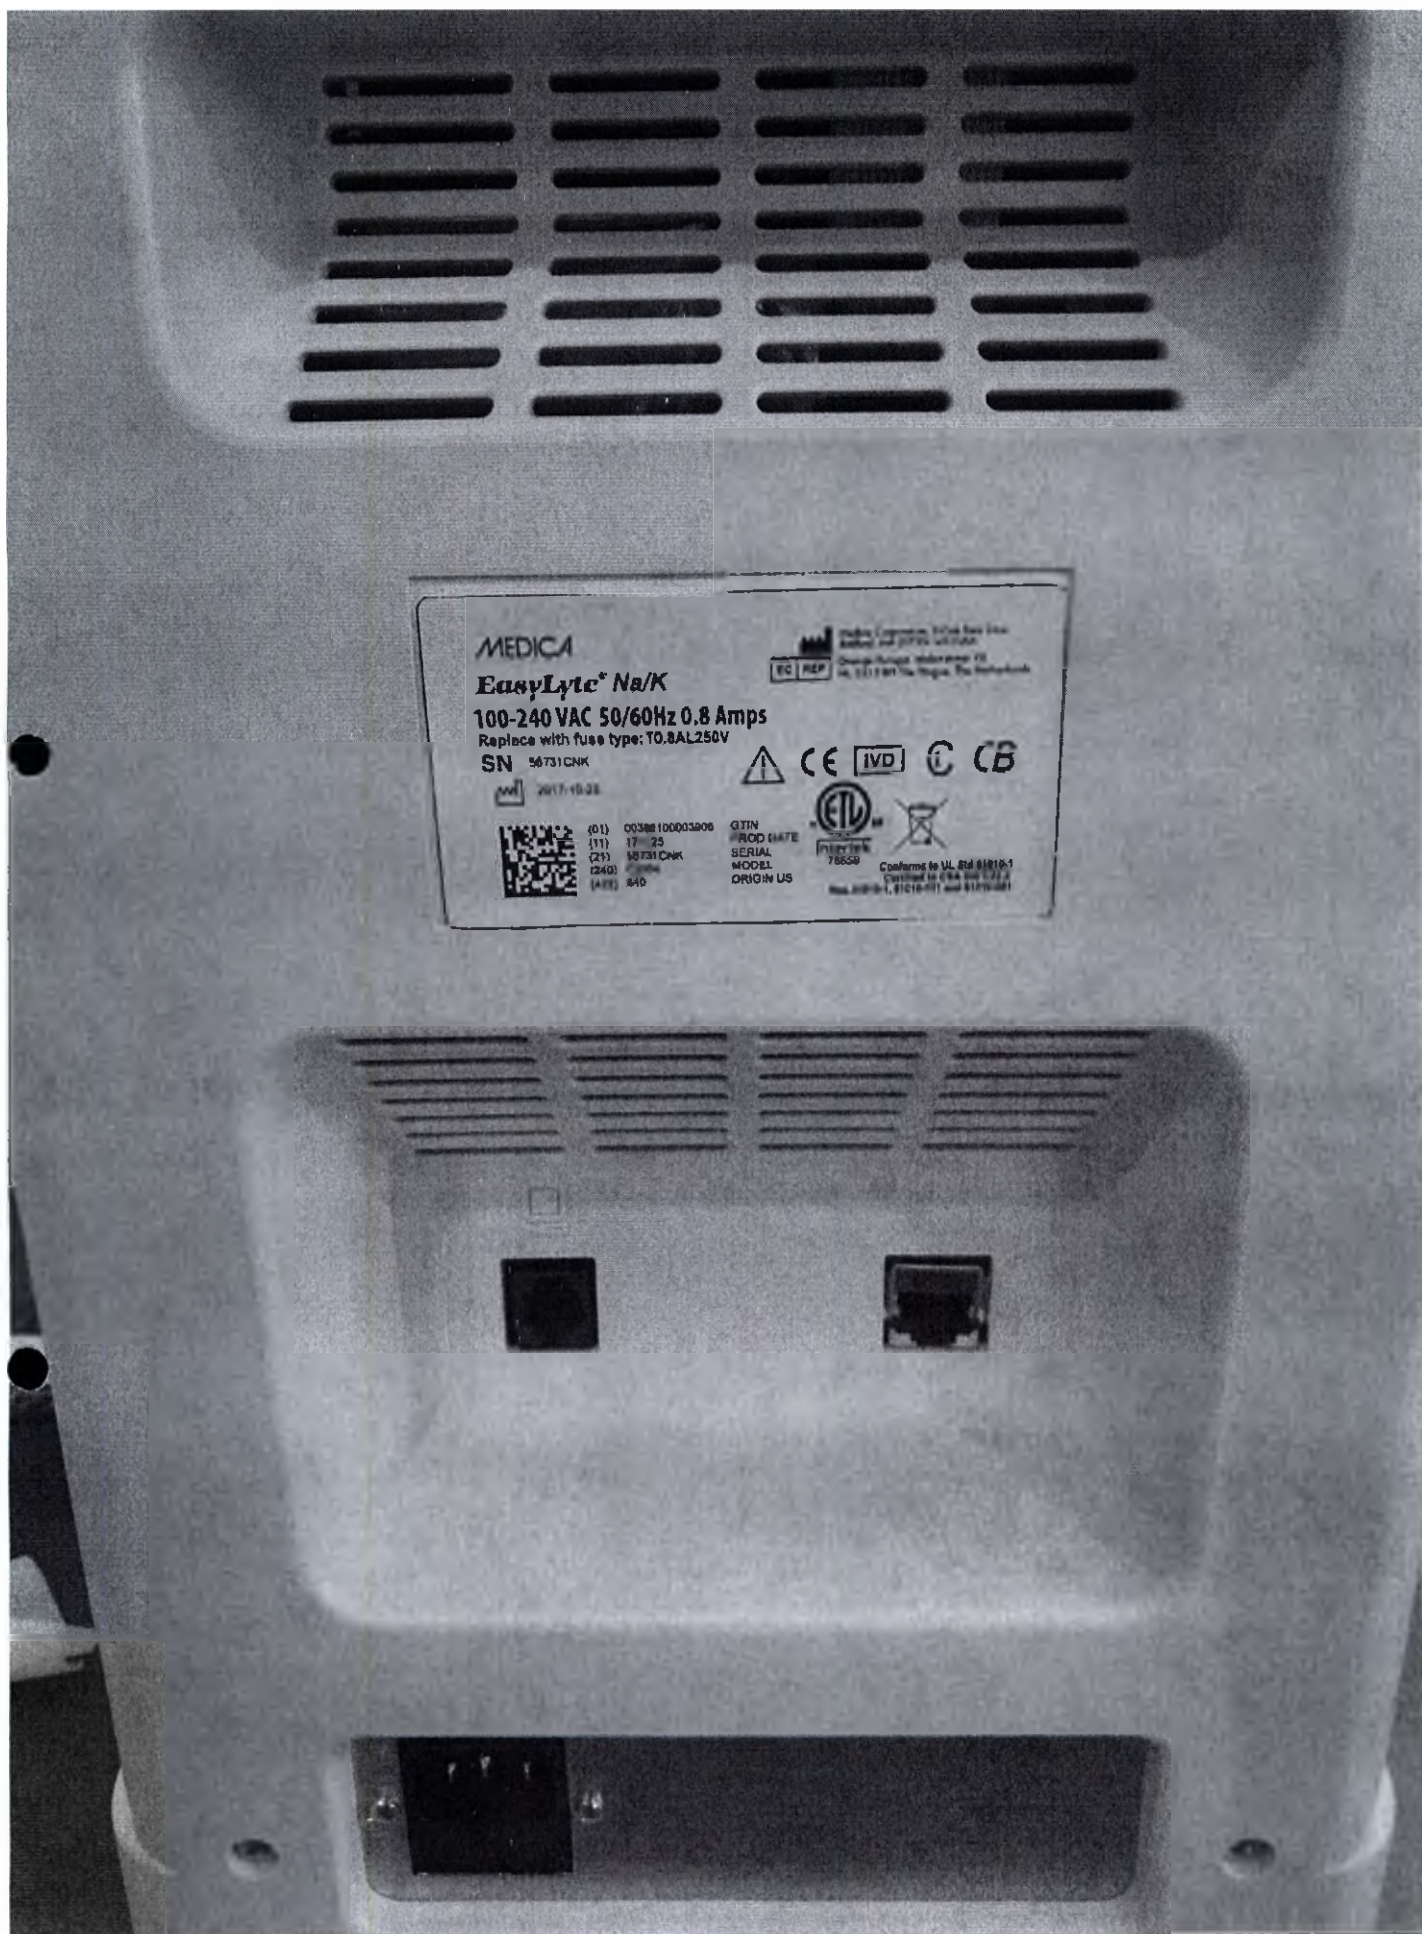

MEDICA

EasyLyte® Na/K

100-240 VAC 50/60Hz 0.8 Amps

Replace with fuse type: T0.8AL250V

SN 56731CNK

2017-10-28




(01) 00388100003806
(11) 17 25
(21) 56731 CNK
(240) 78558
(4XX) 840

GTIN
PROD DATE
SERIAL
MODEL
ORIGIN US




Conforms to UL Std 61810-1
Certified to CSA Std C22.2
No. 61810-1, 61810-11 and 61810-12

Маркировка: Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte® Na/K

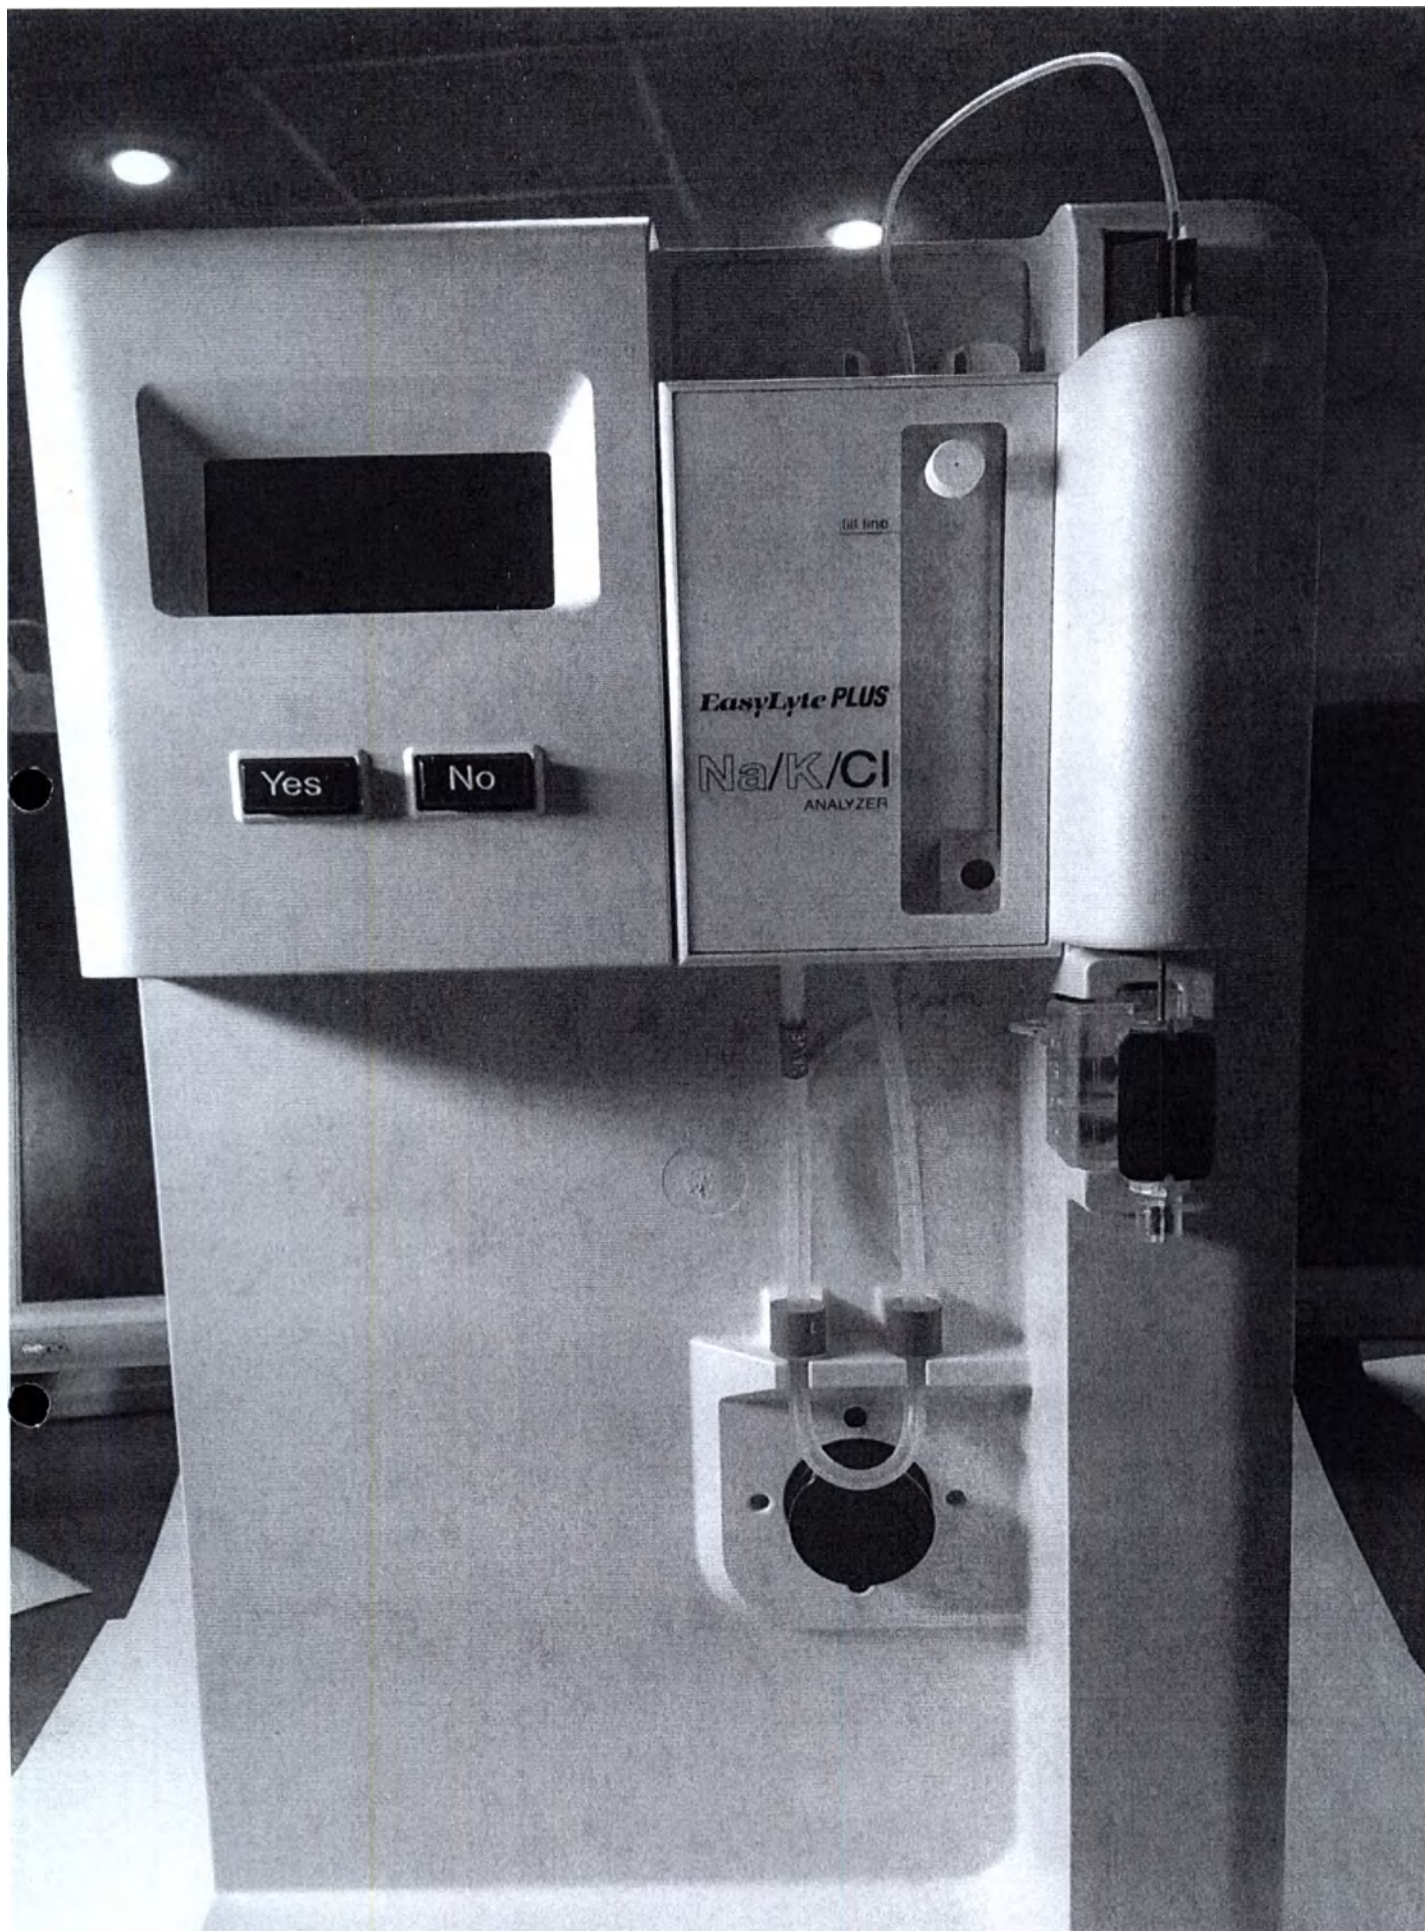

Общий вид: Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte® Plus Na/K/Cl

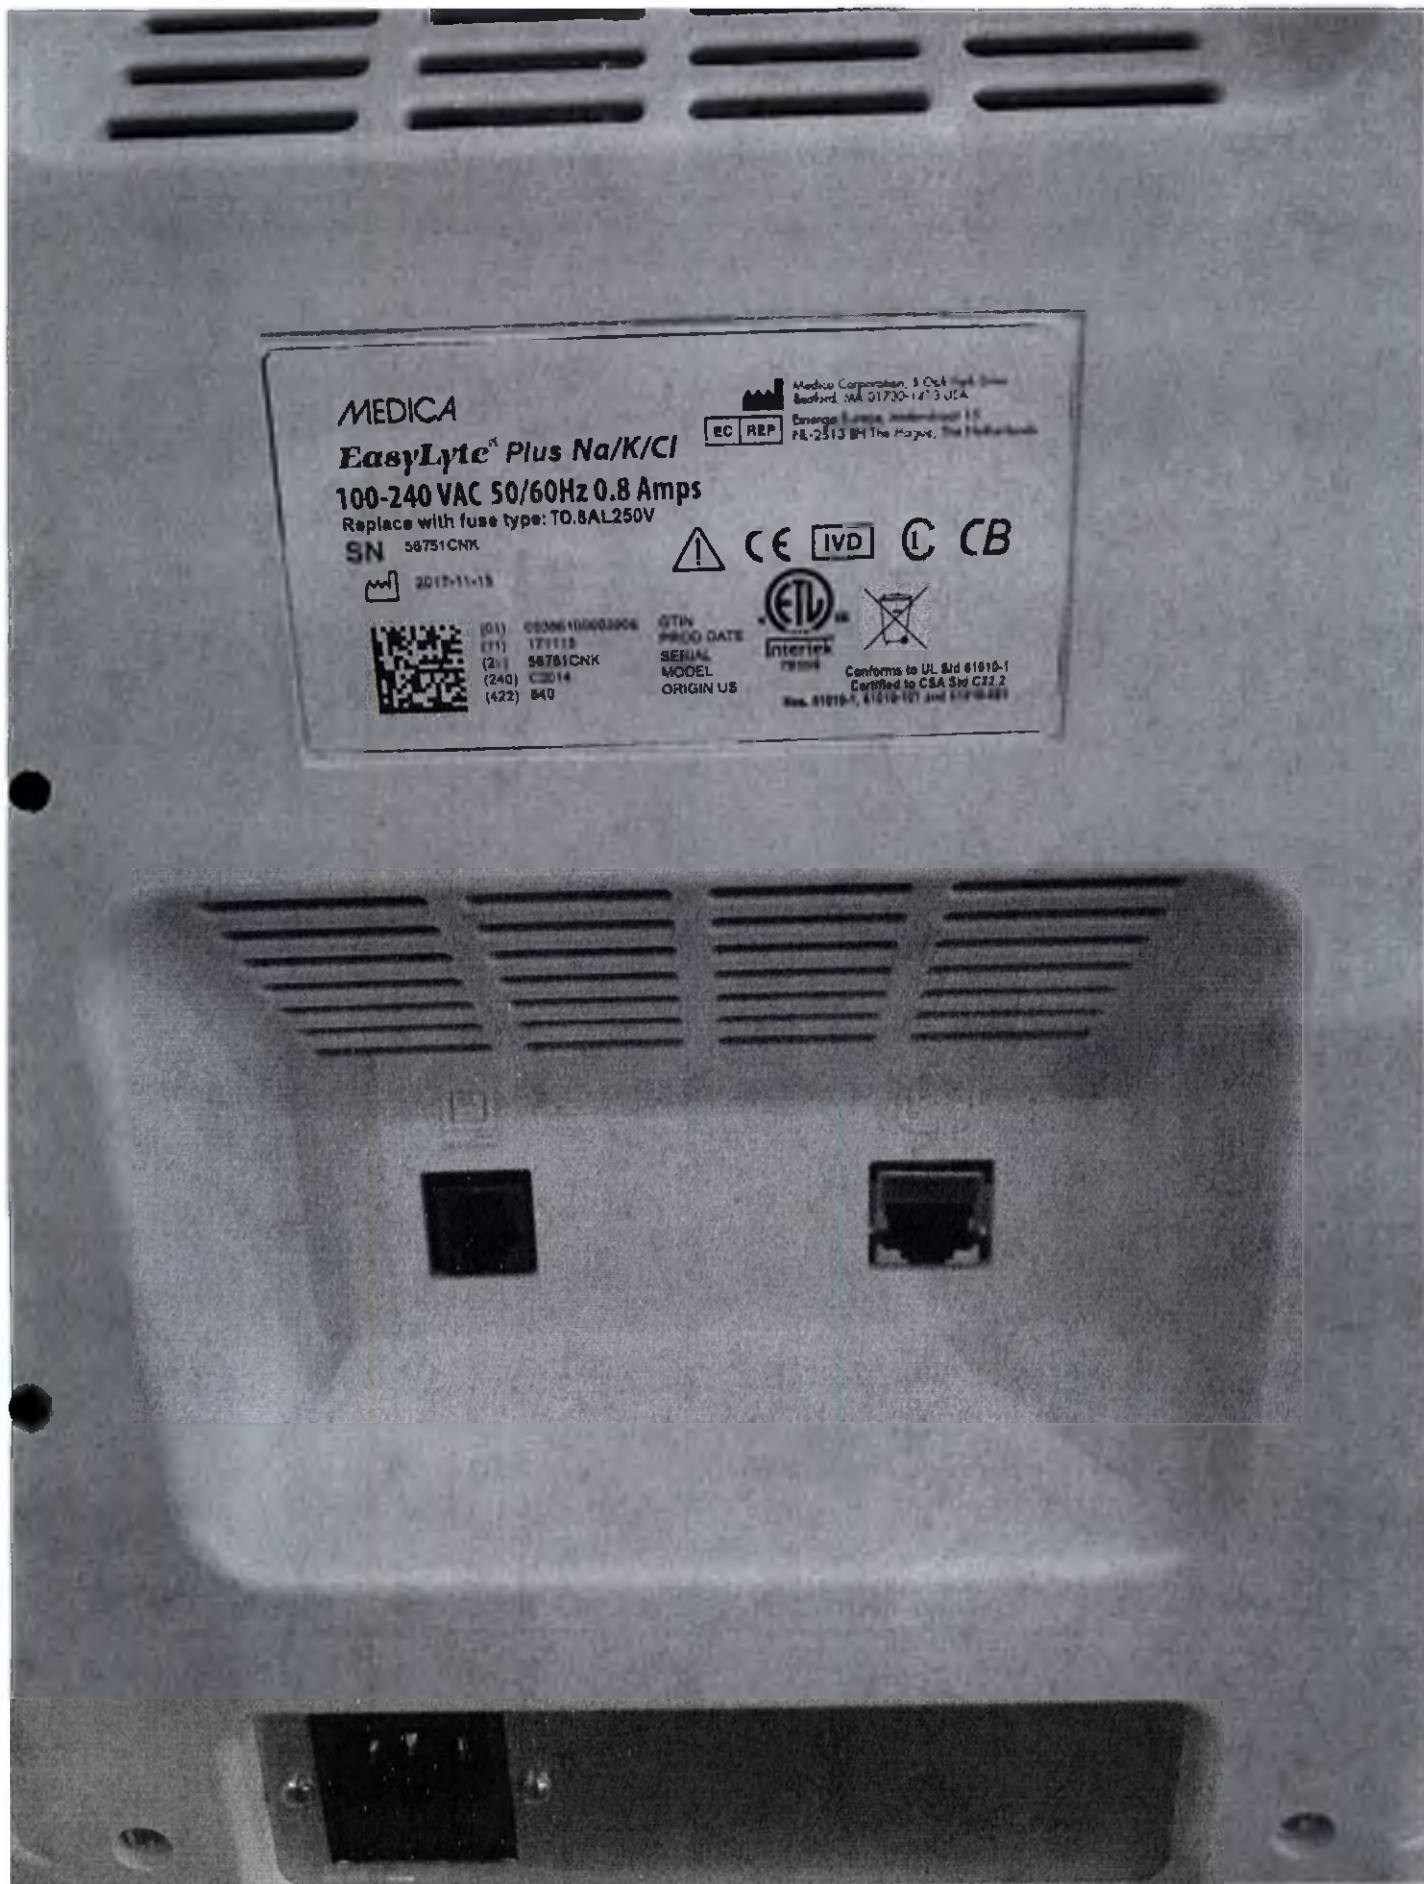

MEDICA

EasyLyte[®] Plus Na/K/Cl

100-240 VAC 50/60Hz 0.8 Amps

Replace with fuse type: TO.8AL250V

SN 58751CNK



2012-11-15



(01) C5306100002906
(11) 171112
(21) 58751CNK
(240) C3014
(422) 840

GTIN
PROD DATE
SERIAL
MODEL
ORIGIN US



CE


IVD

CB



Conforms to UL Std 61010-1
Certified to CSA Std C22.2
Std. 61010-1, 61010-101 and 61010-102

Маркировка: Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte[®] Plus Na/K/Cl

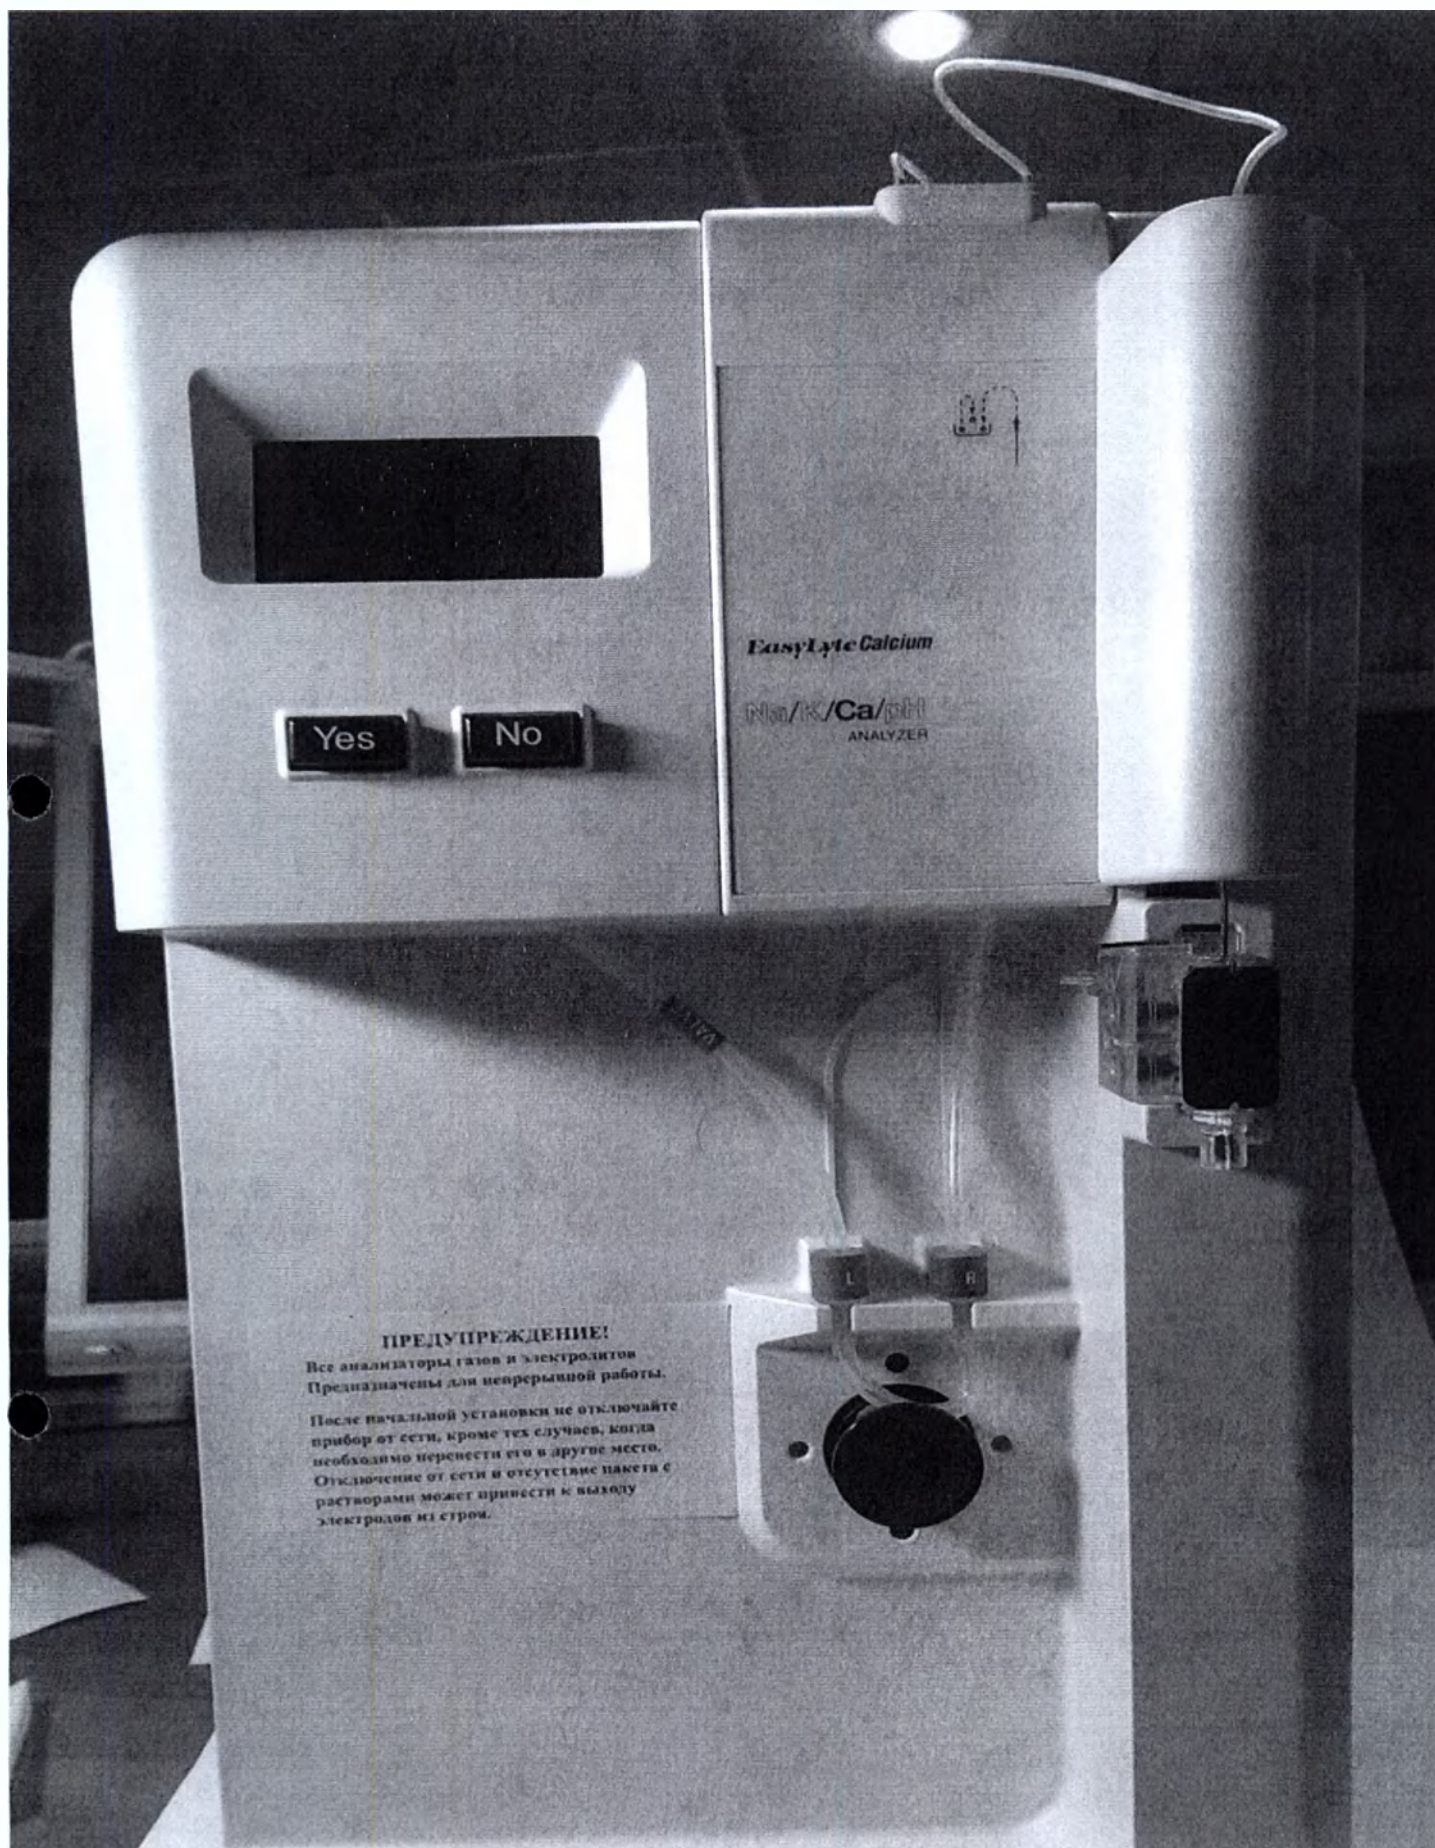

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Все анализаторы газов и электролитов
Предназначены для непрерывной работы.
После начальной установки не отключайте
прибор от сети, кроме тех случаев, когда
необходимо перенести его в другое место.
Отключение от сети и отсутствие пакета с
растворами может привести к выходу
электродов из строя.

Общий вид: Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte® Calcium Na/K/Ca/pH

MEDICA

EasyLyte[®] Calcium Na/K/Ca/pH

100-240 VAC 50/60Hz 0.8 Amps

Replace with fuse type: TO.6AL250V

SN 51988CNK



2017-02-09




(01) 00386100003906
(11) 170209
(21) 56751CNK
(240) C2016
(422) 840

GTIN
PROD DATE
SERIAL
MODEL
ORIGIN US




Conforms to UL Std 61010-1
Certified to CSA Std C22.2
Nos. 61010-1, 61010-101 and 61010-081

Маркировка: Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte[®] Calcium Na/K/Ca/pH

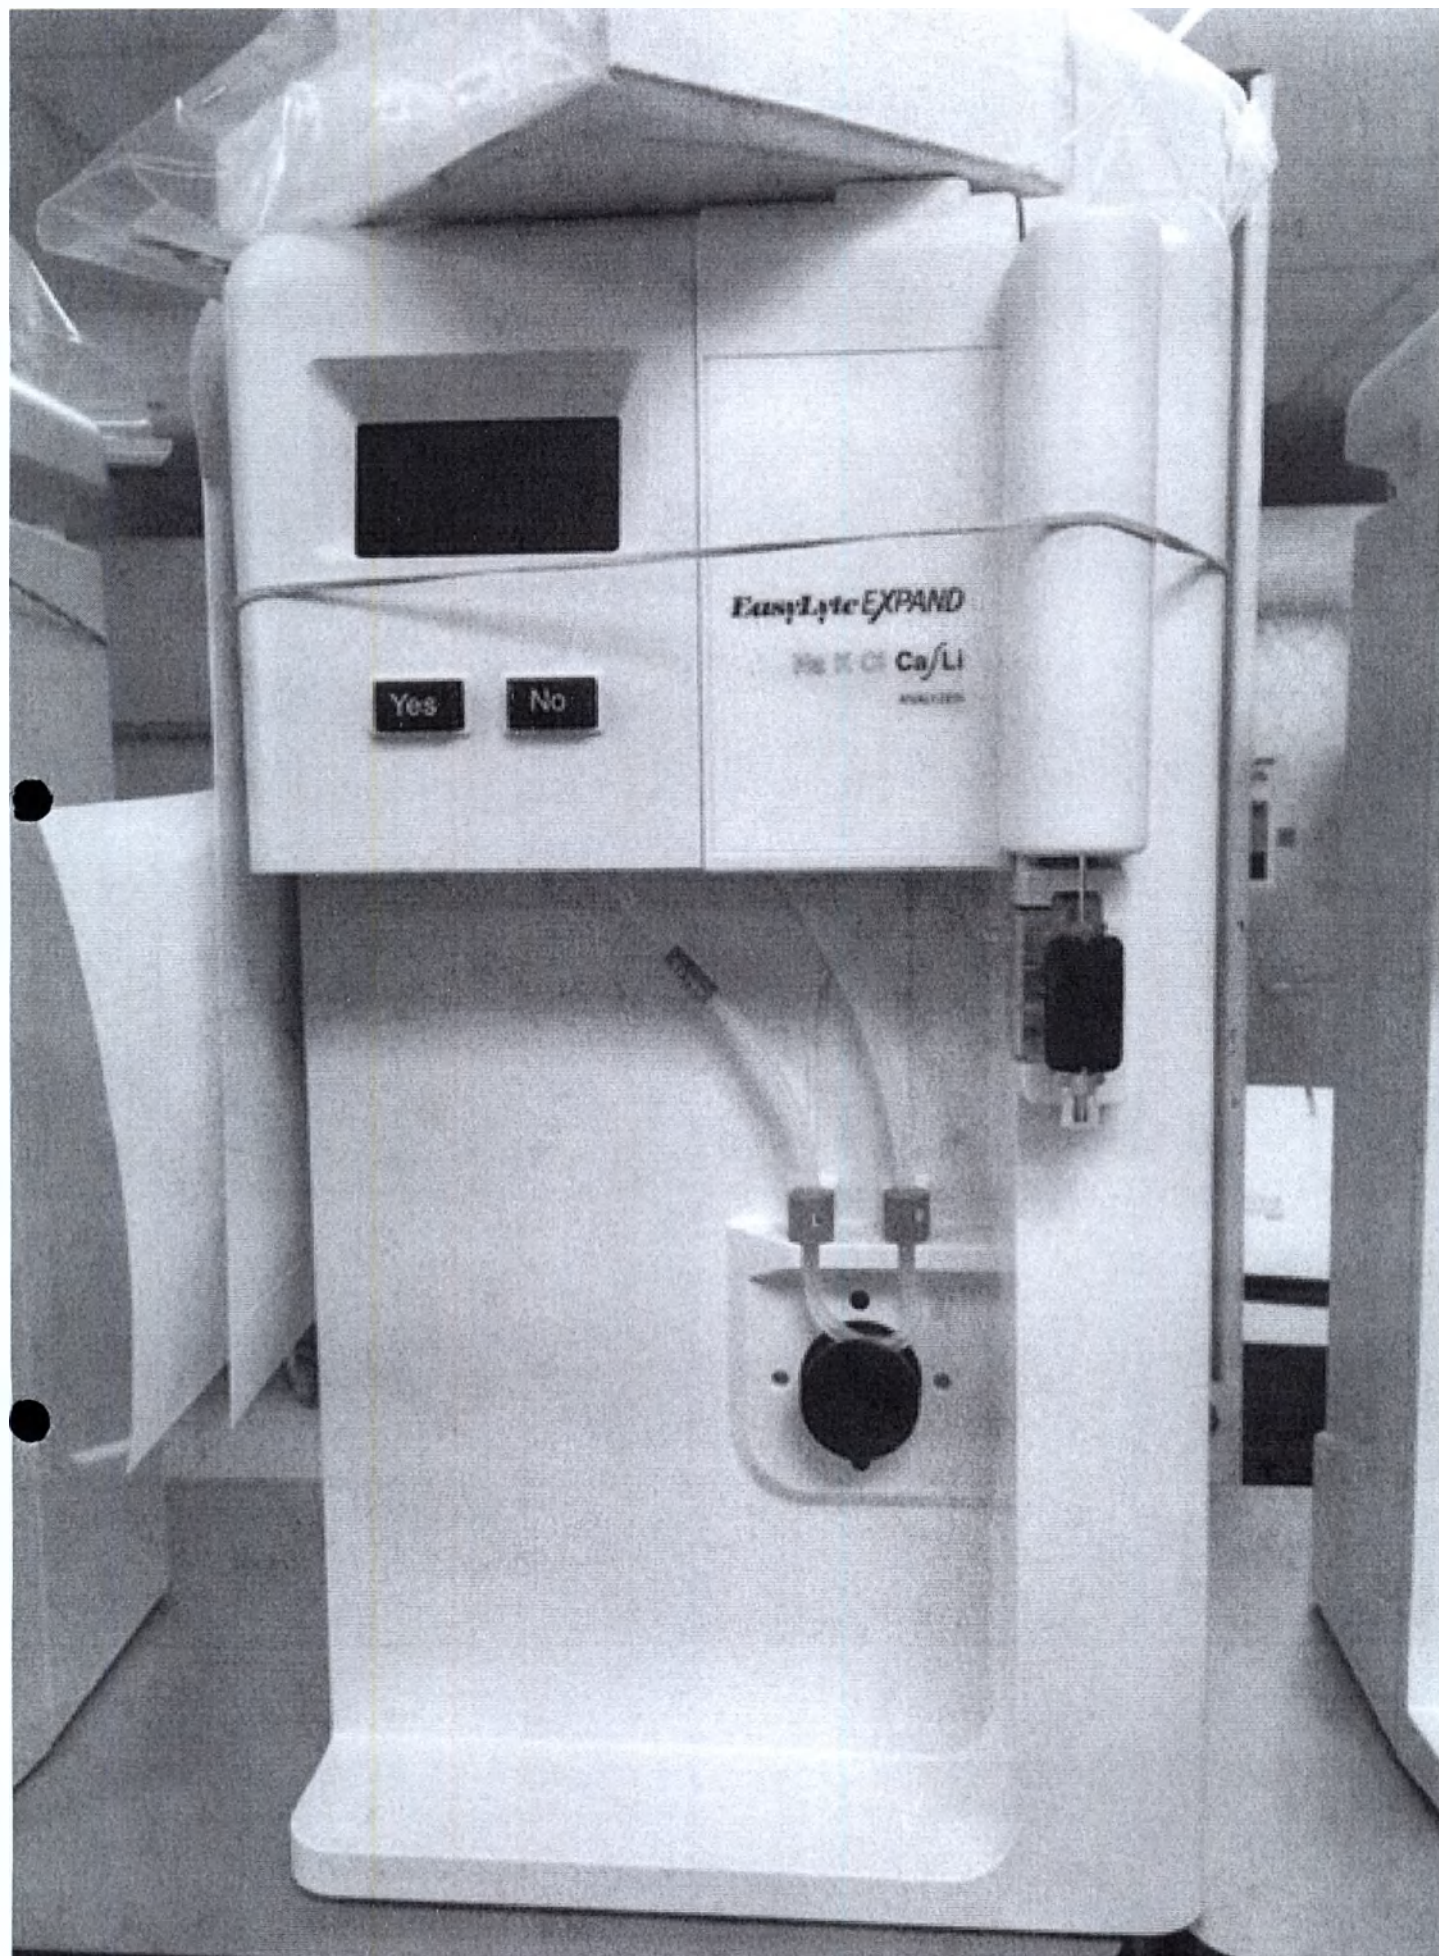

Общий вид: Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte® EXPAND Na K Cl Ca /Li

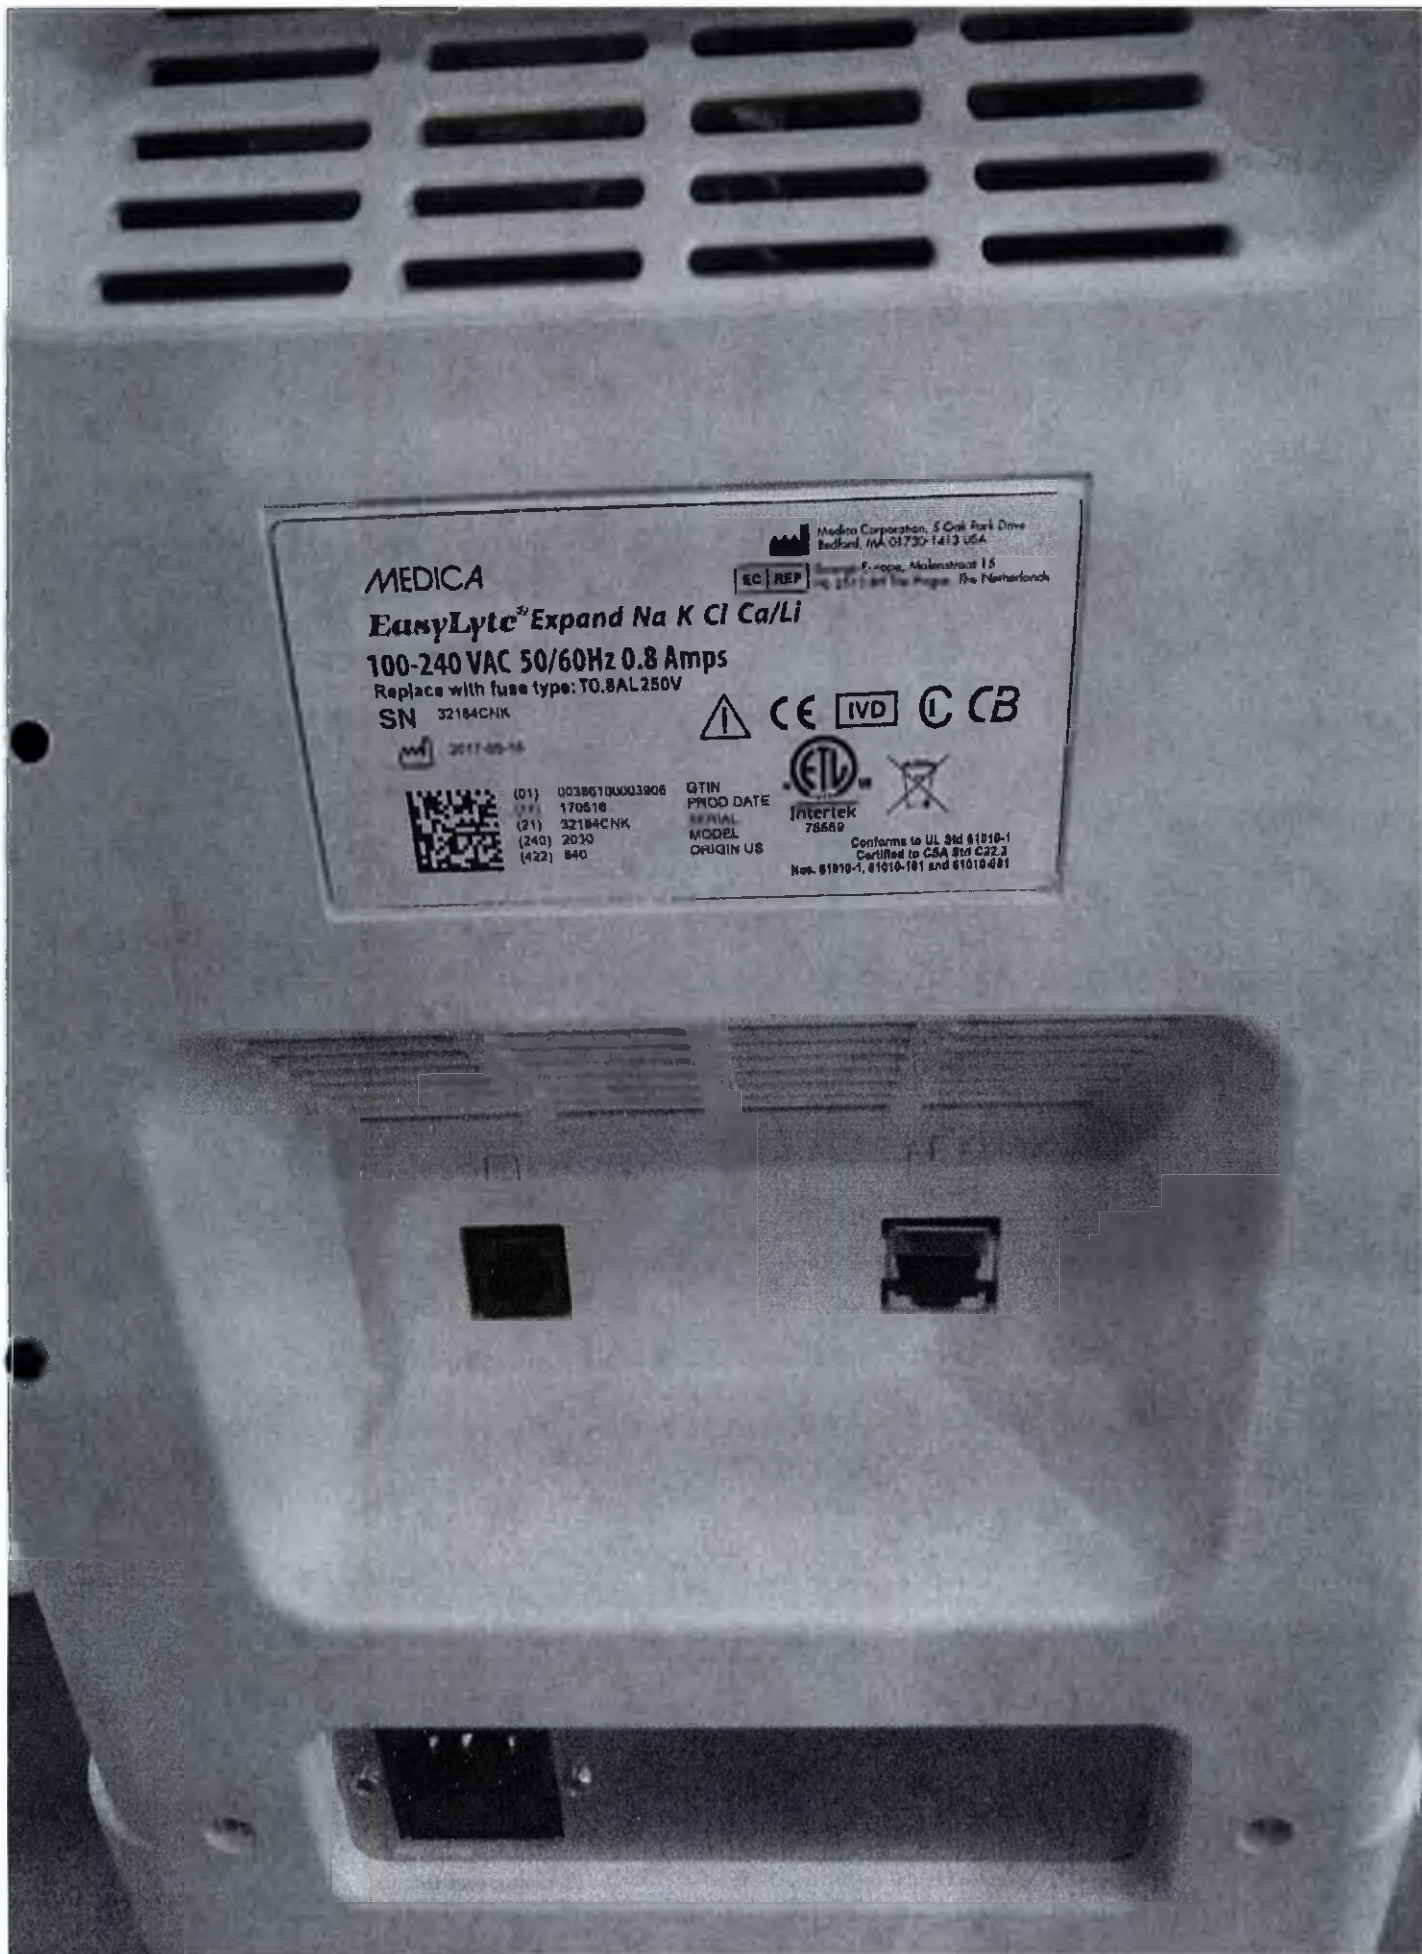

MEDICA

EasyLyte[®] Expand Na K Cl Ca/Li

100-240 VAC 50/60Hz 0.8 Amps

Replace with fuse type: T0.8AL250V

SN 32184CNK

2017-05-16



(01) 00386100003906
(02) 170610
(21) 32184CNK
(240) 2030
(422) 840

QTN
PMOD DATE
SERIAL
MODEL
ORIGIN US



Intertek

78689

Conforms to UL Std 61010-1

Certified to CSA Std C22.2

Nov. 61010-1, 61010-101 and 61010-401

Маркировка: Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: EasyLyte[®] EXPAND Na K Cl Ca /Li

MEDICA
EasyLyte®

REF 2101

K+ Electrode
Electrode de potassium
Elettrodo Potassio
Kalium Elektrode
Electrodo de K+
Electrodo K+
K+ Elektrode

LOT 18086

2019-03-27

2018-03-27

(01) 00386100002961
(10) 18086
(11) 180327
(15) 190327
(422) 840



For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorien te kullutama epi.


GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europe, Molenstraat 18
NL-2513 BH The Hague
The Netherlands

003779-014 810

Электрод измерительный «K+» (K+ (Potassium) Electrode)

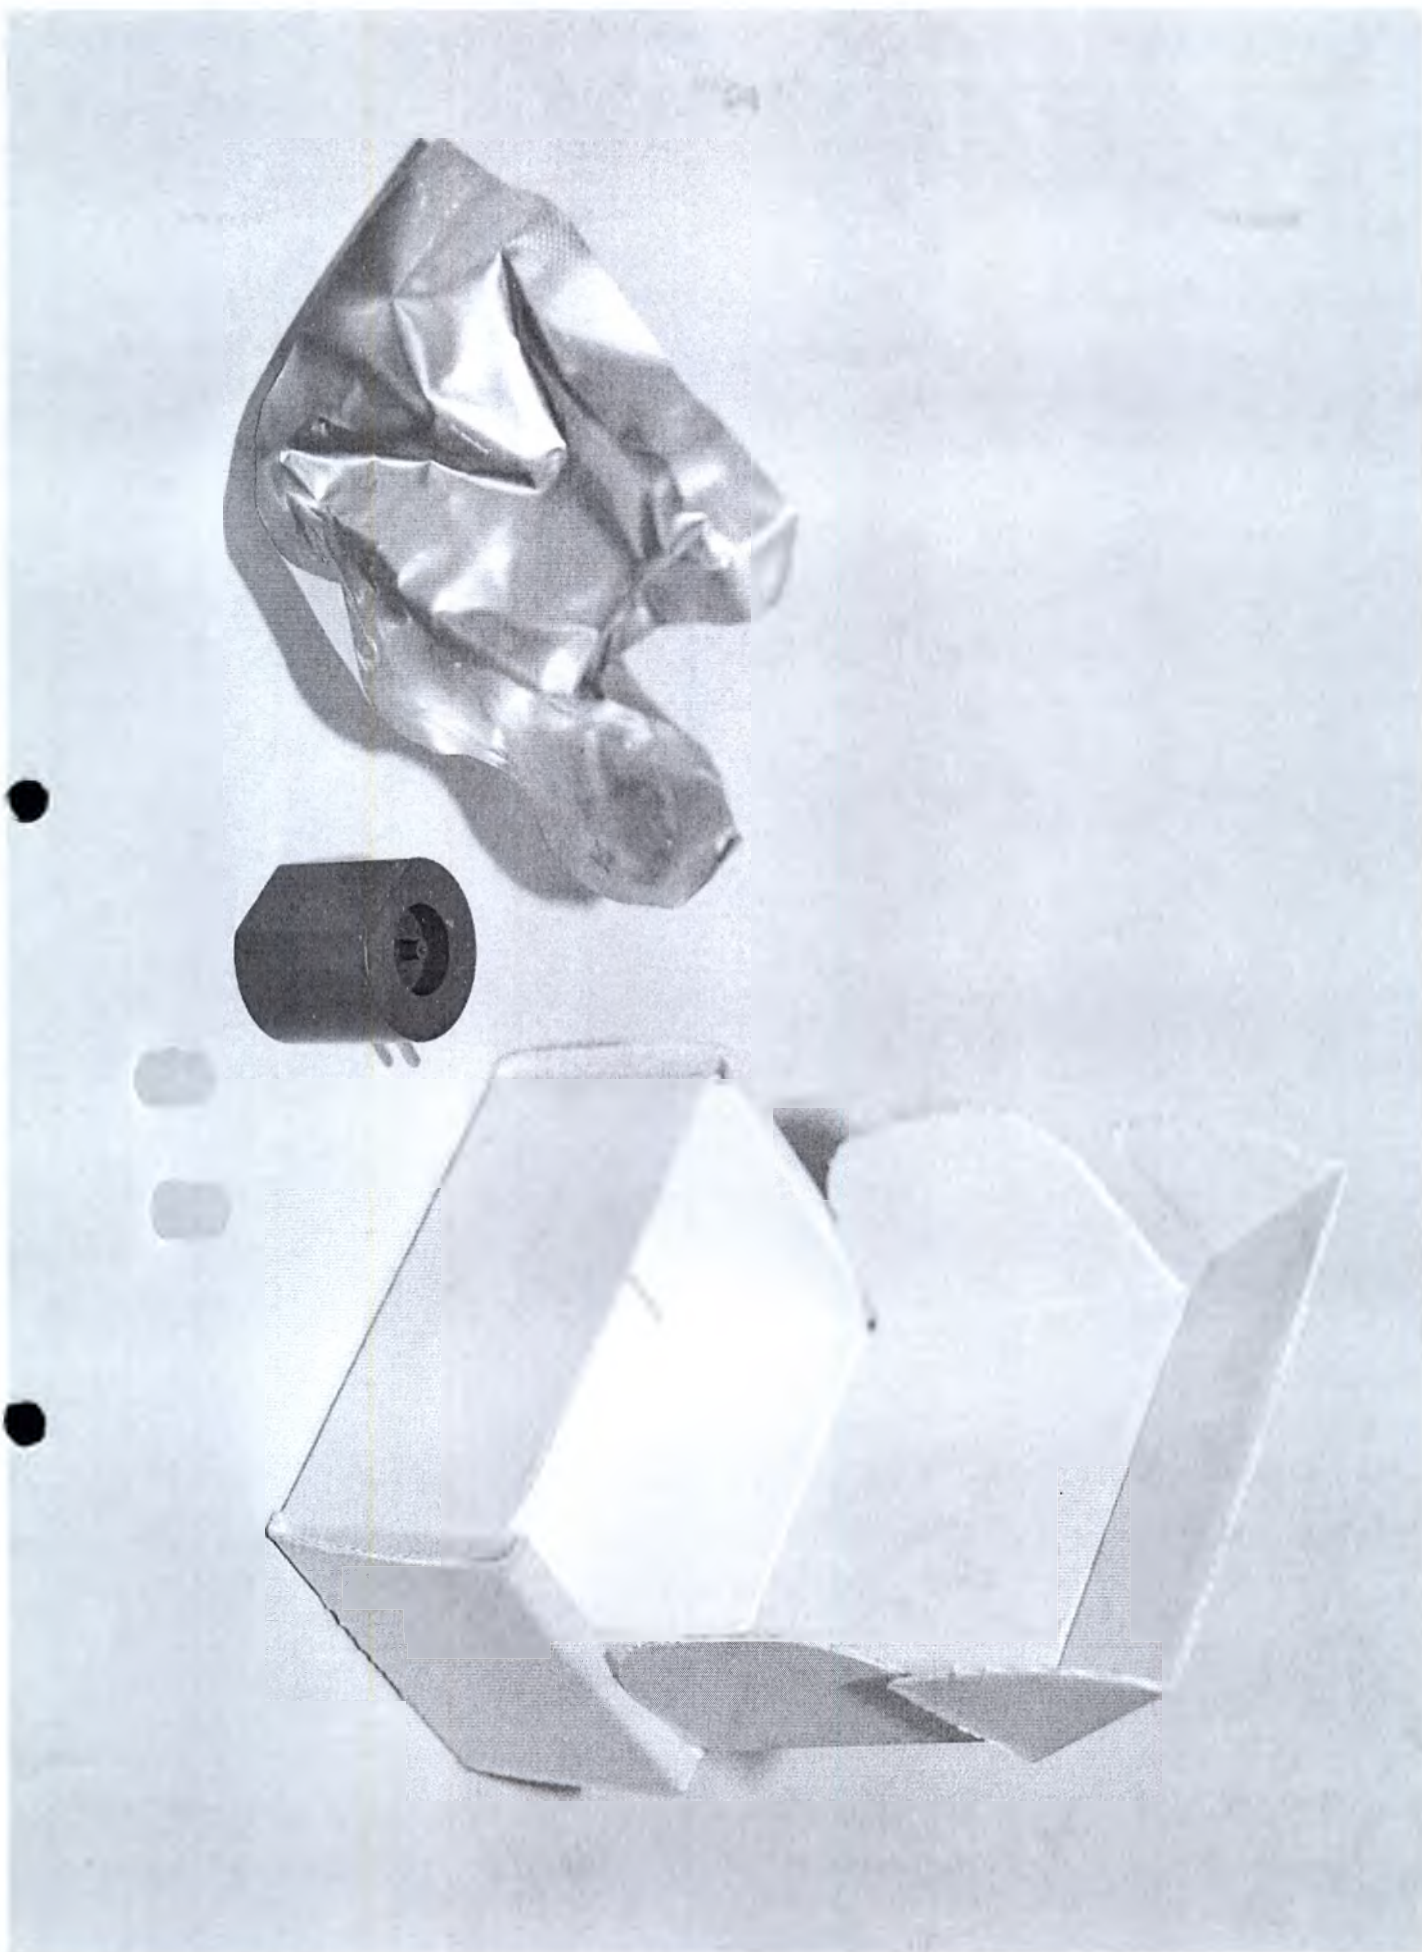

Электрод измерительный «K+» (K+ (Potassium) Electrode)

Кат. № 2101

Lot №18086

Годен до. 03.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro,
с принадлежностями:

Электрод измерительный «K+» (K+ (Potassium) Electrode)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре 4-25°C. Хранить при температуре 4-25°C.

Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и
документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д.2, корп. 1



Маркировка: Электрод измерительный «K+» (K+ (Potassium) Electrode)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2102

Na+ Electrode
Électrode de sodium
Elettrodo Sodio
Natrium Elektrode
Electrodo de Na+
Eléctrodo Na+
Na+ Elektrode

LOT 18108

2019-04-18


2018-04-18

(01) 00386100002978
(10) 18108
(11) 180418
(15) 190418
(422) 340



For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar com analisadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorien de kullumiseks.

GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US

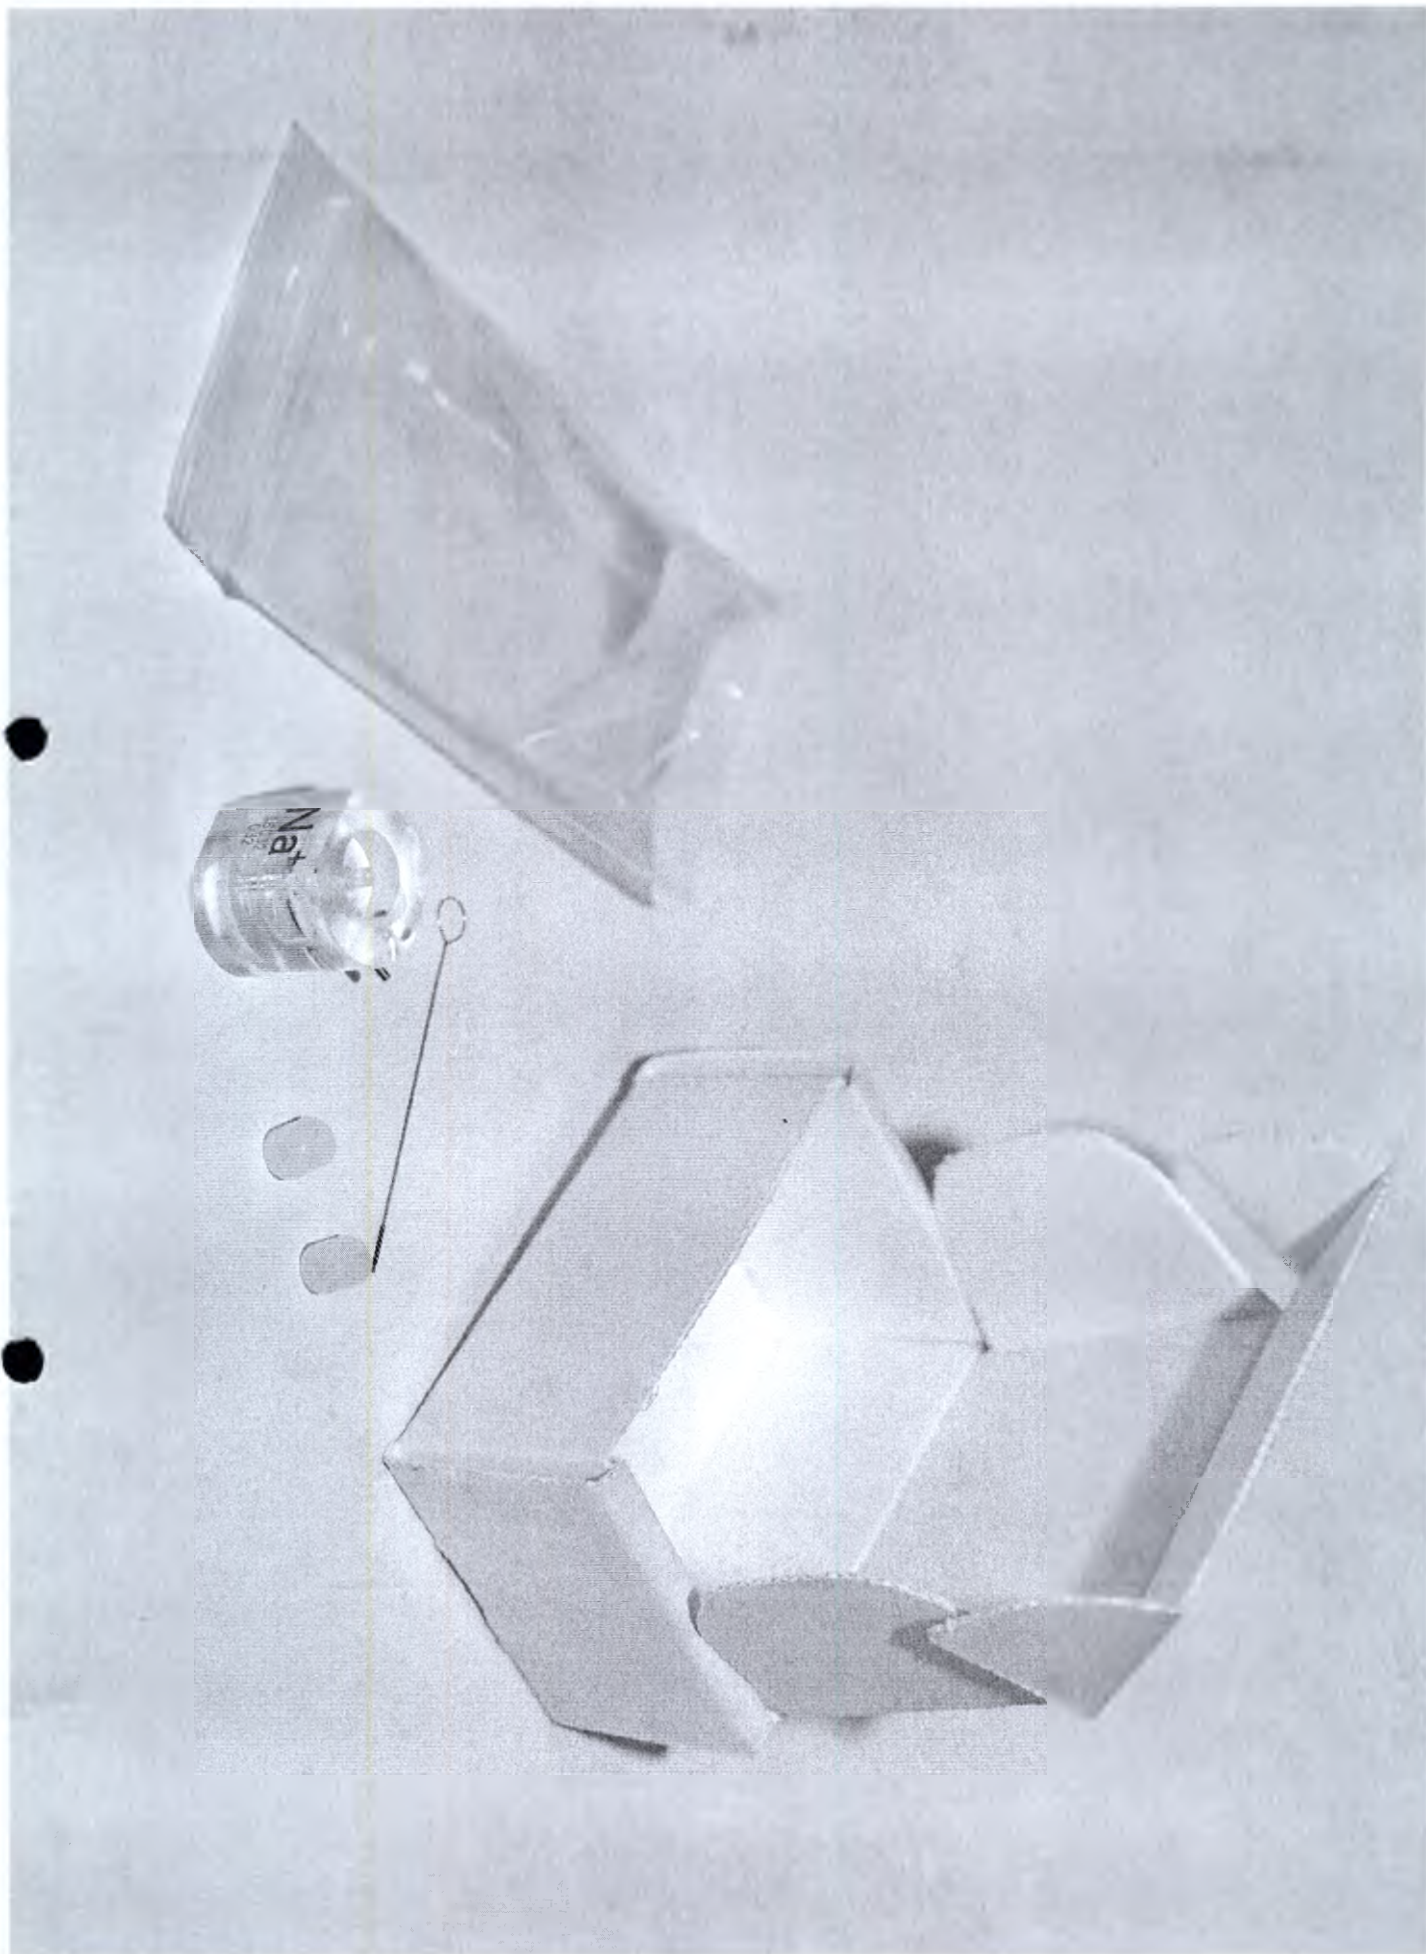

Электрод измерительный «Na+» (Na⁺ (Sodium) Electrode)

Kat. № 2102
Lot №18108

Годен до 04.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, с принадлежностями:

Электрод измерительный «Na+» (Na+ (Sodium) Electrode)

Производитель MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре +25°C. Хранить при температуре +25°C

Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд
Серебряков, д.2, корп.1



Маркировка: Электрод измерительный «Na+» (Na+ (Sodium) Electrode)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2113



Cl- Electrode
Electrode de chlorure
Electrodo Cloruro
Chlorid Elektrode
Electrodo de Cl-
Electrodo Cl-
Cl- Elektrode

For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorien le kullutamiseks.

LOT 18111

2018-04-21

2018-04-21




(01) 00385100003050
(10) 18111
(11) 180421
(15) 180421
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
1000 Park Drive
Burlington, North Carolina 27215
USA
© 2018 Medica Corporation
The Netherlands

Электрод измерительный «Cl-» (Cl- (Chloride) Electrode)

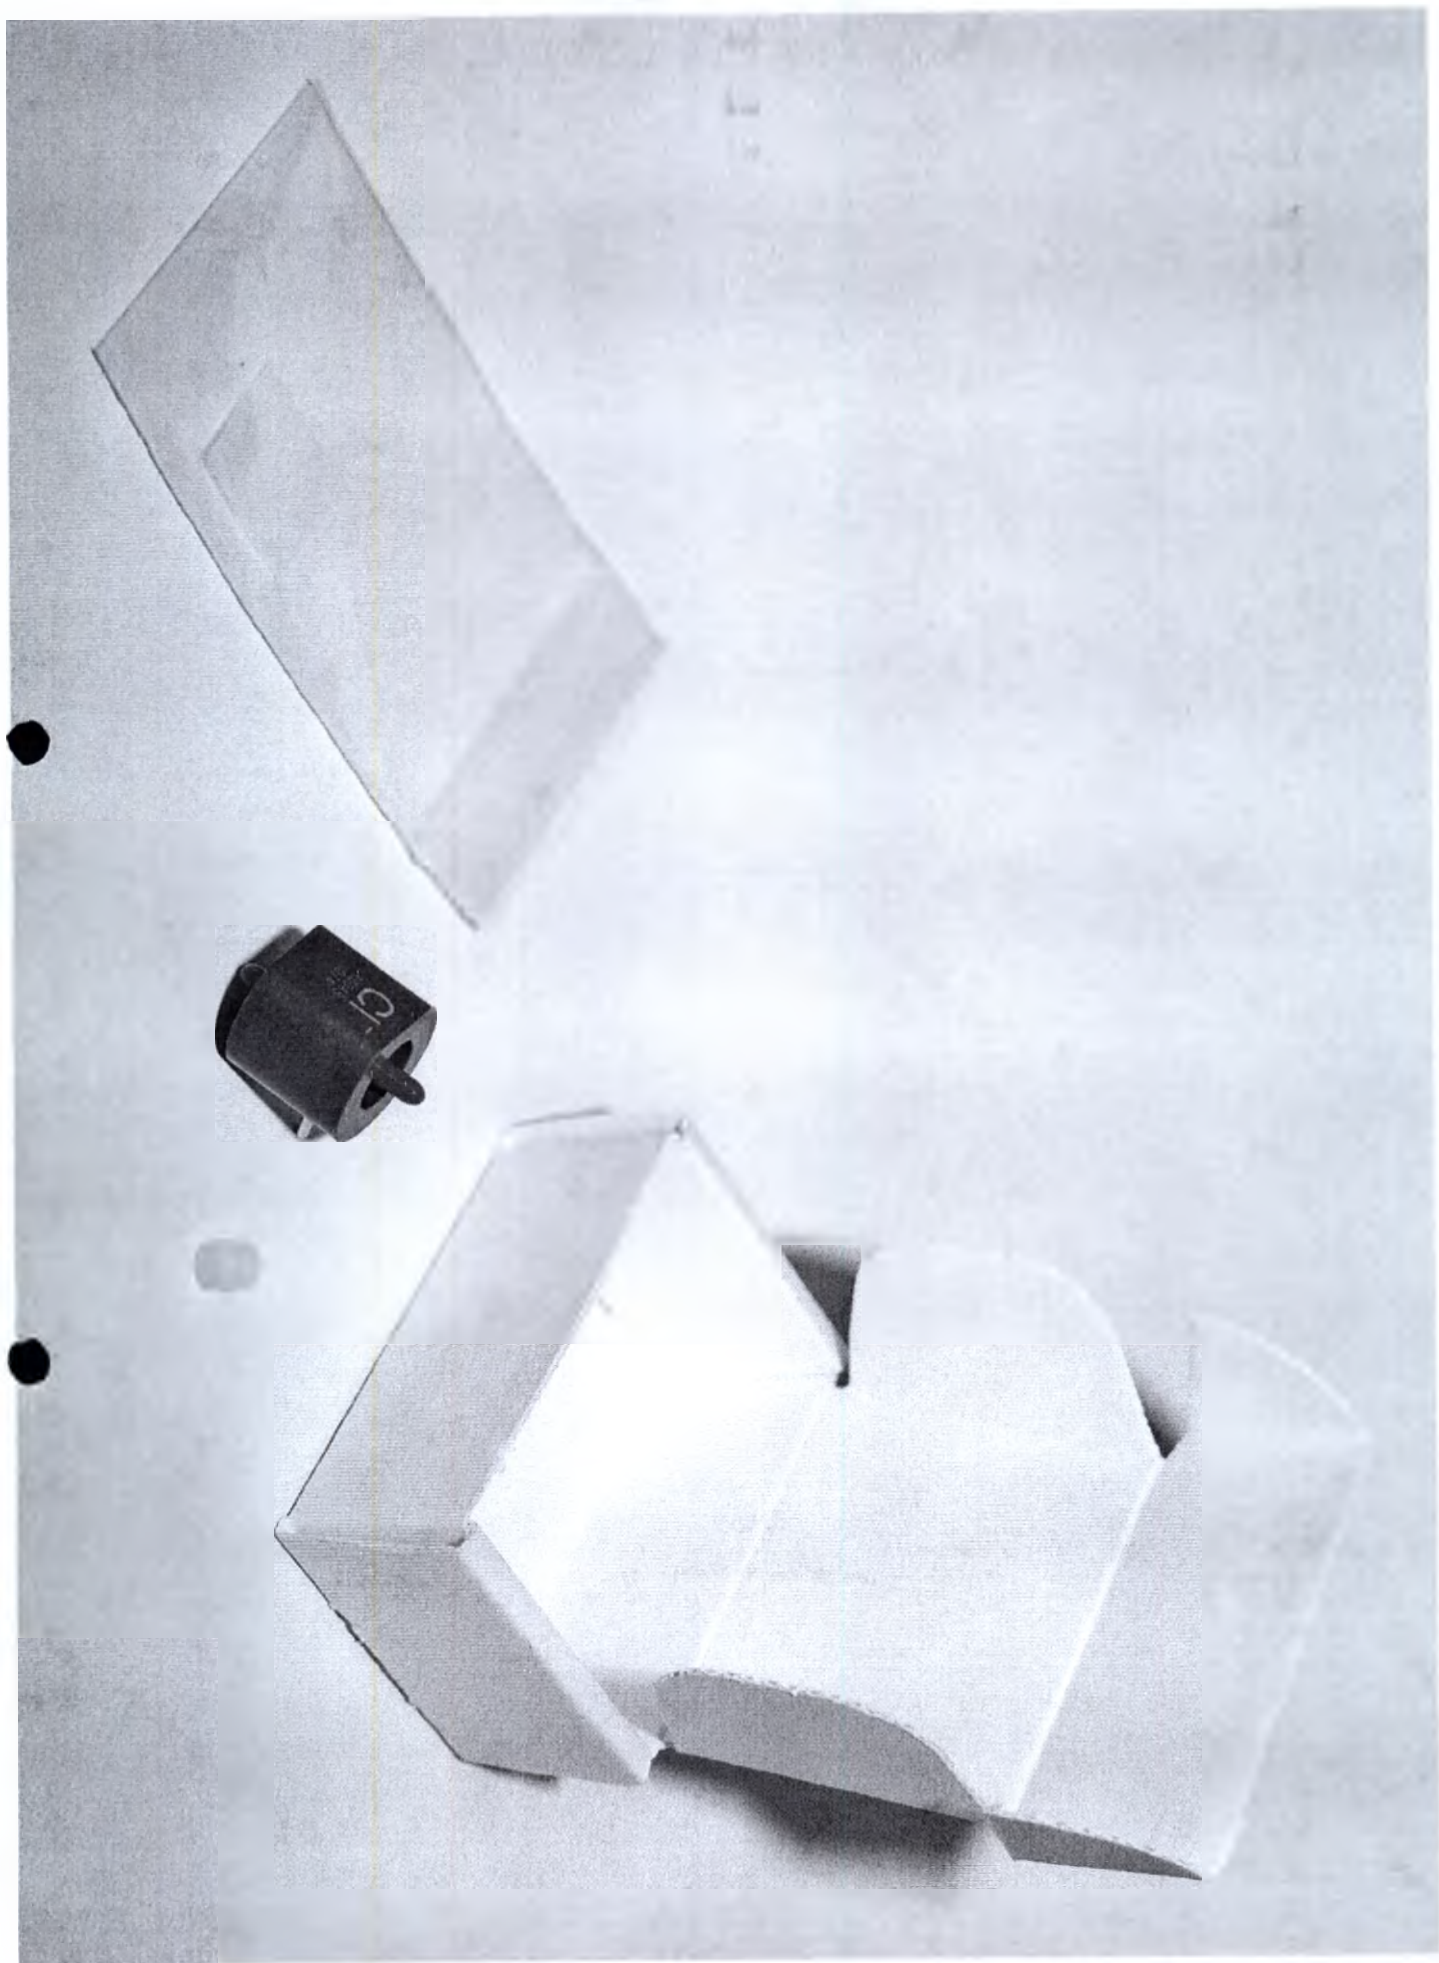

Электрод измерительный «Cl-» (Cl- (Chloride) Electrode)

Кат. № 2113

Lot №18111

Годен до: 04.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro.
с принадлежностями: Электрод измерительный «Cl-» (Cl- (Chloride) Electrode)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,

Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре 4-25°C. Хранить при температуре 4-25°C.

Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см.

вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и

документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп. 1



Маркировка: Электрод измерительный «Cl-» (Cl- (Chloride) Electrode)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2106



Lithium Electrode
Electrode de Lithium
Electrodo Litio
Lithium Elektrode
Electrodo de Litio
Elektrodo litio
Lithium Elektrode

For use with EasyLyte Analyzers
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte
Per uso con gli analizzatori EasyLyte
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren
Para usar en los analizadores EasyLyte
Para utilizar con analizadores EasyLyte
EasyLyte analizatorien le kütazim için

LOT 18065

2019-03-06

2018-03-06

(01) 00386100003005
(10) 18065
(11) 180306
(15) 190306
(422) B40


GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
3 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Europe: Europe, Amsterdam 12
NL 2013 201 The Hague
The Netherlands


00386100003005

Электрод измерительный «Li+» (Li+ (Lithium) Electrode)

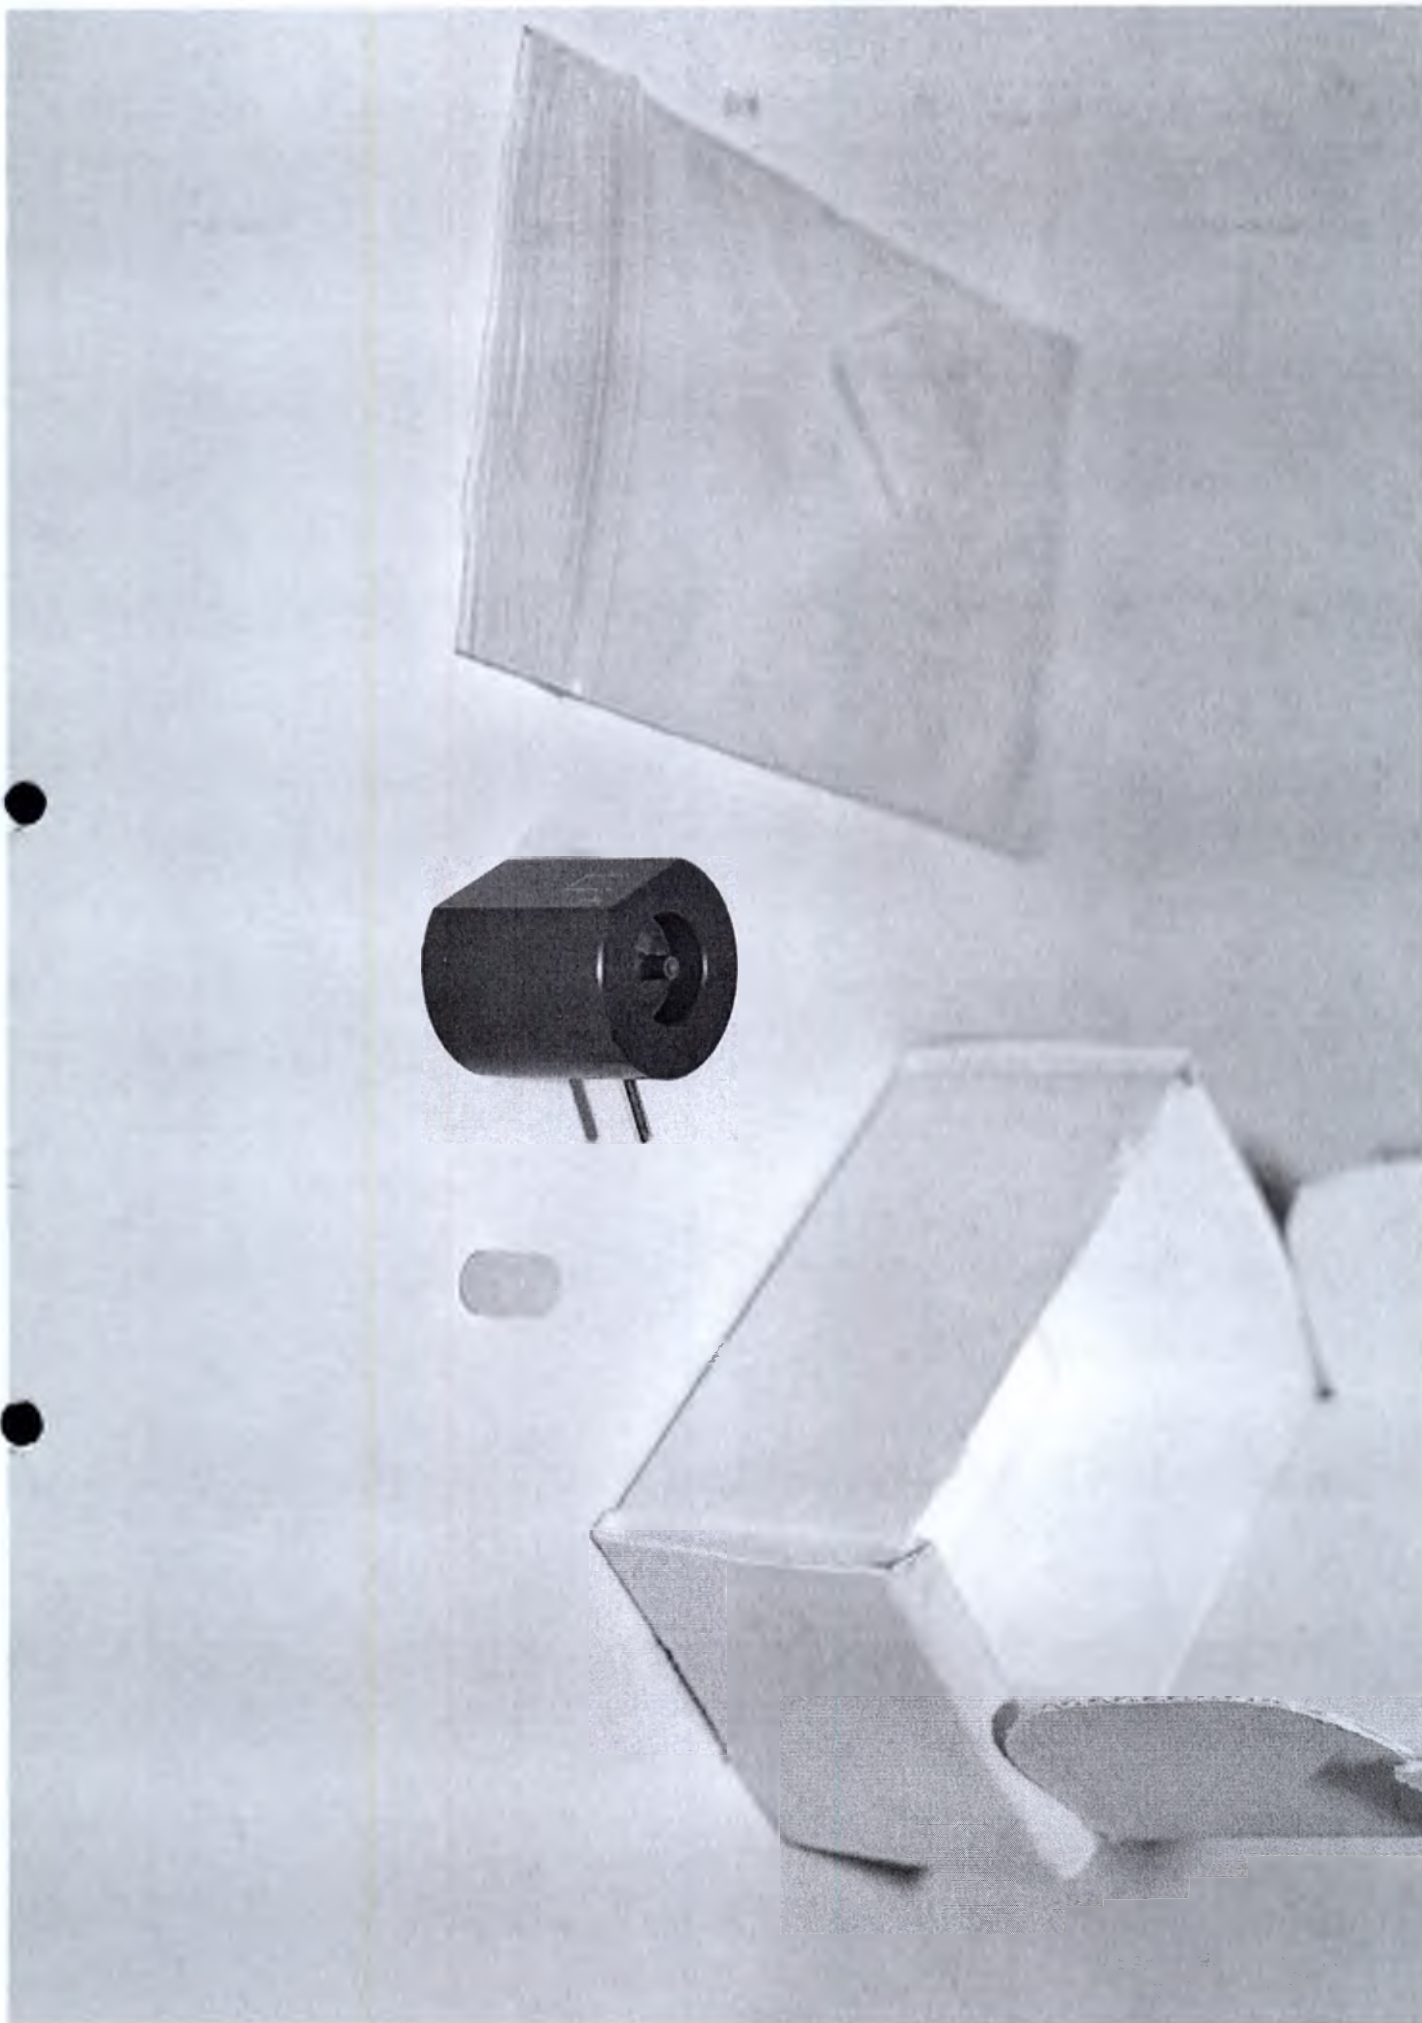

Электрод измерительный «Li+» (Li+ (Lithium) Electrode)

Кат. № 2106
Lot №18065
Годен до: 03.2019
Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, с
применением электродов измерительных «Li+» (Li+ (Lithium) Electrode)
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA
Транспортировка при температуре +25°C. Хранить при температуре +25°C.
Не замораживать!
Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.
Для лабораторной диагностики in vitro
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1



Маркировка: Электрод измерительный «Li+» (Li+ (Lithium) Electrode)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2150

Ca⁺⁺ Electrode
Électrode de calcium
Electrodo del Calcio
Kalzium Elektrode
Electrodo de Ca⁺⁺
Electrodo Ca⁺⁺
Ca⁺⁺ Elektrode

LOT 18101

2019-04-11

2018-04-11



(01) 00388100003135
(10) 18101
(11) 180411
(15) 190411
(422) 840




For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte-Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte analizatori de kaltsium qn.

GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US



Medica Corporation
10000 1st Ave. S.W.
Burien, OR 97149-1000
U.S.A.
© 2018 Medica Corporation
All rights reserved.

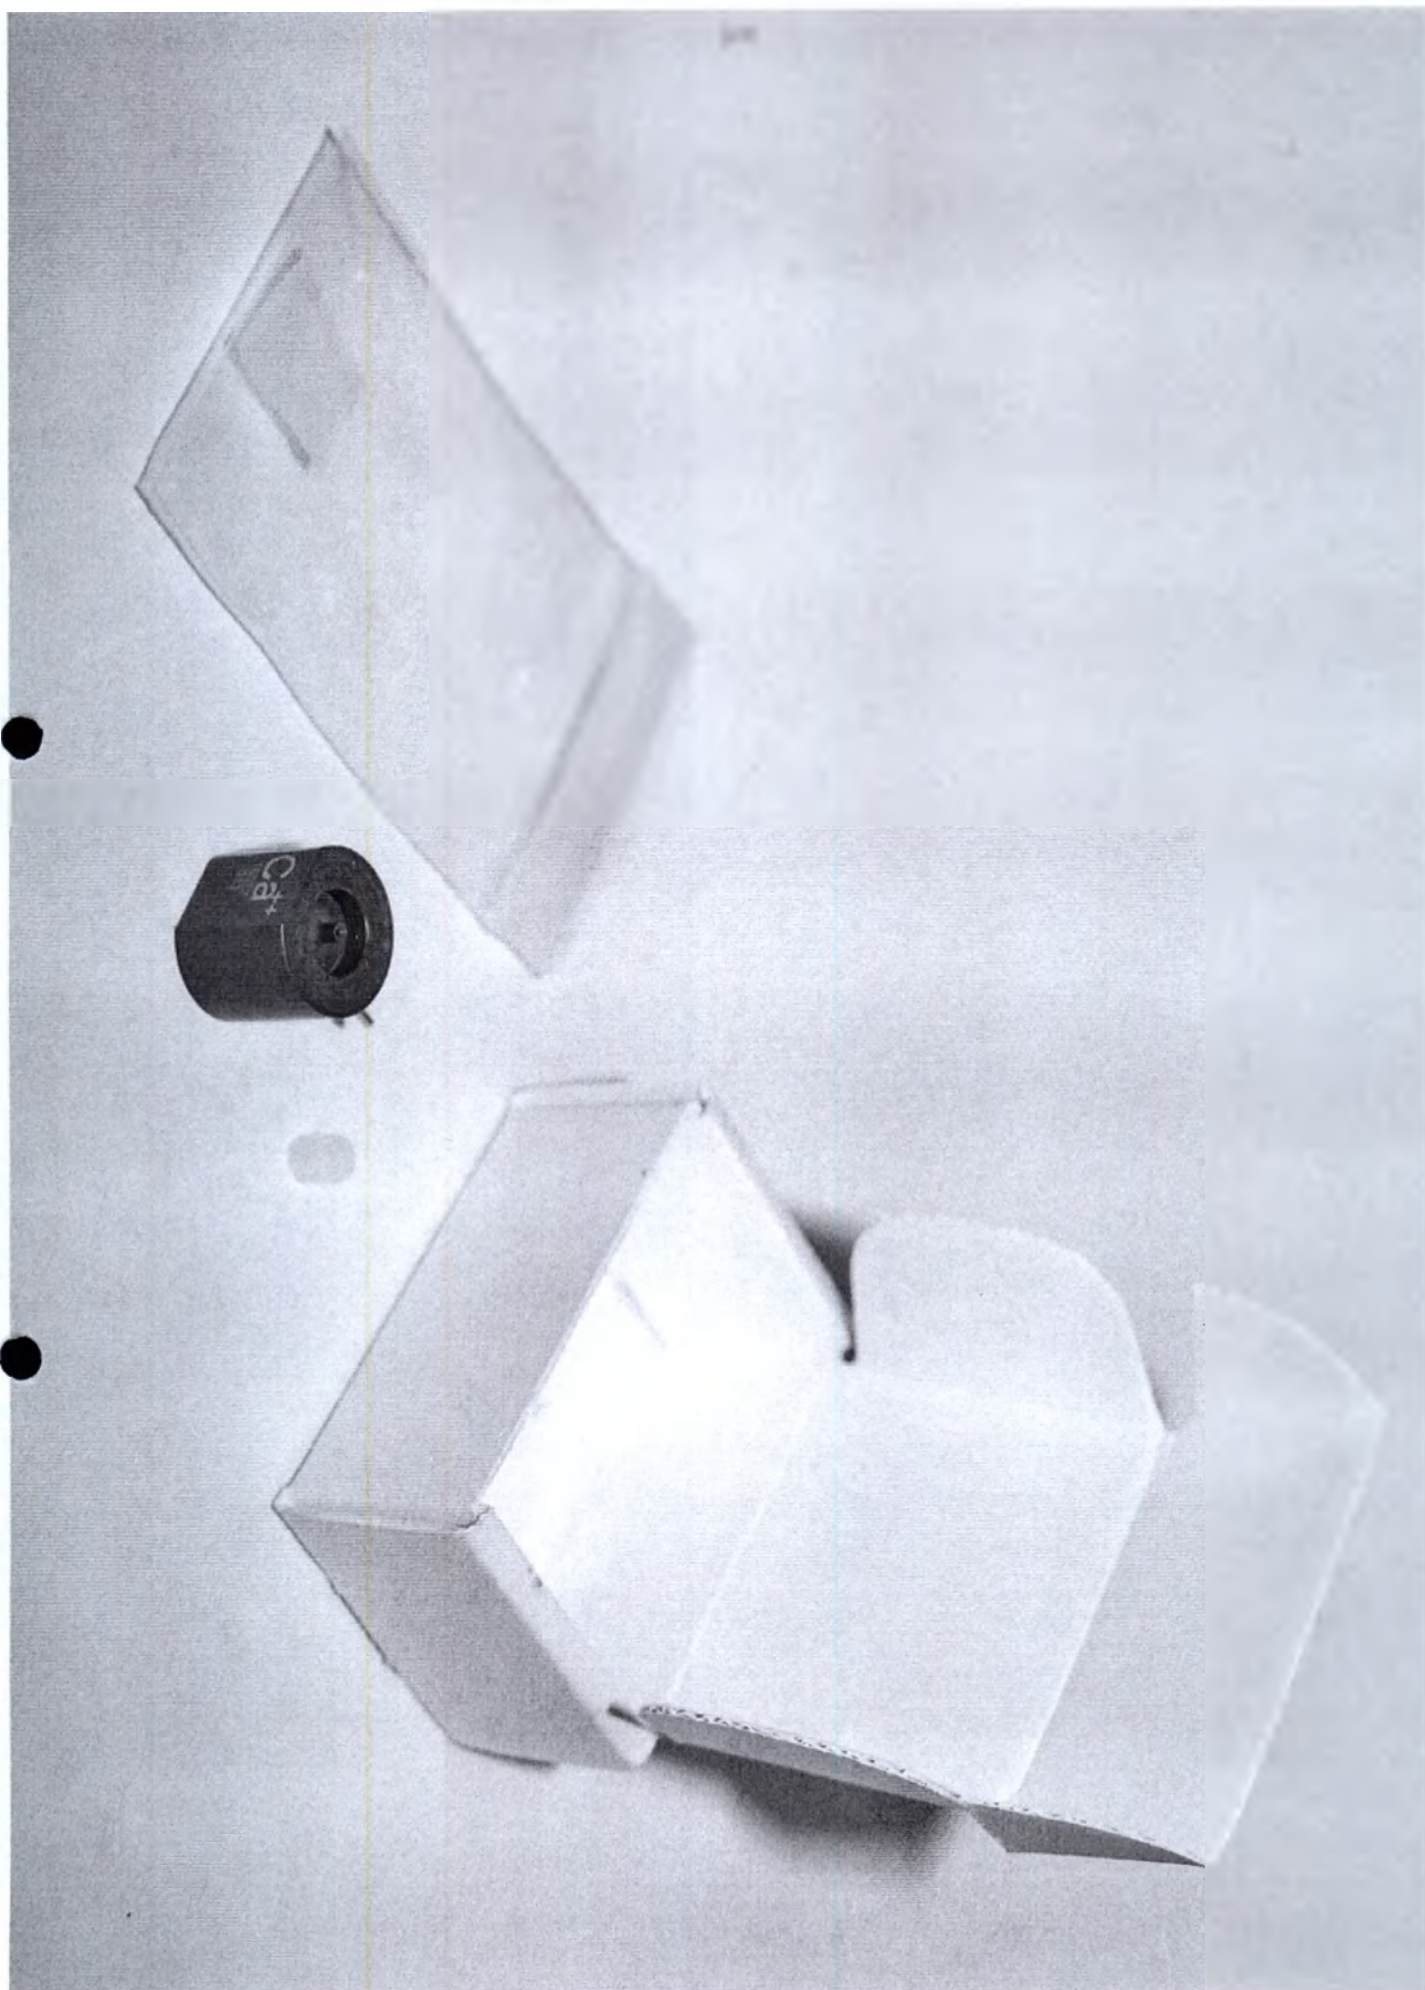

Электрод измерительный «Ca++» (Ca++ (Calcium) Electrode)

Кат. № 2150

Lot №18101

Годен до: 03.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики *in vitro*,
с принадлежностями. Электрод измерительный «Ca++» (Ca++ (Calcium) Electrode)


Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре 4-25°С. Хранить при температуре 4-25°С
Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*
Основные свойства и характеристики: состав, правила и условия использования. См.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и
документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Электрод измерительный «Ca++» (Ca++ (Calcium) Electrode)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2151

pH Electrode
Electrode de pH
Elettrodo pH
pH Elektrode
Electrodo de pH
Electrodo do pH
pH Elektrode

LOT 18032

2019-02-01

2018-02-01

(01) 00388100003142
(10) 18032
(11) 180201
(15) 190201
(422) 840


GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US

For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar com analisadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorak le baliaraz erabil daiteke.



Medica Corporation
1 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1000
MA, 01730-1000 The United States
The Netherlands

Электрод измерительный «рН» (Electrode pH)

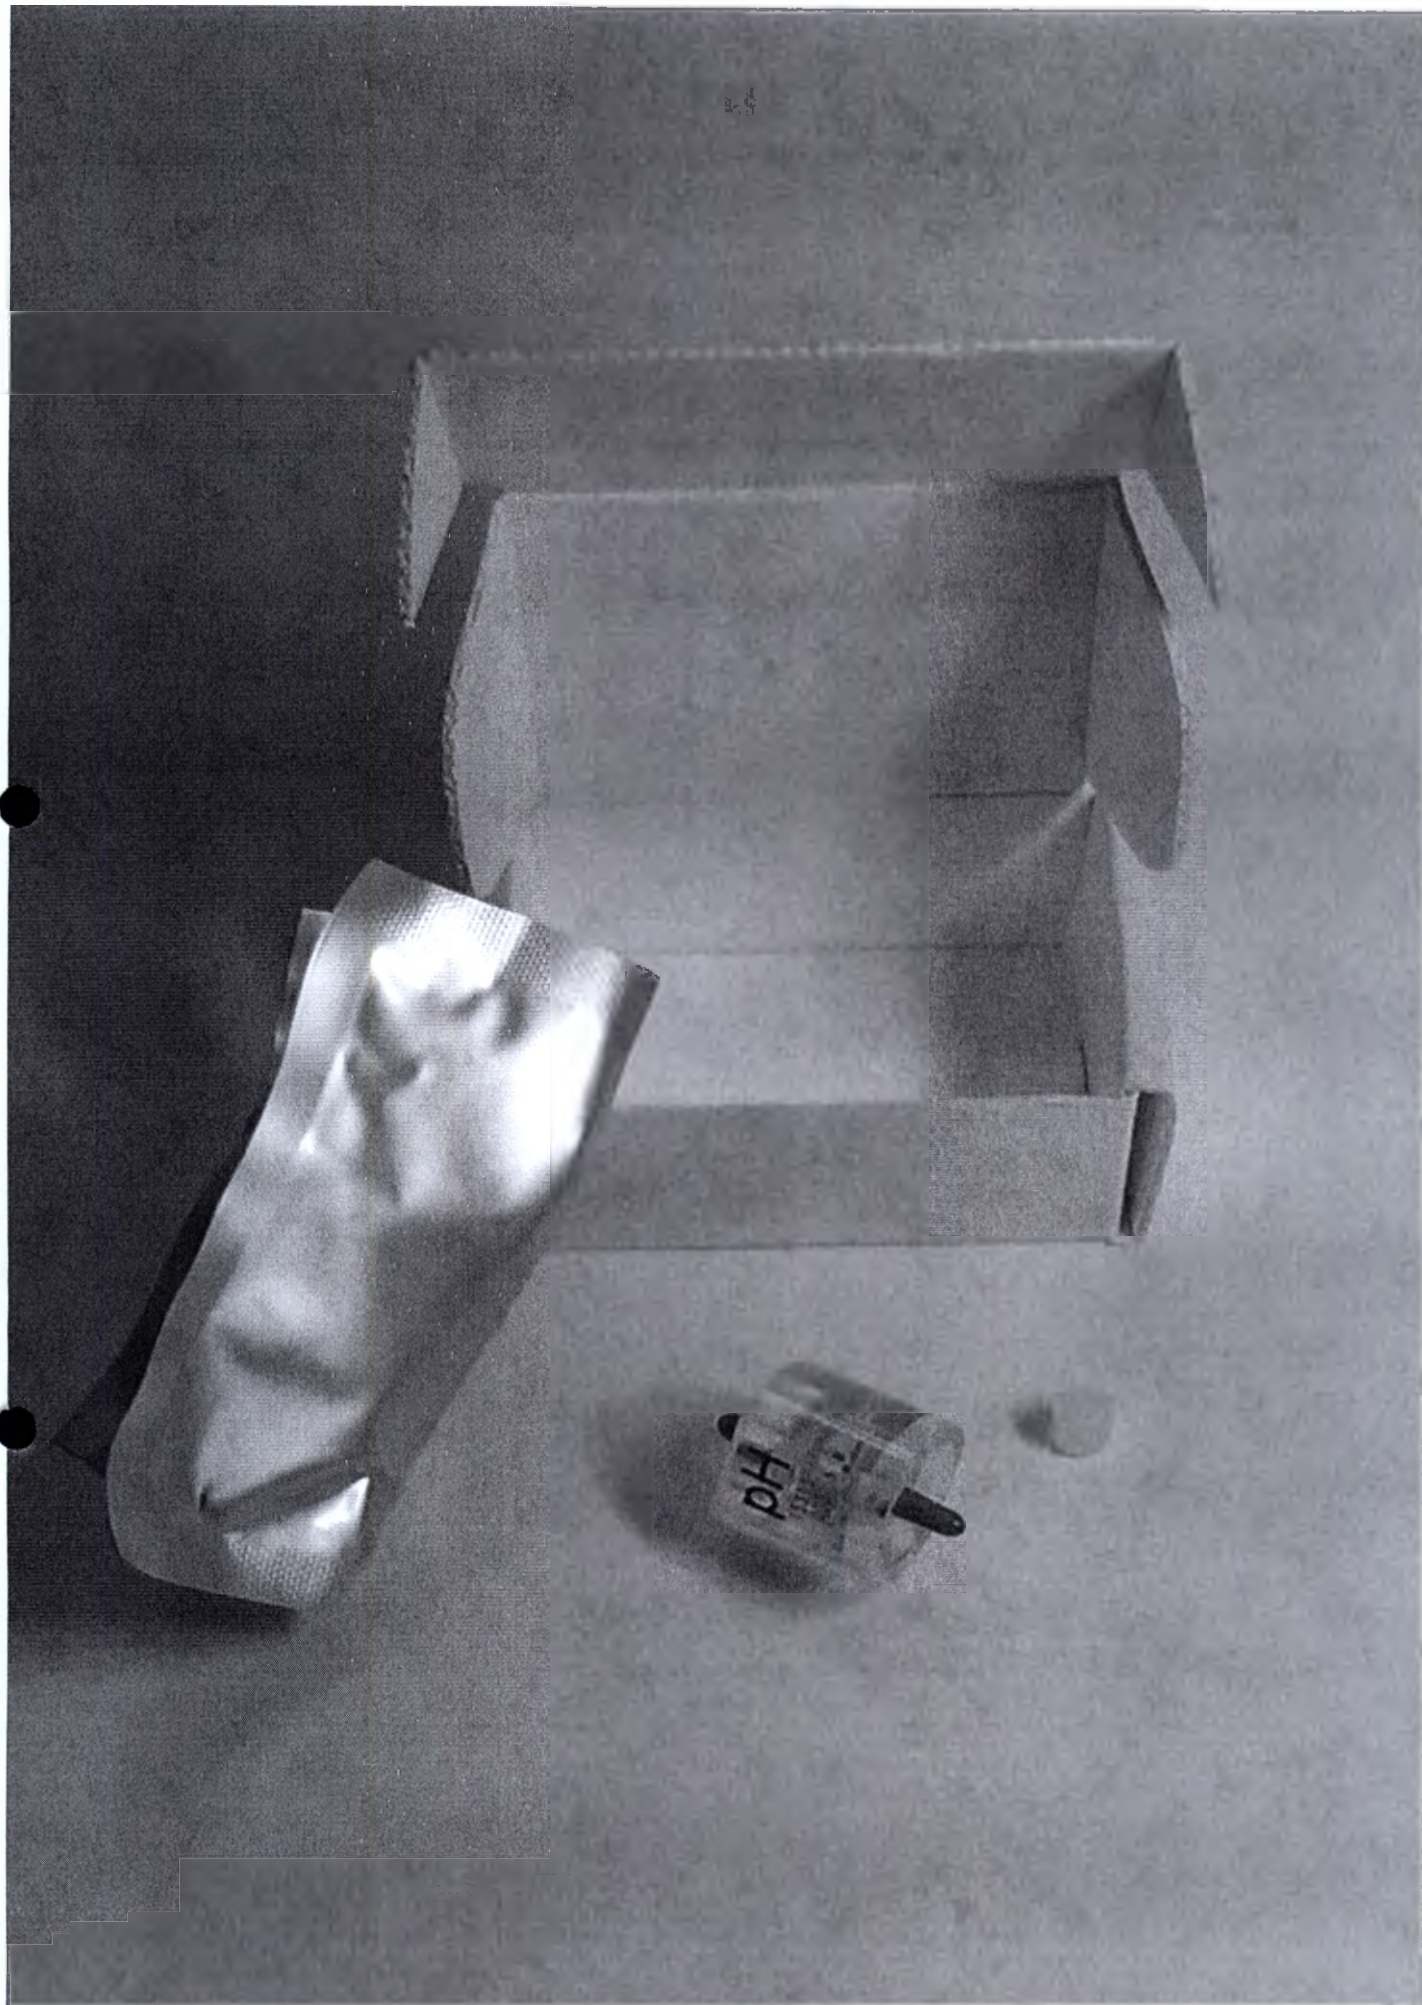

Электрод измерительный «рН» (Electrode pH)

Кат. №: 2151

Lot №18032

Годен до: 02.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики *in vitro*, с принадлежностями: Электрод измерительный «pH» (Electrode pH)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре +25°C. Хранить при температуре +4-25°C.
Не замораживать!


Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Электрод измерительный «pH» (Electrode pH)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2152

Disposable Reference Electrode
Electrode de référence jetable
Elettrodo Monouso di Riferimento
Wegwerf Bezugsselektrode
Electrodo de referencia desechable
Electrodo de referencia descartável
Sart Referans Elektrodu

For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorien lie kullannin için.

CE

MD

1

Store at 25°C
4°C

LOT 18087

2019-03-28

2018-03-28




(01) 00386100003159
(10) 18087
(11) 180328
(15) 190328
(422) 840


GTIN
LOT
PROD DATE
BEST BEFORE
ORIGIN US

Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1419 USA
Emergo Europa, Industriestraat 15
NL-2813 BN The Hague
The Netherlands

003779-008 R0

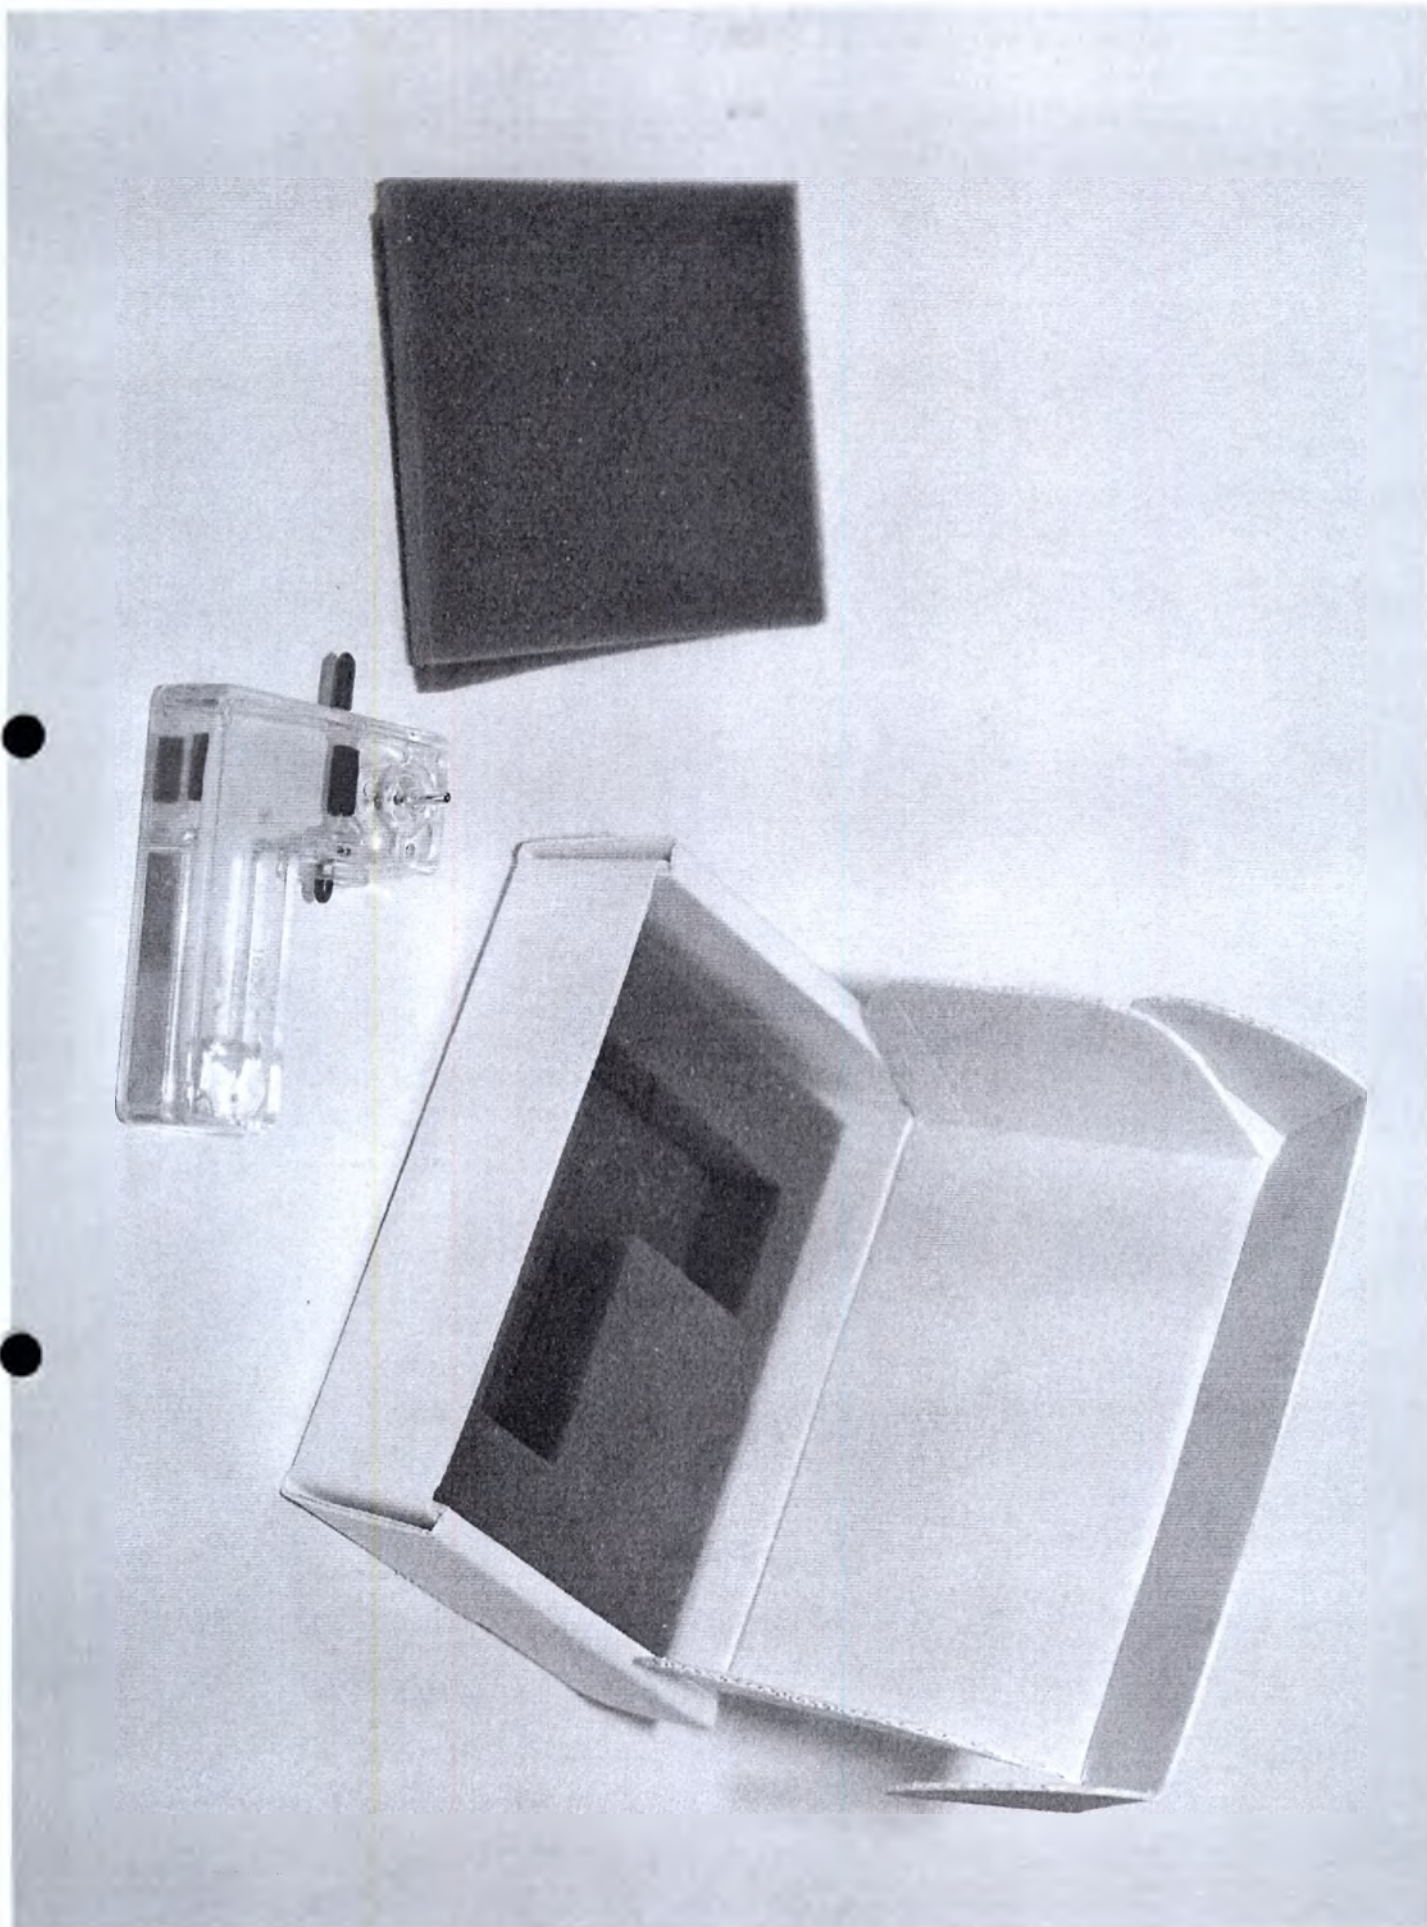

Электрод референсный (Disposable Reference Electrode)

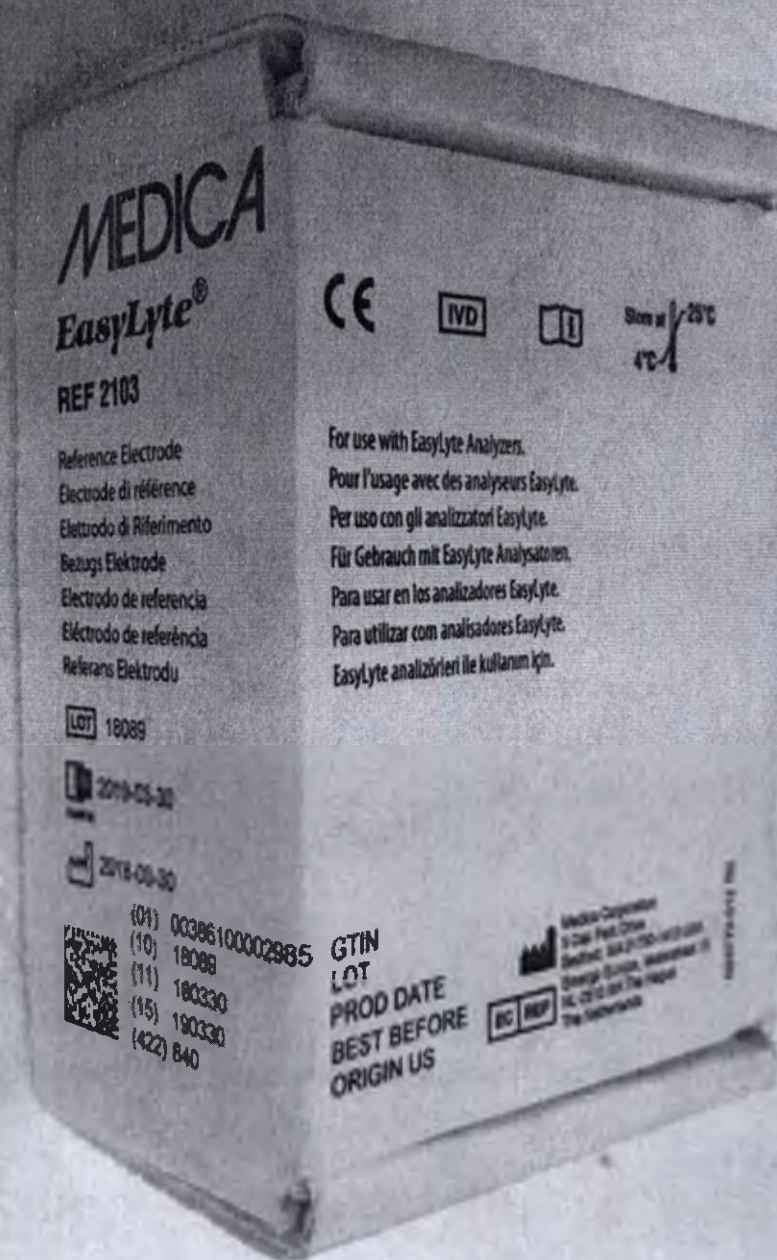

Электрод референсный (Reference Electrode)



Электрод референсный (Reference Electrode)

MEDICA
EasyLyte®

REF 2253

Membrane Assembly
Ensemble de membrane
Asamblea de la membrana
Membranhalter
Asamblea de la membrana
Lanjunto da membrana
Membran Düzenegi

LOT 18064


2018-03-05



(01) 00386100003173
(10) 18064
(11) 180305
(422) 840

Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Eemwa E. opo, Medica
ML-2019 BH The Hague, The Netherlands

BC REP



For use with EasyLyte Analyzers.
Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte.
Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte.
Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte Analizörleriyle kullanım için.

GTIN
LOT
PROD DATE
ORIGIN US

006278-008 R3

Сборка мембраны (Membrane Assembly)

Кат. № 2258

Lot № 18064

Анализатор электролитов крови Easy Lyte® для лабораторной диагностики in vitro,
с принадлежностями Сборка мембраны (Membrane Assembly)

Транспортировка при температуре +25°C. Хранить при температуре +25°C

Не замораживать!

Производитель MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,

Bedford, Massachusetts 01730 USA

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.


Для лабораторной диагностики in vitro


Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и

документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1



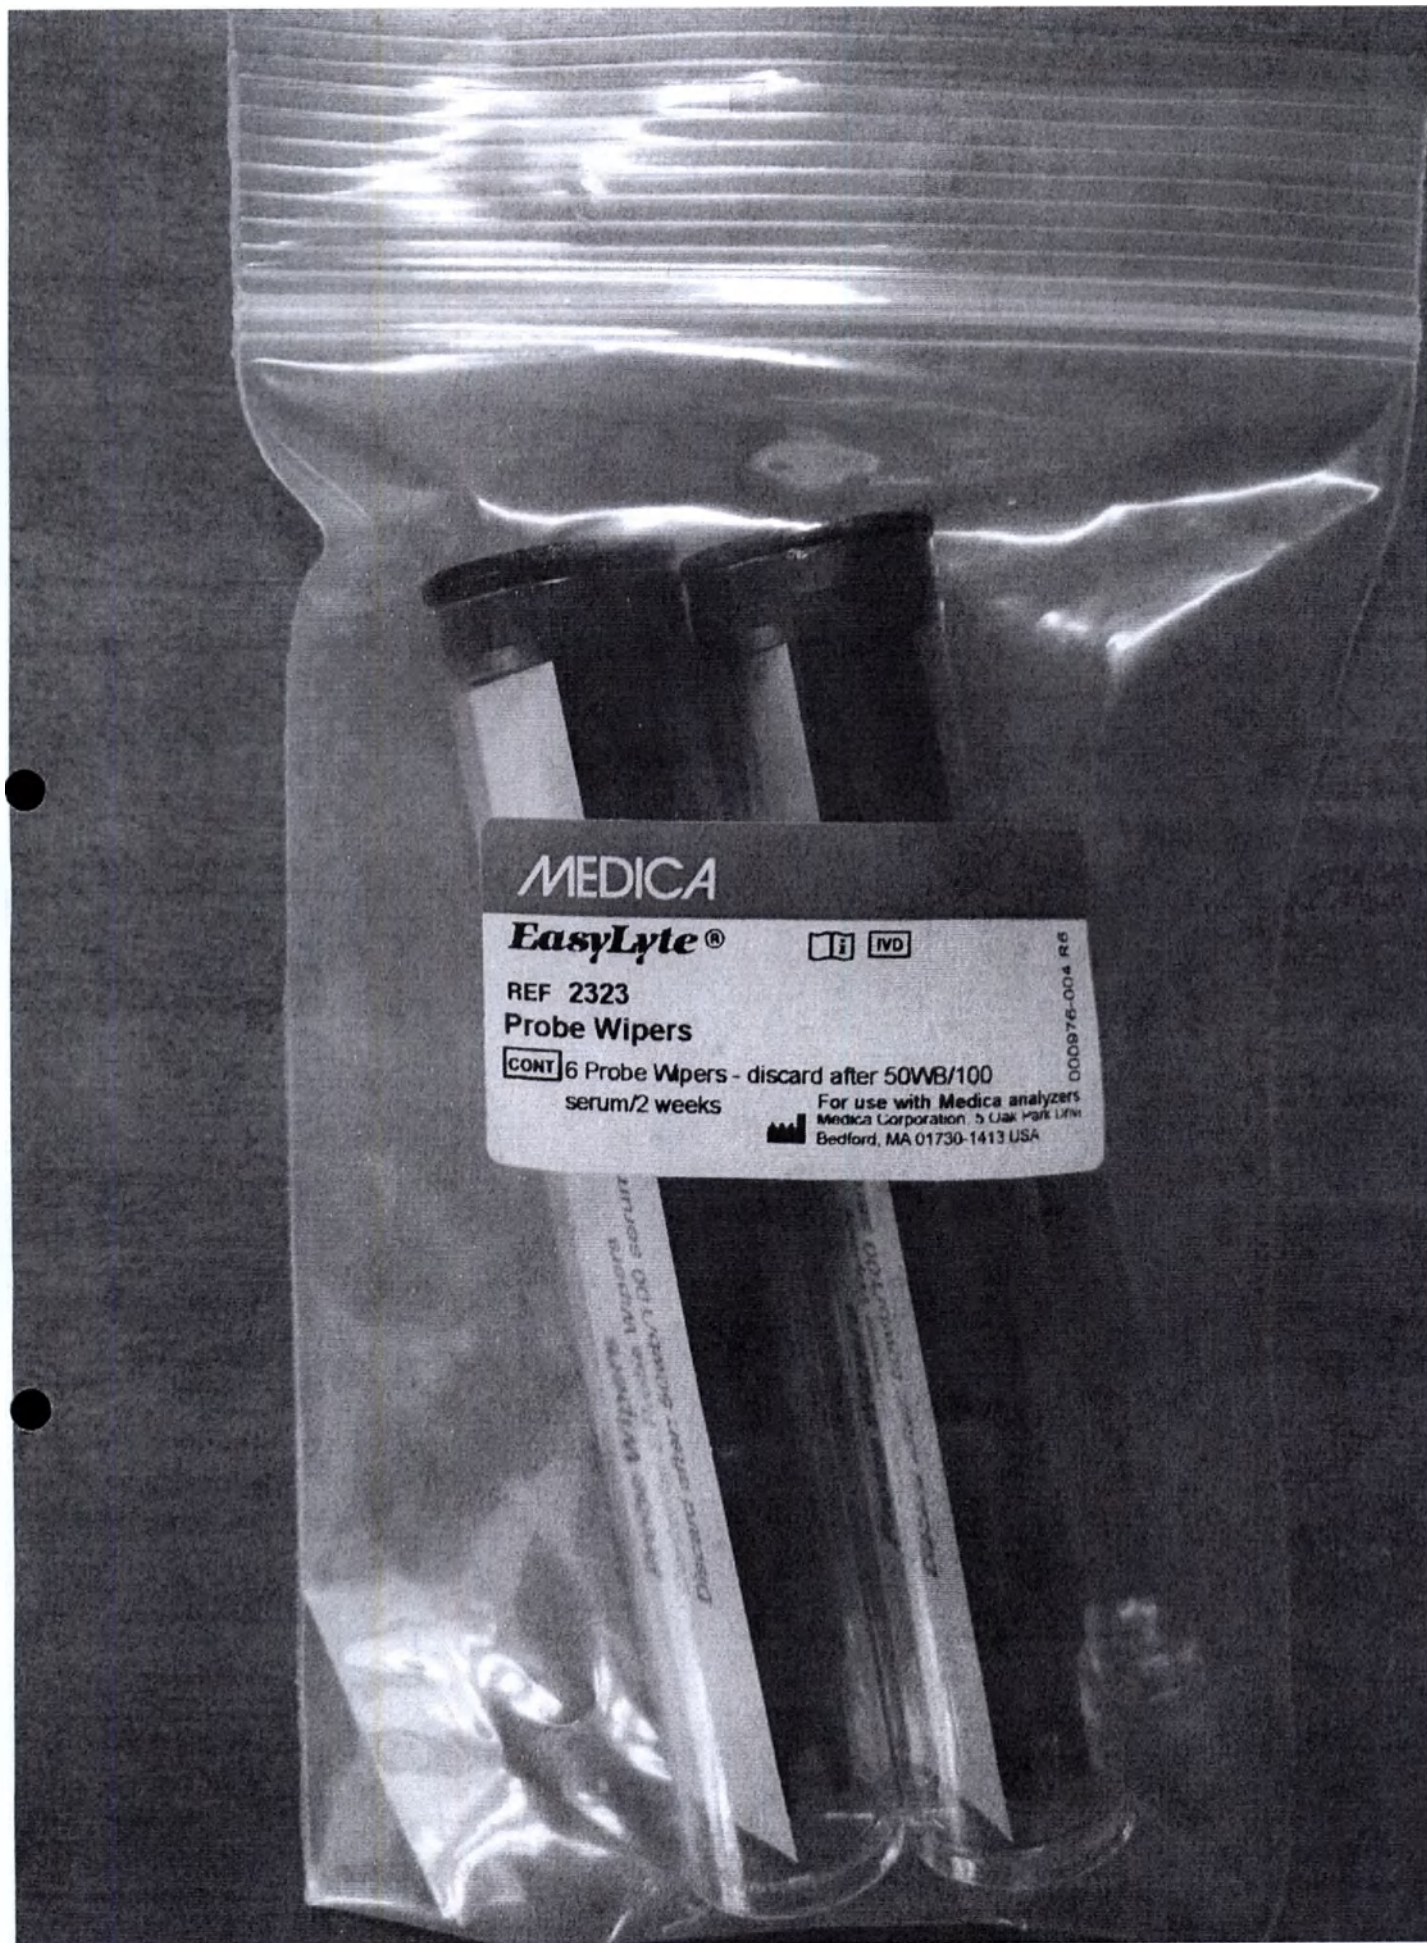

Осушитель зонда (Probe Wipers), 2 тубуса по 3шт./тубус

MEDICA
EasyLyte®

REF 2104

Tubing Kit

Tüp Takımı



2018-02-27



(01) 00388100003302
(10) 18058
(11) 180227
(422) 840

Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Energie Europe, Molenstraat 15
NL-2515 SM The Hague, The Netherlands

EC REP

IWD



CONT

1 sample tube, 1 pump tube

For use with Medica analyzers.

Medica Analizörleriyle kullanım için.

GTIN
LOT
PROD DATE
ORIGIN US

000671-015 RS

Комплект трубок (Tubing Kit): трубка насоса; трубка для образцов



Кат. №: 2104

Lot №18058

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики 10 Y100, с принадлежностями: Комплект трубок (Tubing Kit): трубка насоса, трубка для образцов.

Состав: трубка насоса (1 шт.); трубка для образцов (1 шт.)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,

Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/1638 от 03.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики 10 Y100


Основные сведения и характеристики, состав, правила и условия использования, см. прилагаемую инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129341, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Комплект трубок (Tubing Kit): трубка насоса; трубка для образцов

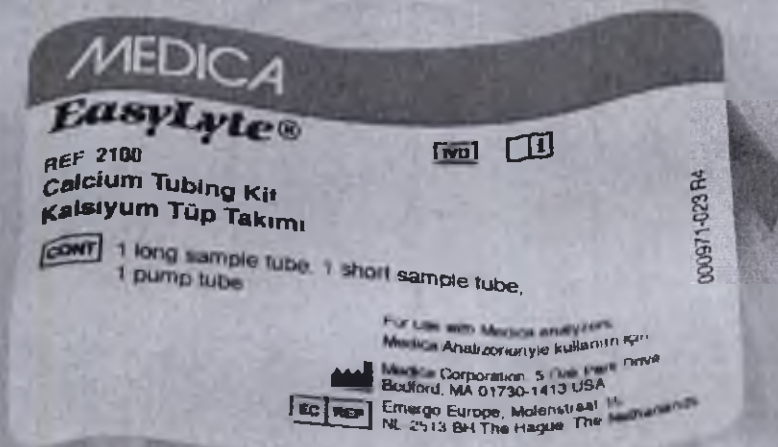


Комплект трубок (Calcium Tubing Kit): трубка насоса; трубка для образцов, 2 шт.

Кат. № 2100
Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro,
с принадлежностями.
Комплект трубок (Calcium Tubing Kit): трубка насоса; трубка для образцов, 2 шт.
Состав: трубка насоса (1 шт.); трубка для образцов (2 шт.).
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA
Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.
Для лабораторной диагностики in vitro
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и
документы по товару доступны на сайте: www.analytika.ru
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Комплект трубок (Calcium Tubing Kit): трубка насоса; трубка для образцов, 2 шт.

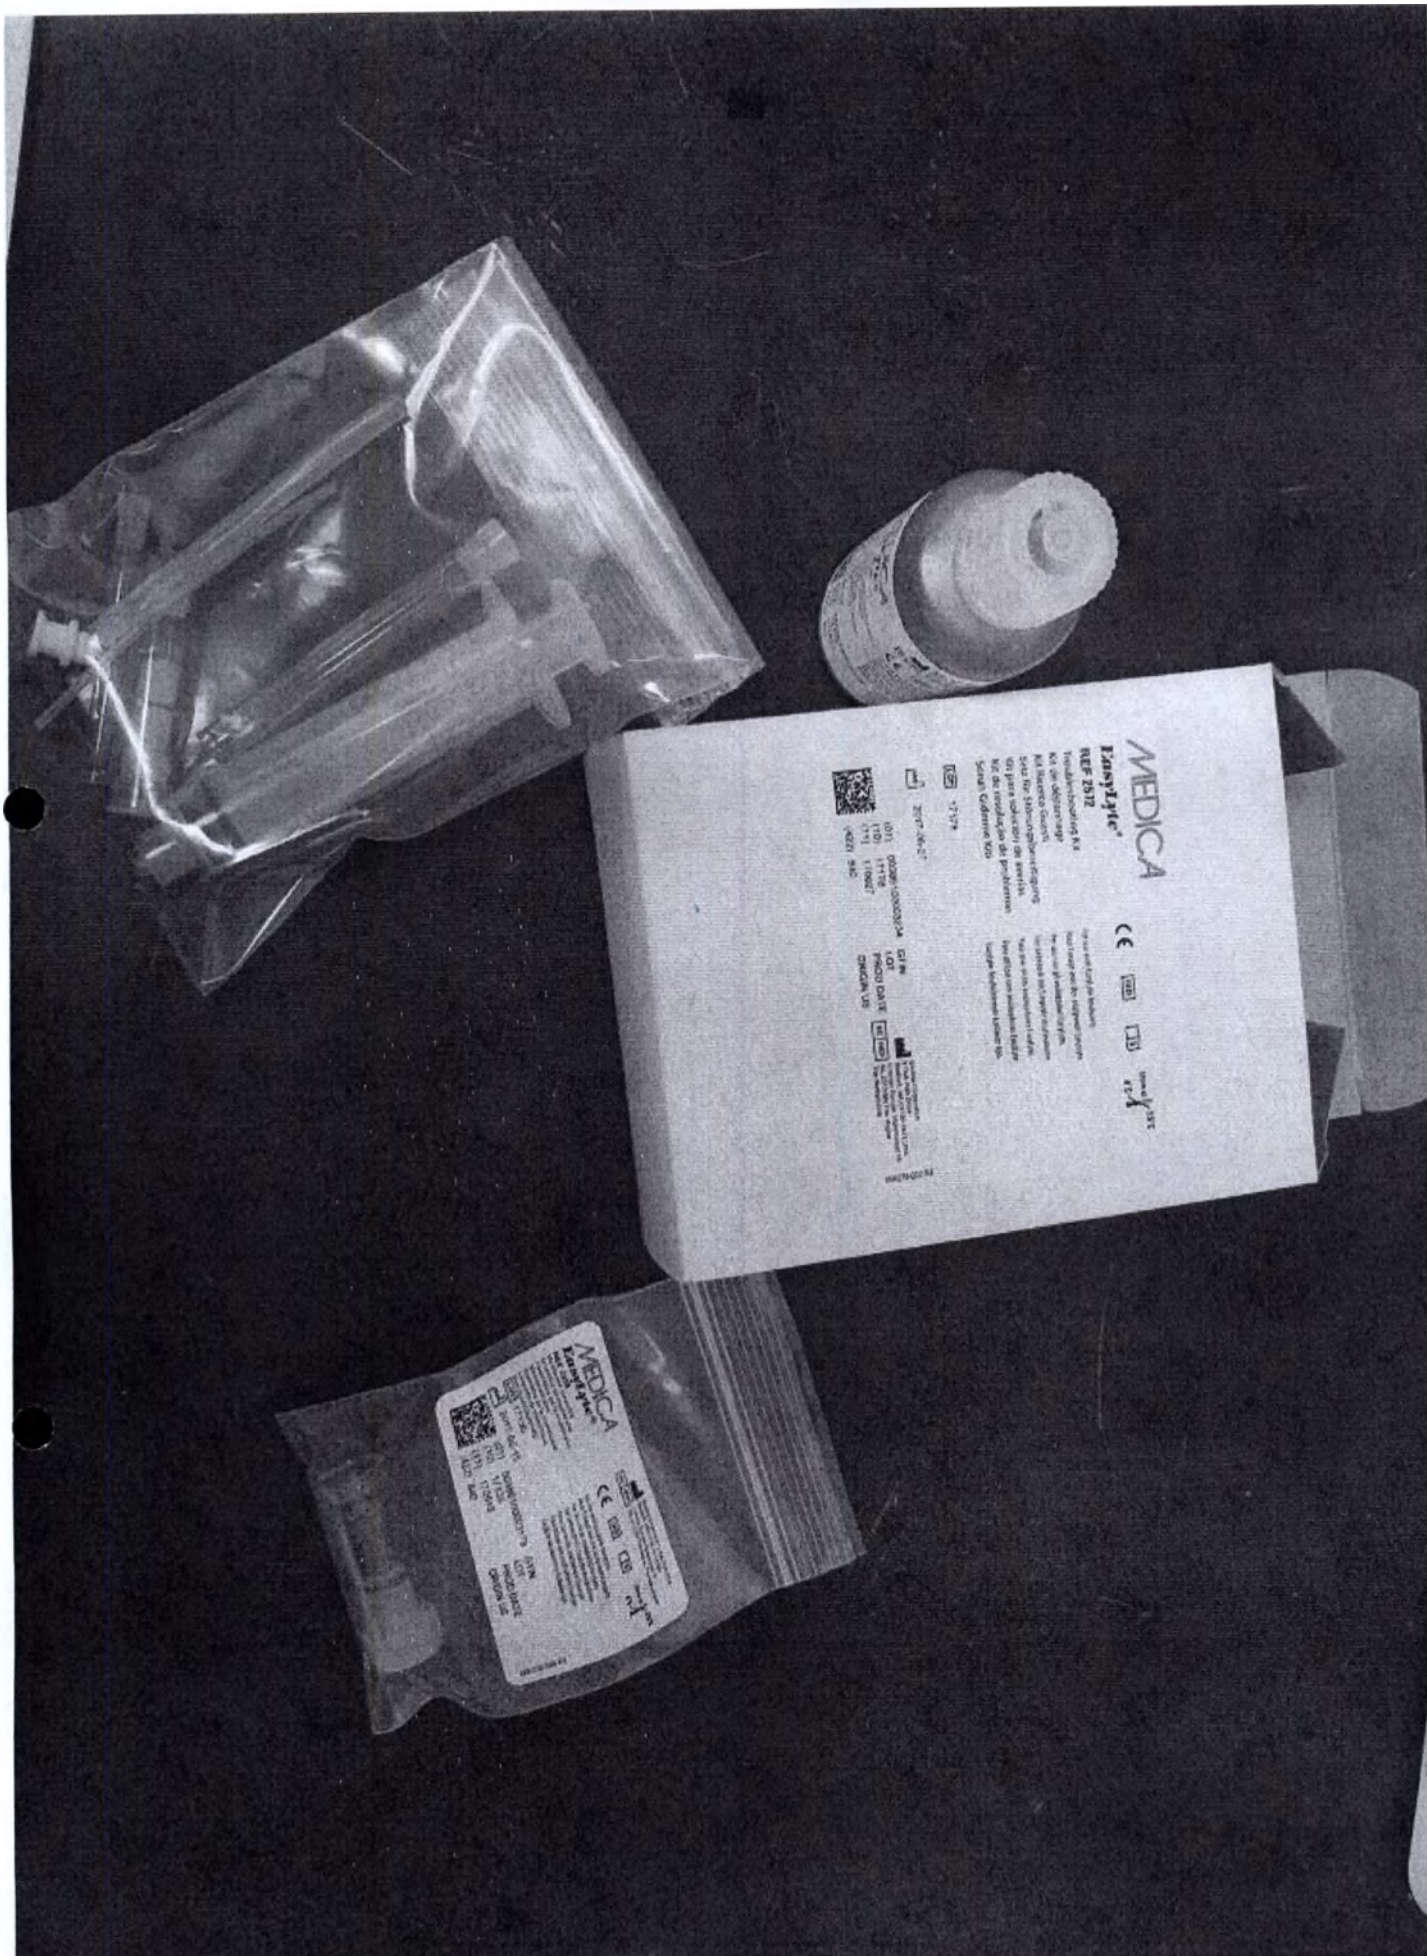

Ремонтный набор (Troubleshooting Kit): шприц; игла; трубки, 2 шт.; щетка для прочистки электрода; уплотнители для электродов, 4 шт.; заглушка; ключ для электрода; пробка; сборка мембраны; тест-раствор

MEDICA

EasyLyte®

REF 2572

Troubleshooting Kit
Kit de dépannage
Kit Ricerca Guasti
Satz für Störungsbeseitigung
Kit para solución de averías
Kit de resolução de problemas
Sorun Giderme Kiti



Store at 25°C
4°C

For use with EasyLyte Analyzers.

Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.

Per uso con gli analizzatori EasyLyte.

Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.

Para usar en los analizadores EasyLyte.

Para utilizar com analisadores EasyLyte.

EasyLyte Analizörleriyle kullanım için.


LOT 18108

2018-04-18



(01) 00386100003234
(10) 18108
(11) 180418
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
ORIGIN US



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emargo Europe, Molenstraat 15
NL-2513 BZ The Hague
The Netherlands

003279-002 R4

Ремонтный набор (Troubleshooting Kit): шприц; игла; трубки, 2 шт.; щетка для прочистки электрода; уплотнители для электродов, 4 шт.; заглушка; ключ для электрода; пробка; сборка мембраны; тест-раствор

MEDICA
EasyLyte®

REF 2108


Solutions Valve
Solüsyon Valfi

LOT 17341

2017-12-07



(01) 00386100003012
(10) 17341
(11) 171207
(422) 840



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europe, Molensstraat 15
NL-2513 BH The Hague, The Netherlands




Store at 25°C
4°C

For use with Medica analyzers.
Medica Analizörlerle kullanılm içîn.

GTIN
LOT
PROD DATE
ORIGIN US

000971-012 R7

Перепускное устройство (Solutions Valve)

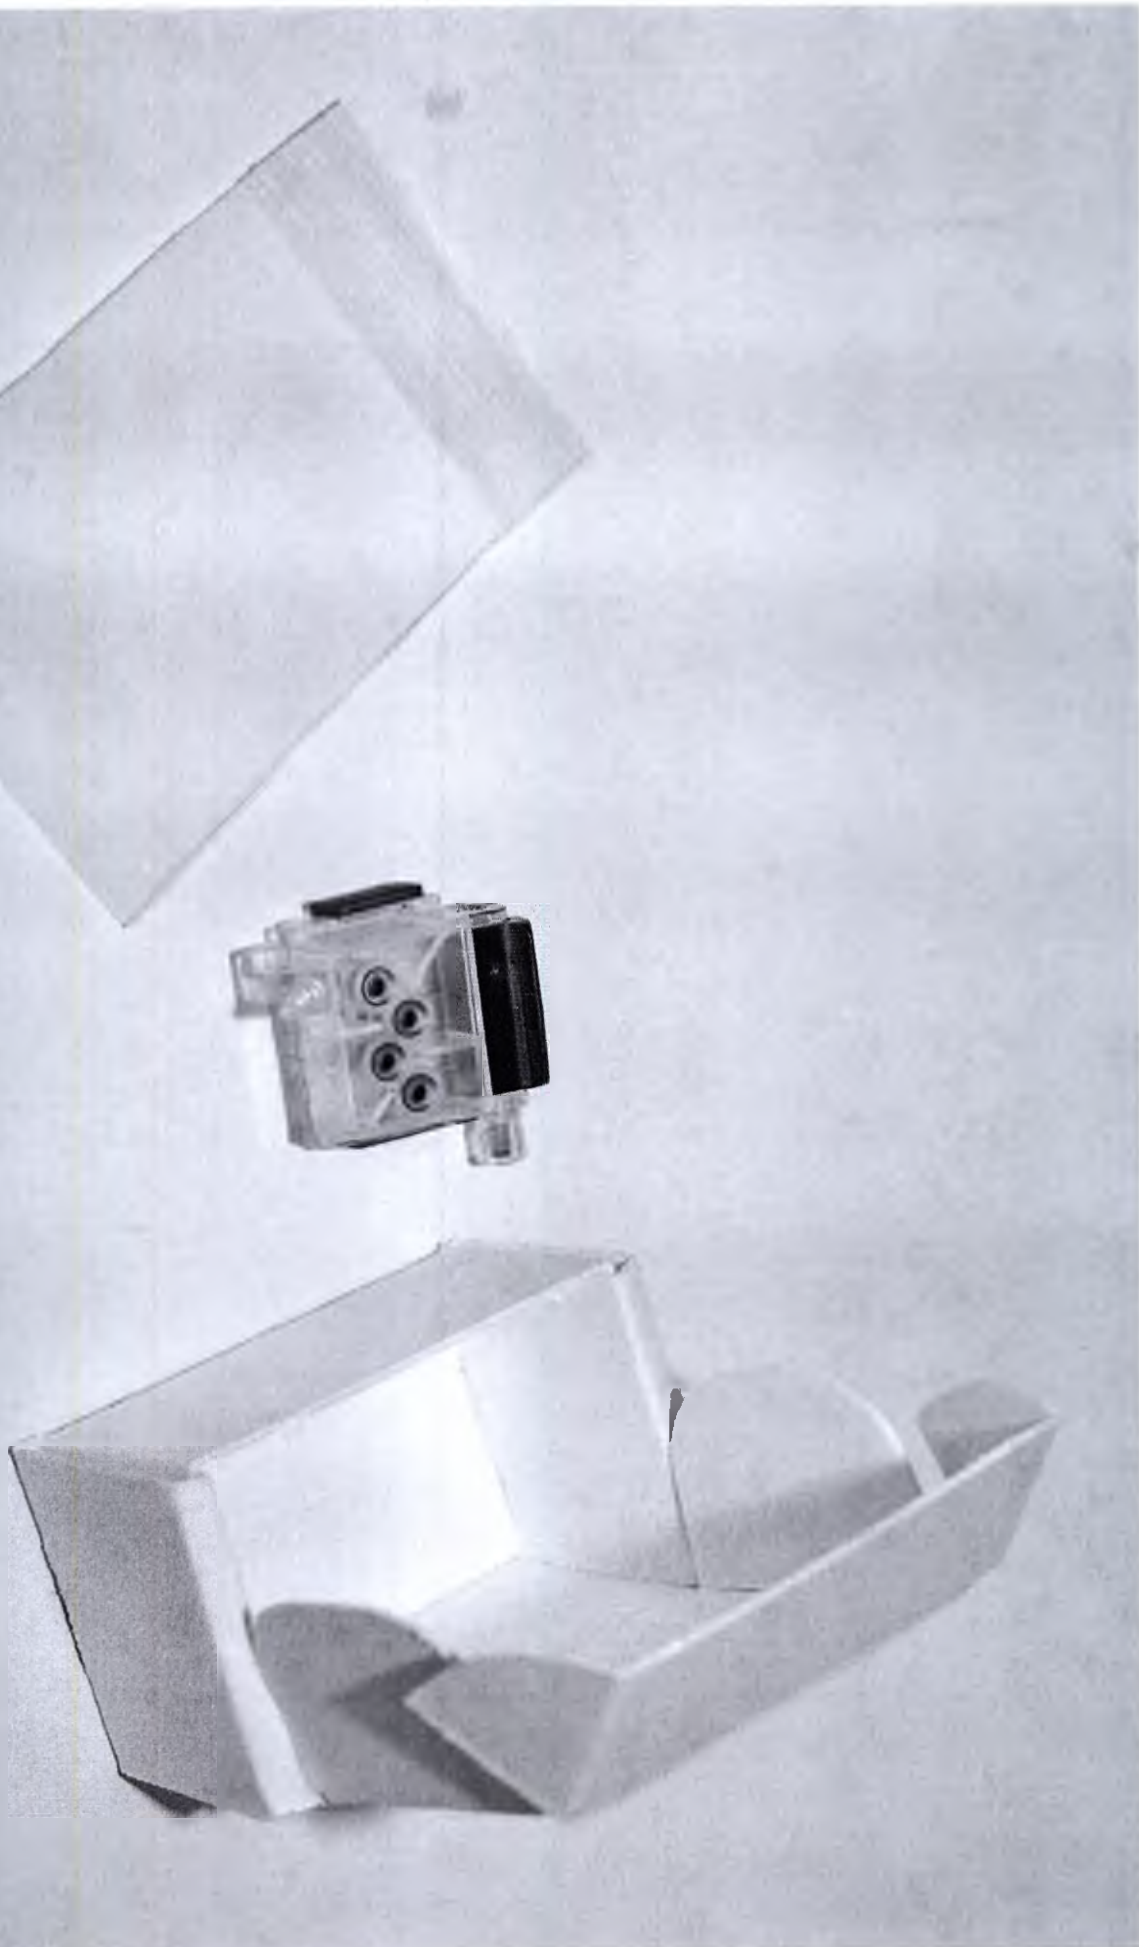

Перепускное устройство (Solutions Valve)

Кат. №: 2108

Lot №17341

Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro, с принадлежностями: Перепускное устройство (Solutions Valve)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре 4-25°C. Хранить при температуре 4-25°C.

Не замораживать!


Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1



Маркировка: Перепускное устройство (Solutions Valve)

MEDICA

EasyLyte
REF 2070

Elaborando un Armostador automatico

[illegible]

Ensign Europe Medical is
No. 251 B-1 The square The Netherlands

006278-199 R1

1981, p. 273) — «содержит более 1000 видов лекарственных растений и около 100 видов животных, птиц, насекомых, рыб, земноводных и рептилий». В настоящее время в парке находится 4200 видов растений, 420 видов животных, птиц, насекомых, рыб, земноводных и рептилий.

Организаторы: МЕДИКА Corporation, 1 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730, USA.

Средства транспортировки: авиатранспортом, в контейнере, в течение 10-15 дней.


Средства хранения: в холодильнике, в течение 10-15 дней.

Особенности: «содержит аборигенные лекарственные растения и животные, которые являются эндемиками и встречаются только в этой местности». «Содержит редкие виды животных и растений, которые не встречаются в других местах». «Содержит редкие виды животных и растений, которые не встречаются в других местах».


Транспортные средства: авиатранспортом, в контейнере, в течение 10-15 дней.

1981, p. 273) — «содержит более 1000 видов лекарственных растений и около 100 видов животных, птиц, насекомых, рыб, земноводных и рептилий». В настоящее время в парке находится 4200 видов растений, 420 видов животных, птиц, насекомых, рыб, земноводных и рептилий.



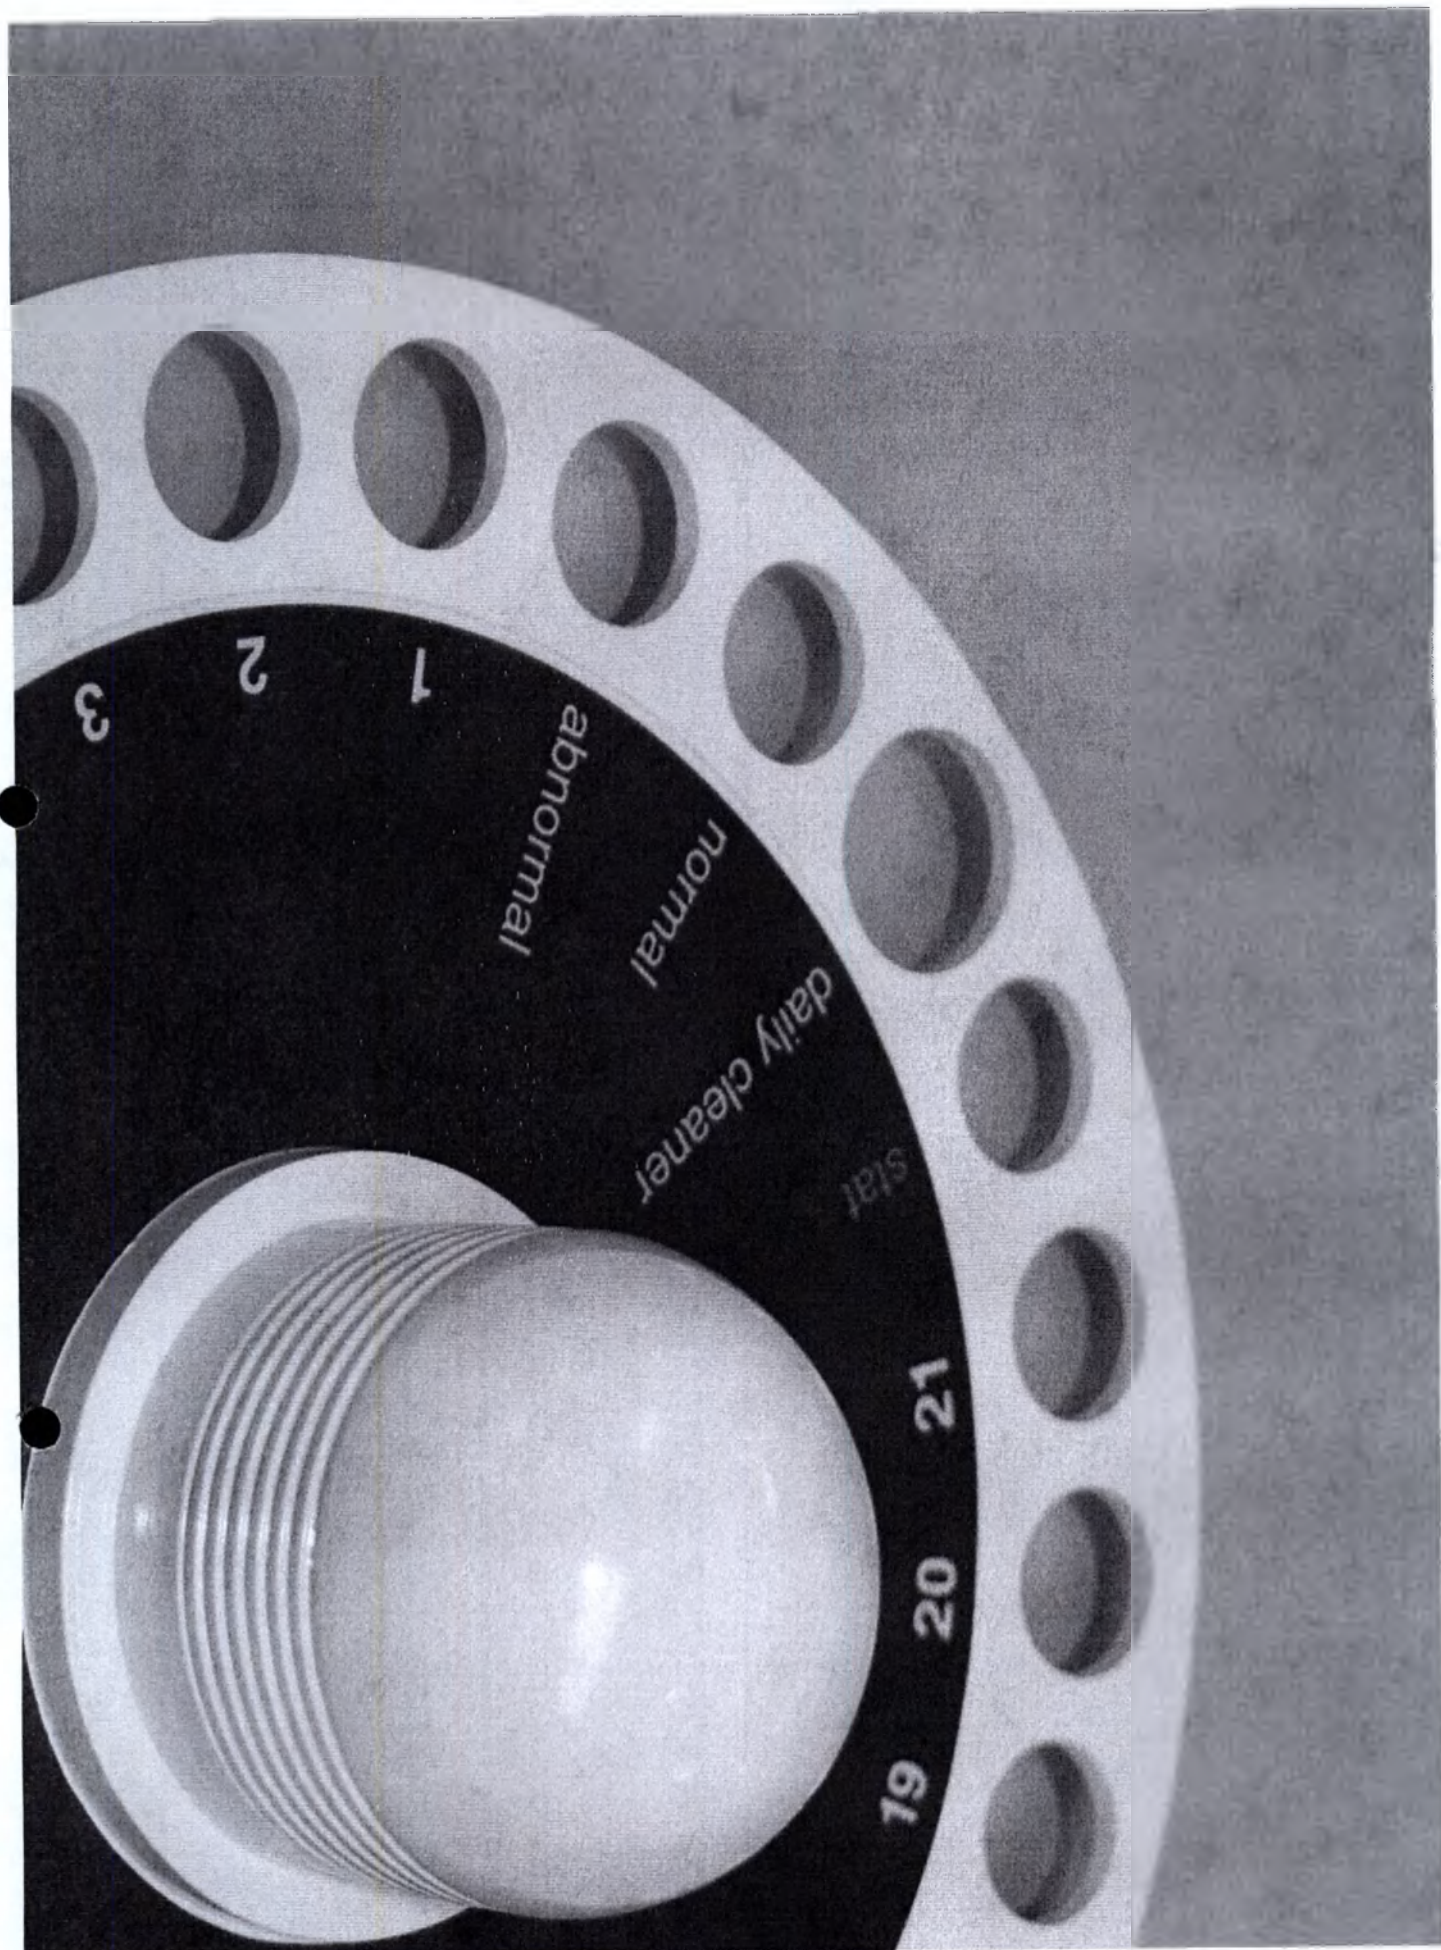

Карусель для проб (Sample Tray)

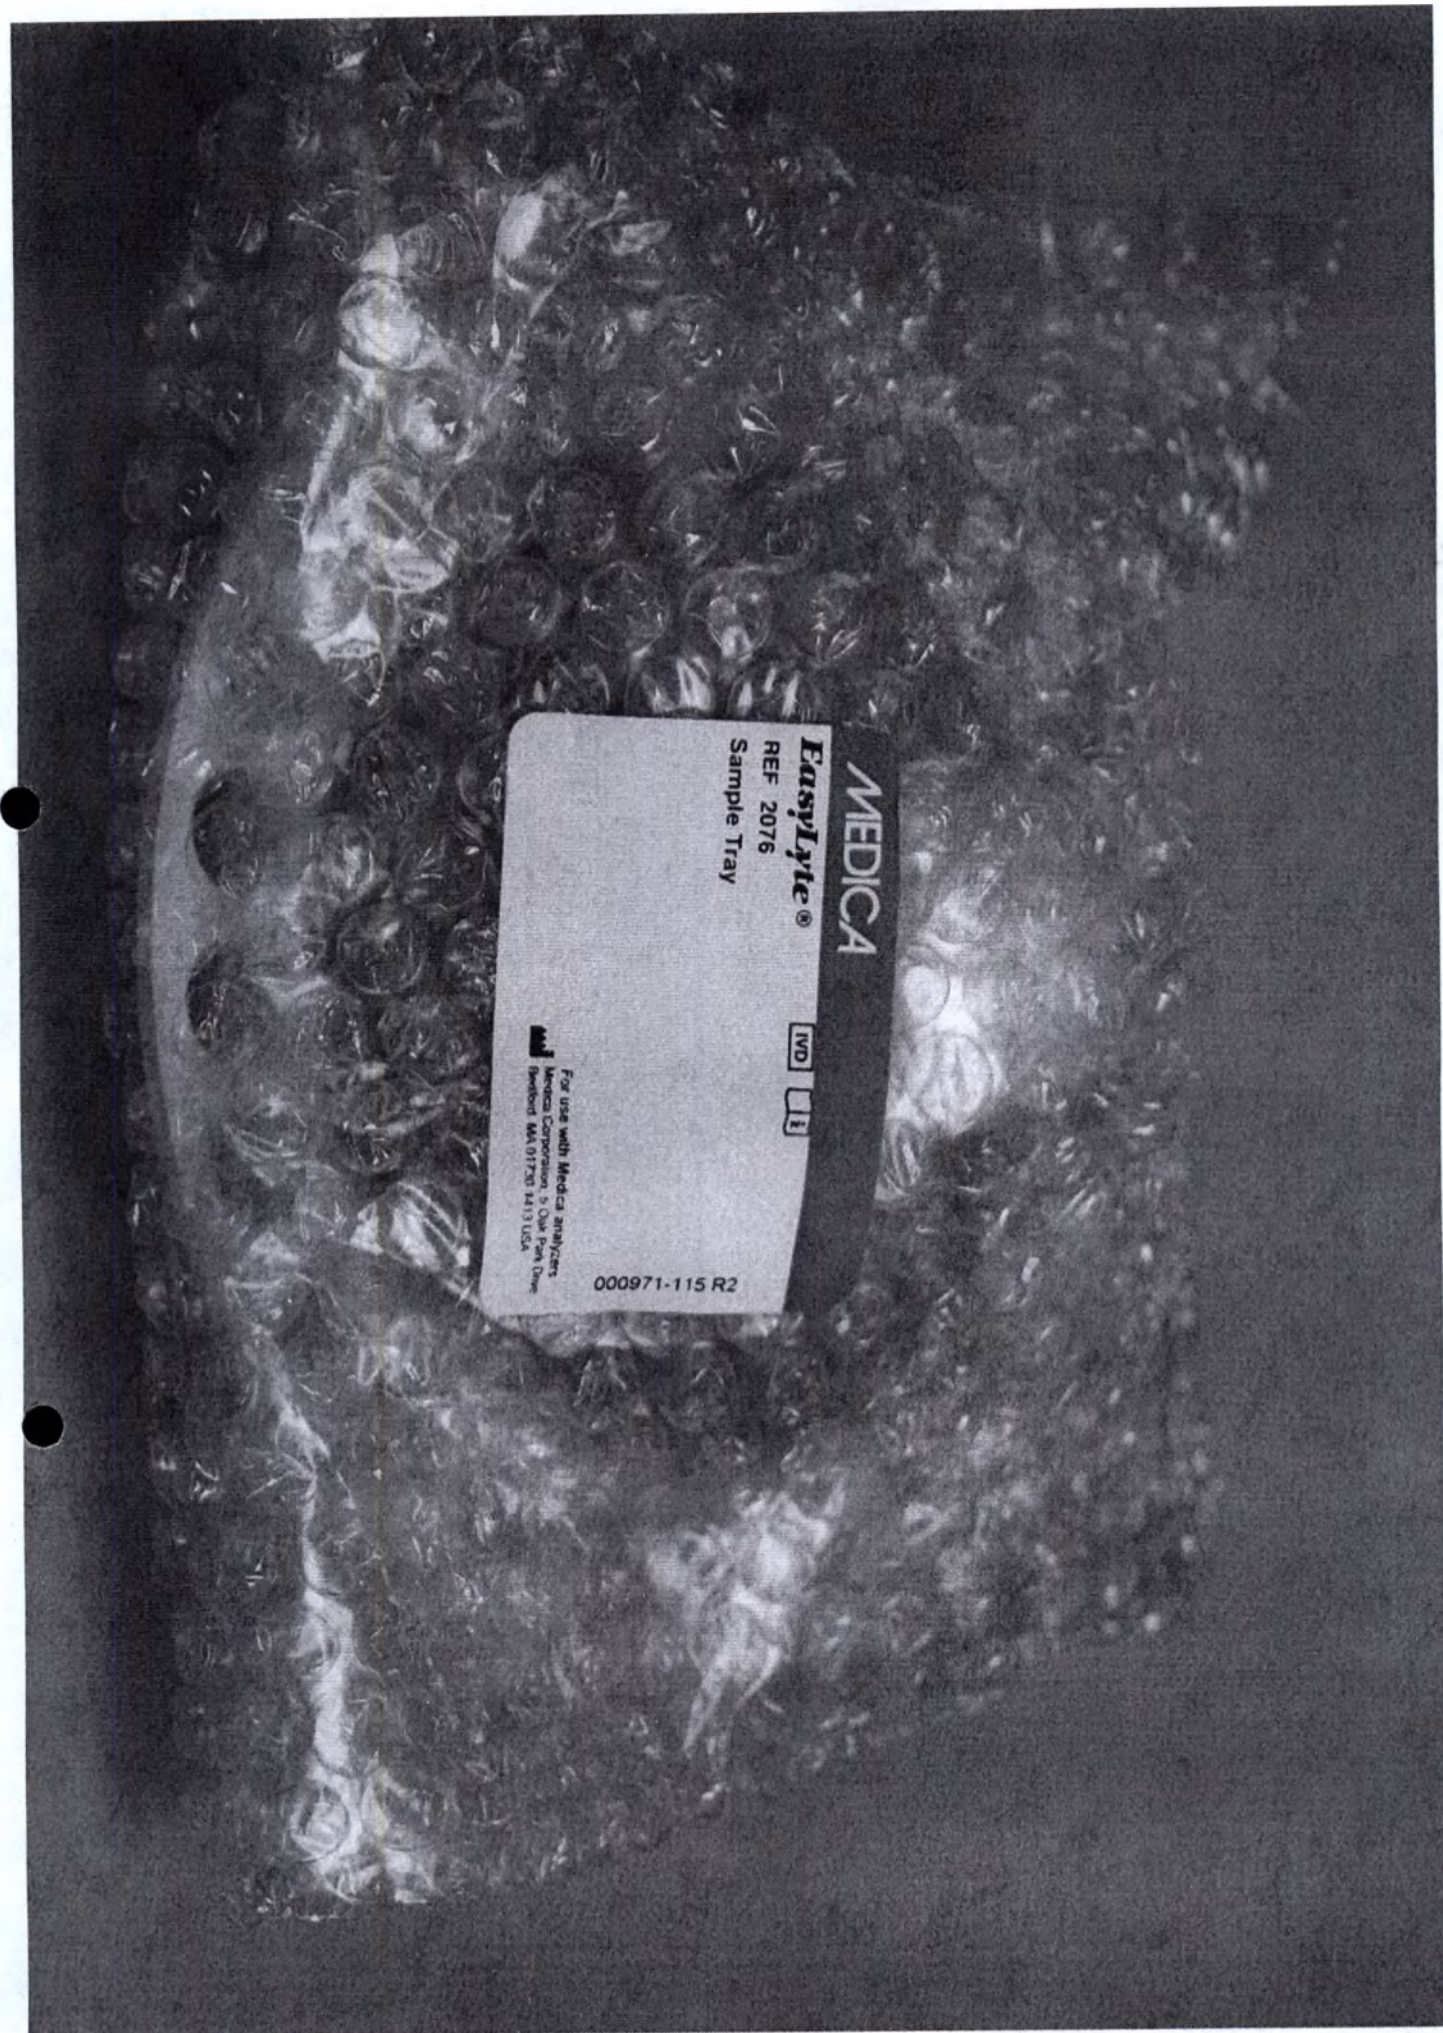


Карусель для проб (Sample Tray)

Кат. № 2076
Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, с принадлежностями.
Карусель для проб (Sample Tray)
Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts, 01730 USA
Регистрационное Удостоверение №: ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.
Для лабораторной диагностики, состав, правила и условия использования, см.
Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы
по товару доступны на сайте: www.analytica.ru
Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Карусель для проб (Sample Tray)

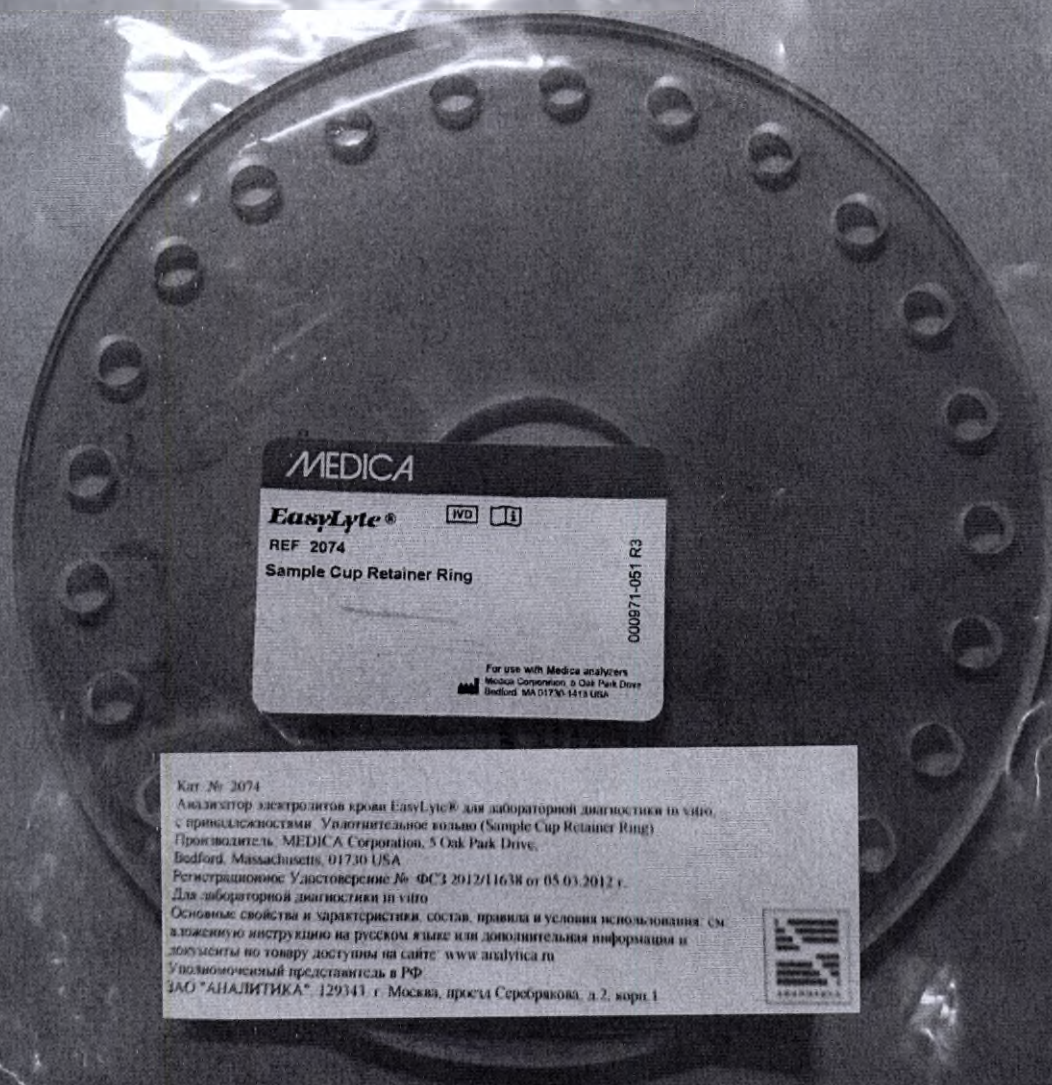

MEDICA

EasyLyte®



REF 2074

Sample Cup Retainer Ring

000871-051 R3

For use with Medica analyzers
Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1515 USA

Кат. № 2074

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики *in vitro*, с принадлежностями. Уплотнительное кольцо (Sample Cup Retainer Ring).

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730 USA.


Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования см. прилагаемую инструкцию на русском языке или дополнительную информацию и документы по товару доступны на сайте: www.analytica.ru

Уполномоченный представитель в РФ:

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343 г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1



Уплотнительное кольцо (Sample Cup Retainer Ring)



MEDICA

EasyLyte®

IVD



REF 2598

Daily Cleaner Cup

000971-048 R3

For use with Medica analyzers
Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

Пробирка для ежедневной промывки (Daily Cleaner Cup)



MEDICA

EasyLyte

CE IVD i

Easysampler Sample Cups
Gobelets d'échantillonnage
Easysampler
Coppette per campione
Easysampler
Easysampler-Probenbecher
Vasos de muestreo Easysampler
Recipientes de muestra de
análisis automático

CONT 100 cups (500 uL)
100 gobelets (500 uL); 100 coppette (500 uL);
100 Becher (500 uL); 100 vasos (500 uL); 100
recipientes (500 uL)

For use with Medica analyzers / Pour l'usage avec
des analyseurs Medica / Per uso con gli analizzatori
Medica / Für Gebrauch mit Medica Analysatoren /
Para usar en los analizadores Medica / Para utilizar
con analizadores Medica.

Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Andover, MA 01730-1413 USA


Emigo Europe, Molendijk 15
NL-2513 BH The Hague, The Netherlands

006278-201 R1


Пробирки для проб 500 мкл (EasySampler Sample Cups), 100 шт./упак.




Пробирки для проб 2,0 мл (EasySampler Sample Cups), 100 шт./упак.

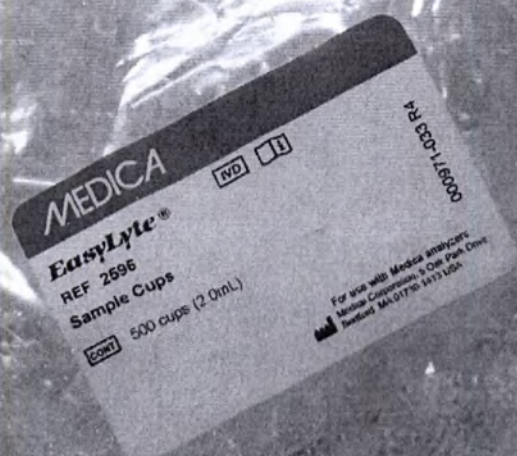


Пробирки для проб 2,0 мл (Sample Cups), 500 шт./упак.

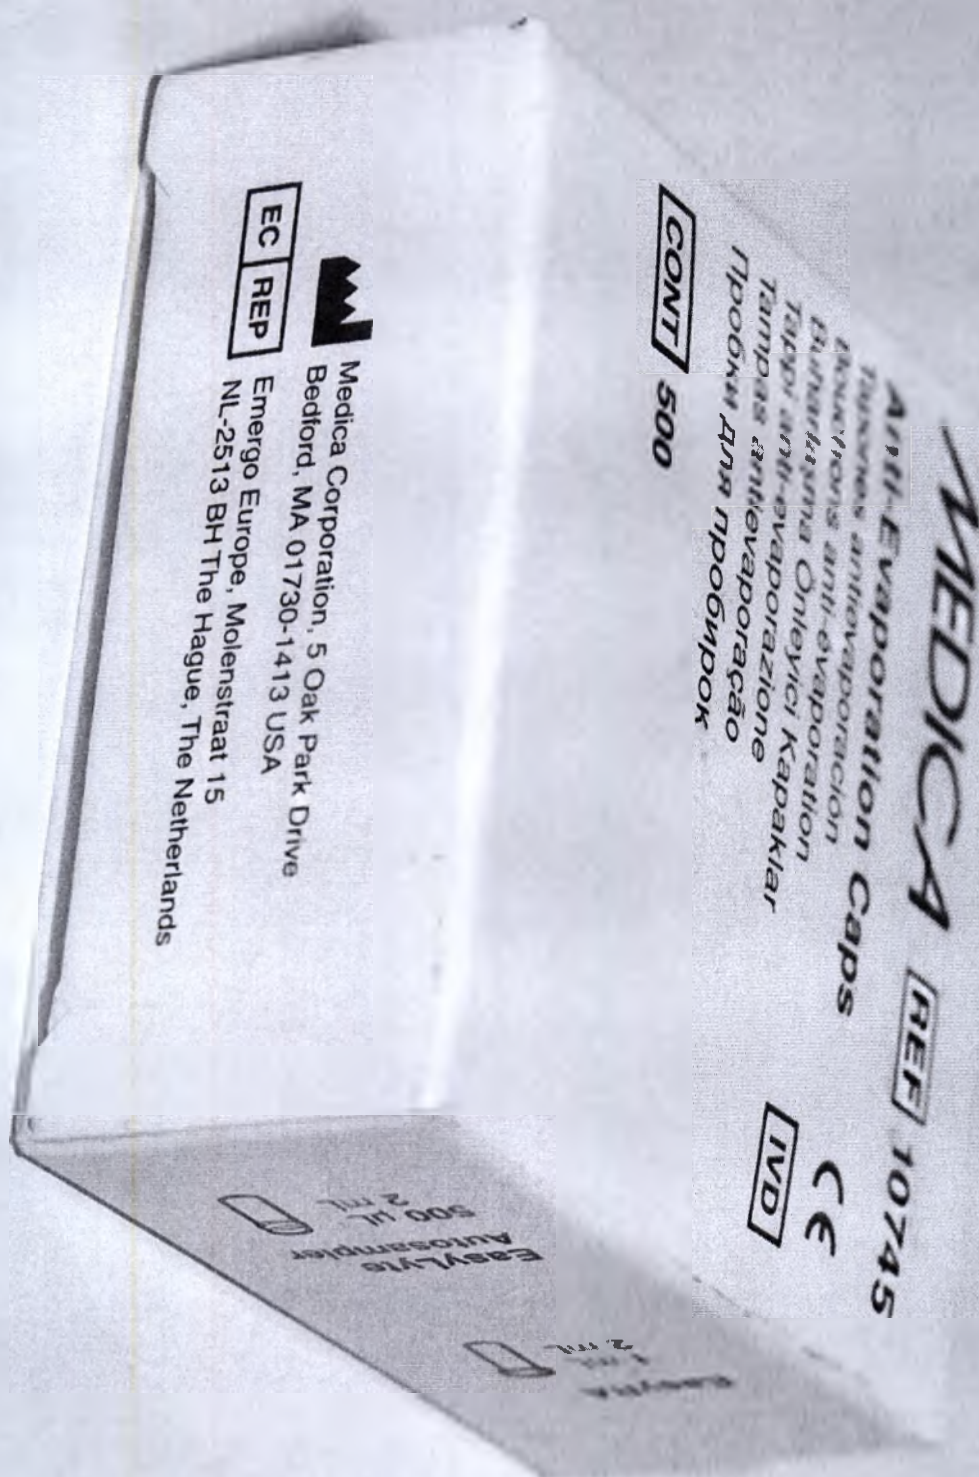


Пробки для пробирок с защитой от испарения (Anti-Evaporation Caps), 500 шт./упак.

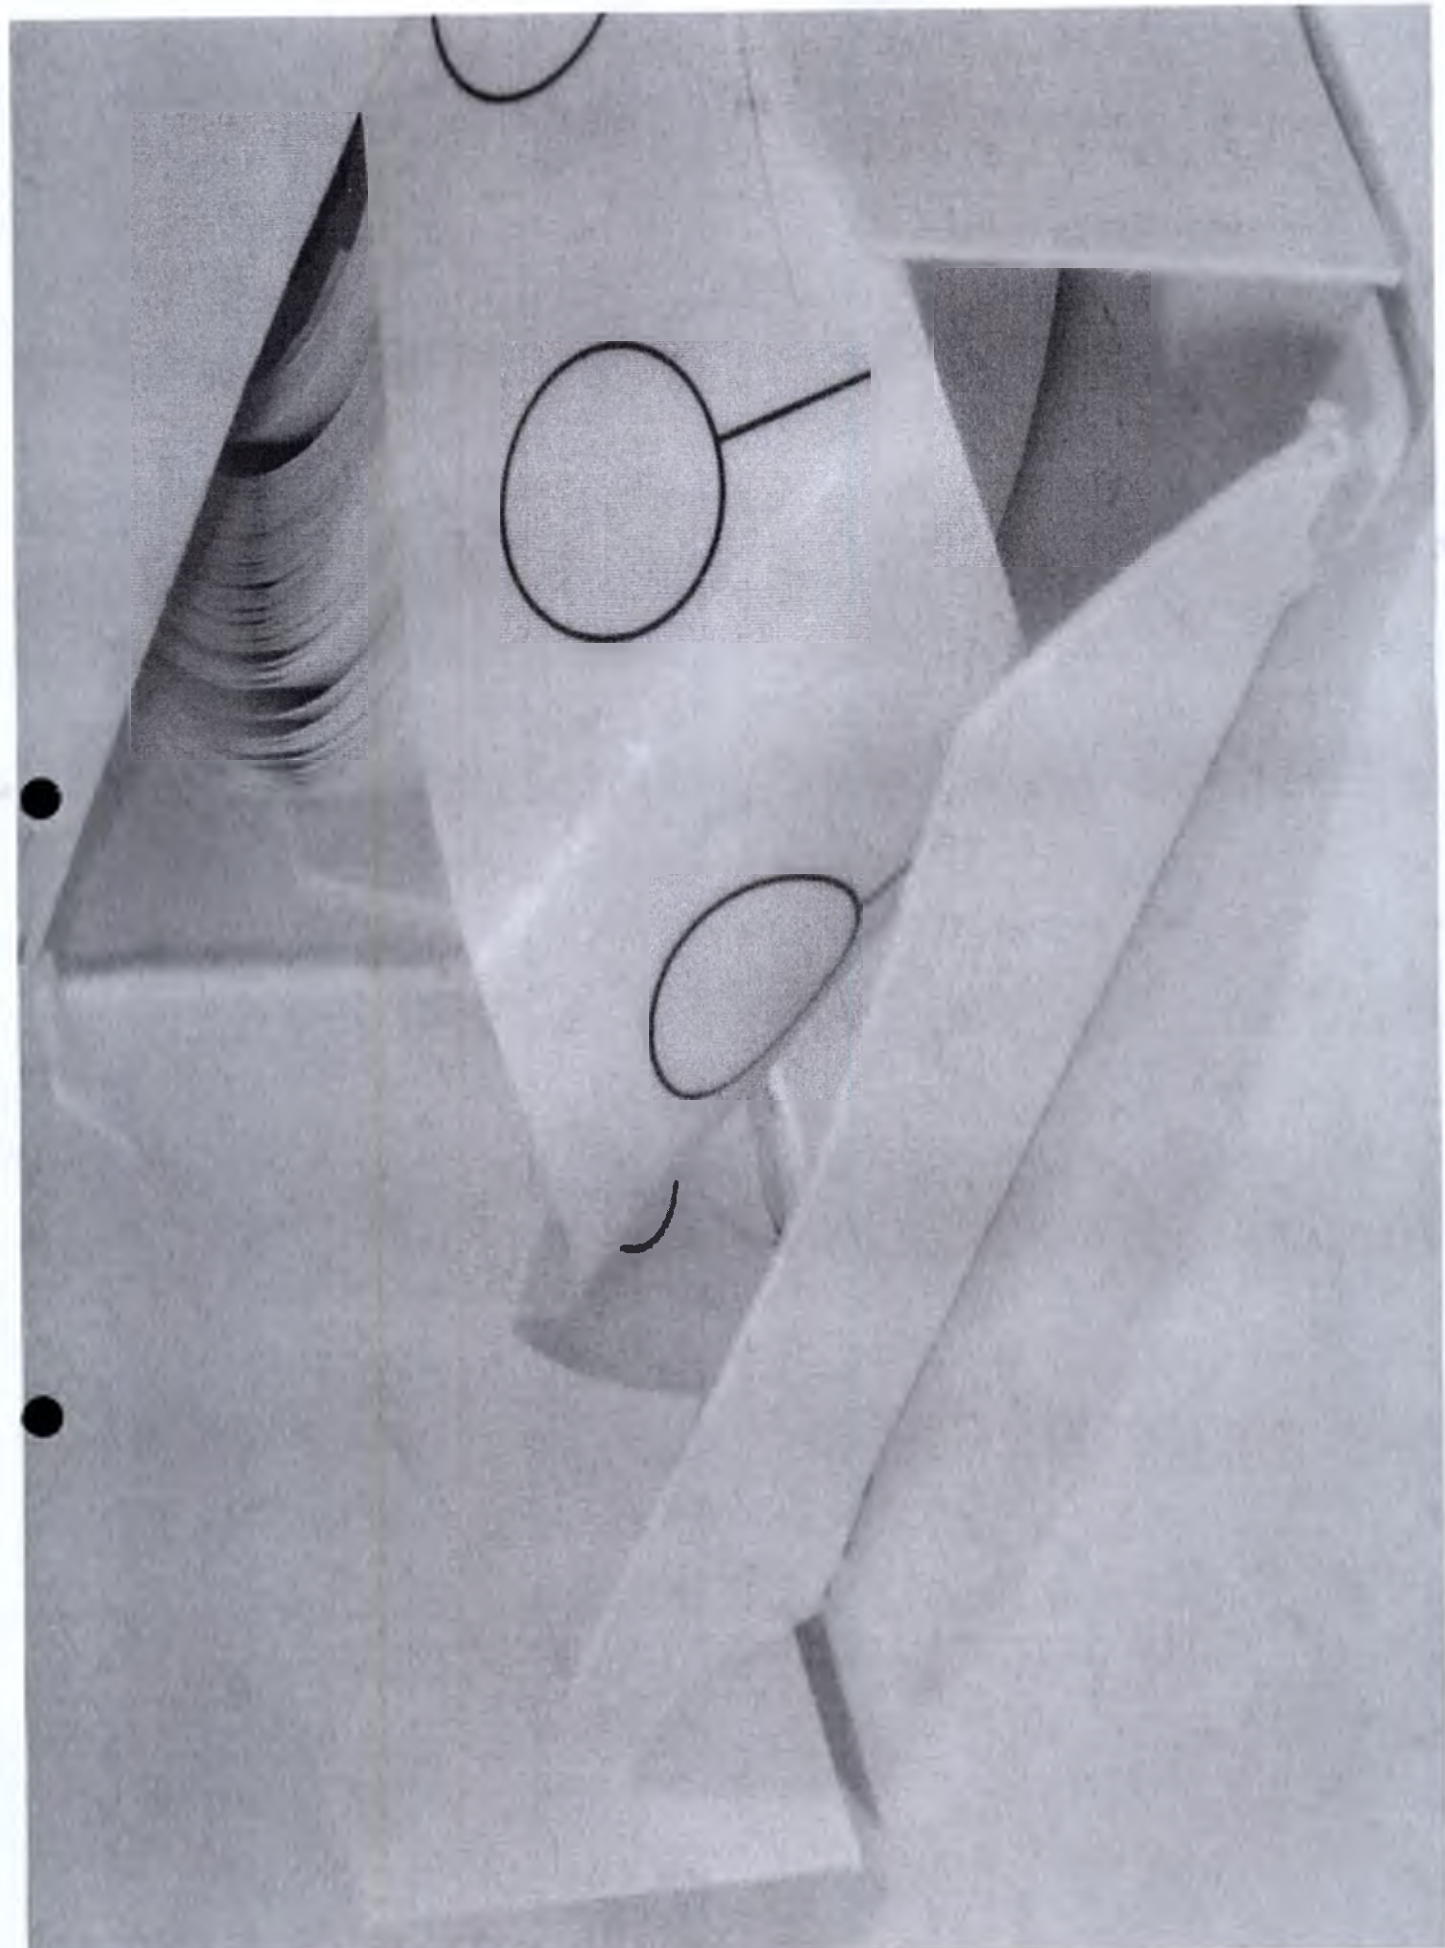

Пробки для пробирок с защитой от испарения (Anti-Evaporation Caps), 500 шт./упак.

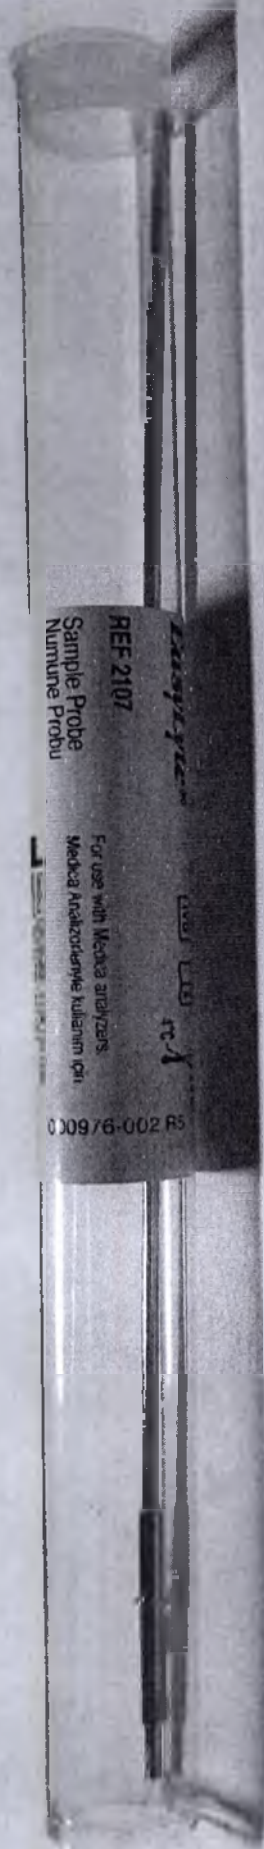


Зонд пробы (Sample Probe)

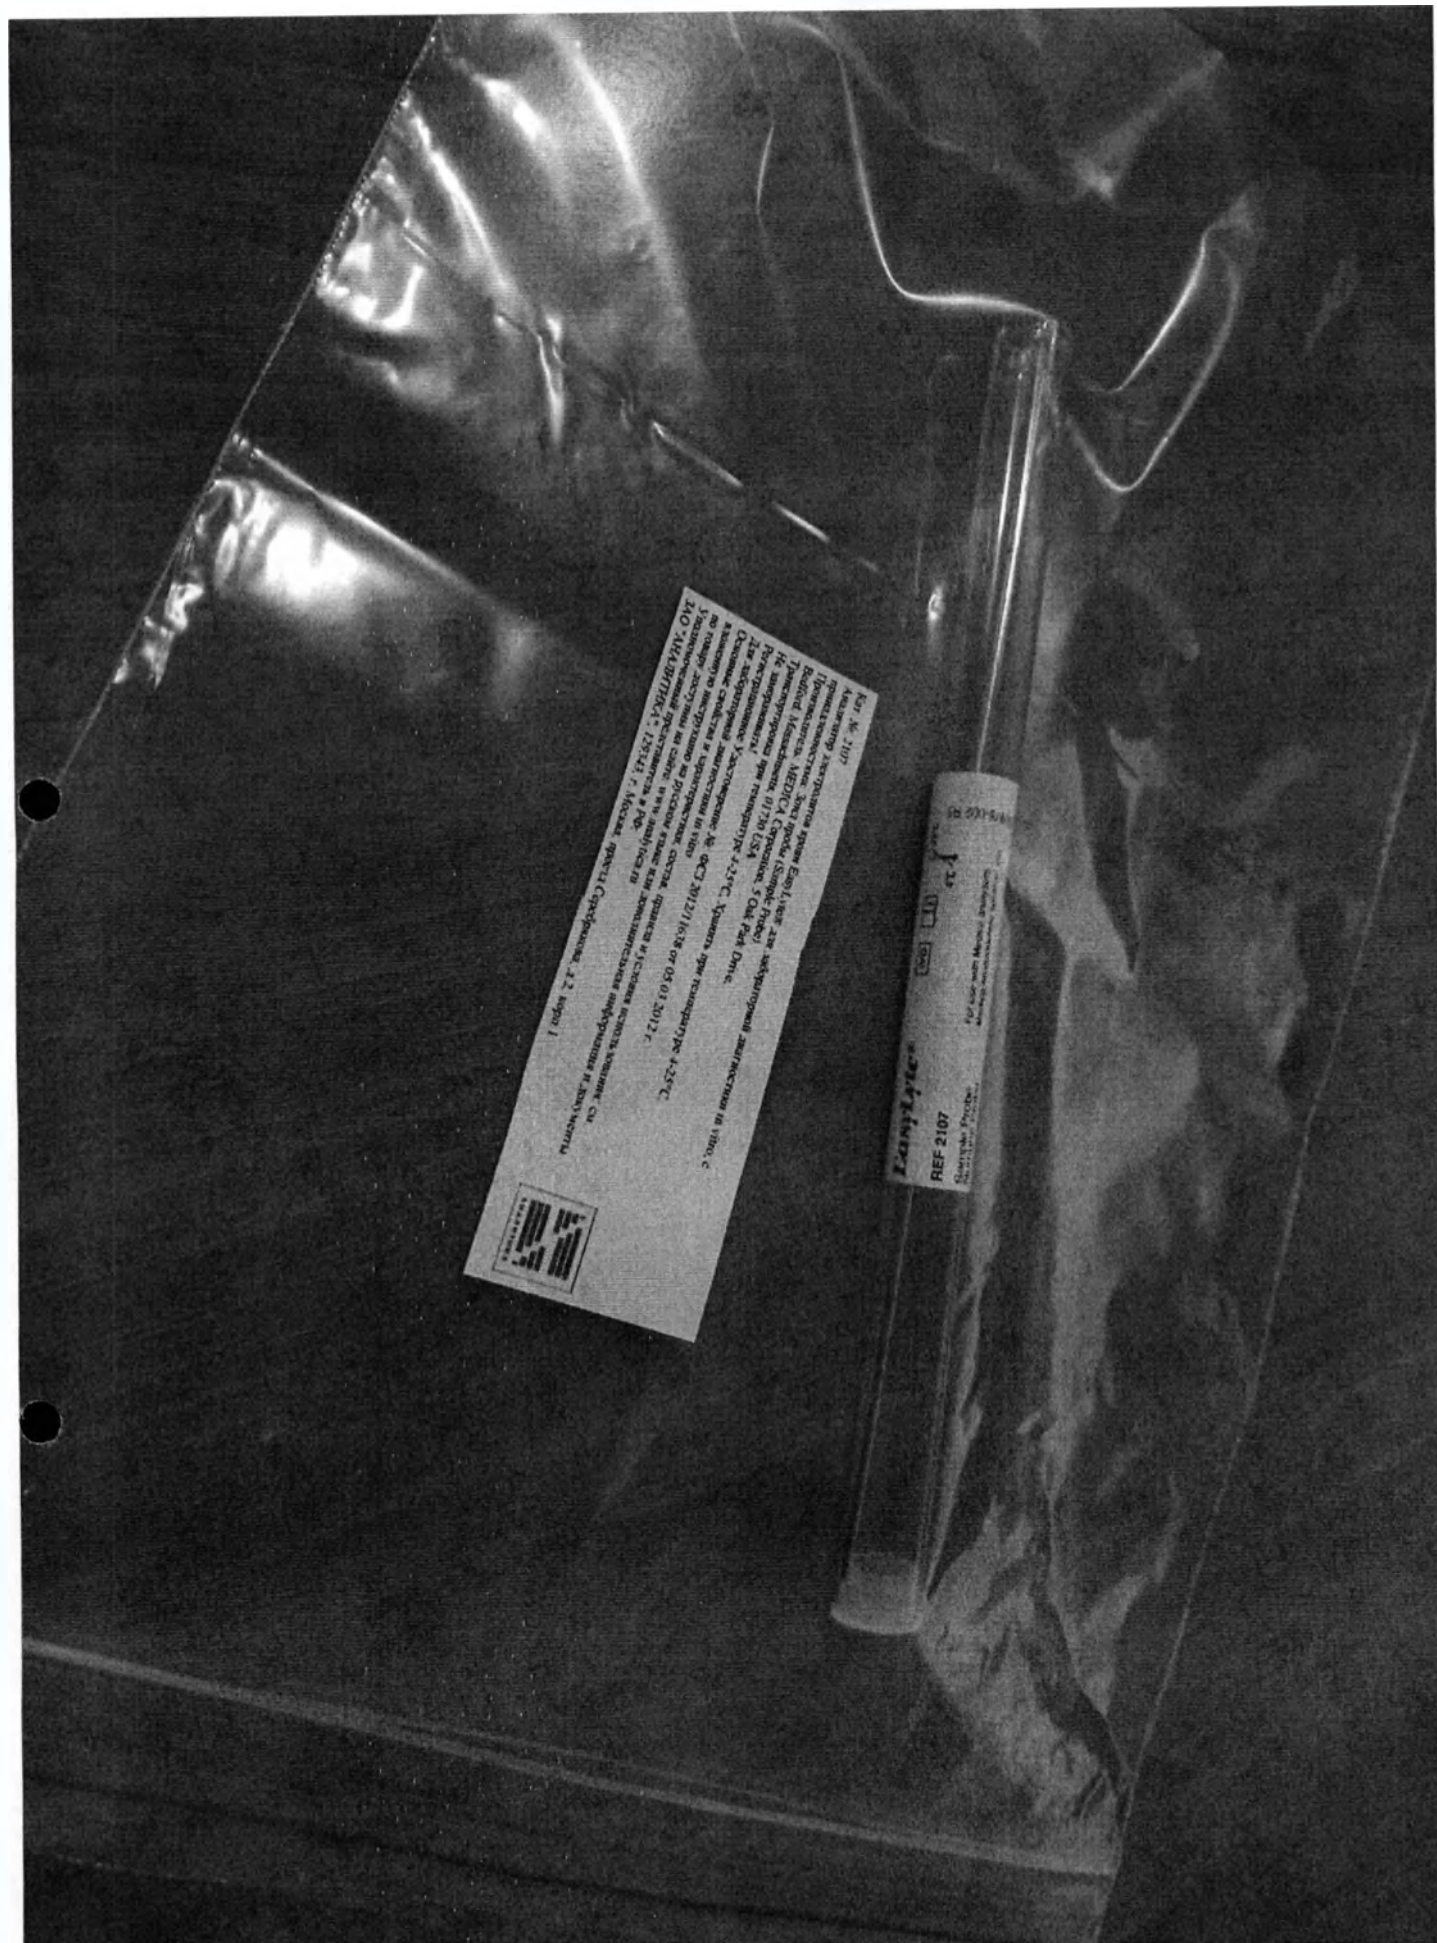

Маркировка: Зонд пробы (Sample Probe)



Детектор пробы (Sample Detector)

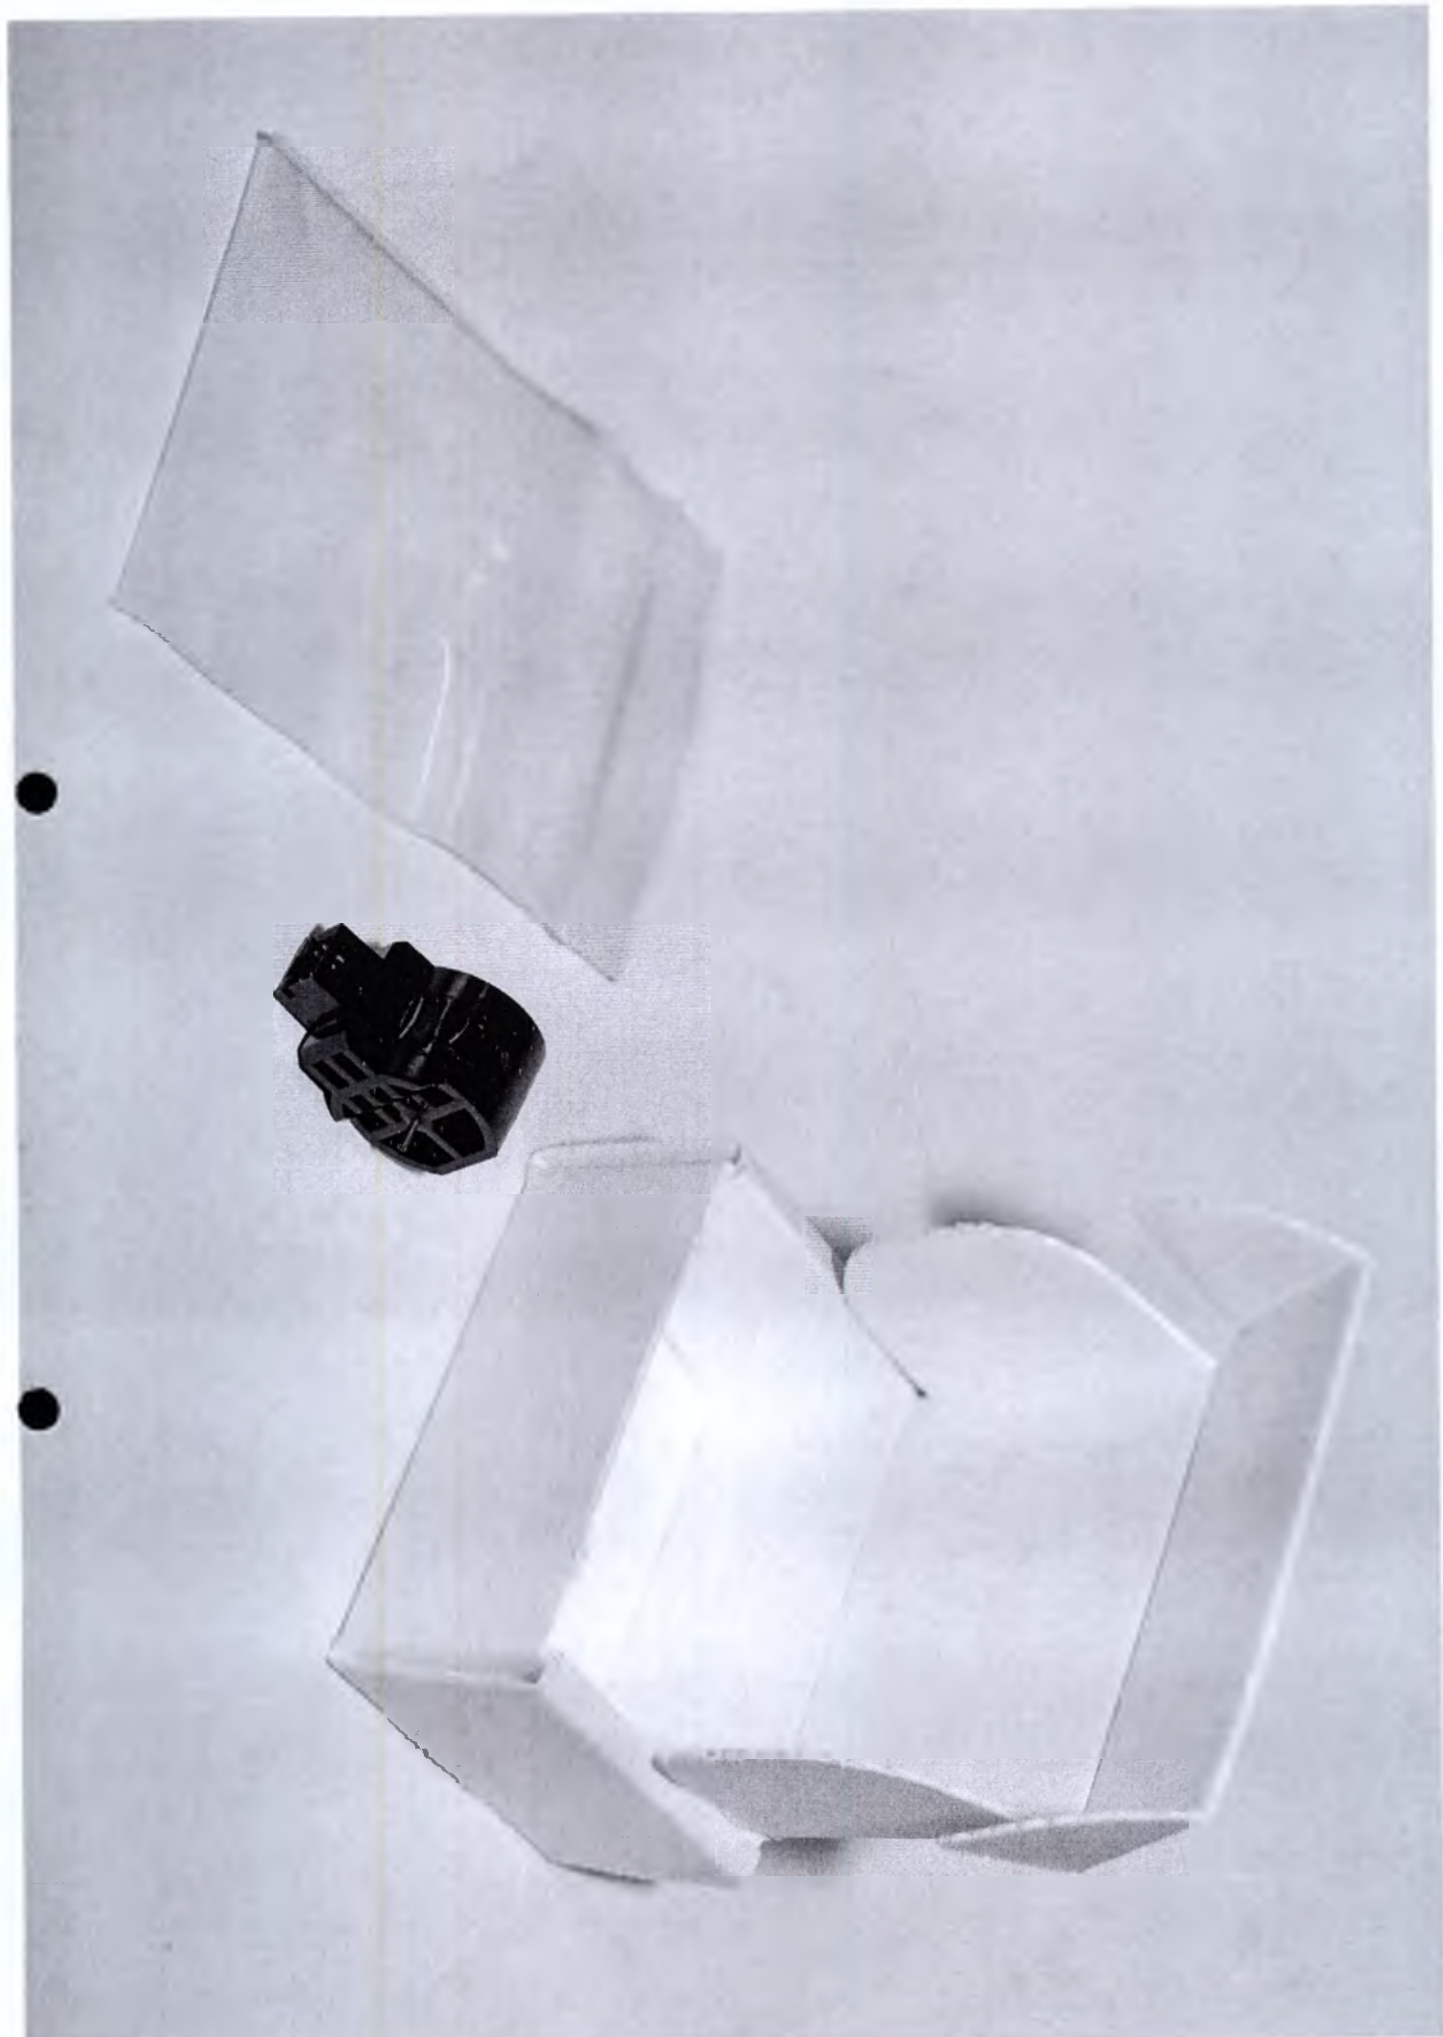

Детектор пробы (Sample Detector)

Кит № 2257

Lot №16019

Годен до 07.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte[®] для лабораторной диагностики in vitro,
с принадлежностями. Детектор пробы (Sample Detector)

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive,
Bedford, Massachusetts 01730 USA

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.
Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования см.
вложенную инструкцию на русском языке или дополнительную информацию в

документы по товару доступны на сайте: www.analytika.ru

Уполномоченный представитель в РФ

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1



Маркировка: Детектор пробы (Sample Detector)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2095

Maintenance Kit
Bakım Seti

IVD



Store at 25°C
4°C

CONT.

1 Internal Filling Solution
1 Membrane Assembly
1 Tubing Kit

LOT 18080

Exp 2019-06-28

2018-03-17



(01) 00386100005964
(10) 18080
(11) 180317
(17) 190628
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
EXPIRY
ORIGIN US


EC REP



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europe, Molenstraat 15
NL-2513 BH The Hague
The Netherlands

000972-014 R7

Установочный комплект (Maintenance Kit): сборка мембраны; трубки, 2 шт.; раствор для заполнения камеры

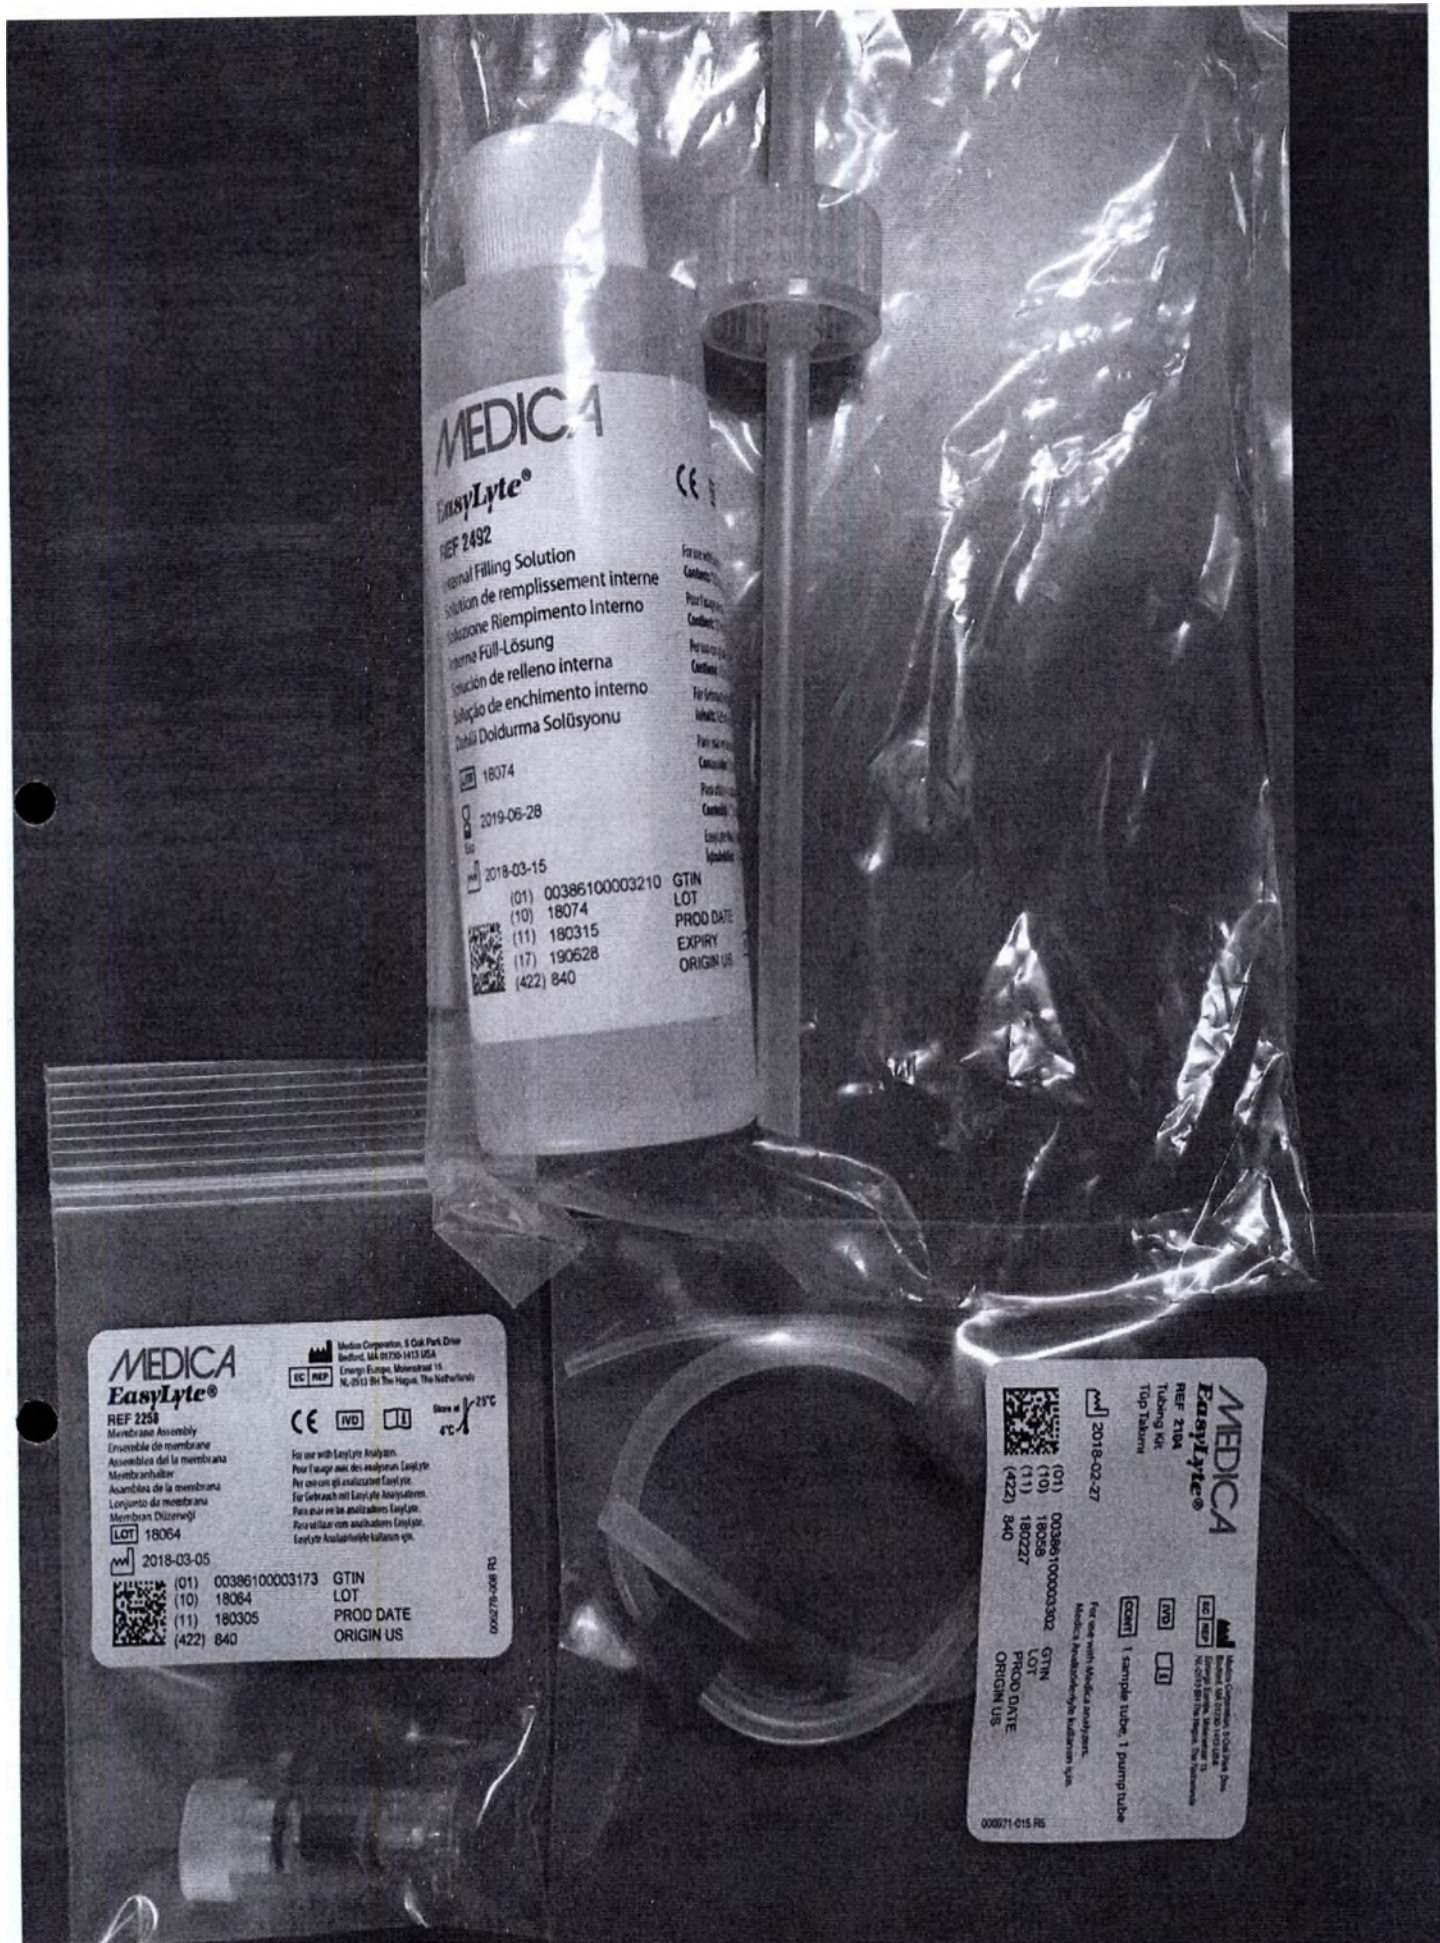

Установочный комплект (Maintenance Kit): сборка мембраны; трубки, 2 шт.; раствор для заполнения камеры

Кат. №: 2095

Lot №18080

Годен до 06.2019

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro, с принадлежностями. Установочный комплект (Maintenance Kit): сборка мембраны; трубки, 2 шт.; раствор для заполнения камеры

Состав: сборка мембраны (1 шт.); трубки (2 шт.); раствор для заполнения камеры 125 мл

Производитель: MEDICA Corporation, 5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730 USA

Транспортировка при температуре 4-25°C. Хранить при температуре 4-25°C.

Не замораживать!

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11638 от 05.03.2012 г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования, см.


вложенную инструкцию на русском языке или дополнительная информация и документы по товару доступны на сайте: www.apalyusa.ru

Уполномоченный представитель в РФ

ЗАО "АНАЛИТИКА", 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп. 1



Маркировка: Установочный комплект (Maintenance Kit): сборка мембраны; трубки, 2 шт.; раствор для заполнения камеры

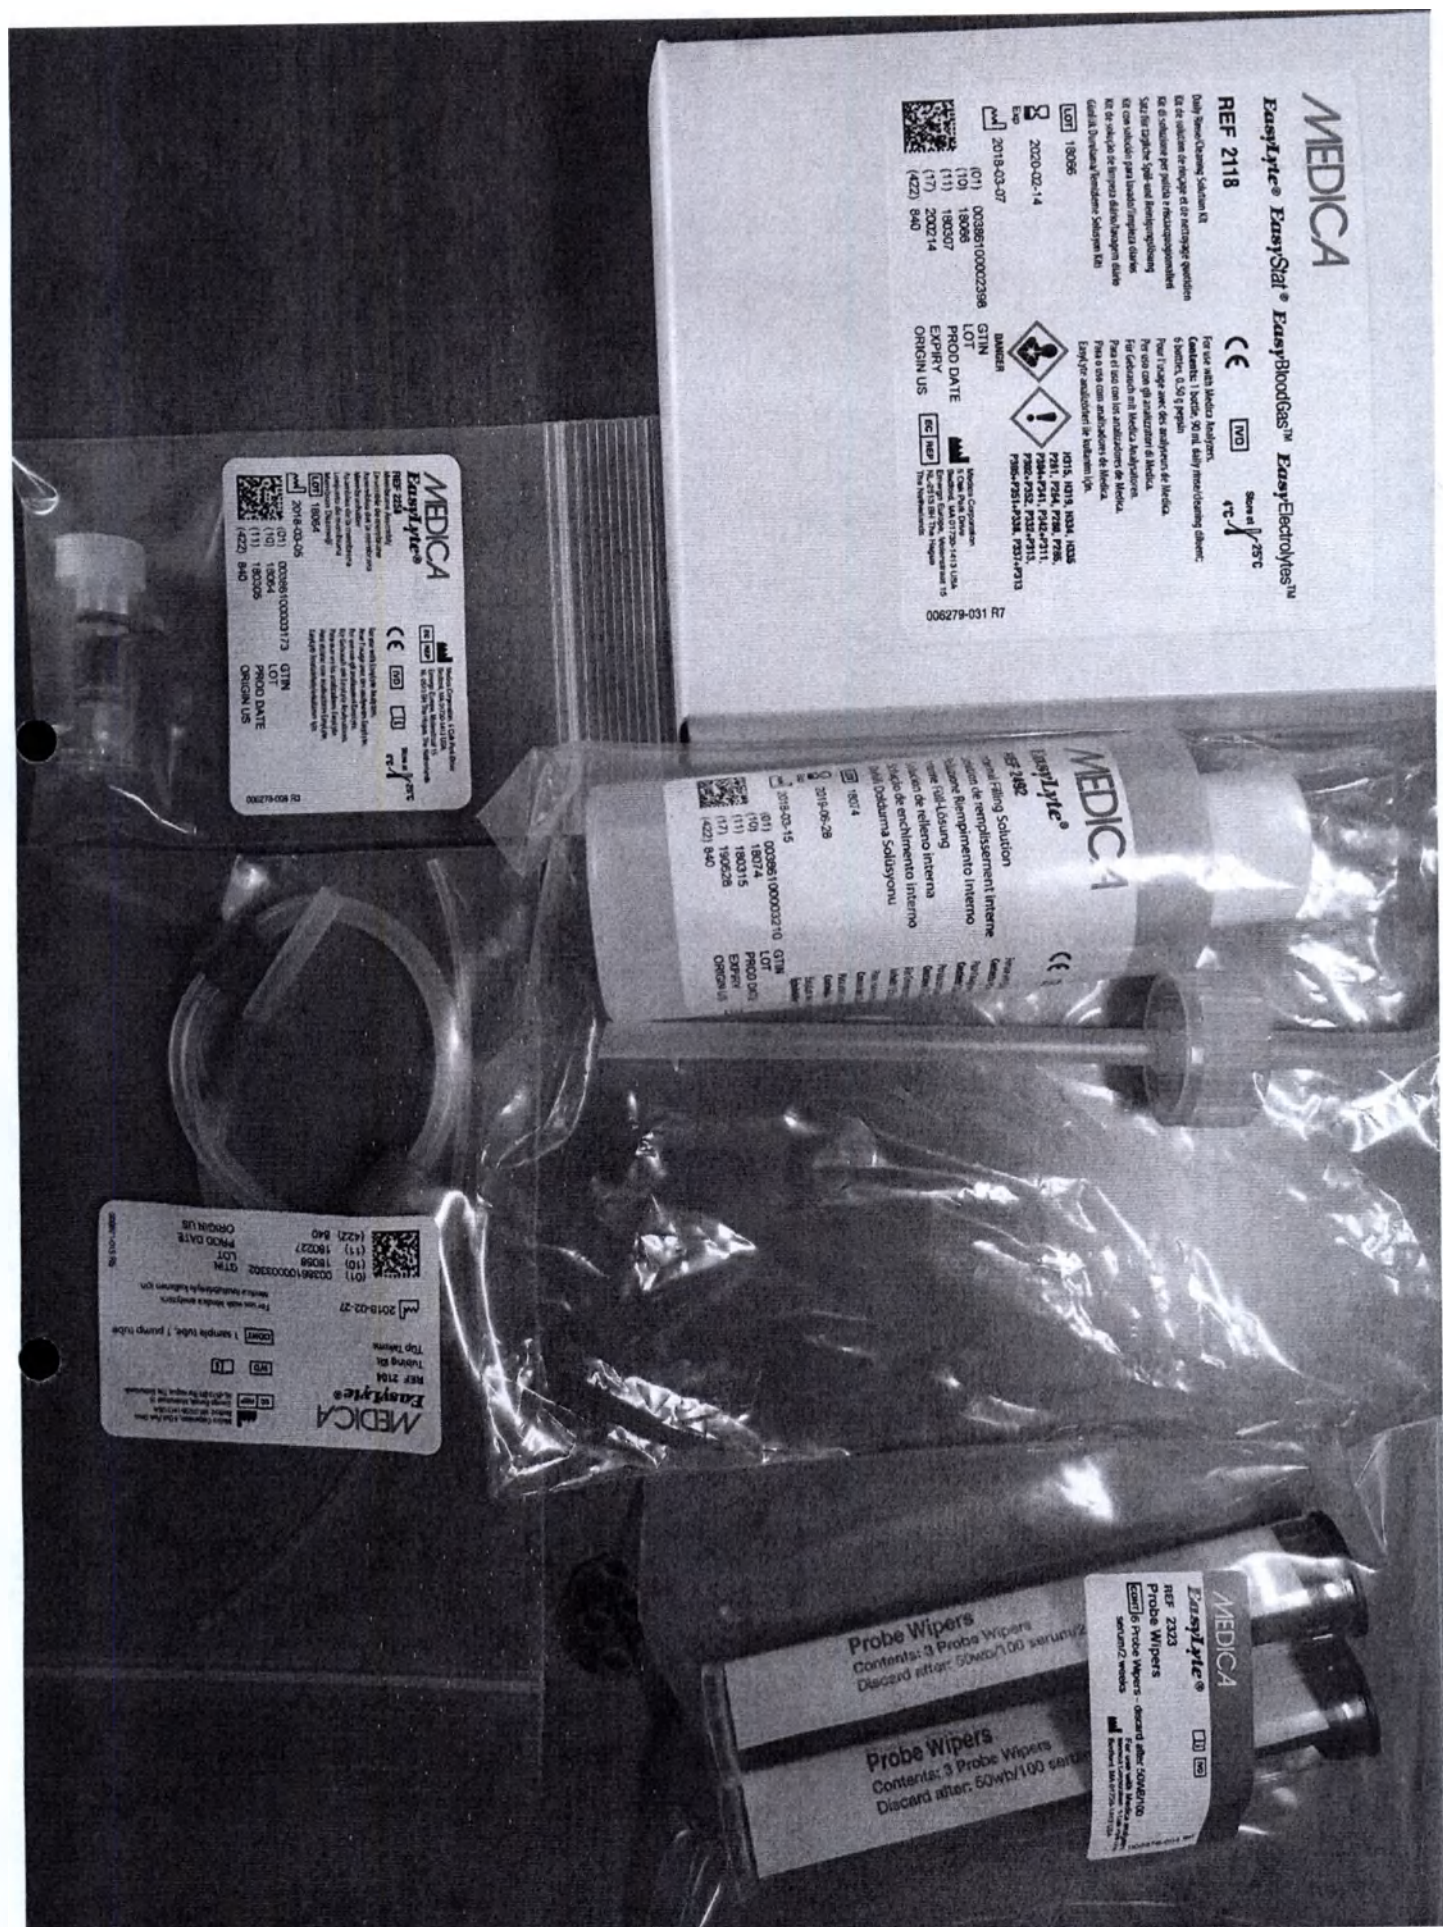

Комплект для обслуживания анализатора (Quarterly Operating Kit): трубки, 2 шт.; сборка мембраны; раствор для заполнения камеры; осушители зонда, 6 шт.; набор реагентов для ежедневной промывки; заглушка

MEDICA

EasyLyte®

REF 2105

Quarterly Operating Kit
Kit pour maintient trimestriel
Kit di Accessori e Consumabili
per manutenzione trimestrale
Satz für vierteljährliche Wartung
Kit mantenimiento trimestral
Kit de operação trimestral

LOT 18120

Exp 2019-06-28

2018-04-30



(01) 00386100002992
(10) 18120
(11) 180430
(17) 190628
(422) 840

CE

IVD



Store at 25°C
4°C

For use with EasyLyte Analyzers. **Contents:** Internal Filling Solution, Daily Cleaning Solution, Membrane Assembly, 4 Solution Pack Caps, Sample Tube, Pump Tube, 6 Probe Wipers.

Pour l'usage avec des analyseurs d'EasyLyte. **Contenants:** solution de remplissage interne, solution de nettoyage quotidien, assemblée de membrane, 4 couvercles de paquet de solution, tube d'éprouve, tube de pompe, 6 essouyeurs de l'arguille de prélèvement.

Per uso con gli analizzatori EasyLyte. **Contiene:** Soluzione di riempimento interna, Soluzione per pulizia giornaliera, Membrana, Tappi per contenitori reagenti, Tubo campione, Tubo pompa peristaltica, sei pulitori della sonda.

Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren. **Inhalt:** Interne Füll Lösung, täglicher Reinigungslösung, Membranhalter, 4 Deckel für Lösungspack, Probenschlauch, Pumperschlauch, 6 Probenadelwischer.

Para usar en los analizadores EasyLyte. **Contenido:** solución de relleno interna, solución para limpieza diaria, conjunto de membrana, 4 tapones para envases de solución, tubo de muestra, tubo de bombeo, 6 paños para limpiar sondas.

Para utilizar com analisadores EasyLyte. **Conteúdo:** Solução de enchimento interna, Solução de limpeza diária/limpeza diária, Conjunto Da Membrana, Tampões De Bico Da Solução, Tubo Da Amostra, Tubo Da Bomba, Limadores Da Ponta de prova.

GTIN
LOT
PROD DATE
EXPIRY
ORIGIN US



Medica Corporation
5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Ernorgo Europe, Molenvaart 15
NL-2513 BH The Hague
The Netherlands

006279-010 R2

Маркировка: Комплект для обслуживания анализатора (Quarterly Operating Kit): трубки, 2 шт.; сборка мембраны; раствор для заполнения камеры; осушители зонда, 6 шт.; набор реагентов для ежедневной промывки; заглушка

Инструкция пользователя

Анализатор электролитов крови EasyLyte® для лабораторной диагностики in vitro
с принадлежностями

Варианты исполнения:


EasyLyte® Na/K

EasyLyte® Calcium Na/K/Ca/pH


EasyLyte® Plus Na/K/Cl

EasyLyte® EXPAND Na K Cl Ca/Li


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

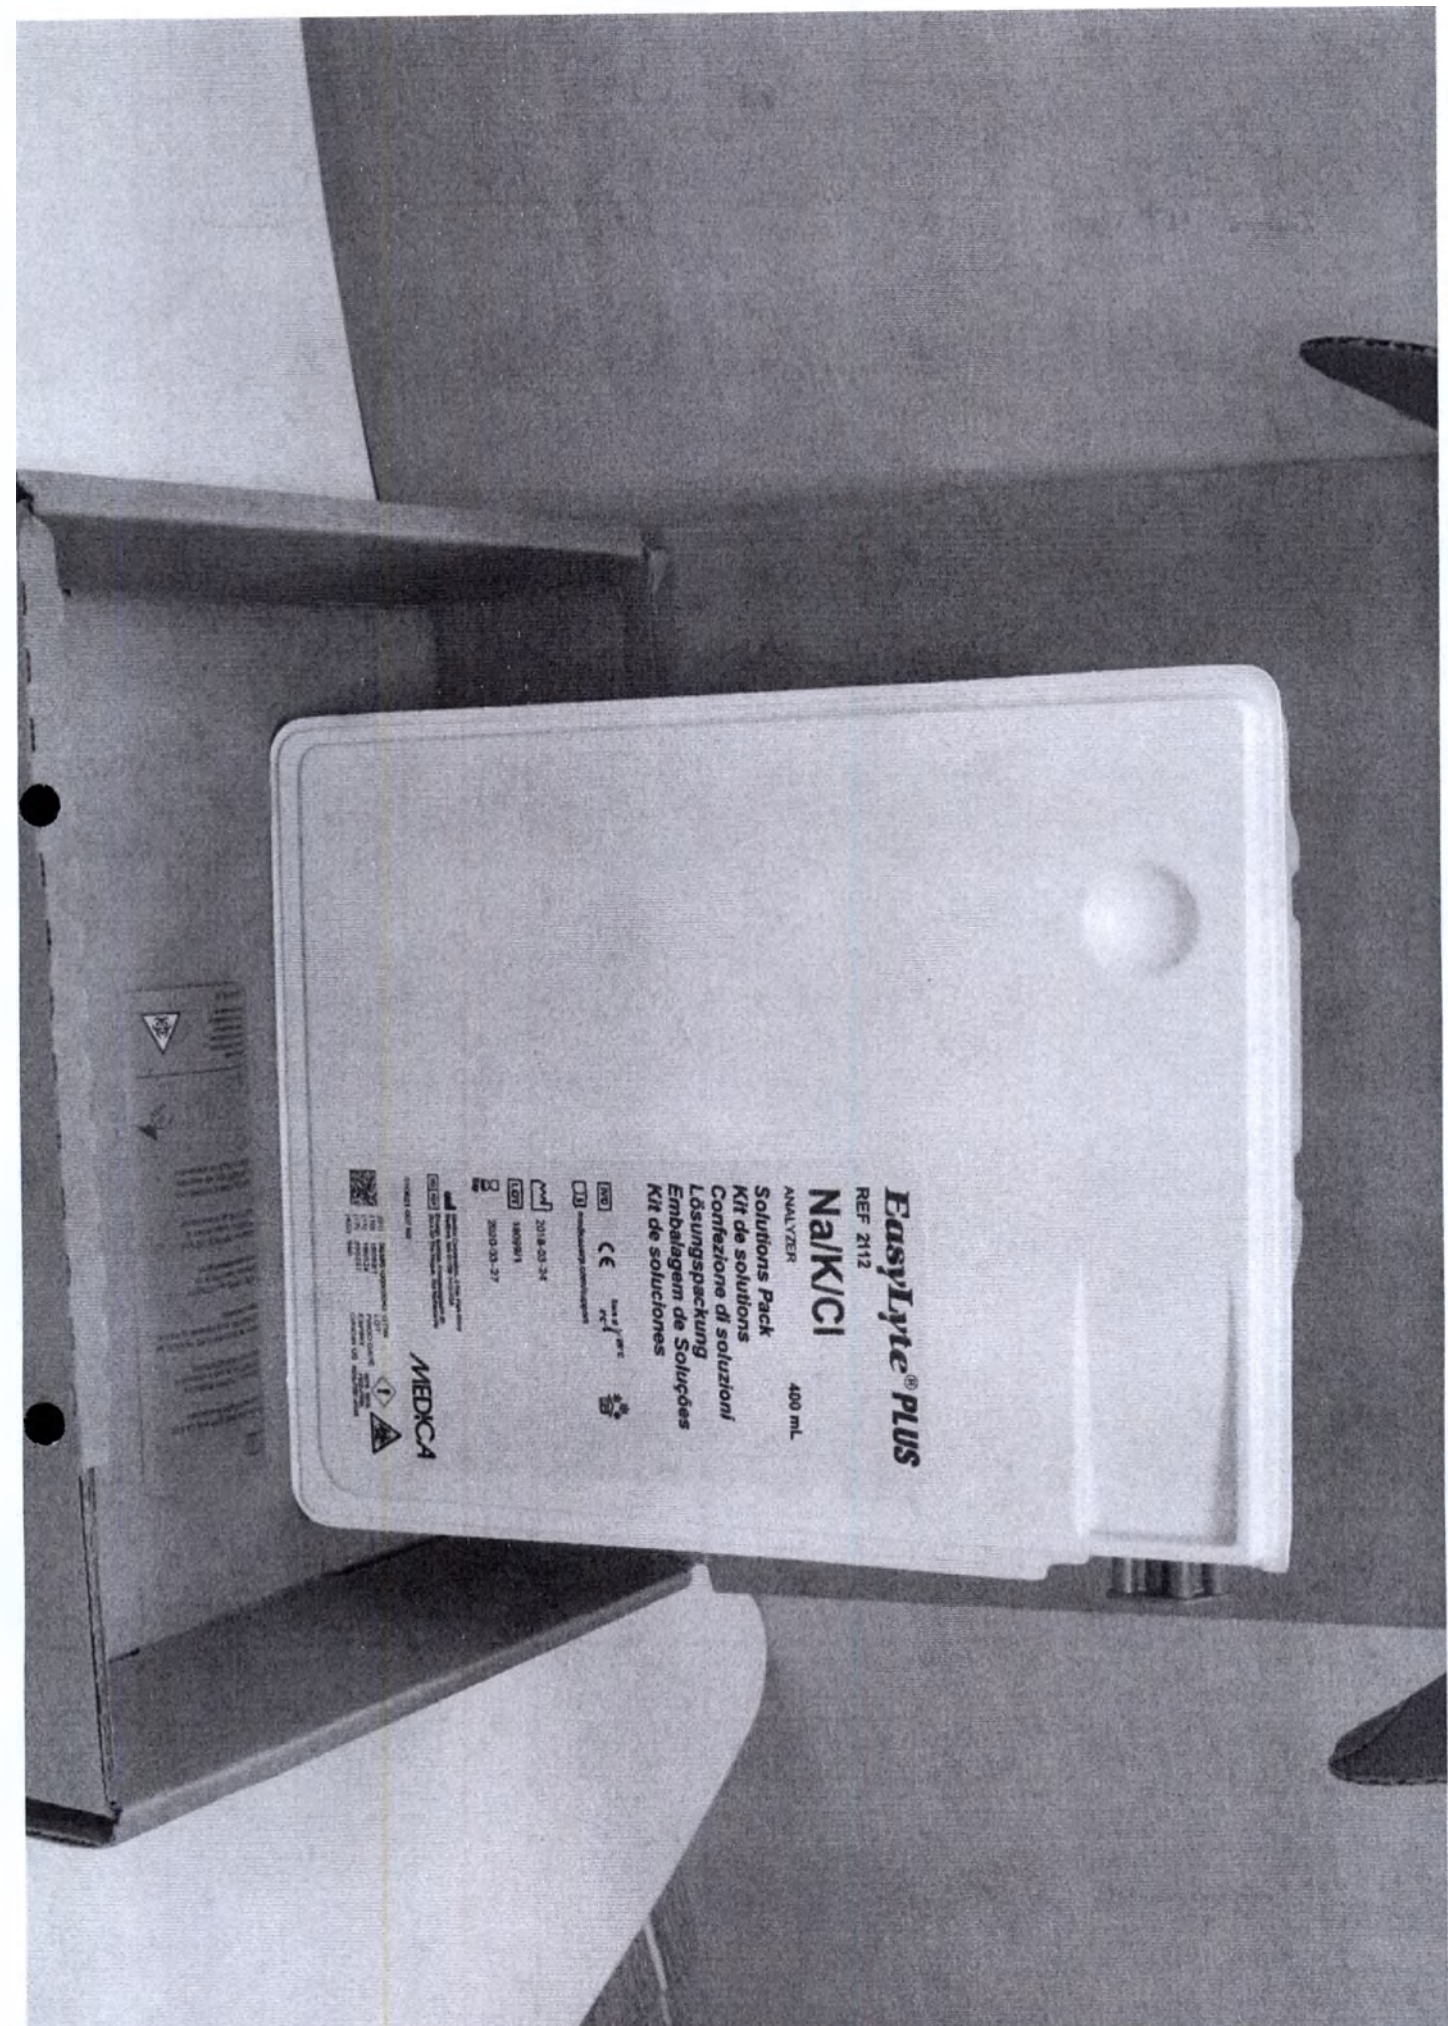

Пакет с растворами Na/K/Cl (EasyLyte® Plus Na/K/Cl Solutions Pack)

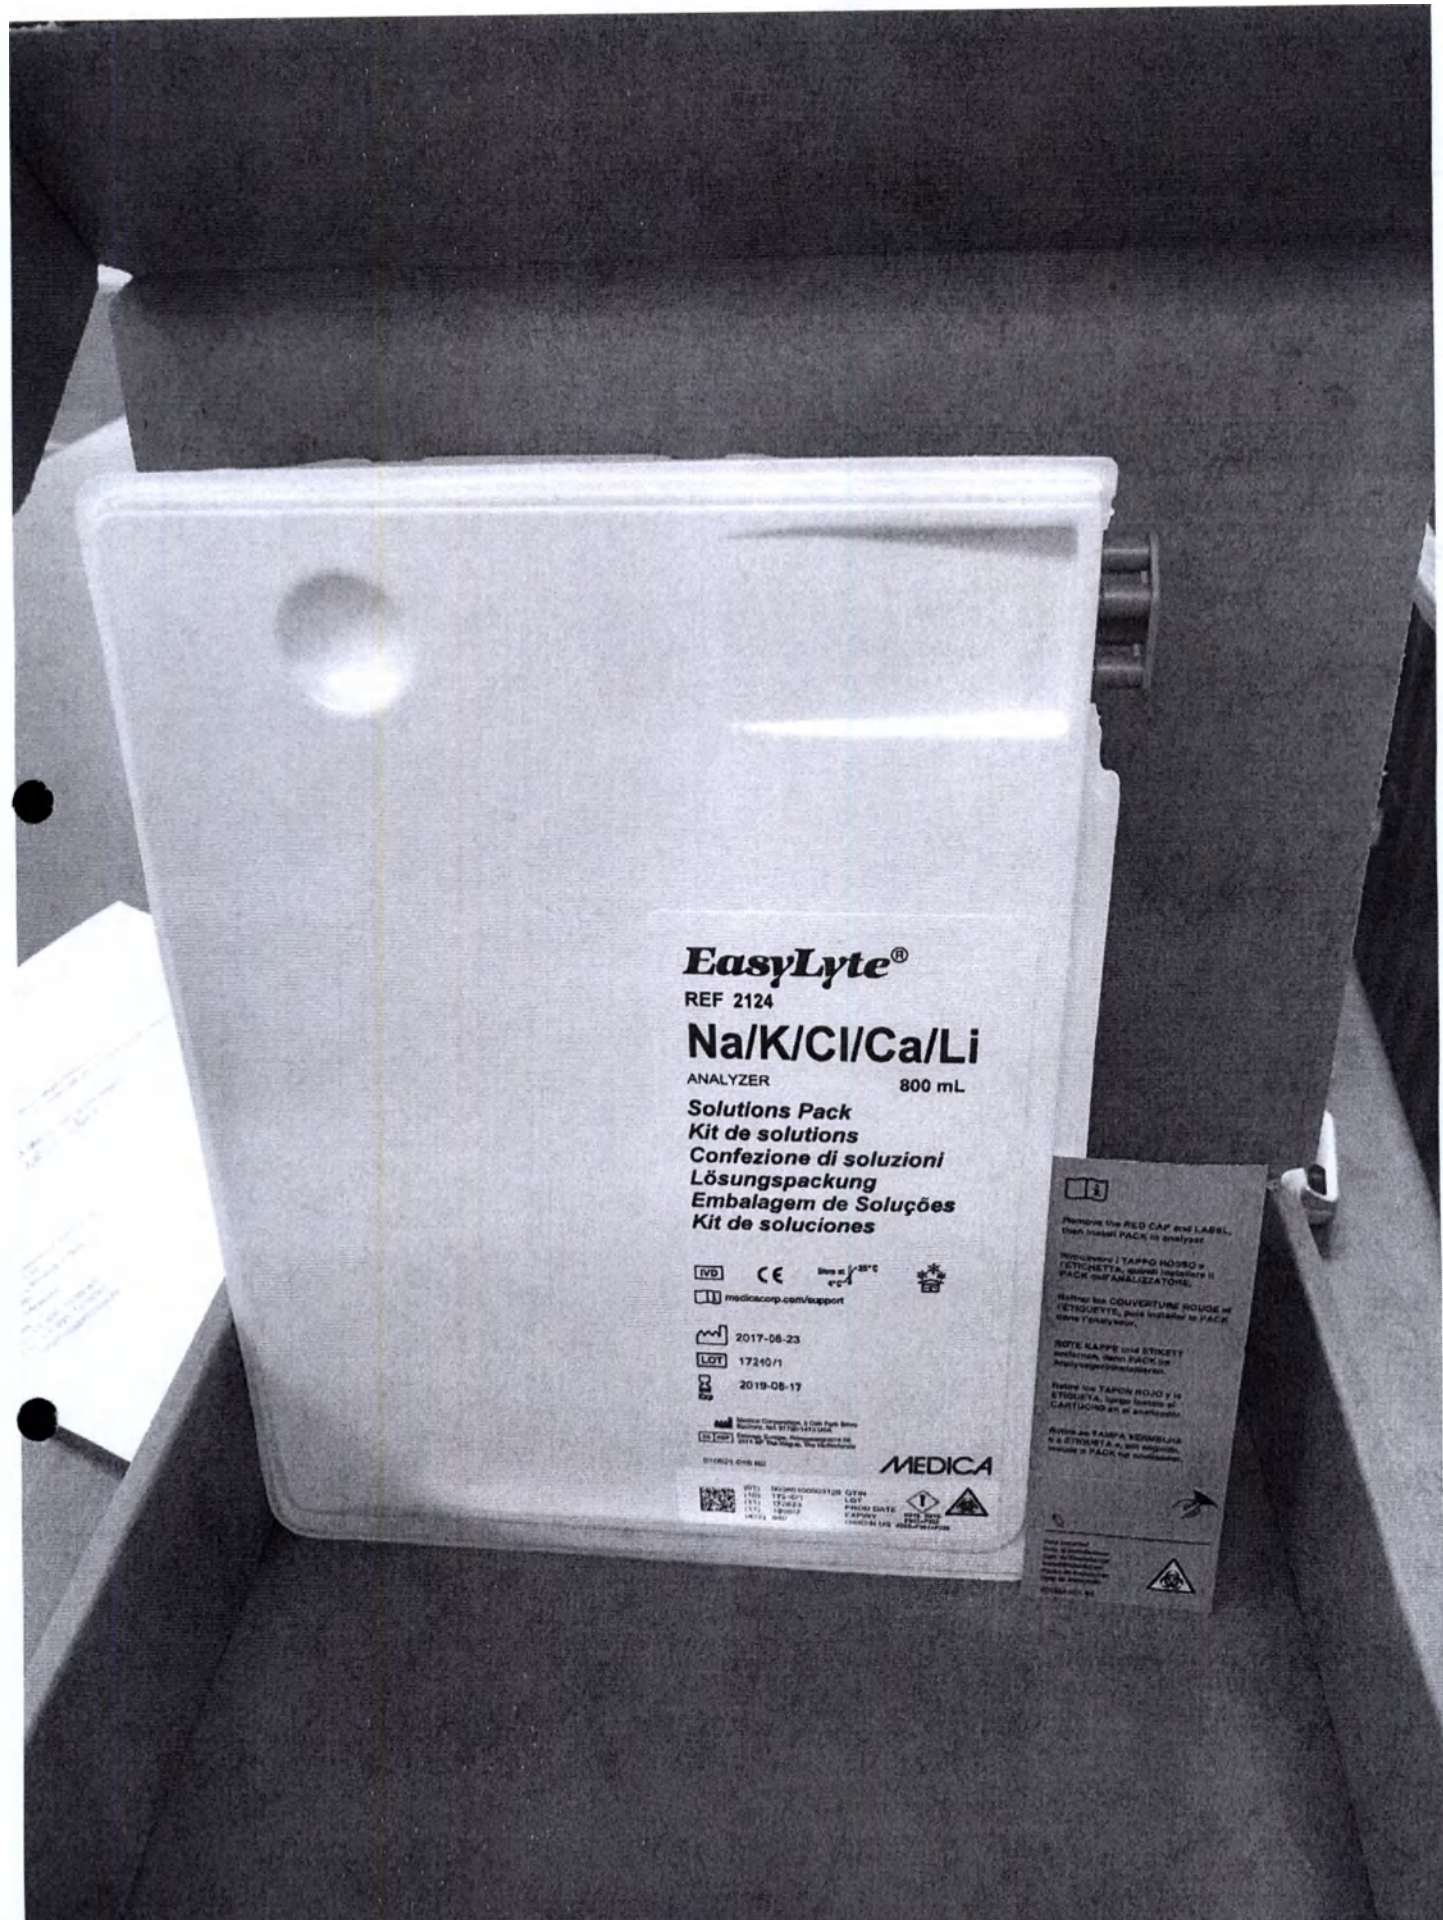

Пакет с растворами Na/K/Cl/Ca/Li (EasyLyte® Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack)

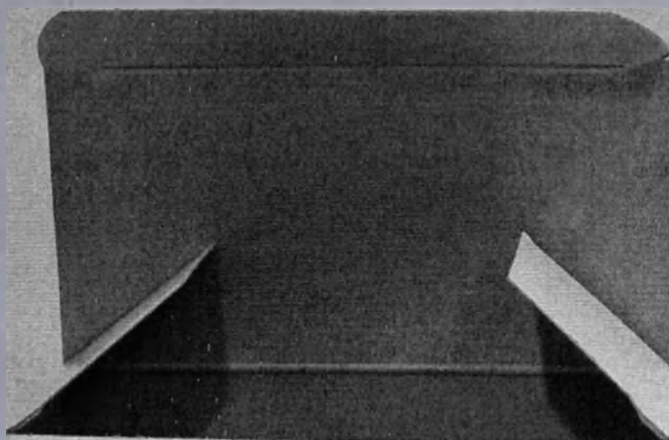

MEDICA

EasyLytic® EasyStat® EasyBloodGas™ EasyElectrolytes™

REF 2118

Daily Rinse/Cleaning Solution Kit
Kit de solution pour rinçage et nettoyage quotidien
Kit de solução para limpeza diária e limpeza permanente
Kit de limpeza para limpeza diária e limpeza permanente
Kit de limpeza para limpeza diária e limpeza permanente

LOT 17159

2019-05-23

2017-06-08

(01) 00386100002398
(10) 17159
(11) 17159



For use with Medica Analyzers.
Contenuto: 1 bottiglia, 90 ml daily cleaning diluent.
4 bottles, 90 ml each.

For use with Medica Analyzers.
Per uso con gli analizzatori di Medica.

For use with Medica Analyzers.
Para uso con los analizadores de Medica.

For use with Medica Analyzers.
Para uso com os analisadores de Medica.

For use with Medica Analyzers.
EasyLytic analyzer kit for Medica.



H018, H019, H020, H021
P001, P002, P003, P004
P005, P006, P007, P008, P009
P010, P011, P012, P013
P014, P015, P016, P017
P018, P019, P020, P021

DANGER

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159


LOT 17159

LOT 17159


LOT 17159

LOT 17159

LOT 17159

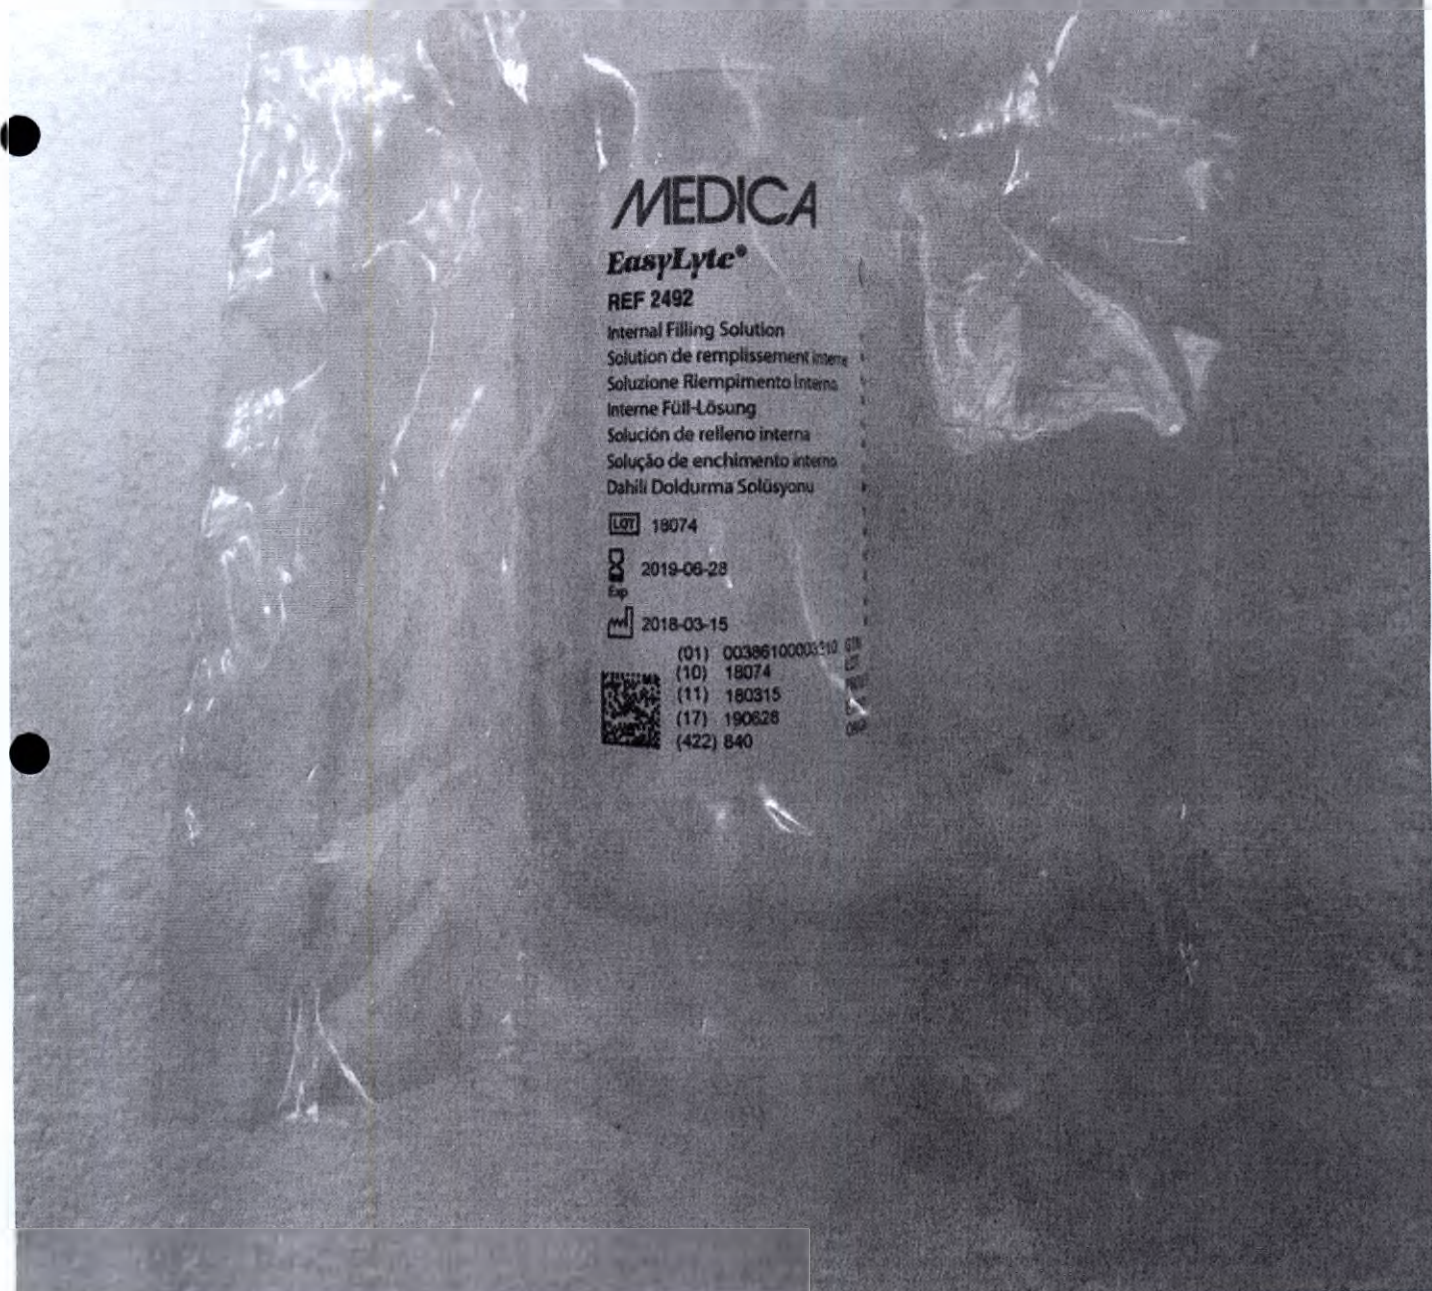

Раствор для заполнения внутренней камеры (Internal Filling Solution)

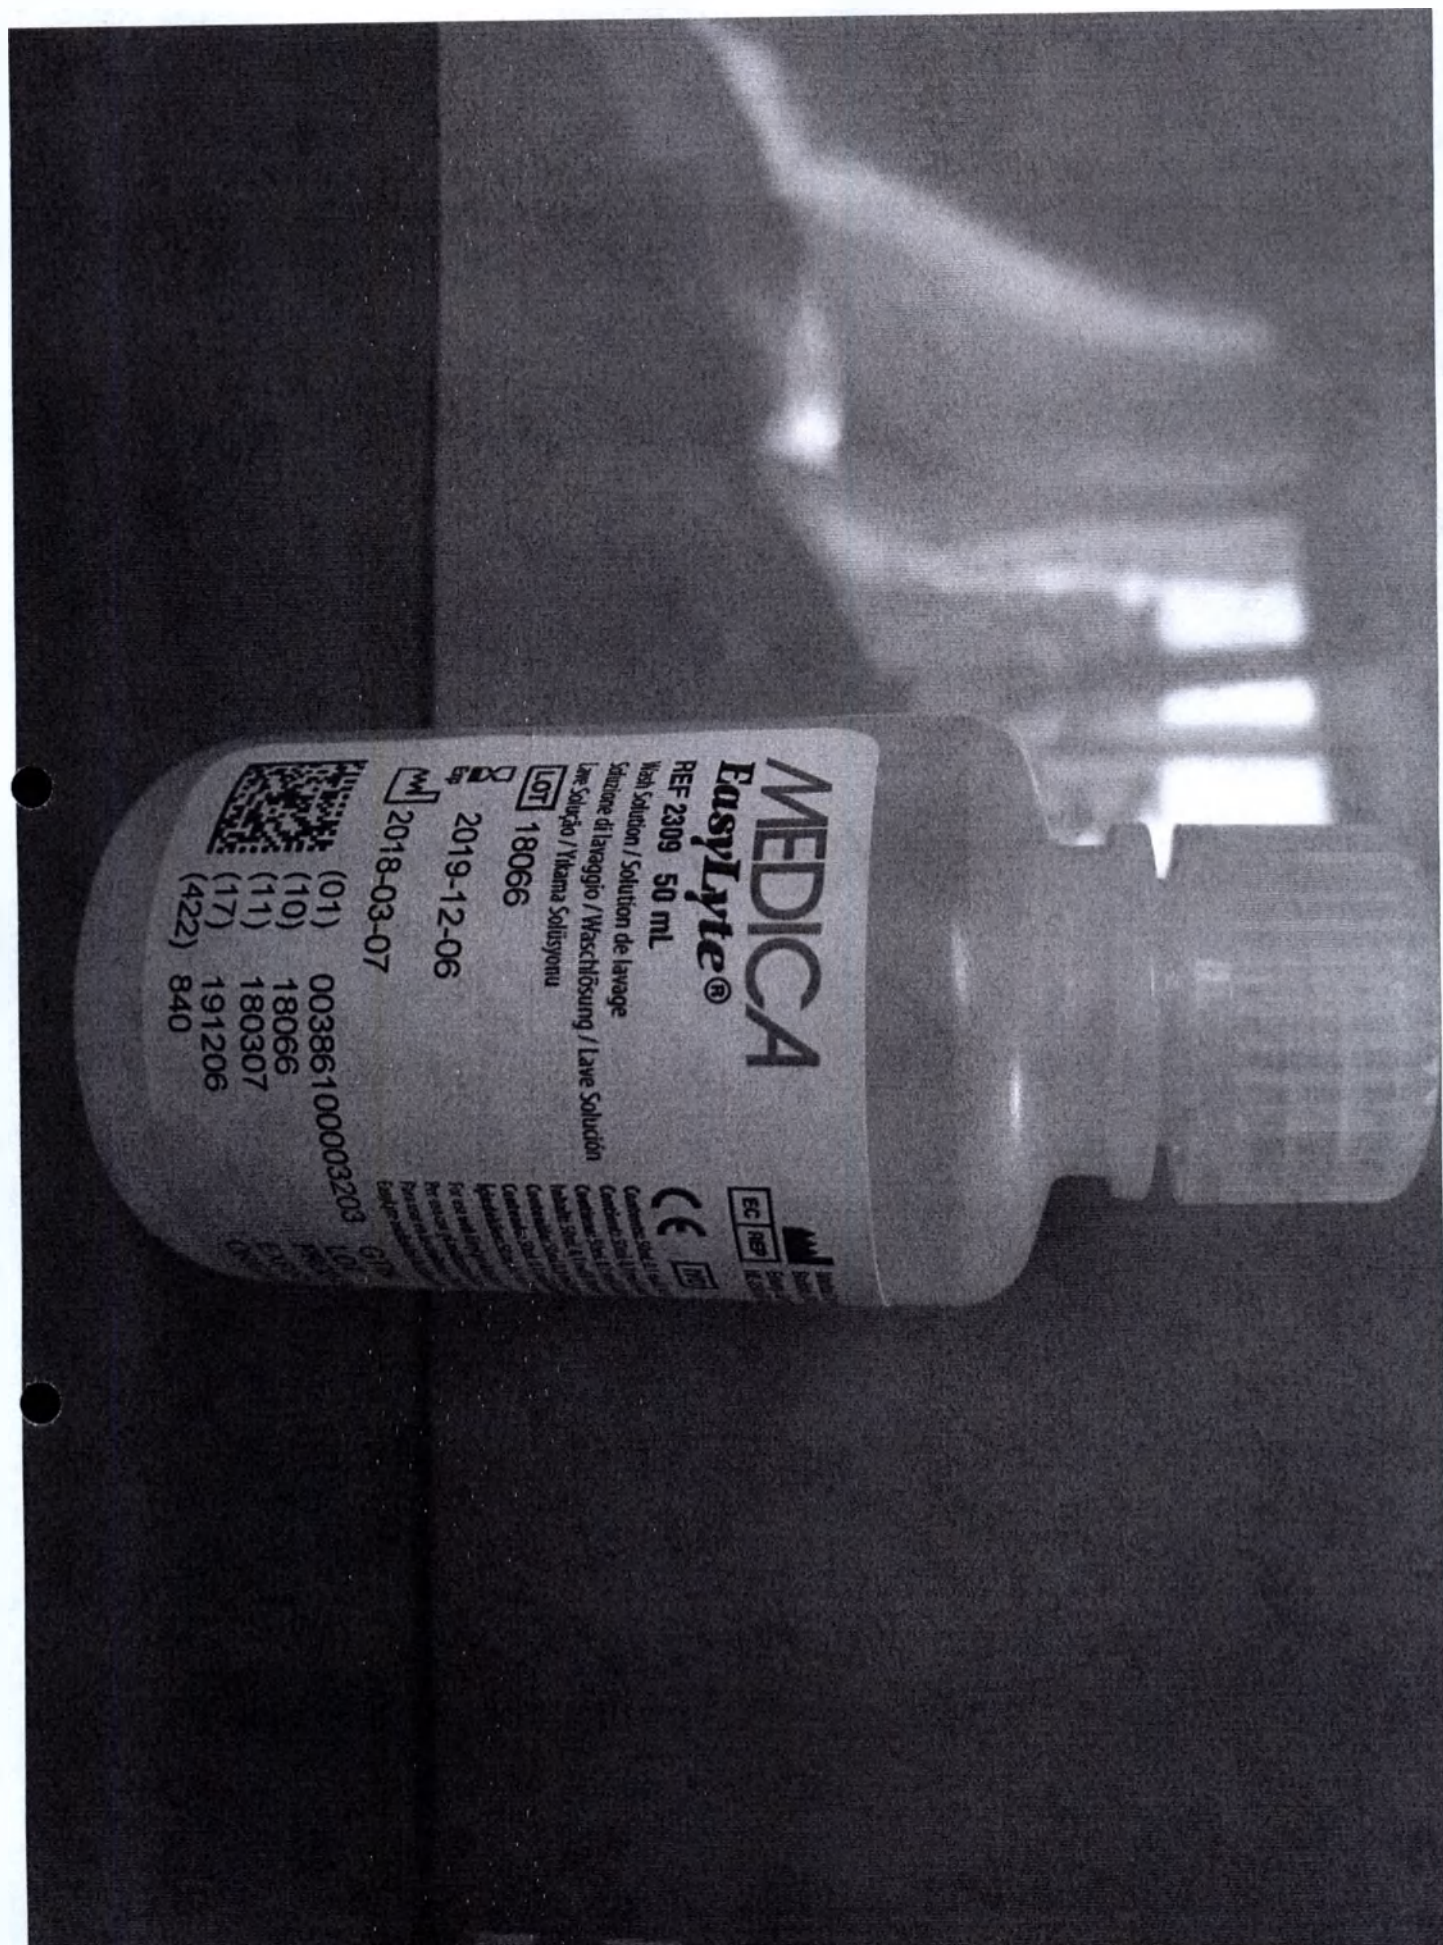

Раствор промывочный (Wash Solution)

MEDICA

EasyLyte®

REF 2111 500 mL

Urine Diluent

Diluant d'urine

Diluyente di urina

Urin-Verdünnungsmittel

Diluyente de orina

Diluyente de urina

İdrar Dilüenti

LOT 17209

Exp 2019-01-05

2017-07-28



(01) 00386100003036
(10) 17209
(11) 170728
(17) 190105
(422) 840

GTIN
LOT
PROD DATE
EXPIRY
ORIGIN US

CE

IVD

i

2019-01-05

For use with EasyLyte Analyzers.

Contents: 5.2 mmol/L magnesium acetate, buffer and preservative.

Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.

Contient: 5,2 mmol/l acétate de magnésium, amortisseur et conservateur.

Per uso con gli analizzatori EasyLyte.

Contiene: 5,2 mmol/l acetato di magnesio, tampone e conservante.

Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.

Inhalt: 5,2 mmol/l Magnesiumazetat, Puffer und Konservierungsstoff.

Para usar en los analizadores EasyLyte.

Contenido: 5,2 mmol/l de acetato de magnesio, solución tampón y preservante.

Para utilizar com analisadores EasyLyte.

Conteúdo: acetato de magnésio 5,2 mmol/L, tampões e preservante.

EasyLyte analizörleri ile kullanım için.

İçindekiler: 5,2 mmol/L magnezyum asetat, bufferler ve koruyucu.

EC REP

Medica Company
2 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730
Emergo Europe
18-2513 BH The Hague
The Netherlands

Дилуент мочи (Urine Diluent)

MEDICA

EasyLyte[®]

IVD

1

REF 002470-001

Capillary Adapter Evaluation Sample Kit

CONT

15 Capillary Adapters; 45 Capillary tubes; Directions for use

000972-027 R3

17271



Exp

2020-03-31



For use with Medica analyzers

Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730 1413 USA

Набор капилляров и адаптеров (Capillary Adapter Evaluation Sample Kit): капилляры, 45 шт./тубус; адаптеры, 15 шт./упак.; спецификация; инструкция по применению

Capil

CLIA Classification:

Sample:	Whole Blood, Serum or Plasma
Sample Size:	60 µL Whole Blood, Serum or Plasma
Method:	Direct measurement by ion-selective electrode
Detection Range:	Na ⁺ : 20–200 mmol/L
Display Resolution:	Na ⁺ : 0.1 mmol/L
Performance:	Na ⁺
BLOOD, SERUM, PLASMA	80–200 mmol/L
Reproducibility (typical)	Performed according to a
within run (N=20)	

EasyLyte®

Capillary Adapter Kit
Kit d'adaptateurs
capillaires
Kit adattatori e capillari
Kapillarenadapterzubehör
Kit de adaptadores de
capilares
Conjunto de Adaptadores
de Capilares
ΚΙΤ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ
προσαρμογέα
Kapiller Adaptör Kiti

EN

FR

IT

DE

ES

PT

GR

TU

REF 2590 CE IVD

MEDICA

MEDICA

EasyLyte®

REF 002470-001

Capillary Adapter Evaluation Sample Kit

CONT

15 Capillary Adapters, 45 Capillary Tubes, Directions for use


N/A

ISO


2020-03-31

For use with Medica EasyLyte®
 Medica Corporation, 1-800-848-8888
 Medica, 844 E 17th St, Tulsa, OK 74103, USA


Набор капилляров и адаптеров (Capillary Adapter Evaluation Sample Kit): капилляры, 45 шт./тубус; адаптеры, 15 шт./упак.; спецификация; инструкция по применению

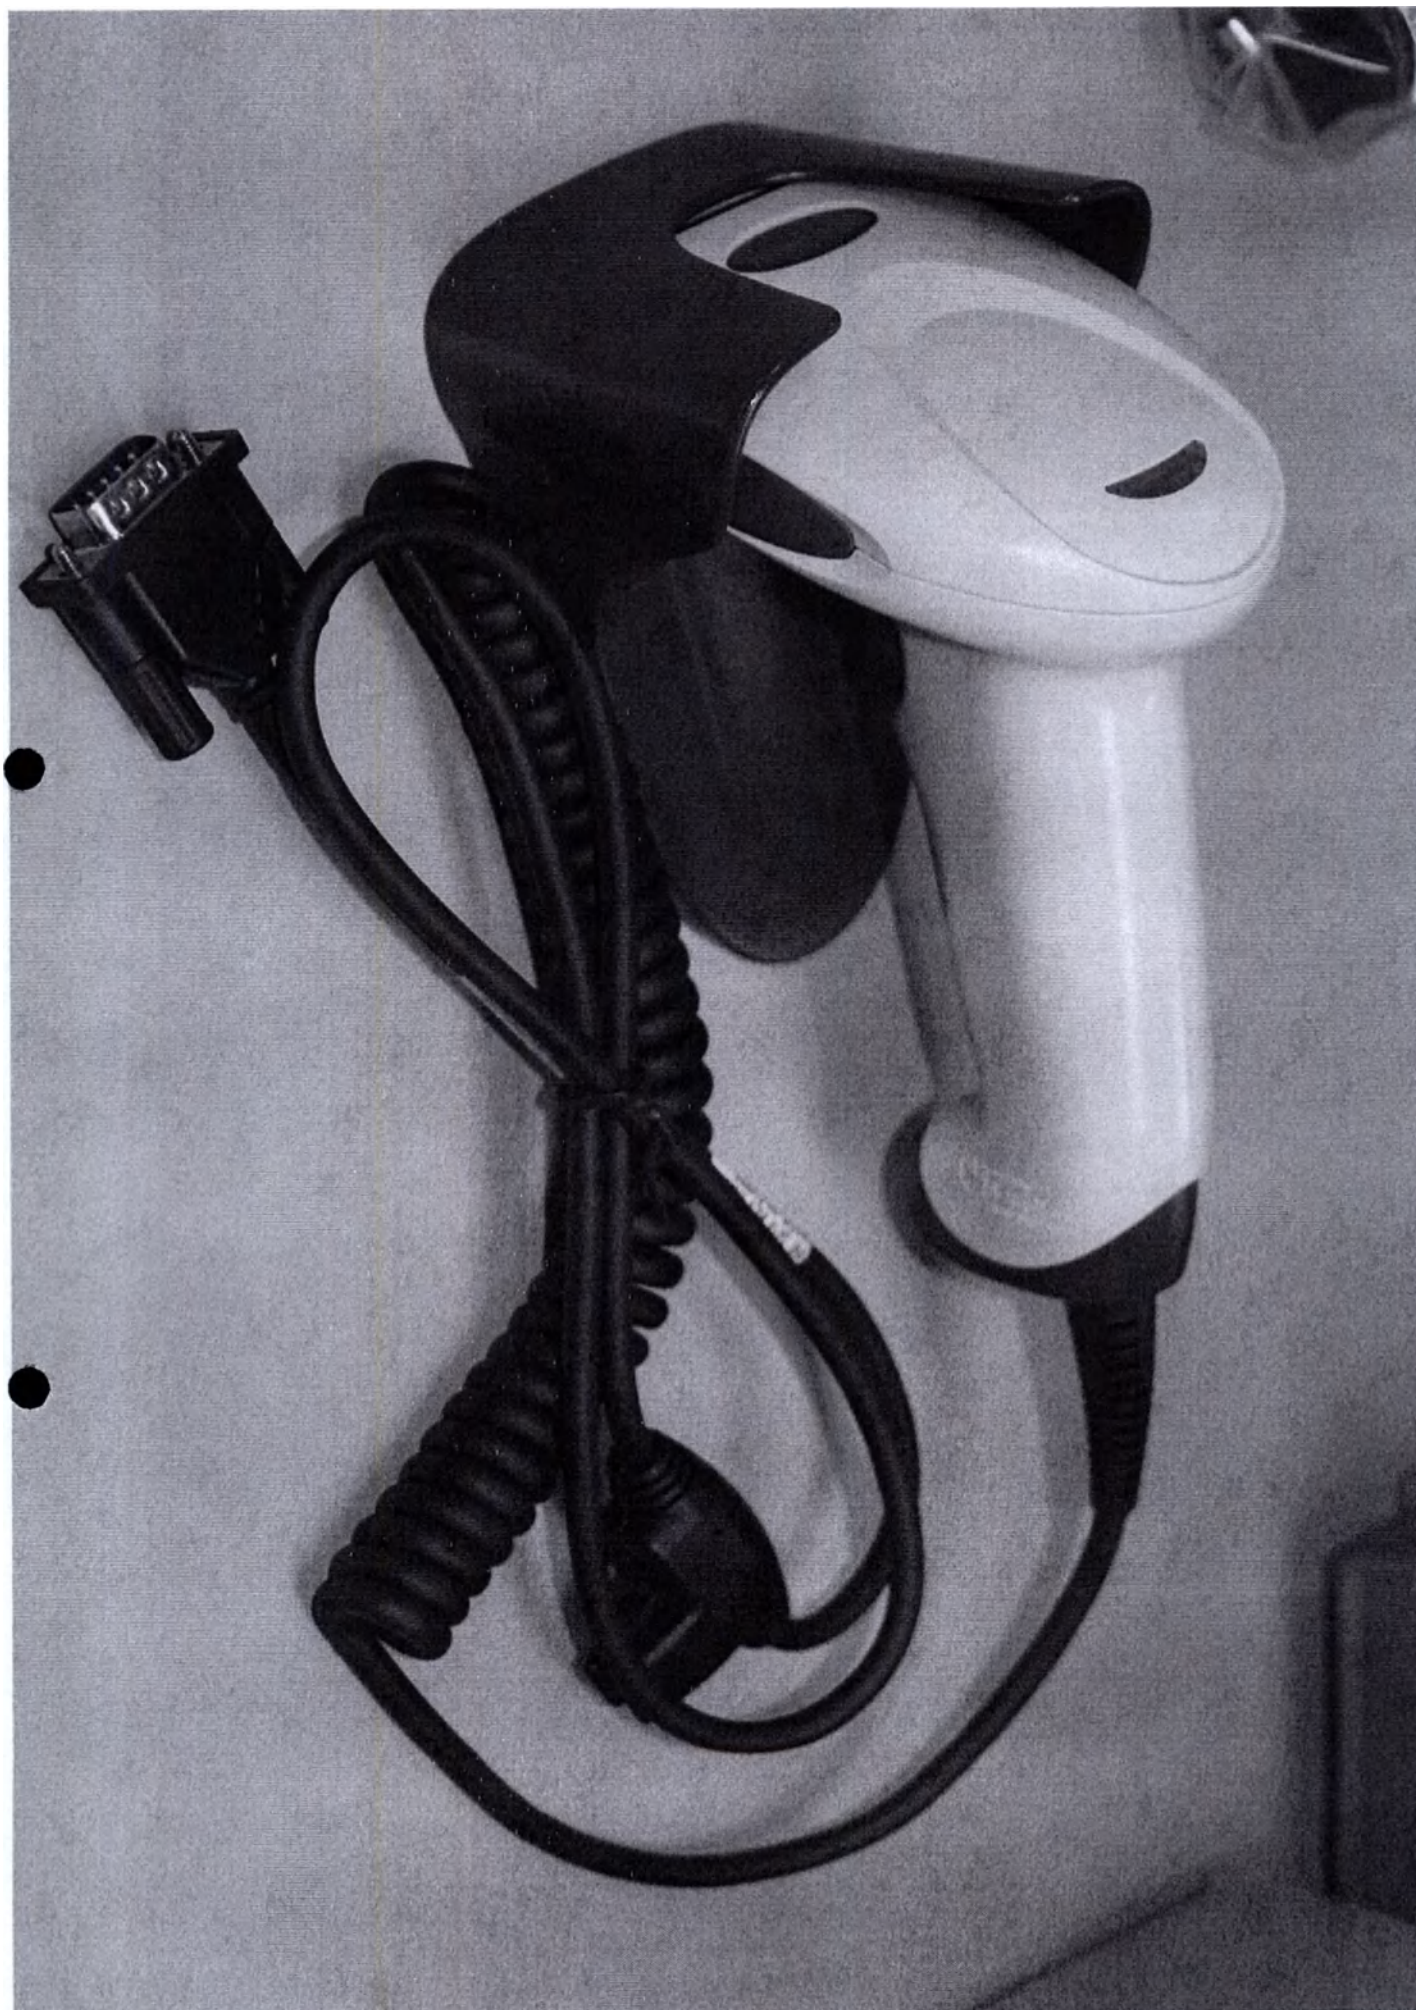

Считыватель штрихкода

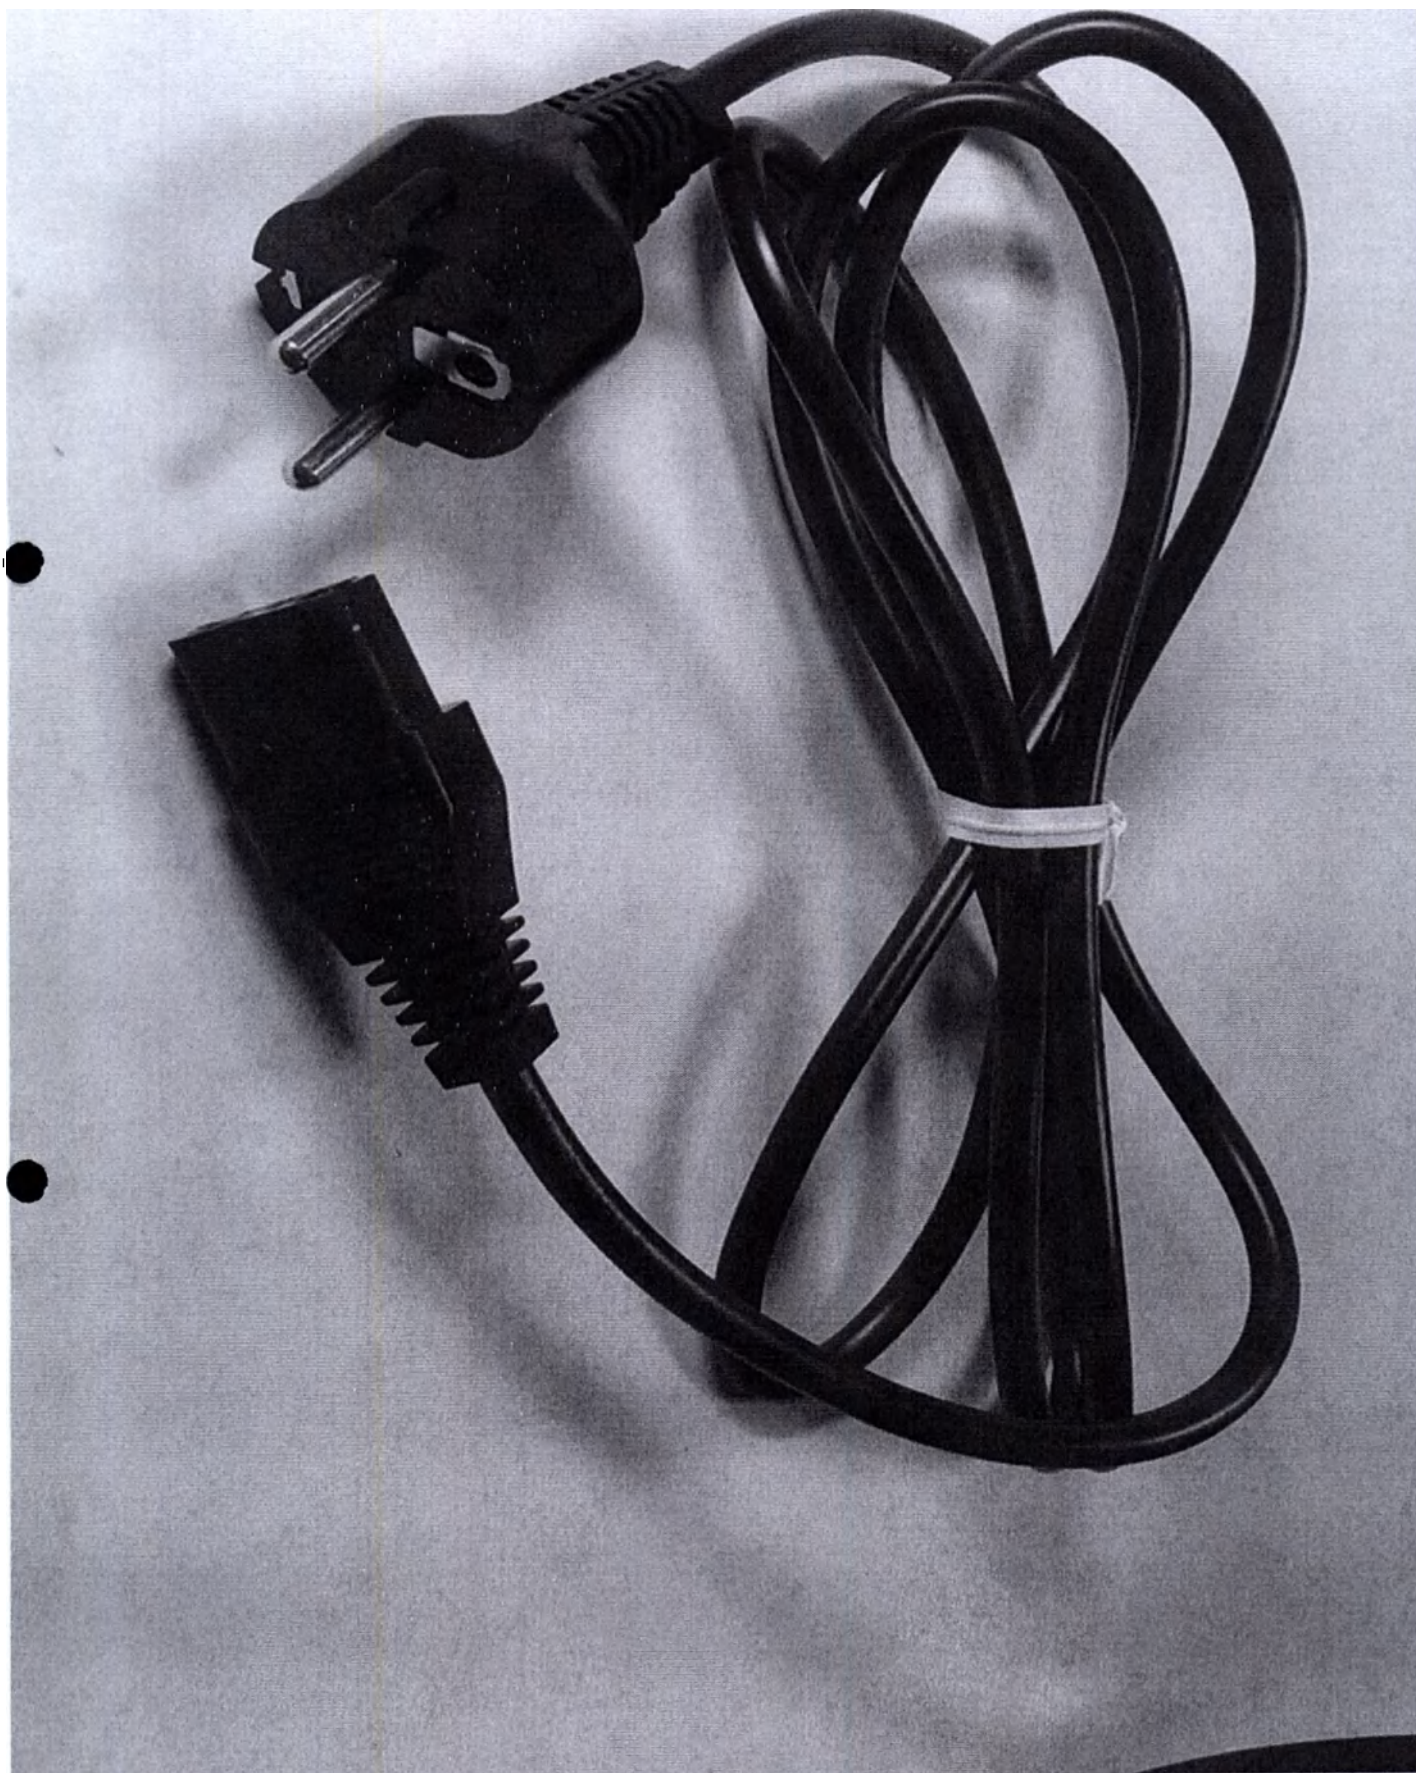

Кабель сетевой

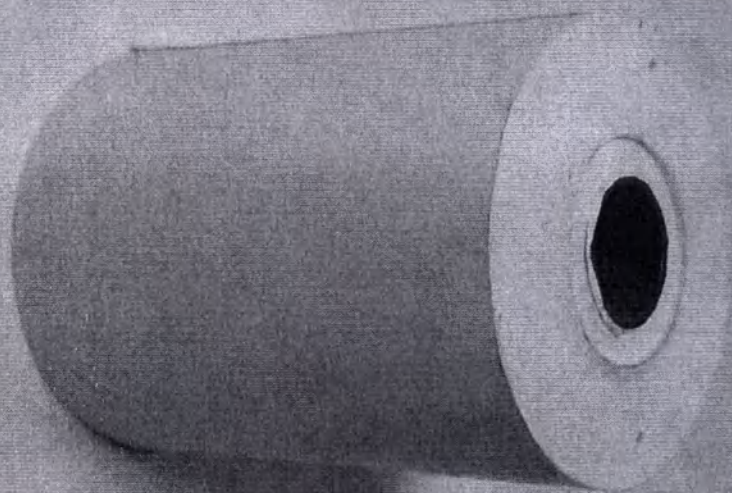

Термобумага в рулоне, 1 рулон

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 79 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С. А.