


**Аппарат лазерный полупроводниковый офтальмотерапевтический спекл-полем в “зеленом” диапазоне
длин волн “ИЗУМРУД-М” по ТУ 26.60.13-060-26857421-2018**





Блок формирования спекл-поля

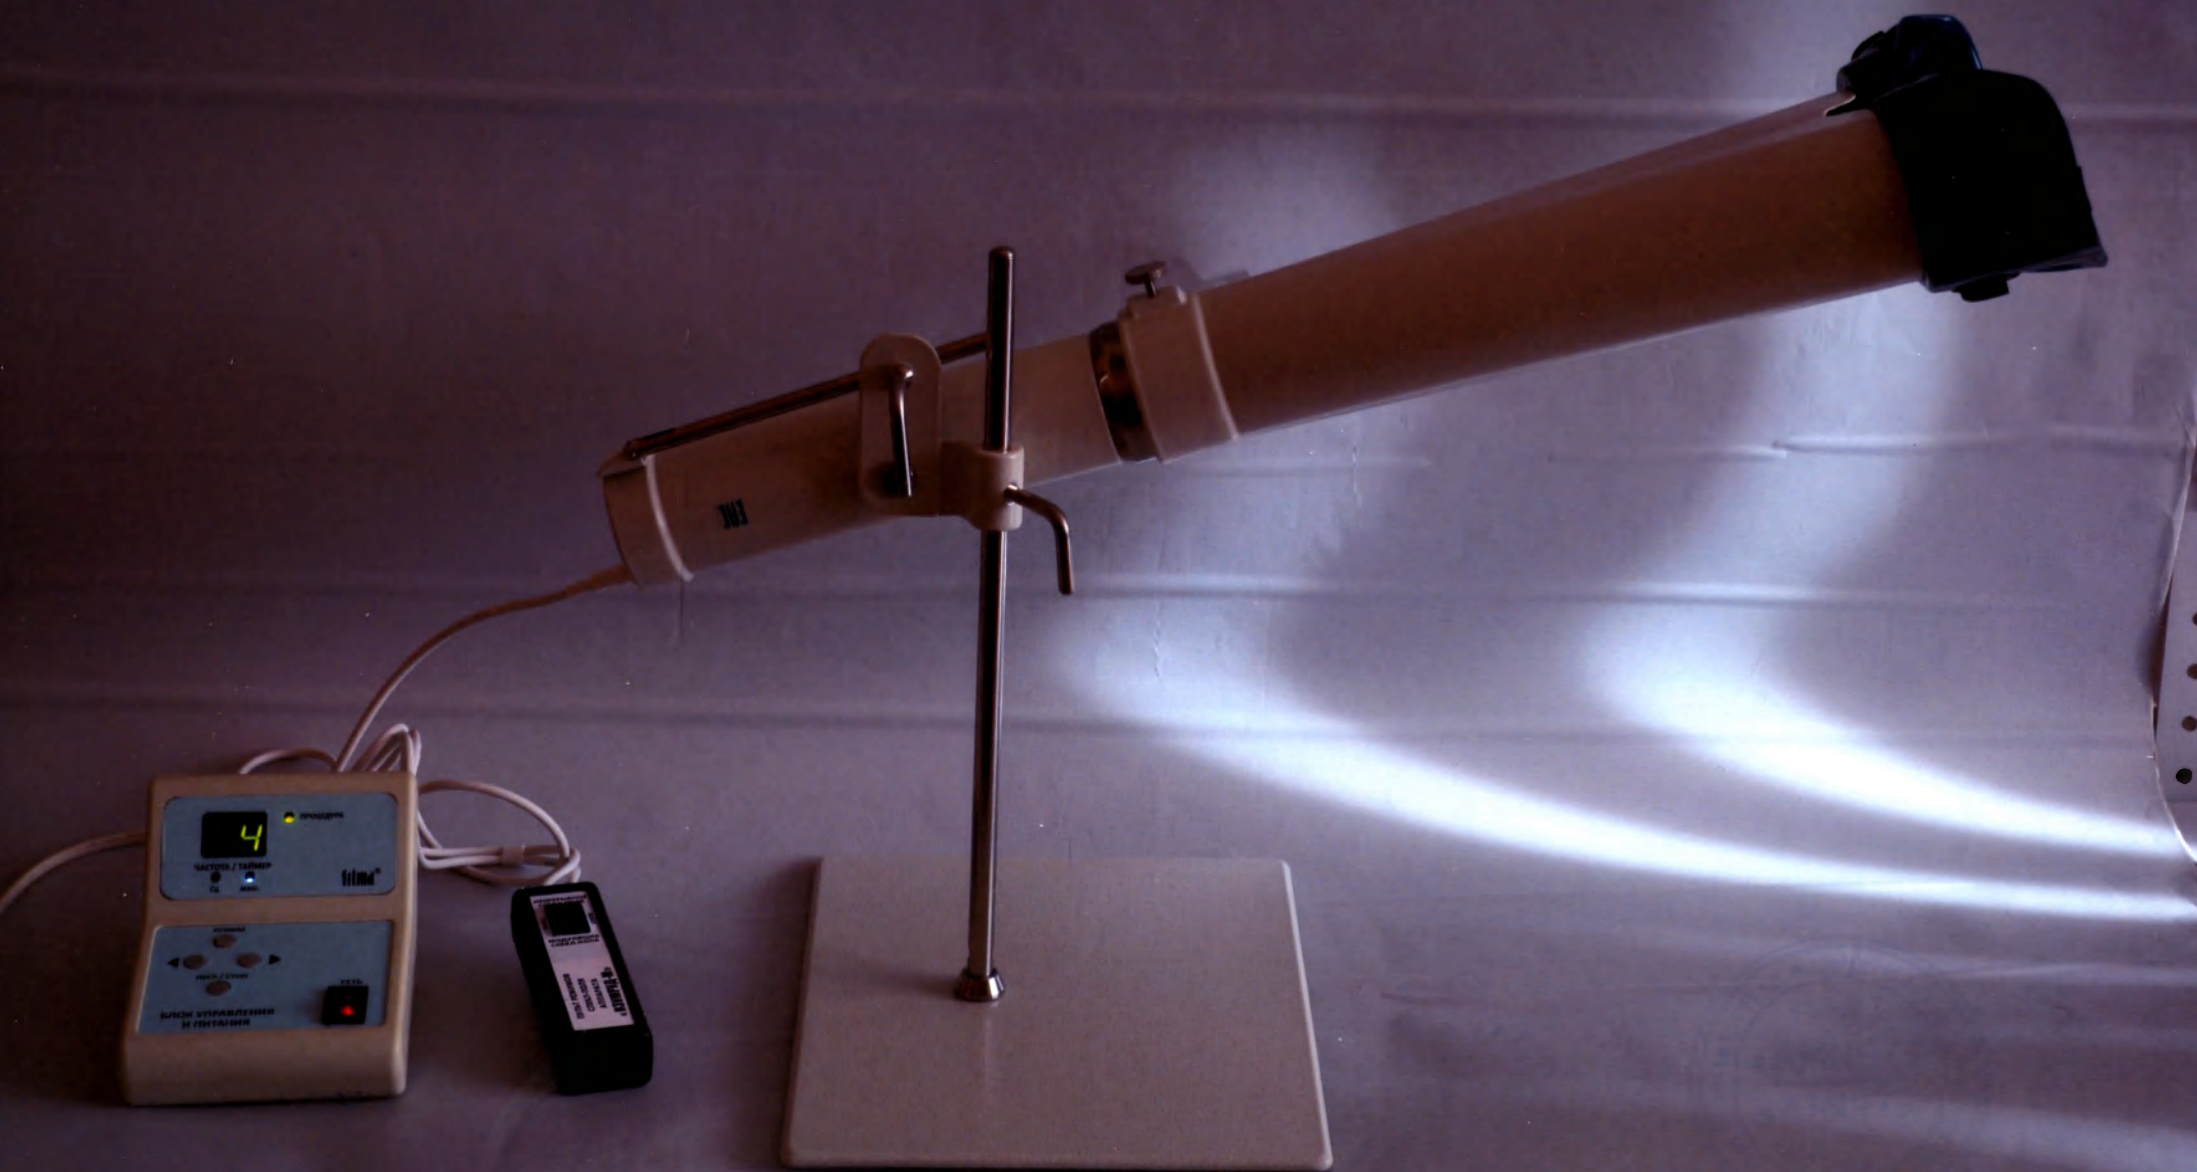

Блок управления и питания





Штатив



Тысяч

