



ООО "Д-Альянс"

117105, Москва, Нагорный пр., д.10, корп.2, под.4, пом.16

Тел/факс: (495) 767 9748 / 229 7612

Web: www.owandy.ru e-mail: owandy@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Д-Альянс"

Христенко Д.И.

М.П.

Фотографии медицинского изделия


Визиограф стоматологический ONE

Производство: «Ованди Радиолоджи С.А.С.»,

Франция, / Owandy Radiology S.A.S., France




Датчик №1. универсальный размер 1

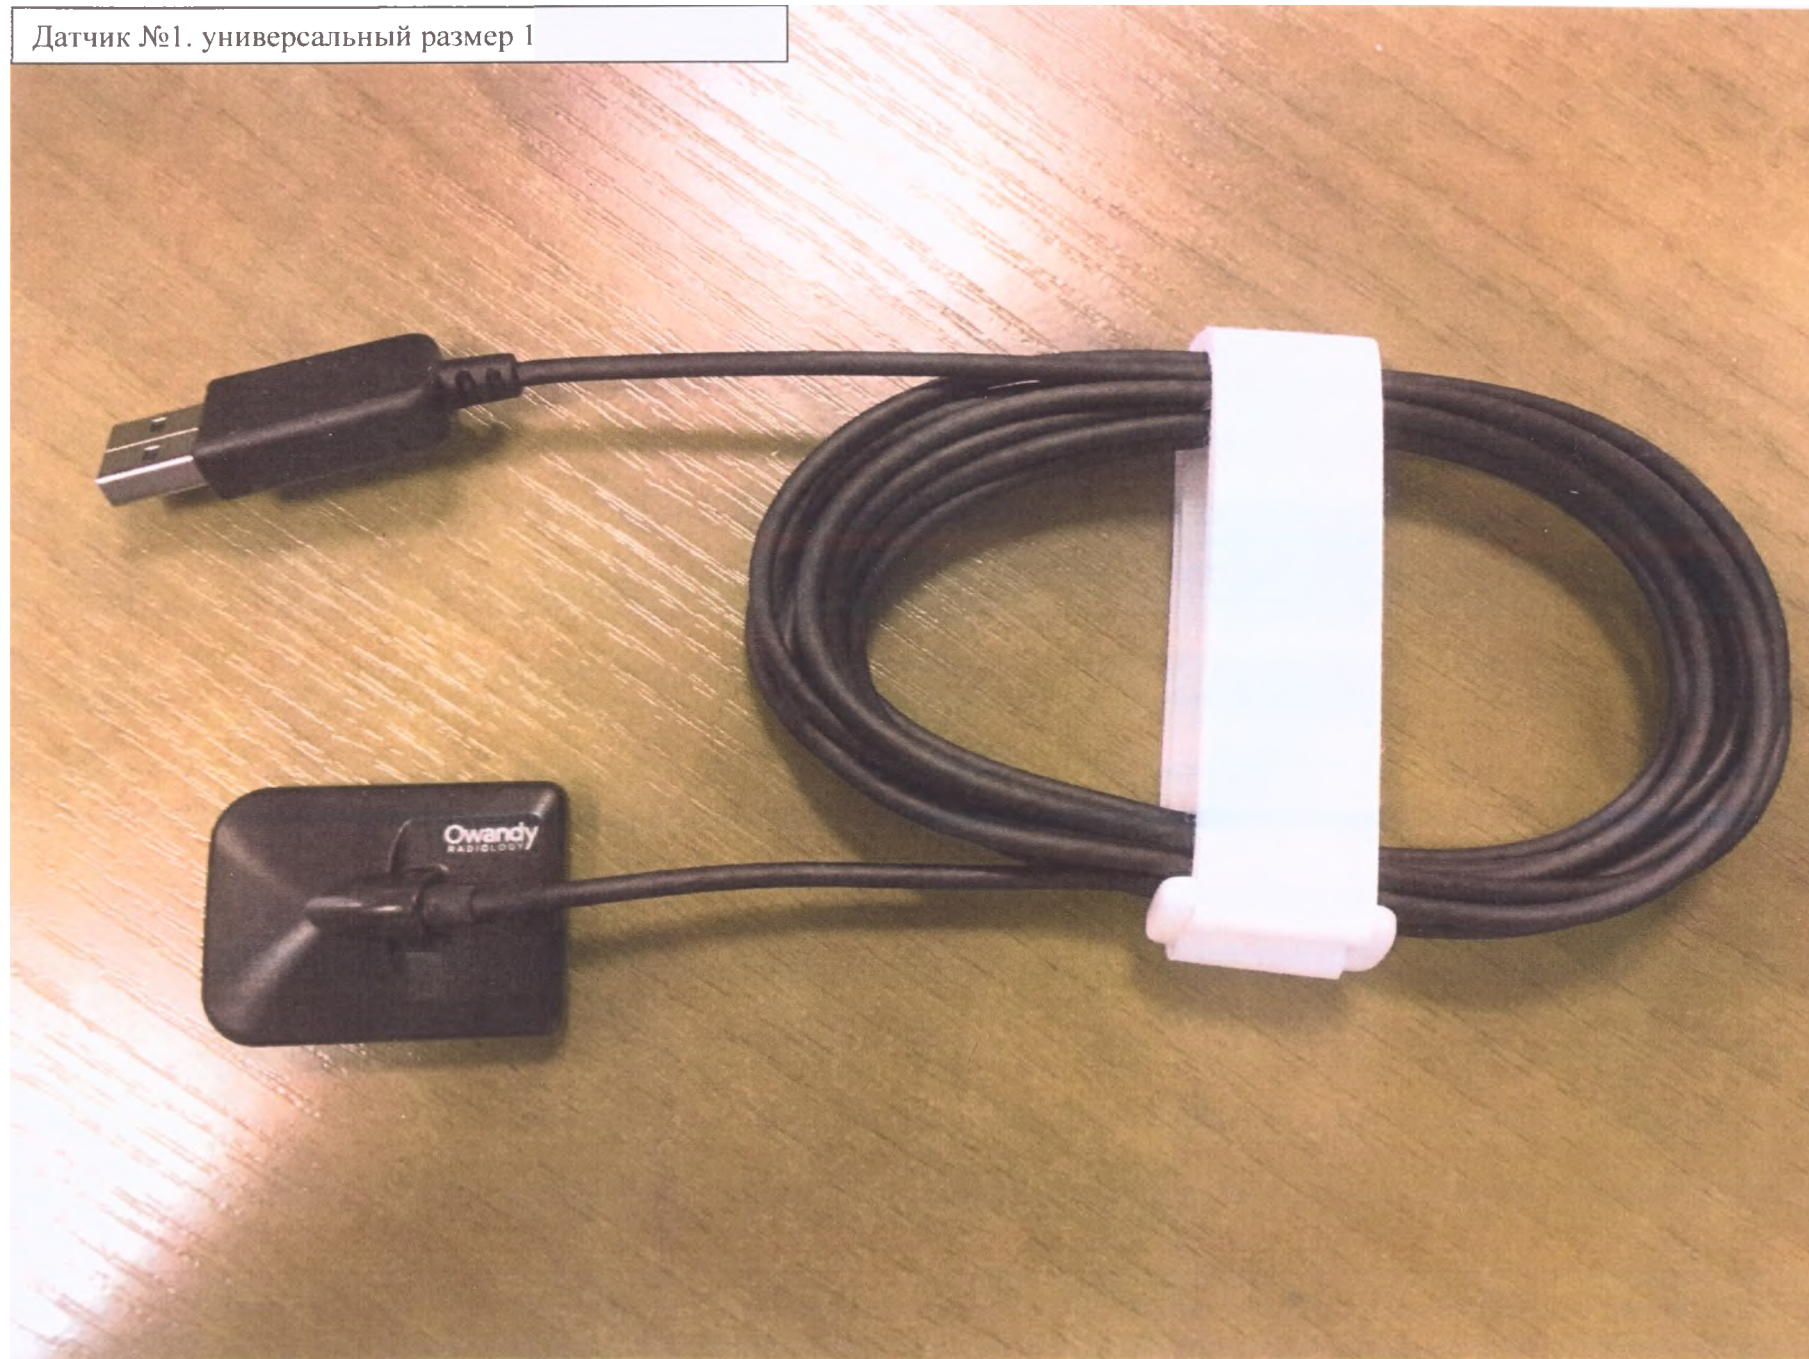


Датчик №2. универсальный размер 2



Датчик №2. универсальный размер 2

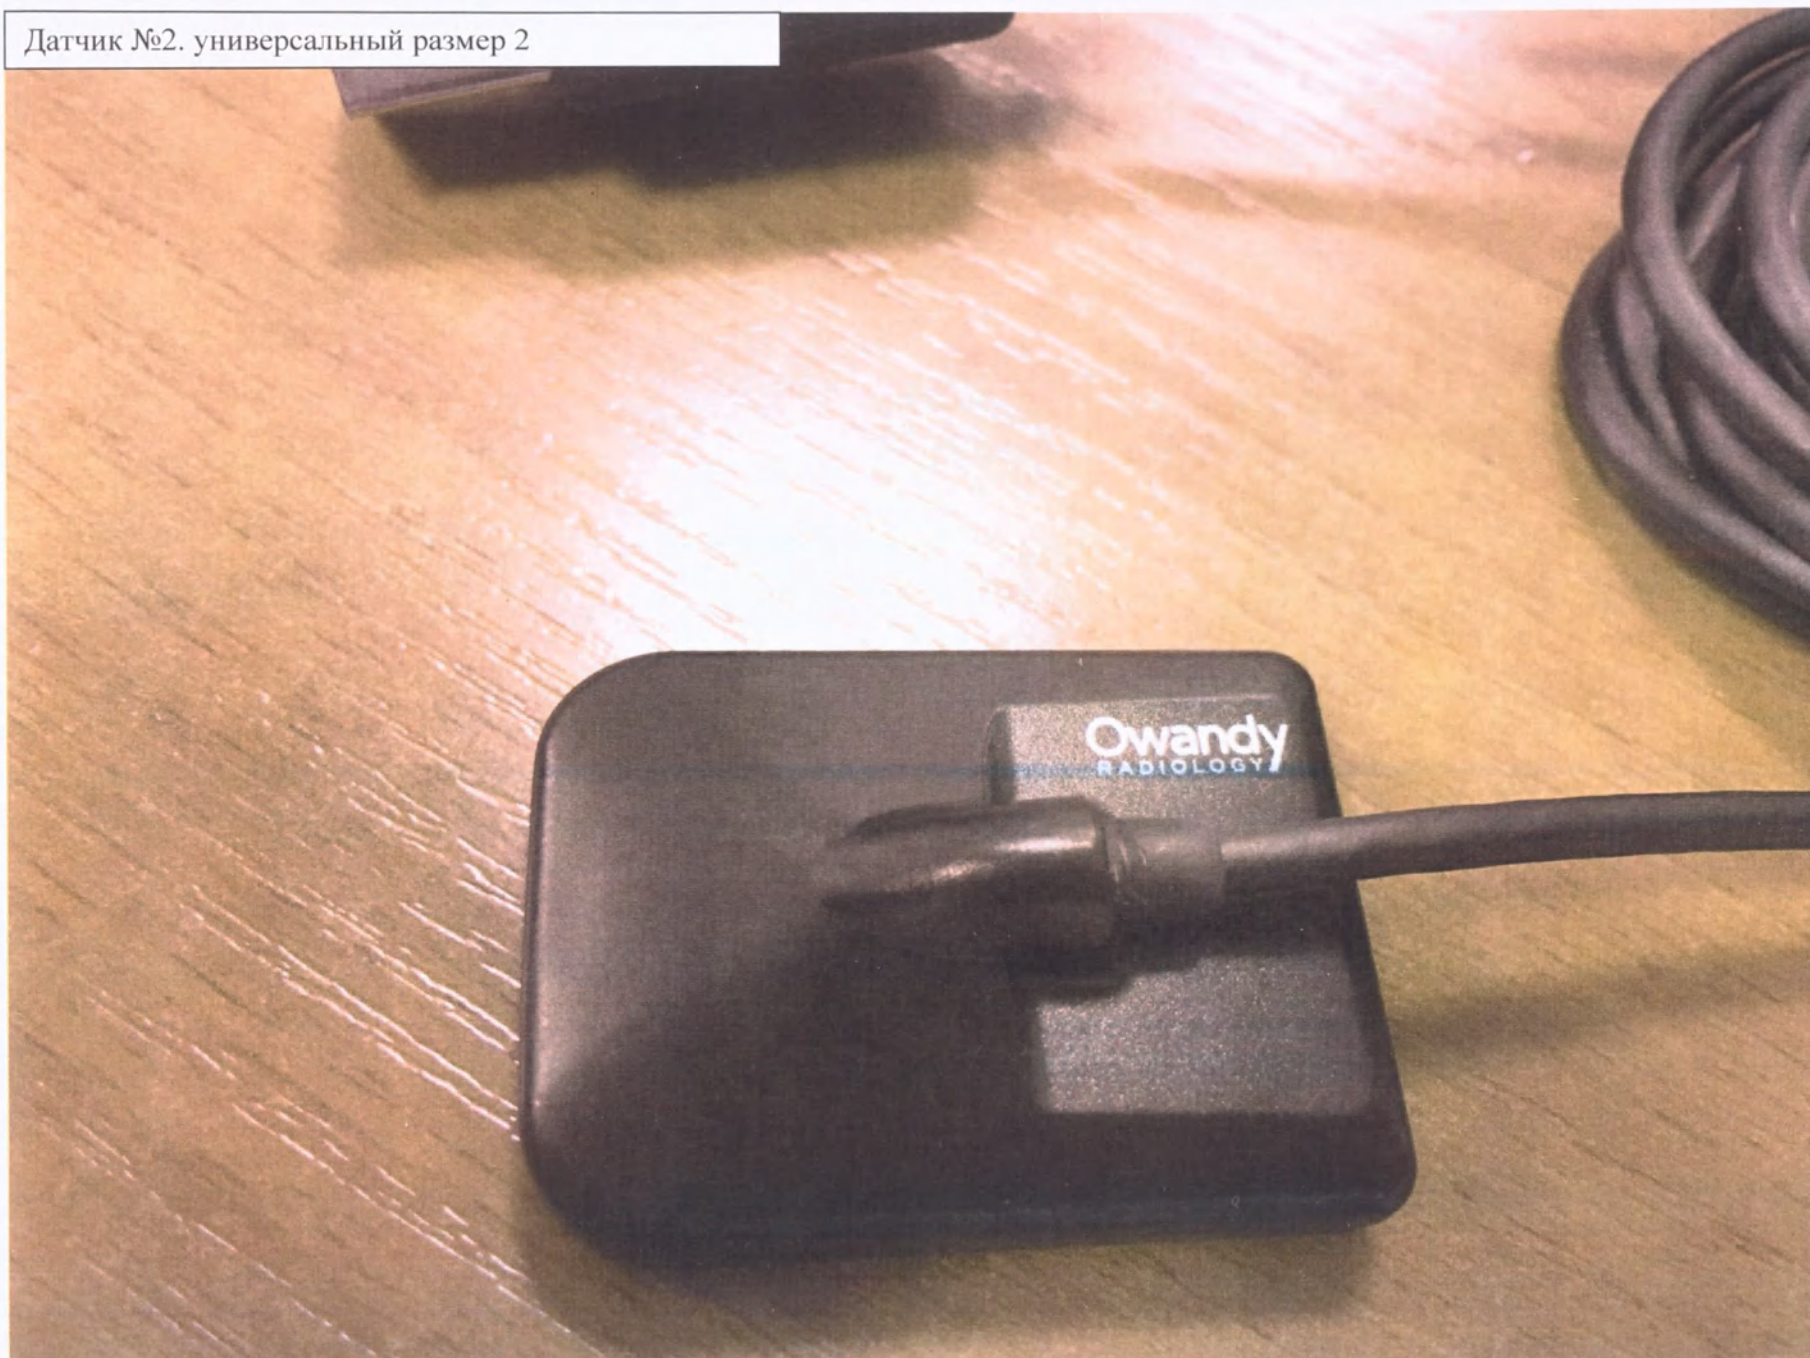

Настенный самоклеящийся держатель для датчика

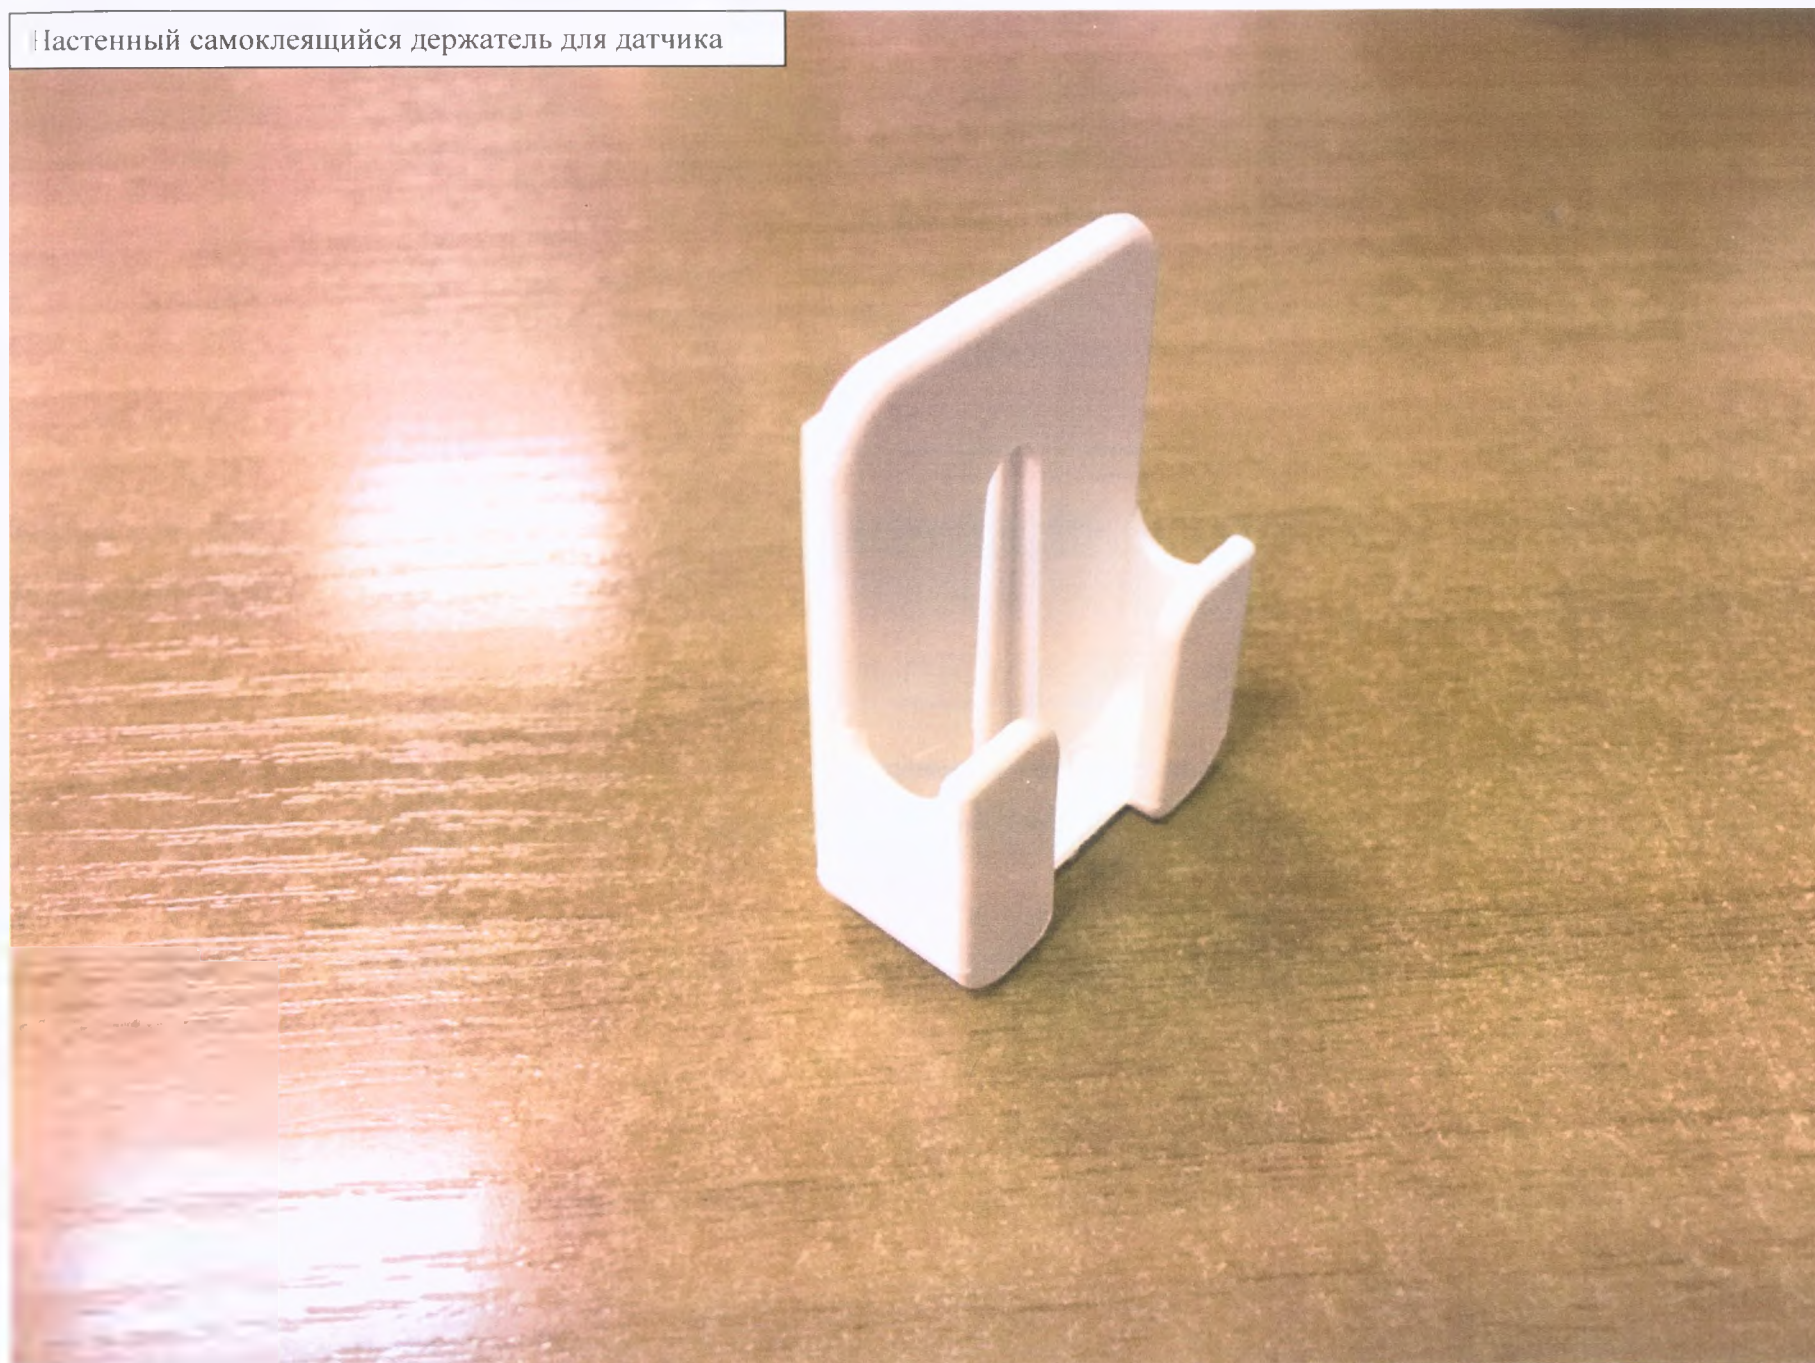

Настенный самоклеящийся держатель для датчика (вид сзади)



Программное обеспечение Quickvision & Driver – программа с драйвером

QuickVision & Drivers

Release: 5.03A
Batch: 01/2018

Windows 7, 8, 10 (32/64bit)

Do not make illegal copies of this disk or the installed software
Ne pas faire de copies illégales de ce disque ou logiciel installé


© Copyright Owandy Radiology
Please read the manual
Veuillez lire le manuel



Owandy
Radiology
2 rue des Vellies Vignes
77183 Croissy-Beaubourg
FRANCE
www.owandy.com

CE 0051

Sensor installation file – калибровочный диск для драйвера

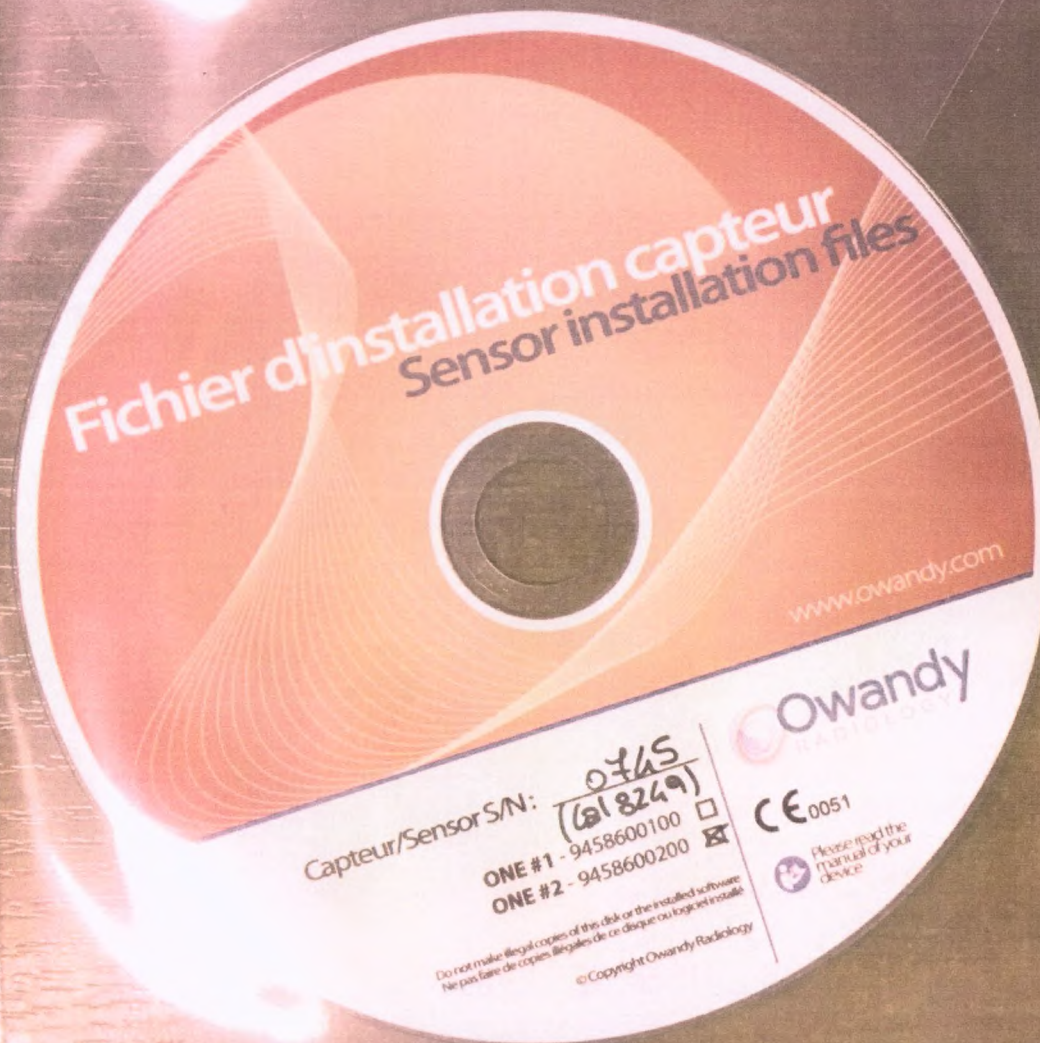

Installation and user manual – инструкция по установке и использованию





EN • INSTALLATION AND USER MANUAL
7758014200 • Version 04, 05 June 2014



One

SIMPLICITY WITHIN REACH
Direct USB Intra-oral Sensor


Инструкция по использованию




Пользовательская упаковка медицинского изделия



Пользовательская упаковка медицинского изделия

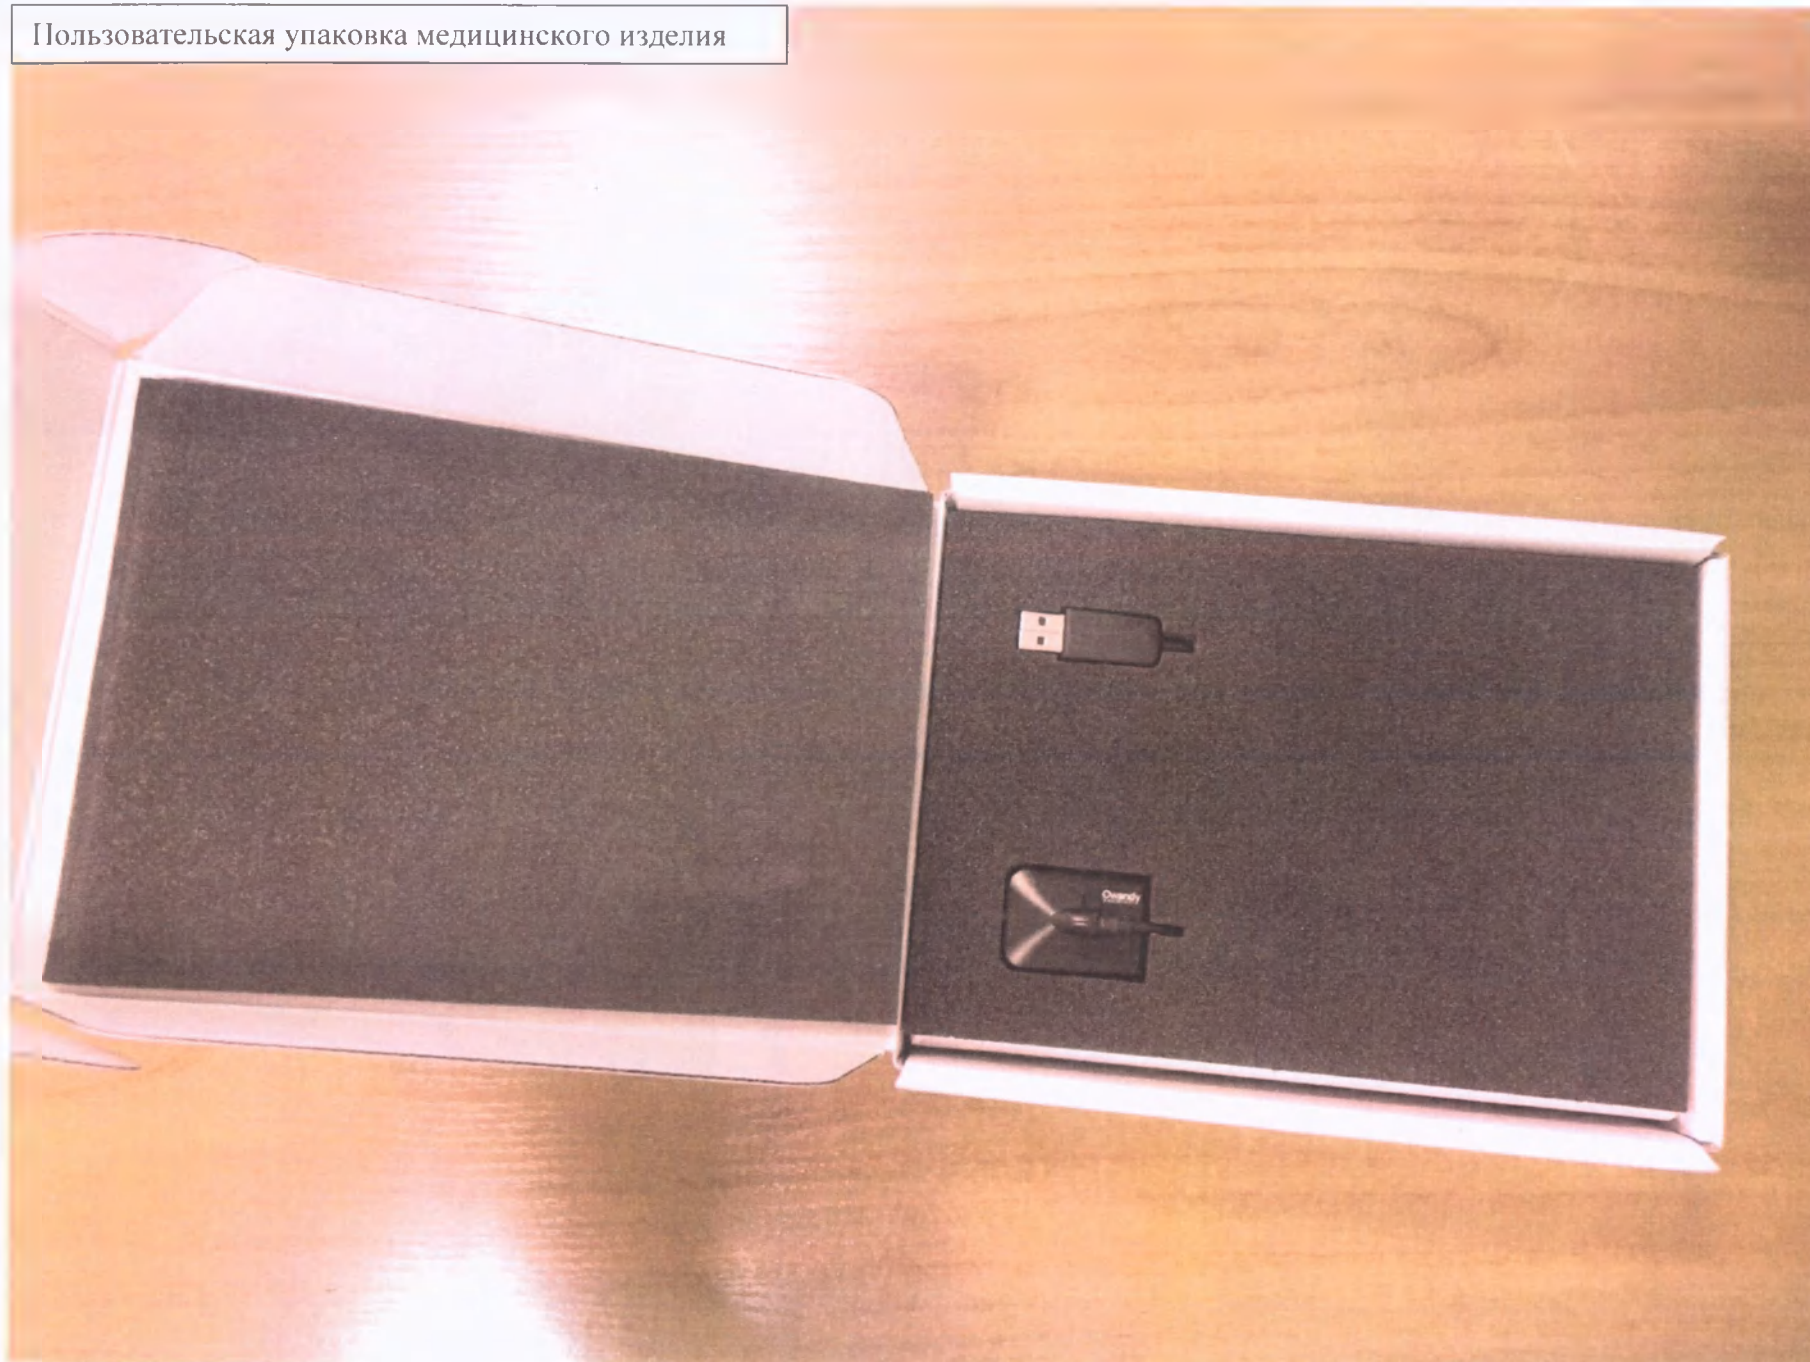

Пользовательская упаковка медицинского изделия

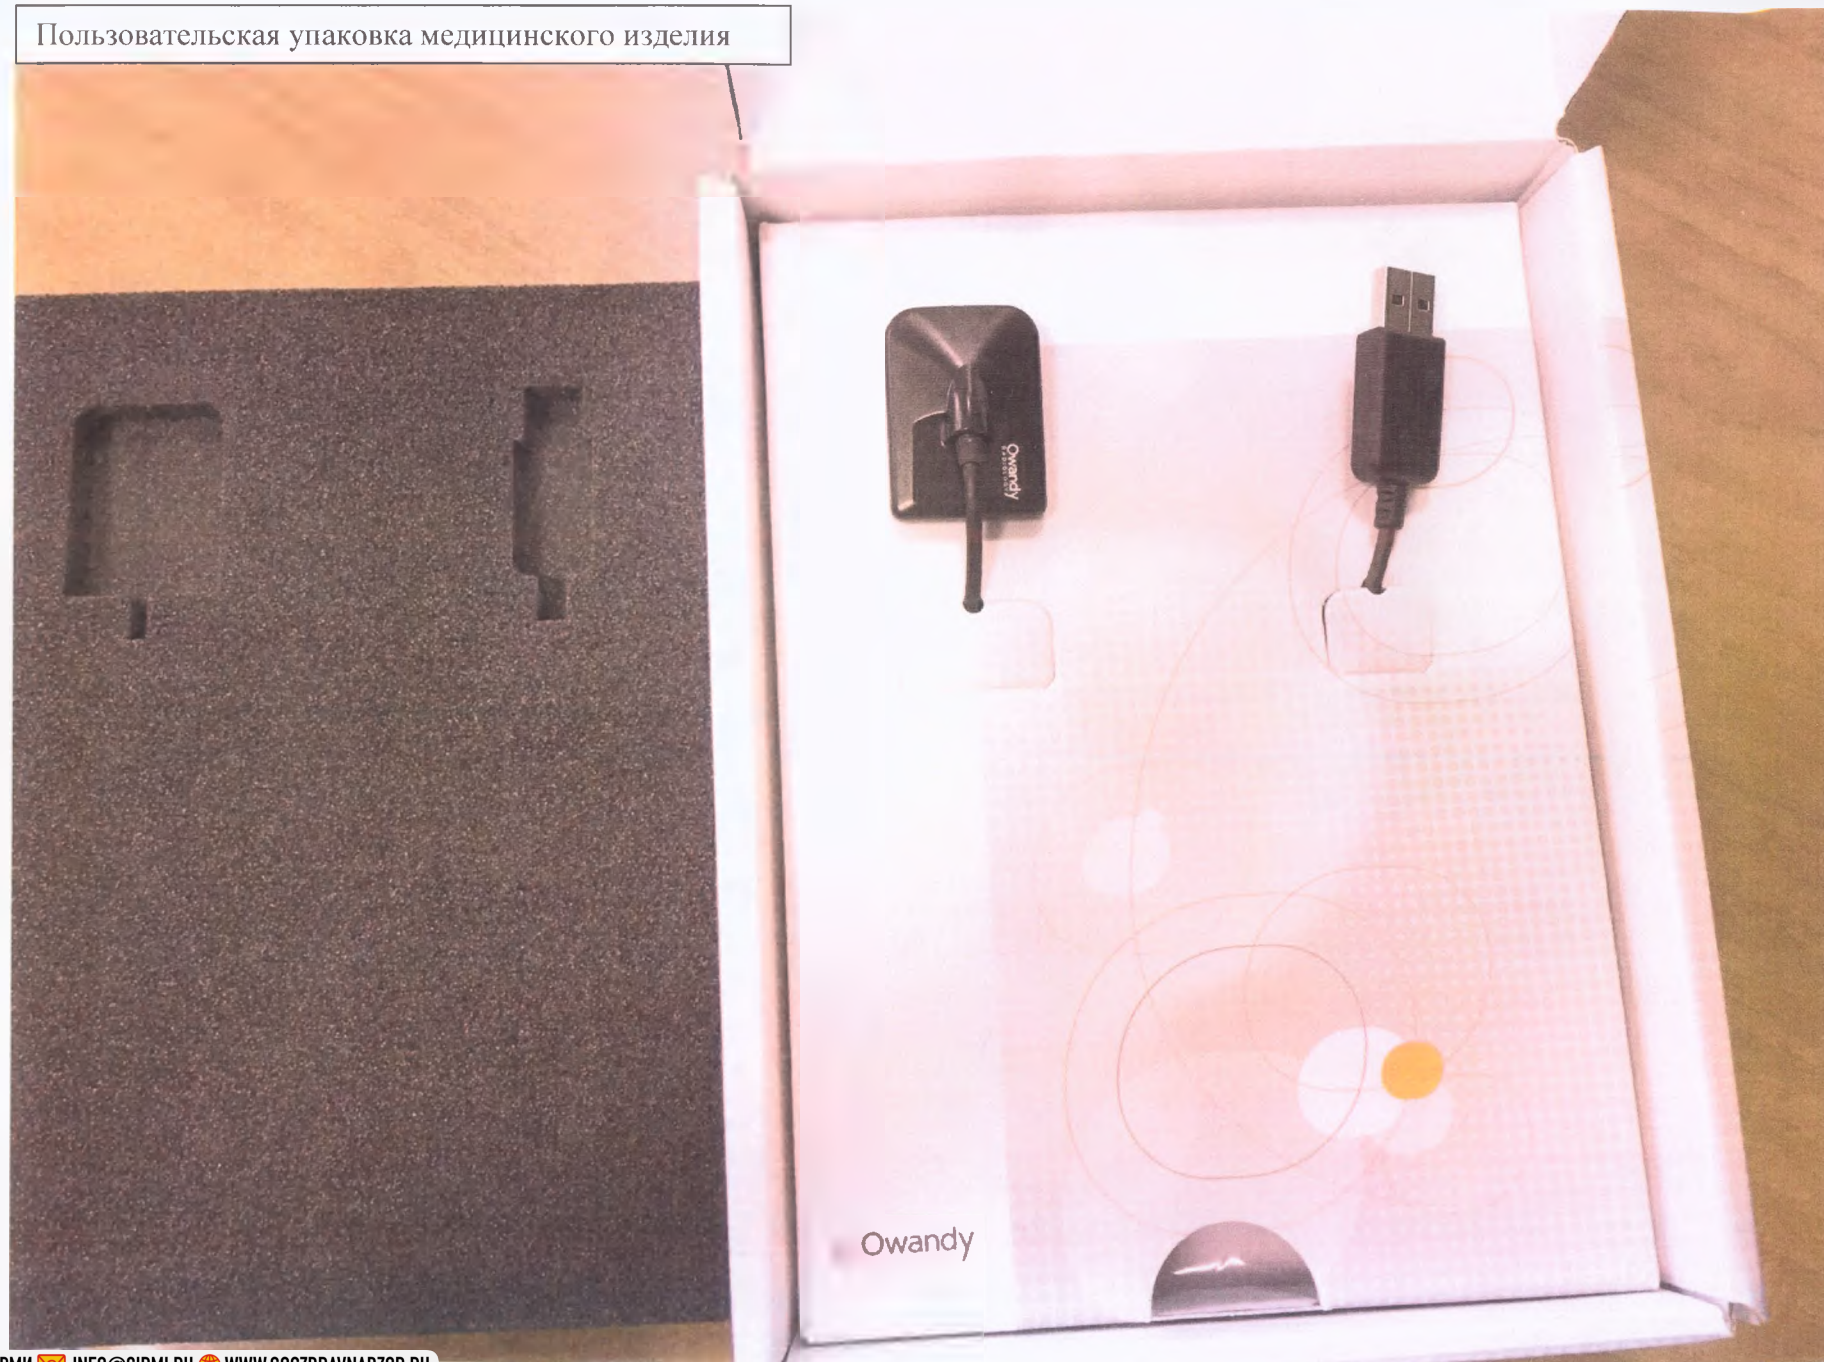

Прошито и пронумеровано
На 14 листах

Генеральный директор
ООО «Д-Альянс»
Христенко Л.И.

