

ООО «КОМ СПАН»

Россия, 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр.3, эт.1, пом. XVII, ком.1 оф. 2.

Тел./ факс: (495) 434 45 06; +7-495-434-71-41

**«Аппарат медицинский Zerto для выполнения импульсной капсулотомии».**

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

РИС.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Аппарат медицинский Zepto для выполнения импульсной капсулотомии. Изображение консоли.



РИС.2. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Аппарат медицинский Zepto для выполнения импульсной капсулотомии. Изображение задней панели консоли.

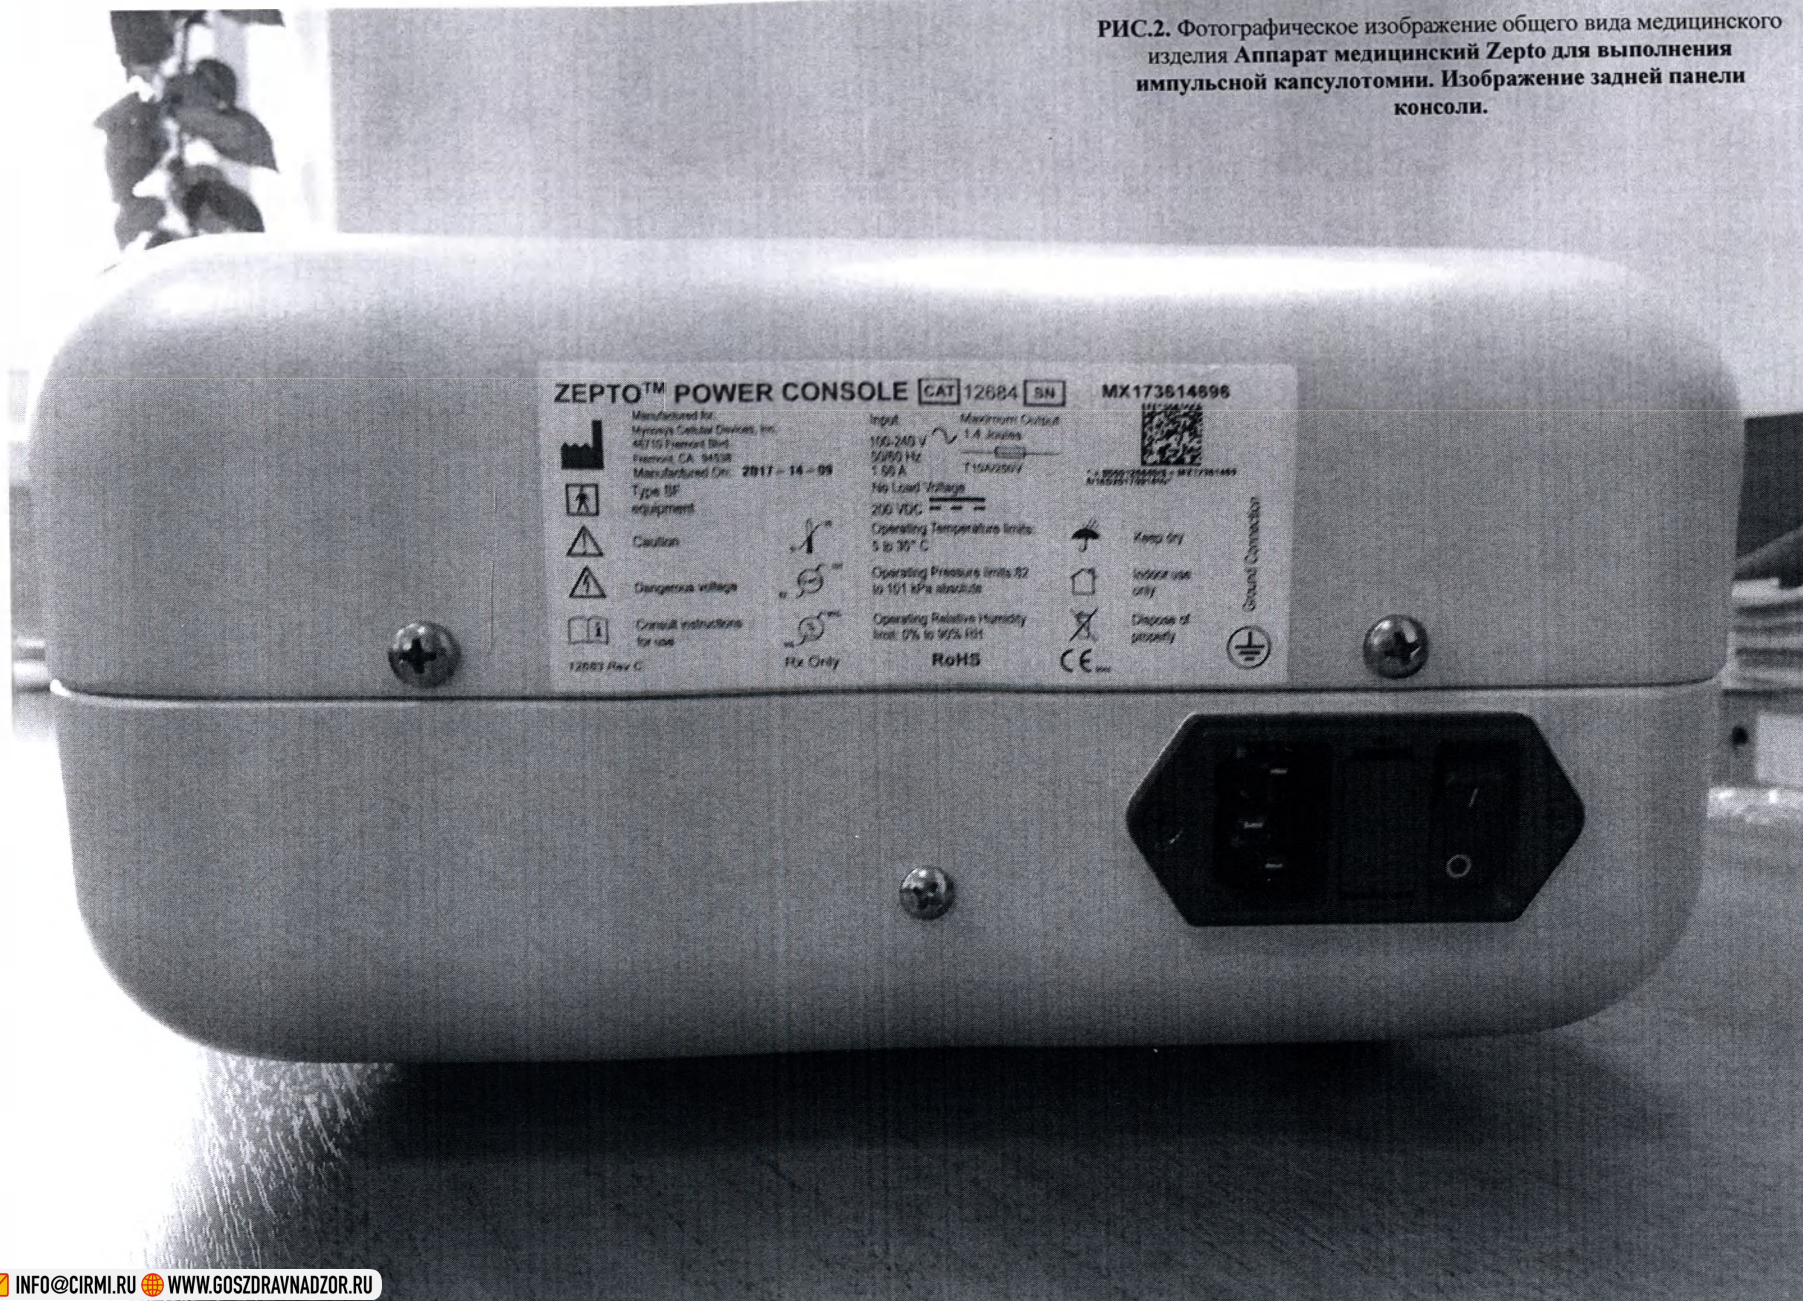


РИС.4. Фотографическое изображение Рукоятки с гибким кабелем, трубкой, роликовым регулятором и насадкой (Zepto Handpiece & Roller)

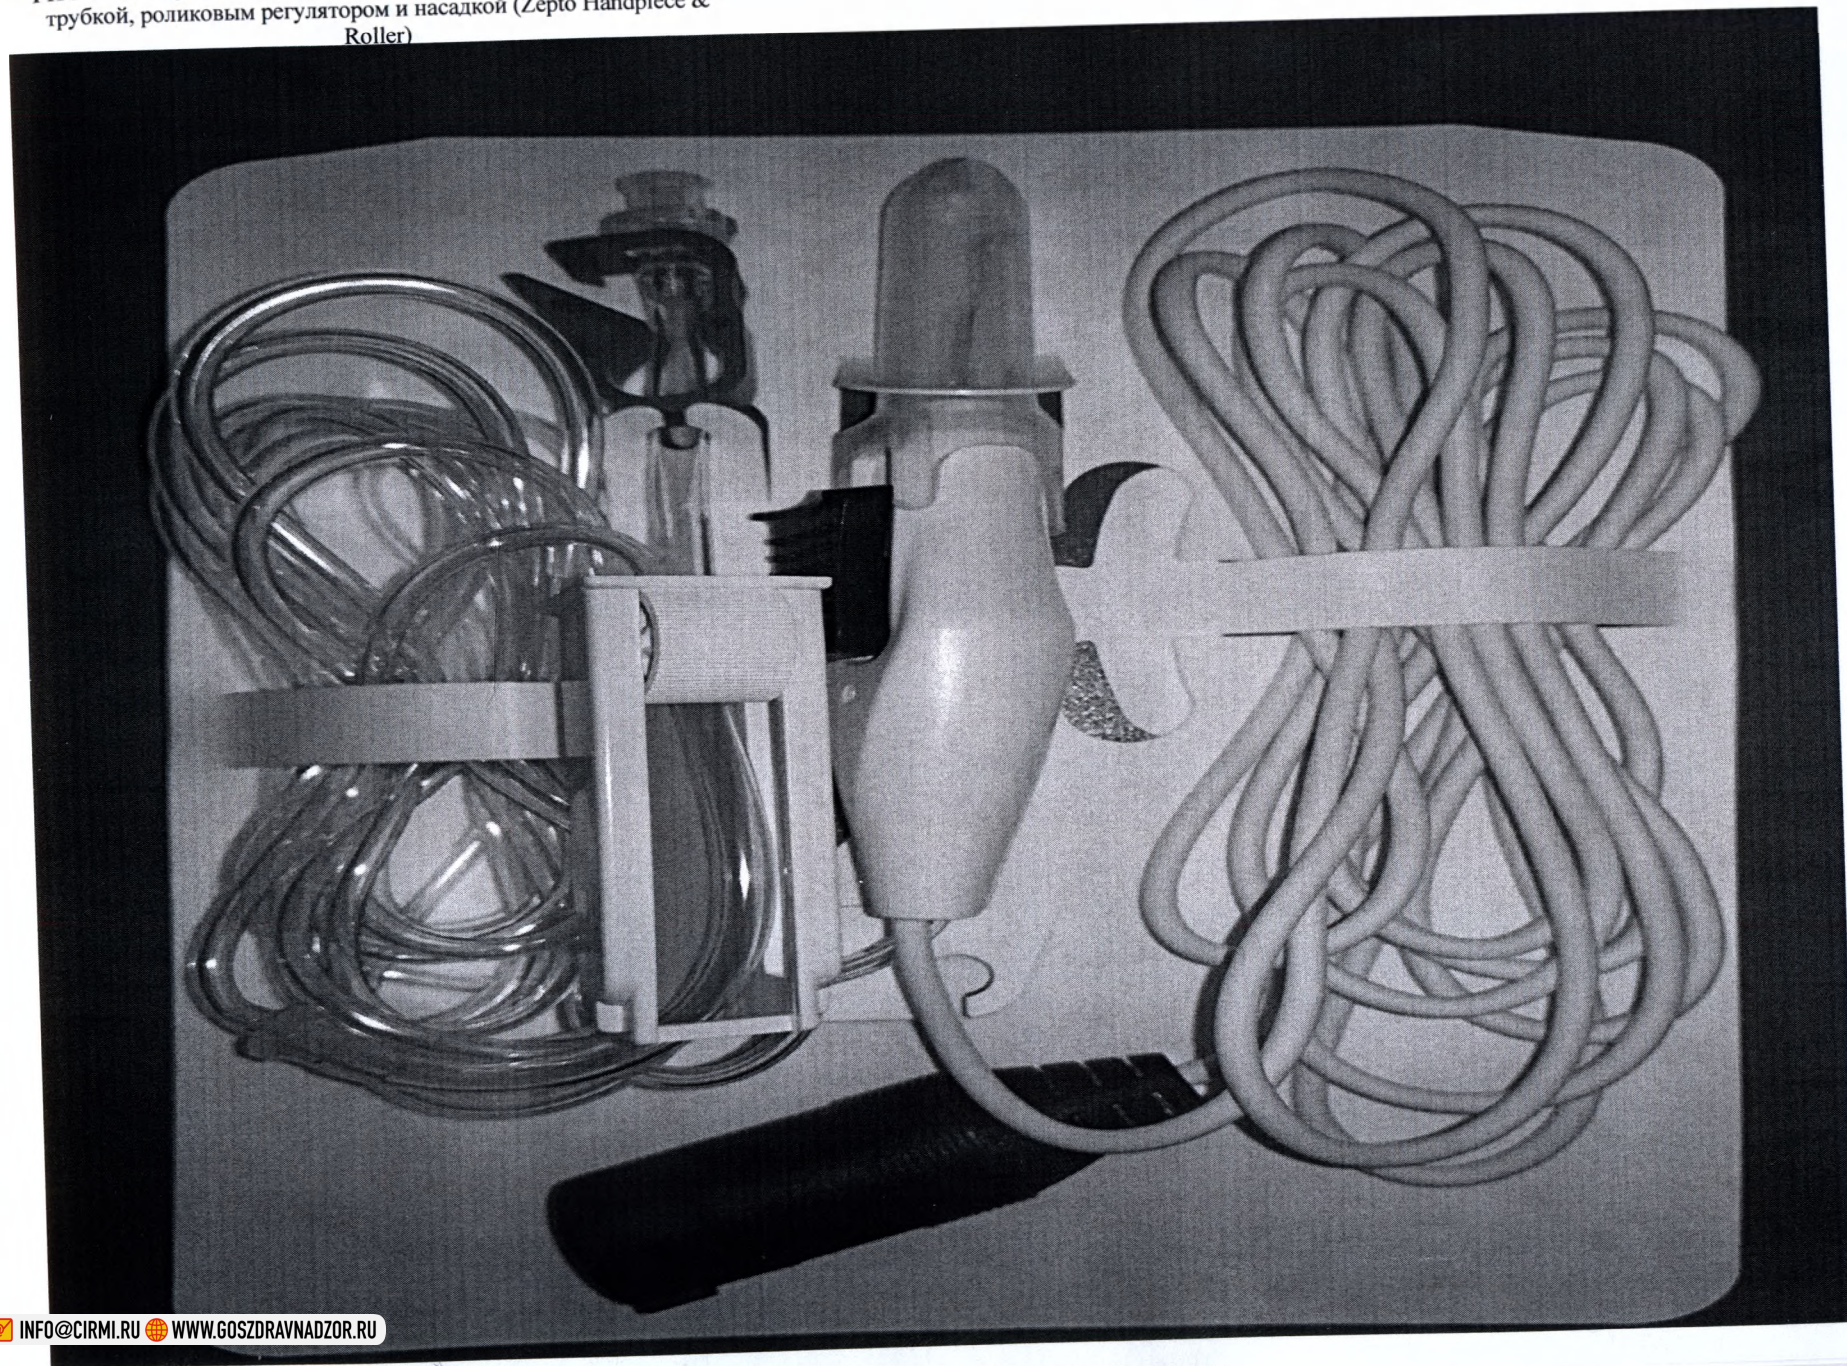


РИС.5. Фотографическое изображение Шприца с трубкой (Zepto Syringe Isolator)

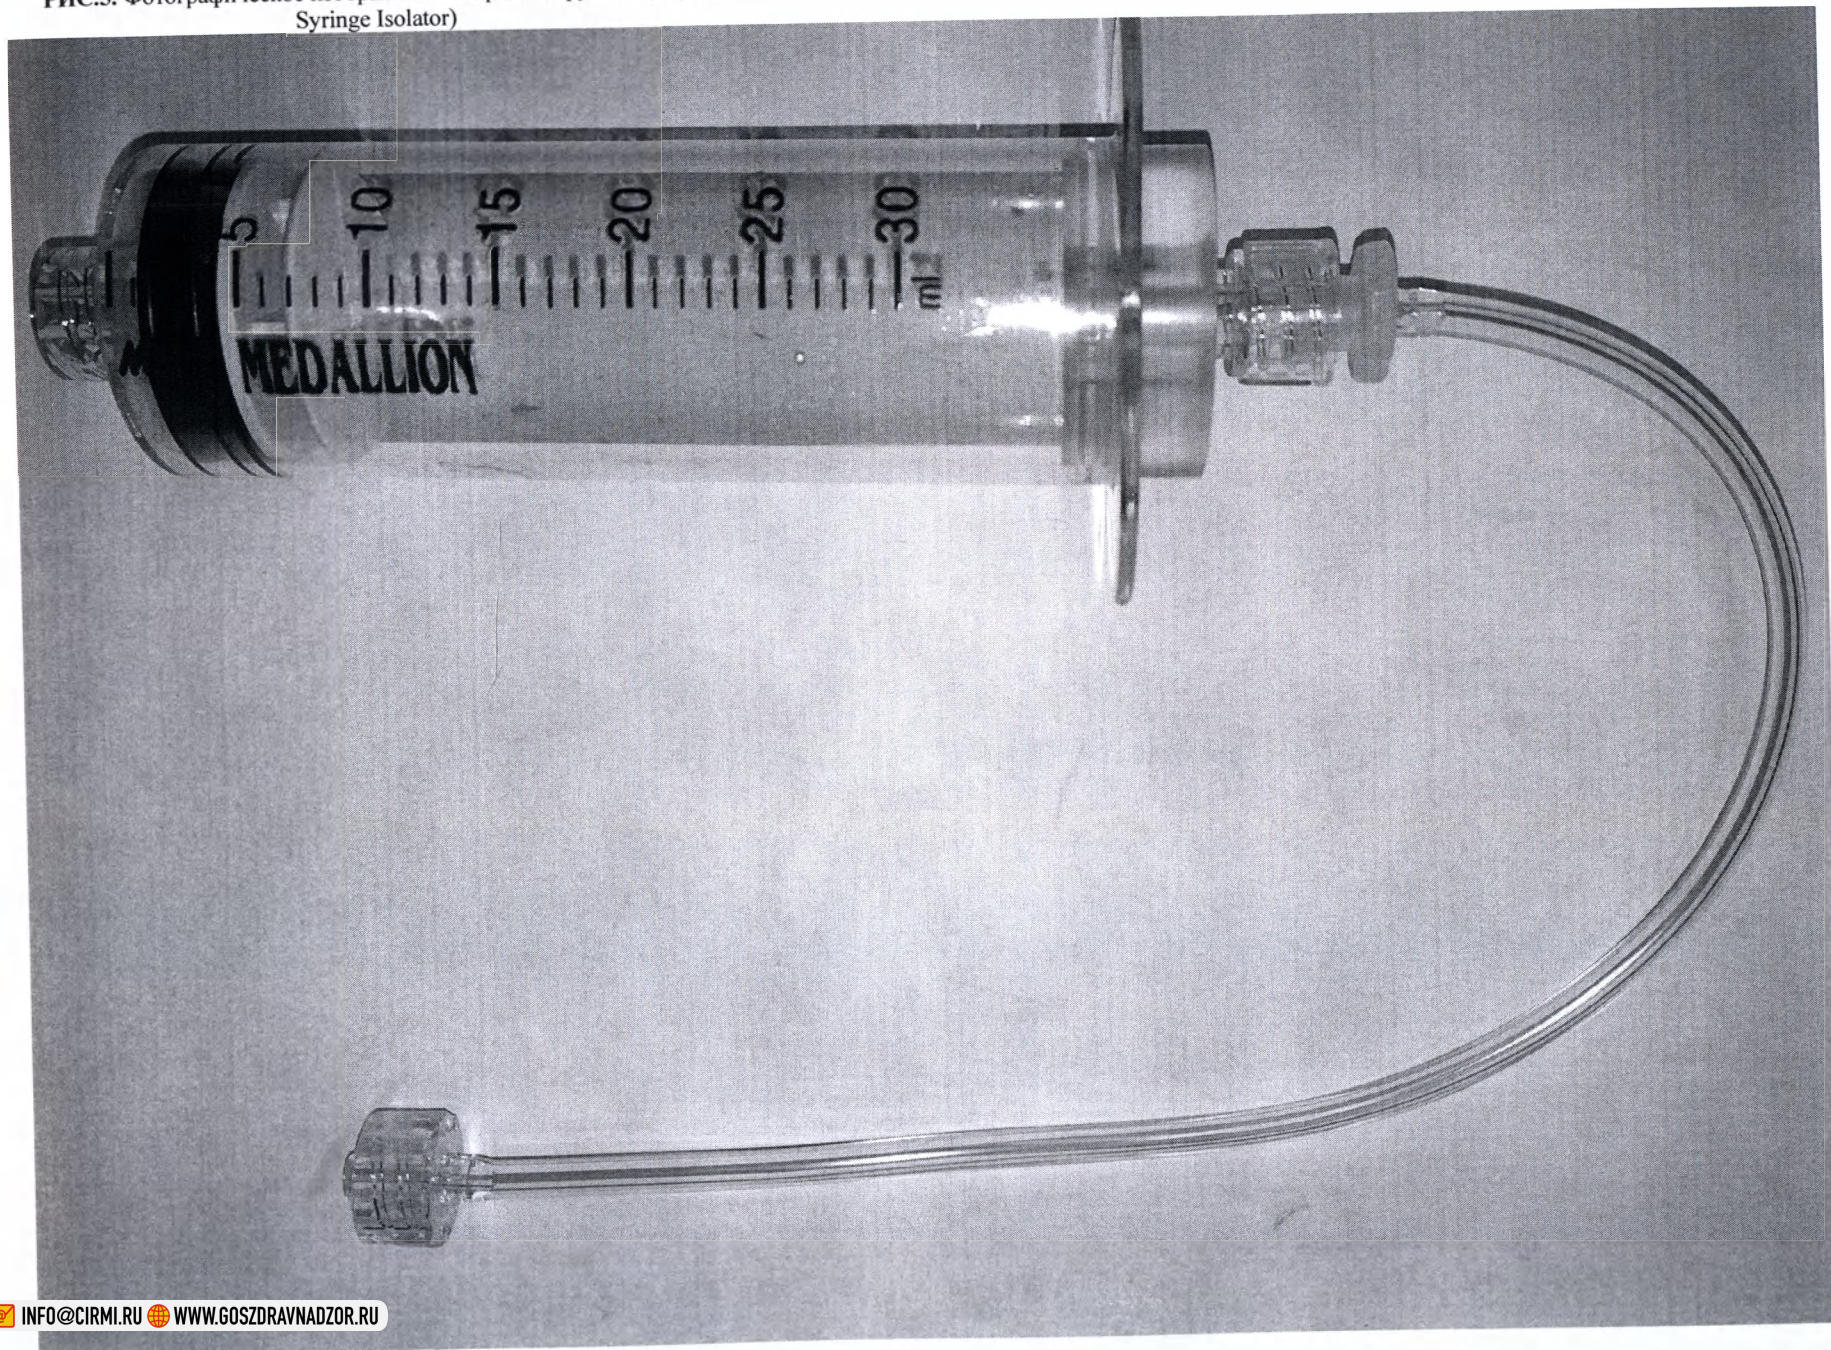


РИС.6. Фотографическое изображение Кабеля питания.



Рис.7. Фотографическое изображение упаковки Apparata  
медицинского Zepto



## Шприц с трубкой (Zepto Syringe Isolator)












|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | Наименование и адрес производителя                             |                                      | Каталожный номер                                       |
|    | Адрес уполномоченного представительства производителя в Европе |                                      | Номер партии                                           |
| RoHS                                                                                |                                                                |                                      | Срок годности.                                         |
|    | Не стерильно                                                   | Количество изделий в упаковке:<br>Надпись: <b>не токсично.</b><br>Надпись: <b>«хранить при комнатной температуре»</b> |                                                        |
|    | Не использовать в случае повреждения упаковки                  |                                      | «Обратитесь к инструкции по применению»                |
|    | Беречь от попадания влаги                                      |                                      | Повторное применение запрещено.                        |
|   | Беречь от солнечных лучей                                      |                                     | Предел допустимой относительной влажности: от 0 до 90% |
|  | Предел допустимой рабочей температуры: от 5°C до 35°C          |                                    | Не утилизировать как бытовые отходы                    |
|  | Рабочая часть, тип: BF                                         |                                                                                                                       |                                                        |
|  | Знак CE                                                        | <b>ШТРИХ-КОД</b>                                                                                                      |                                                        |
| РУ №xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                                                            |                                                                |                                                                                                                       |                                                        |

РИС.9. Изображение макета маркировки на русском языке  
Шприца с трубкой (Zepto Syringe Isolator)


**Рукоятка с гибким кабелем, трубкой, роликовым регулятором и насадкой (Zepto Handpiece & Roller).**

|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | Наименование и адрес производителя                             |                               | Каталожный номер                                          |
|    | Адрес уполномоченного представительства производителя в Европе |                               | Номер партии                                              |
| <b>Rx Only</b>                                                                      |                                                                |                               | Срок годности.                                            |
| <b>RoHS</b>                                                                         |                                                                | Количество изделий в упаковке:<br>Надпись: <b>не токсично.</b><br>Надпись: «хранить при комнатной температуре» |                                                           |
|    | Апирогенно                                                     |                               | «Обратитесь к инструкции по применению»                   |
|    | Не использовать в случае повреждения упаковки                  |                               | Повторная стерилизация запрещена                          |
|    | Стерилизовано Этиленоксидом                                    |                             | Внимание! Возможность повреждения прибора/принадлежностей |
|   | Беречь от попадания влаги                                      |                             | Повторное применение запрещено.                           |
|  | Беречь от солнечных лучей                                      |                             | Предел допустимой относительной влажности: от 0 до 90%    |
|  | Предел допустимой рабочей температуры: от 5°C до 35°C          |                             | Не утилизировать как бытовые отходы                       |
|  | Рабочая часть, тип: BF                                         | <b>ШТРИХ-КОД</b>                                                                                               |                                                           |
|  | Знак CE                                                        |                                                                                                                |                                                           |

РУ №XXXXXXXXXXXX/XXXXXX

**РИС.8.** Изображение макета маркировки на русском языке  
Рукоятки с гибким кабелем, трубкой, роликовым регулятором и насадкой (Zepto Handpiece & Roller).

этого пропускать  
но, проше и  
скреплено печатью.

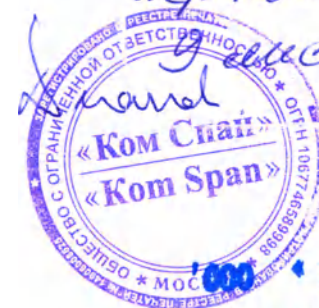

**ООО «КОМ СПАЙ»**  
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**РАВАЛ Д.Ч.**