


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat в вариантах исполнения с принадлежностями»,
производства: Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн



1. Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat P710





2. Подставка для объектов обжига

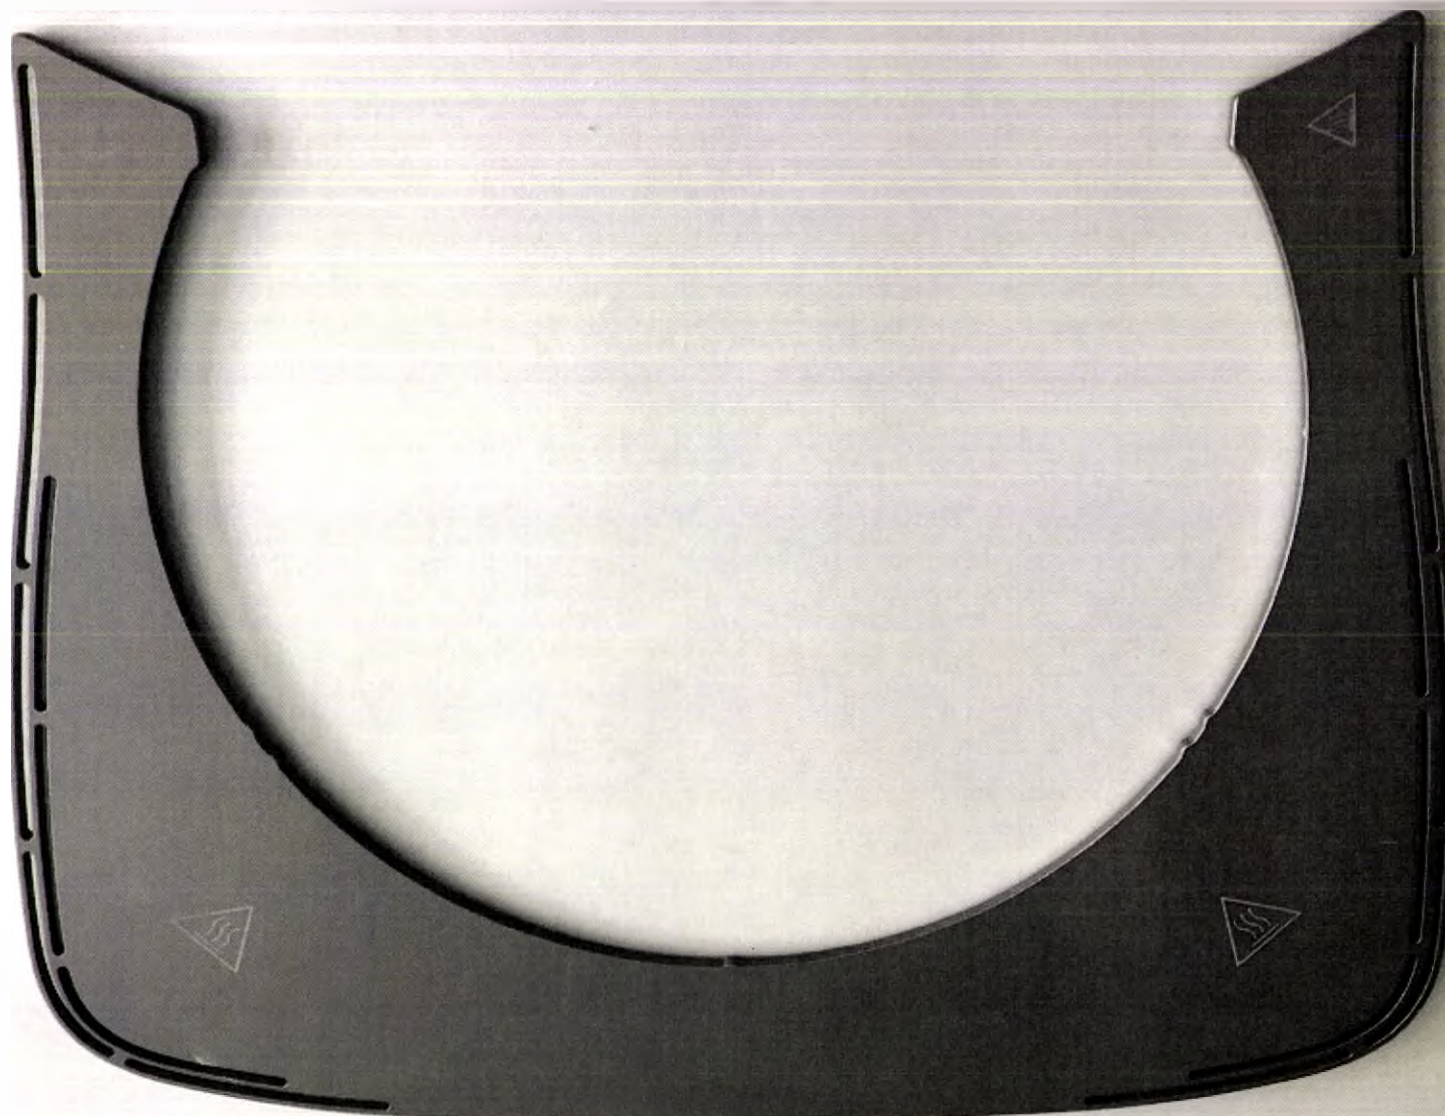


3. Столик для обжига Programat SiC Firing table

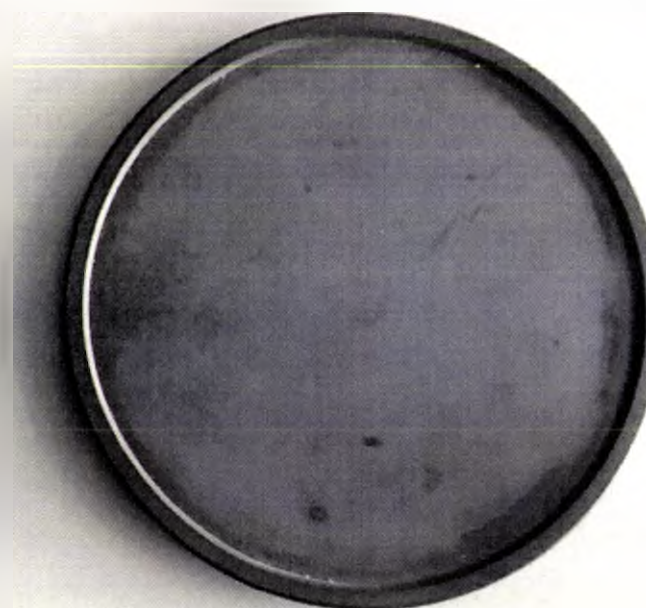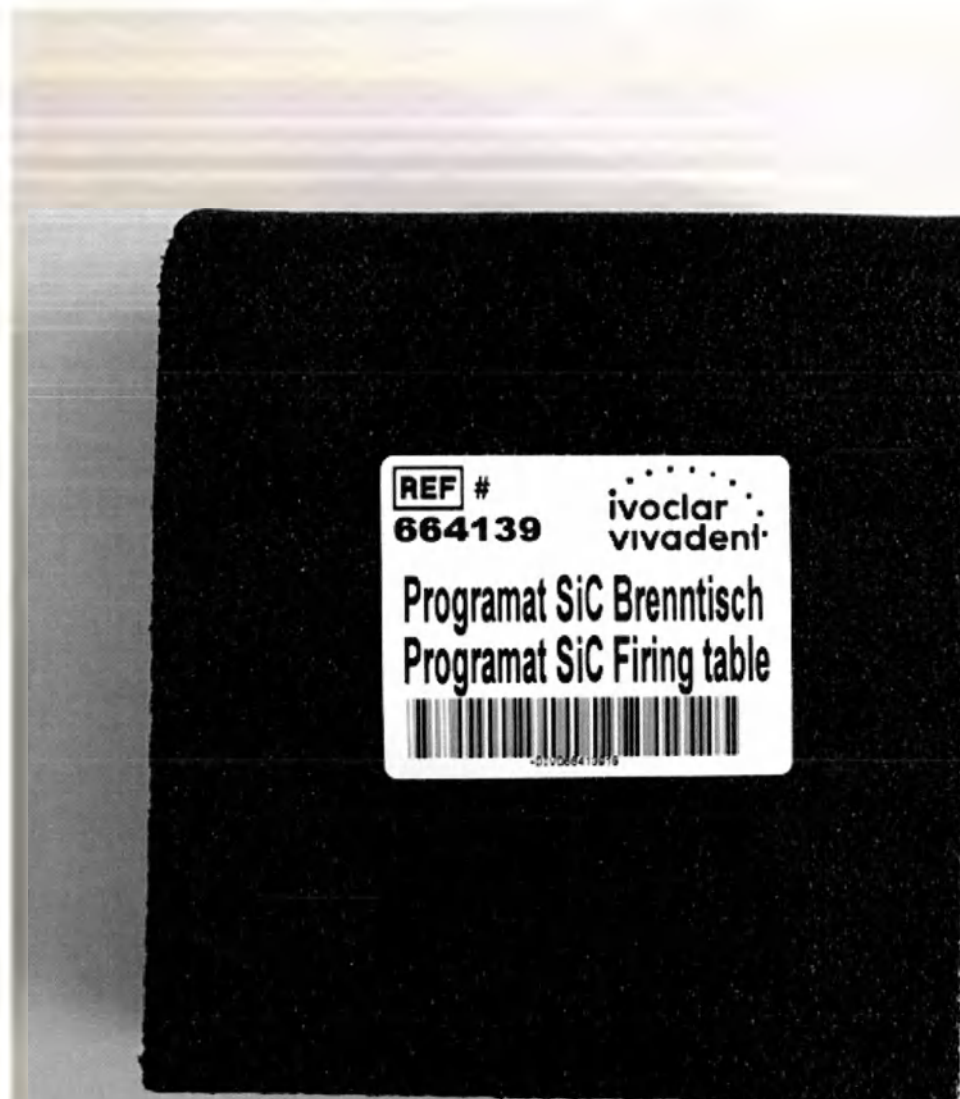

4. Проба для автоматического контроля температуры Automatic Temperature Checking Set 2 (ATK2) (2 шт./уп.)

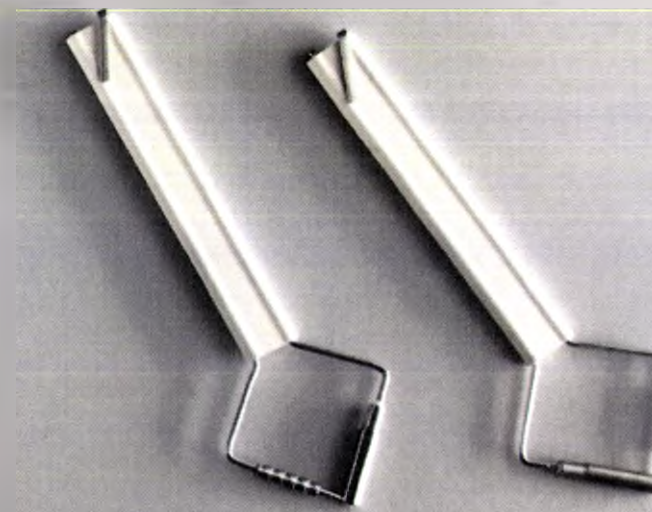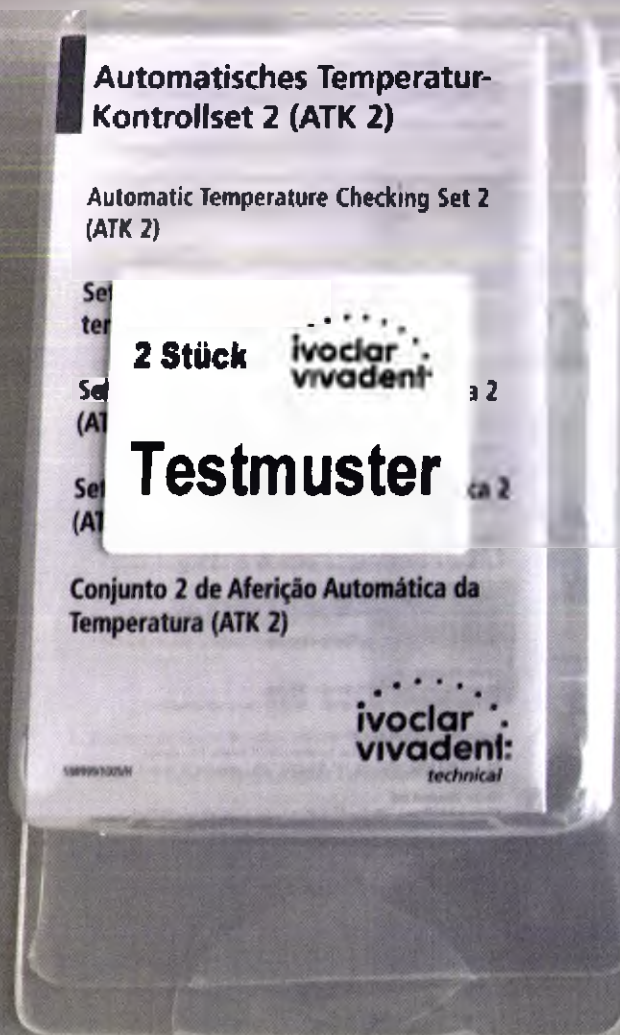


5. Набор для обжига Programat Firing Tray Set 2

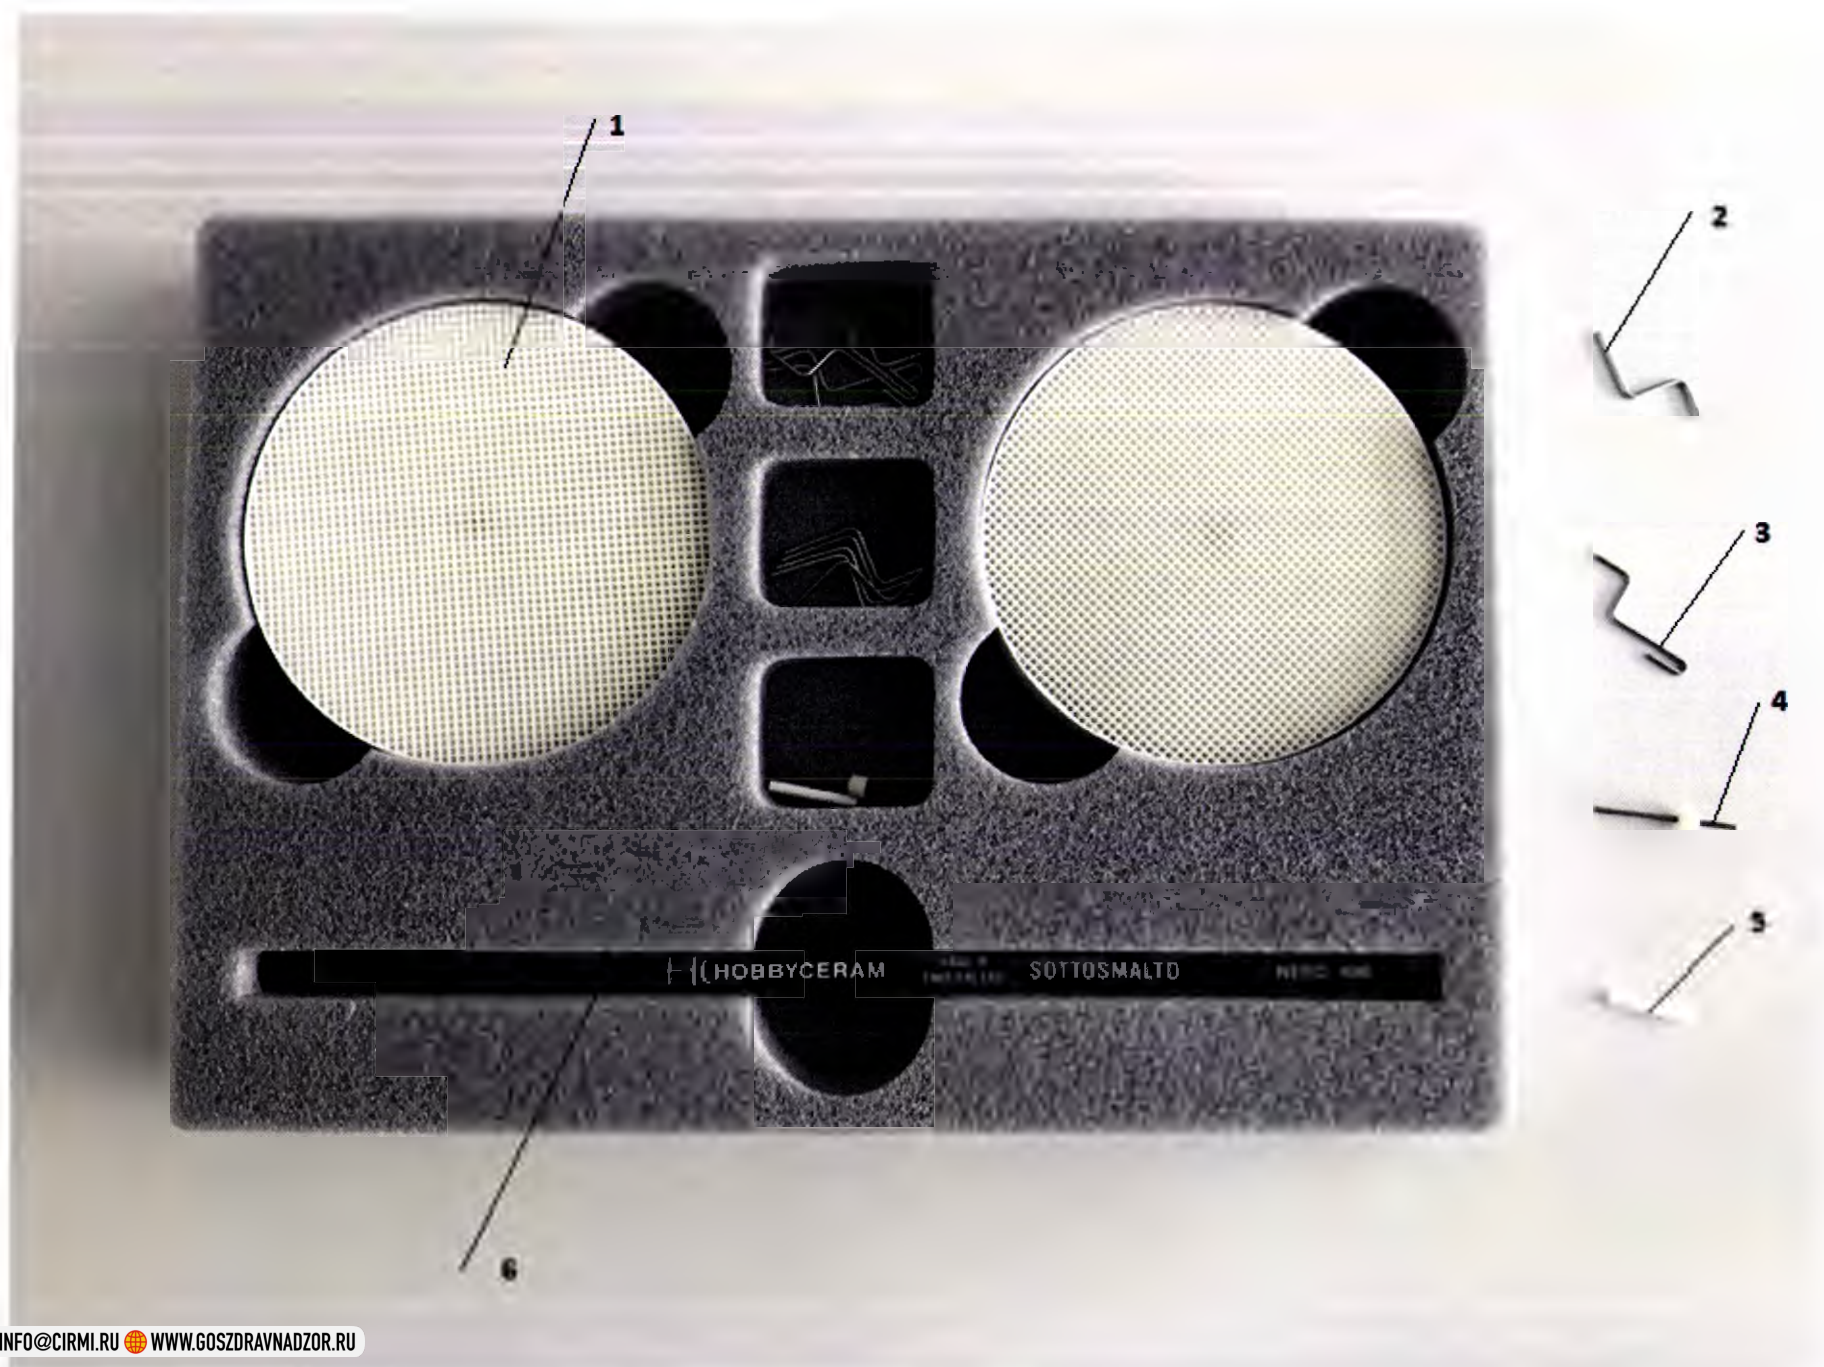


Набор для обжига Programat Firing Tray Set 2, в составе:

1. Трегер для объектов обжига – 2 шт.
2. Пин тип А – 6 шт.
3. Пин тип В – 6 шт.
4. Пин веерный – 2 шт.
5. Рукав керамический – 2 шт.
6. Карандаш – 1 шт.

6. Кабель питания, 1.8 м


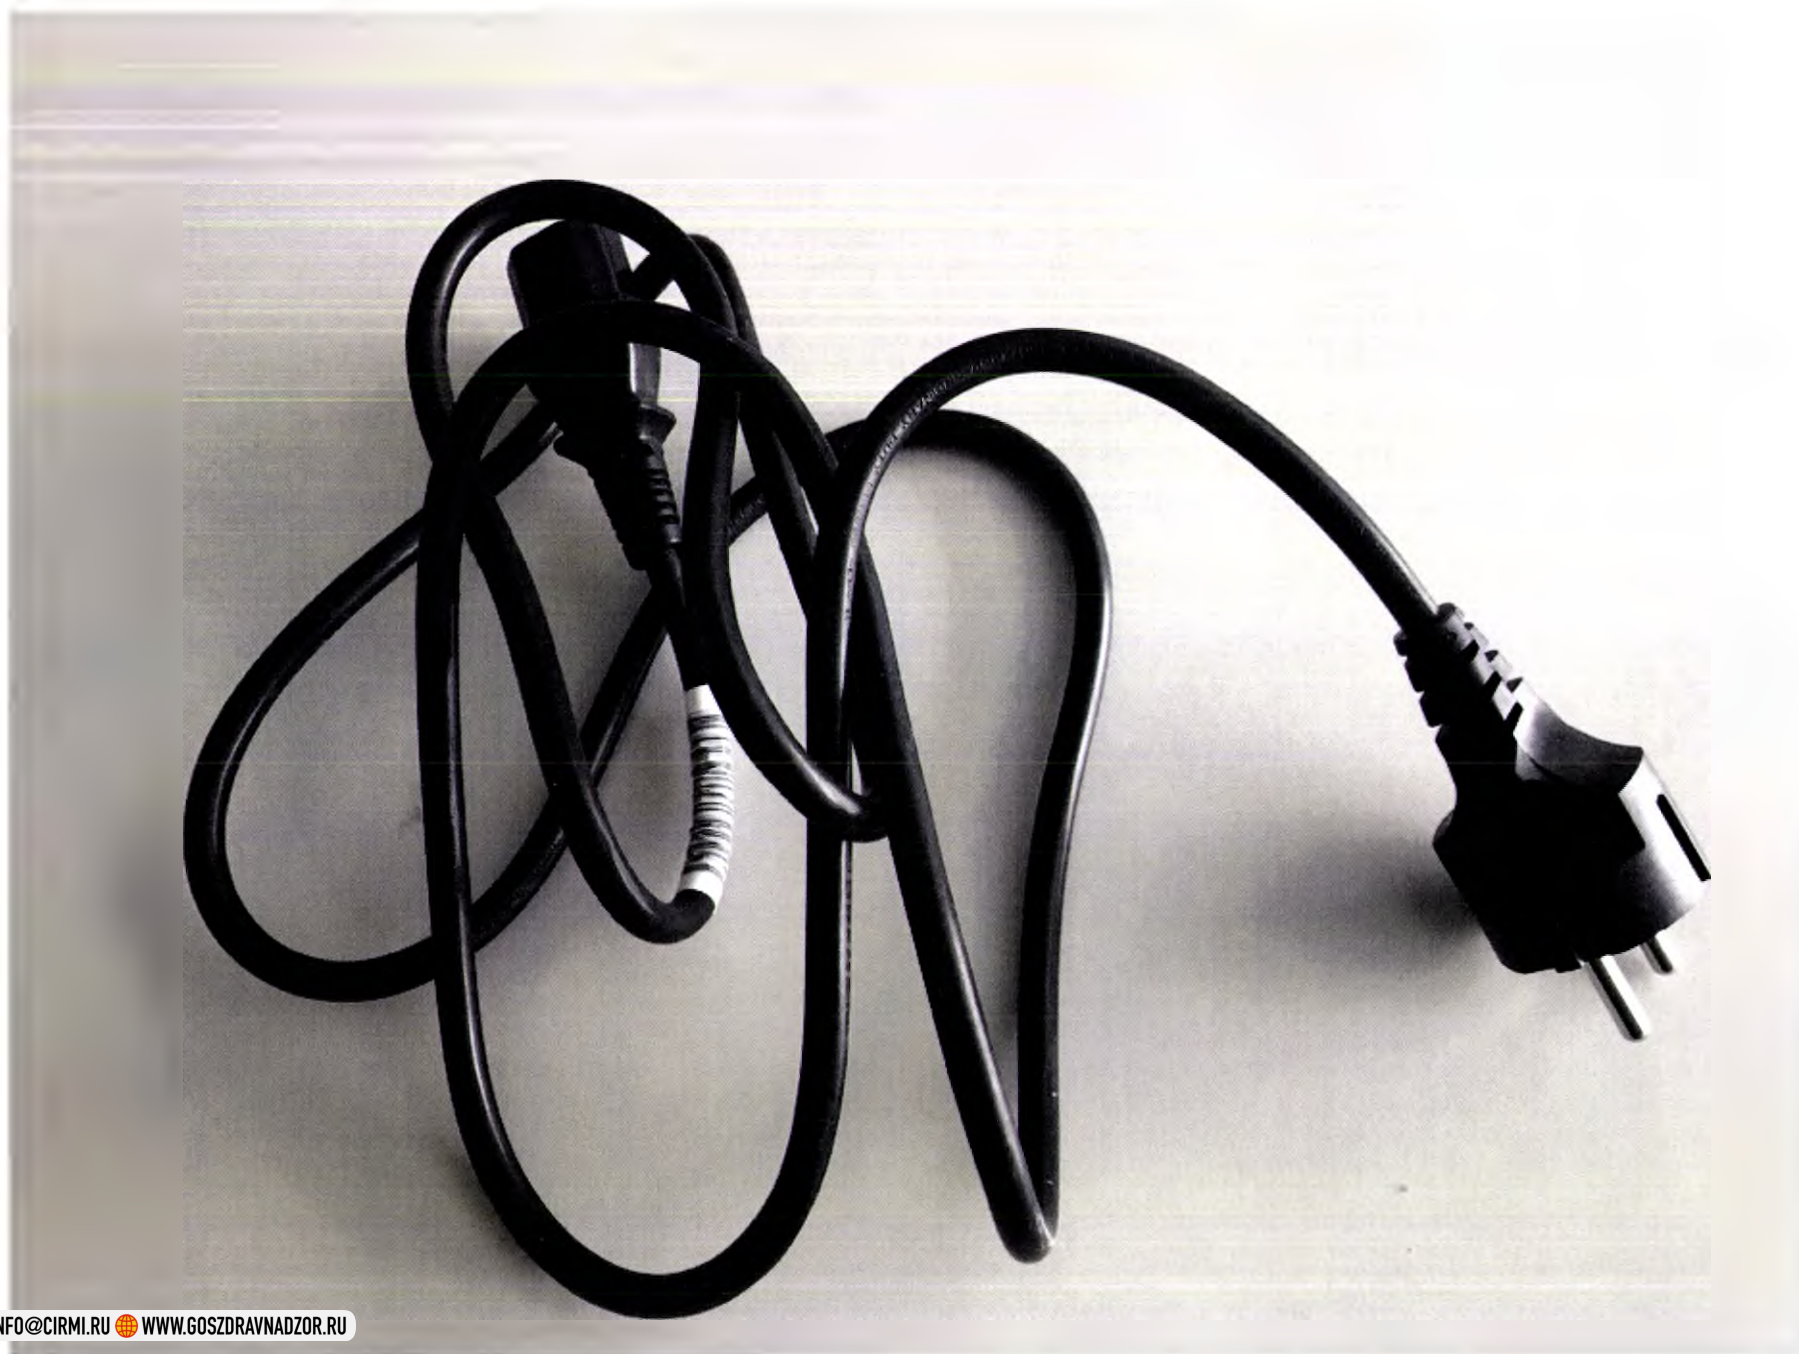


7. Кабель USB, 1.8 м; Кабель сетевой, 3 м; Шланг вакуумный, 1.8 м

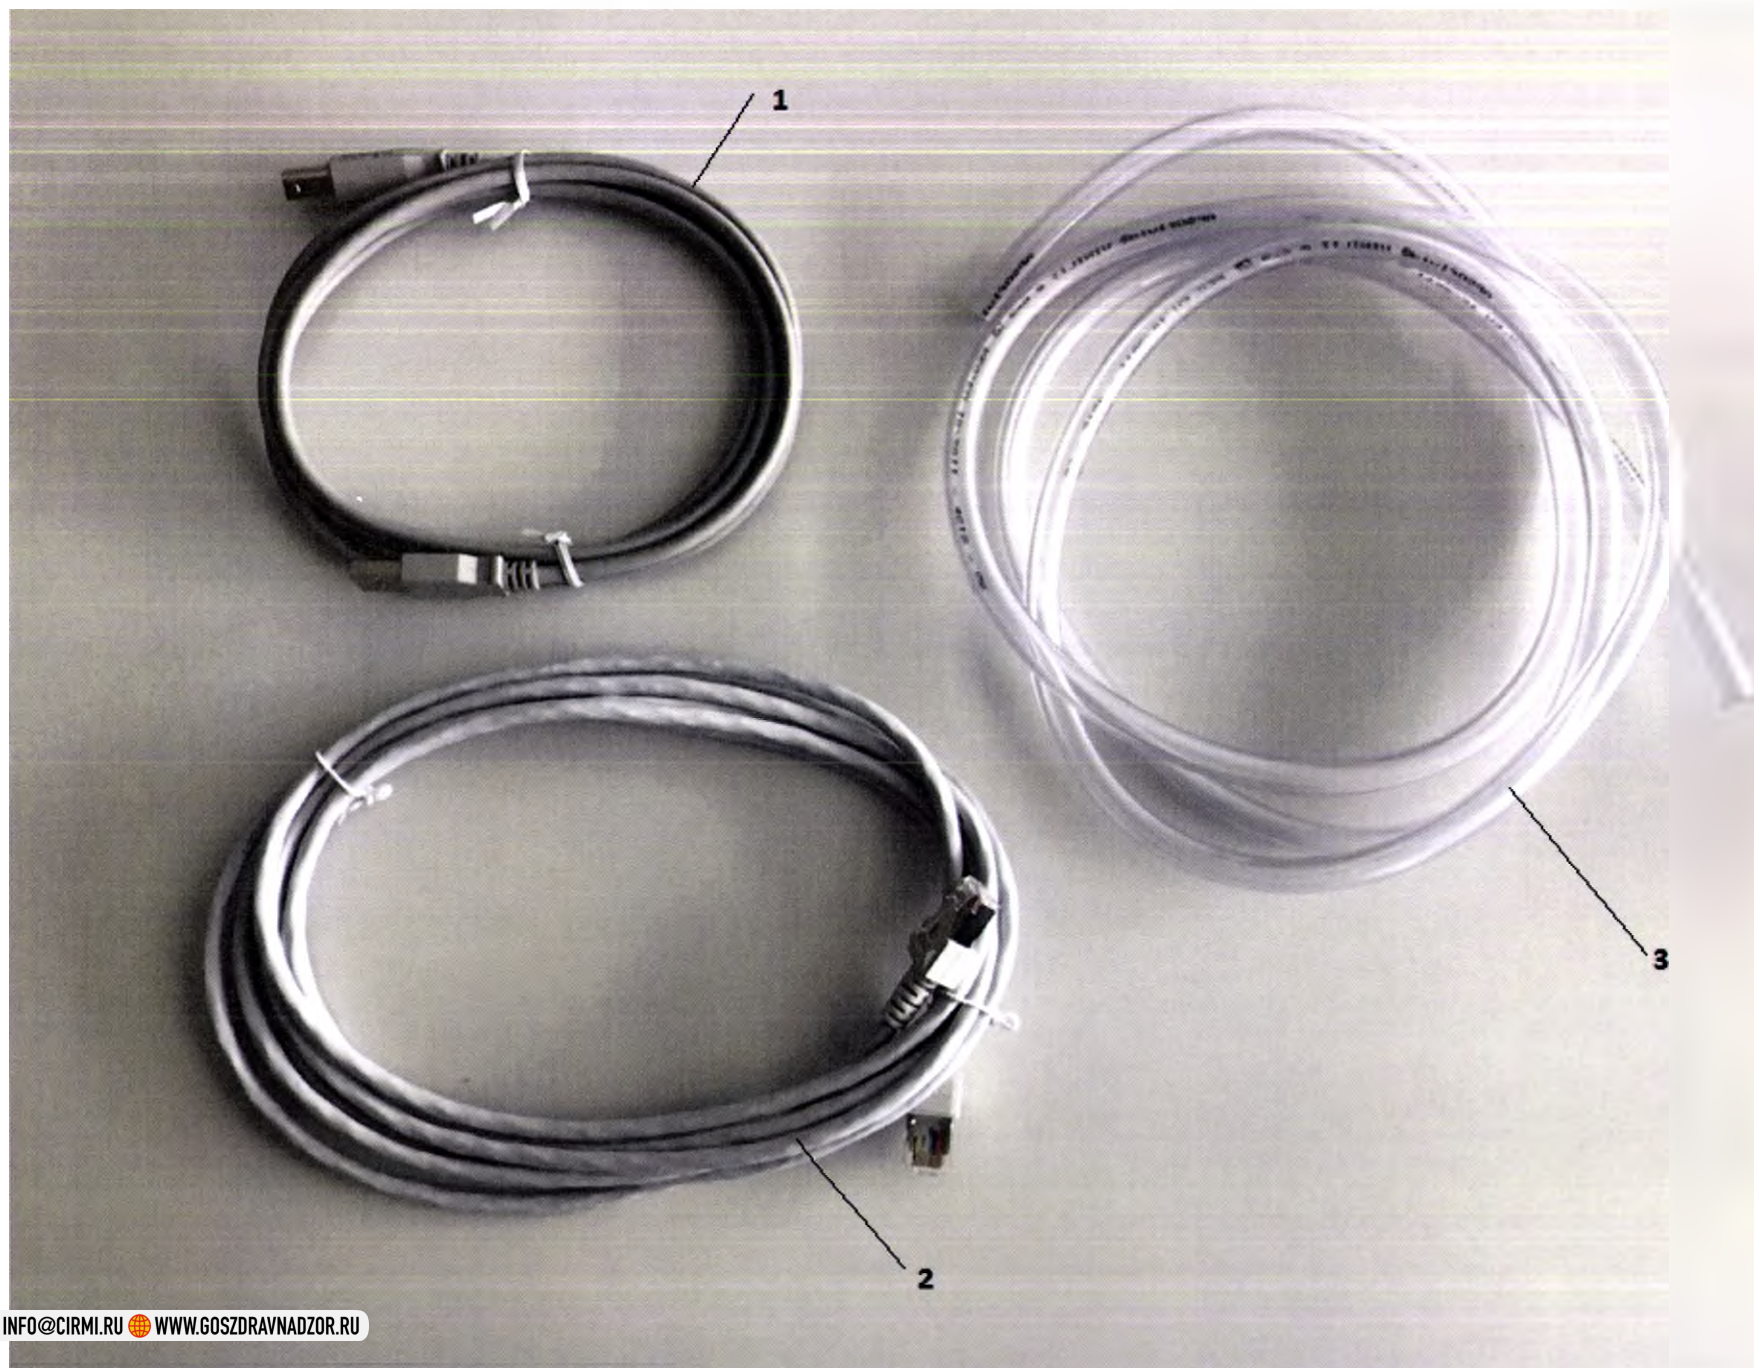

1. Кабель USB, 1.8 м
2. Кабель сетевой, 3 м
3. Шланг вакуумный, 1.8 м


8. Держатель щипцов Tongue holder

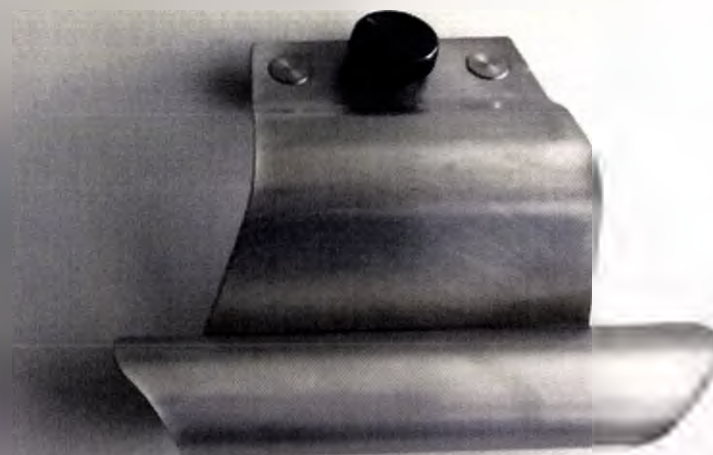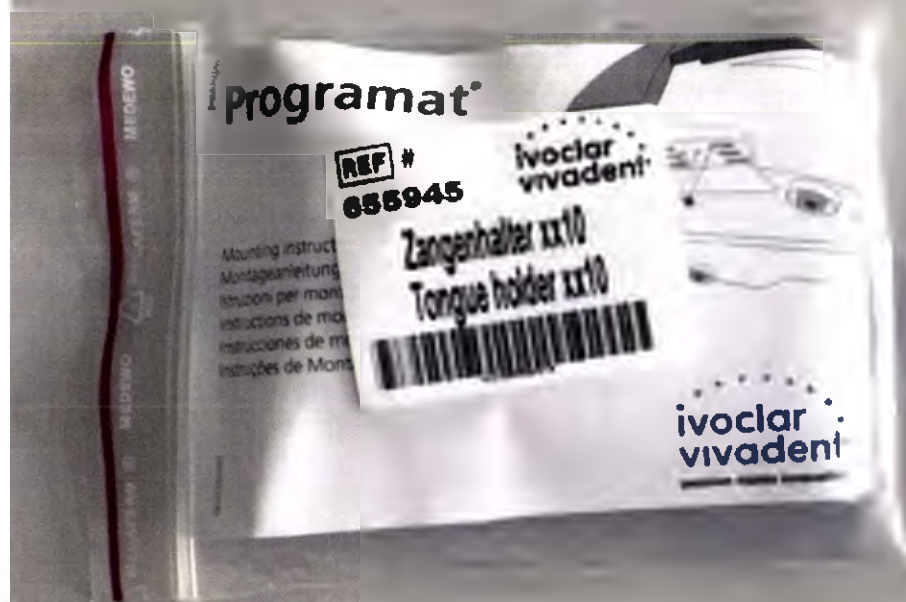


9. Накопитель USB Programat USB-Stick




10. Салфетка тканевая для экрана

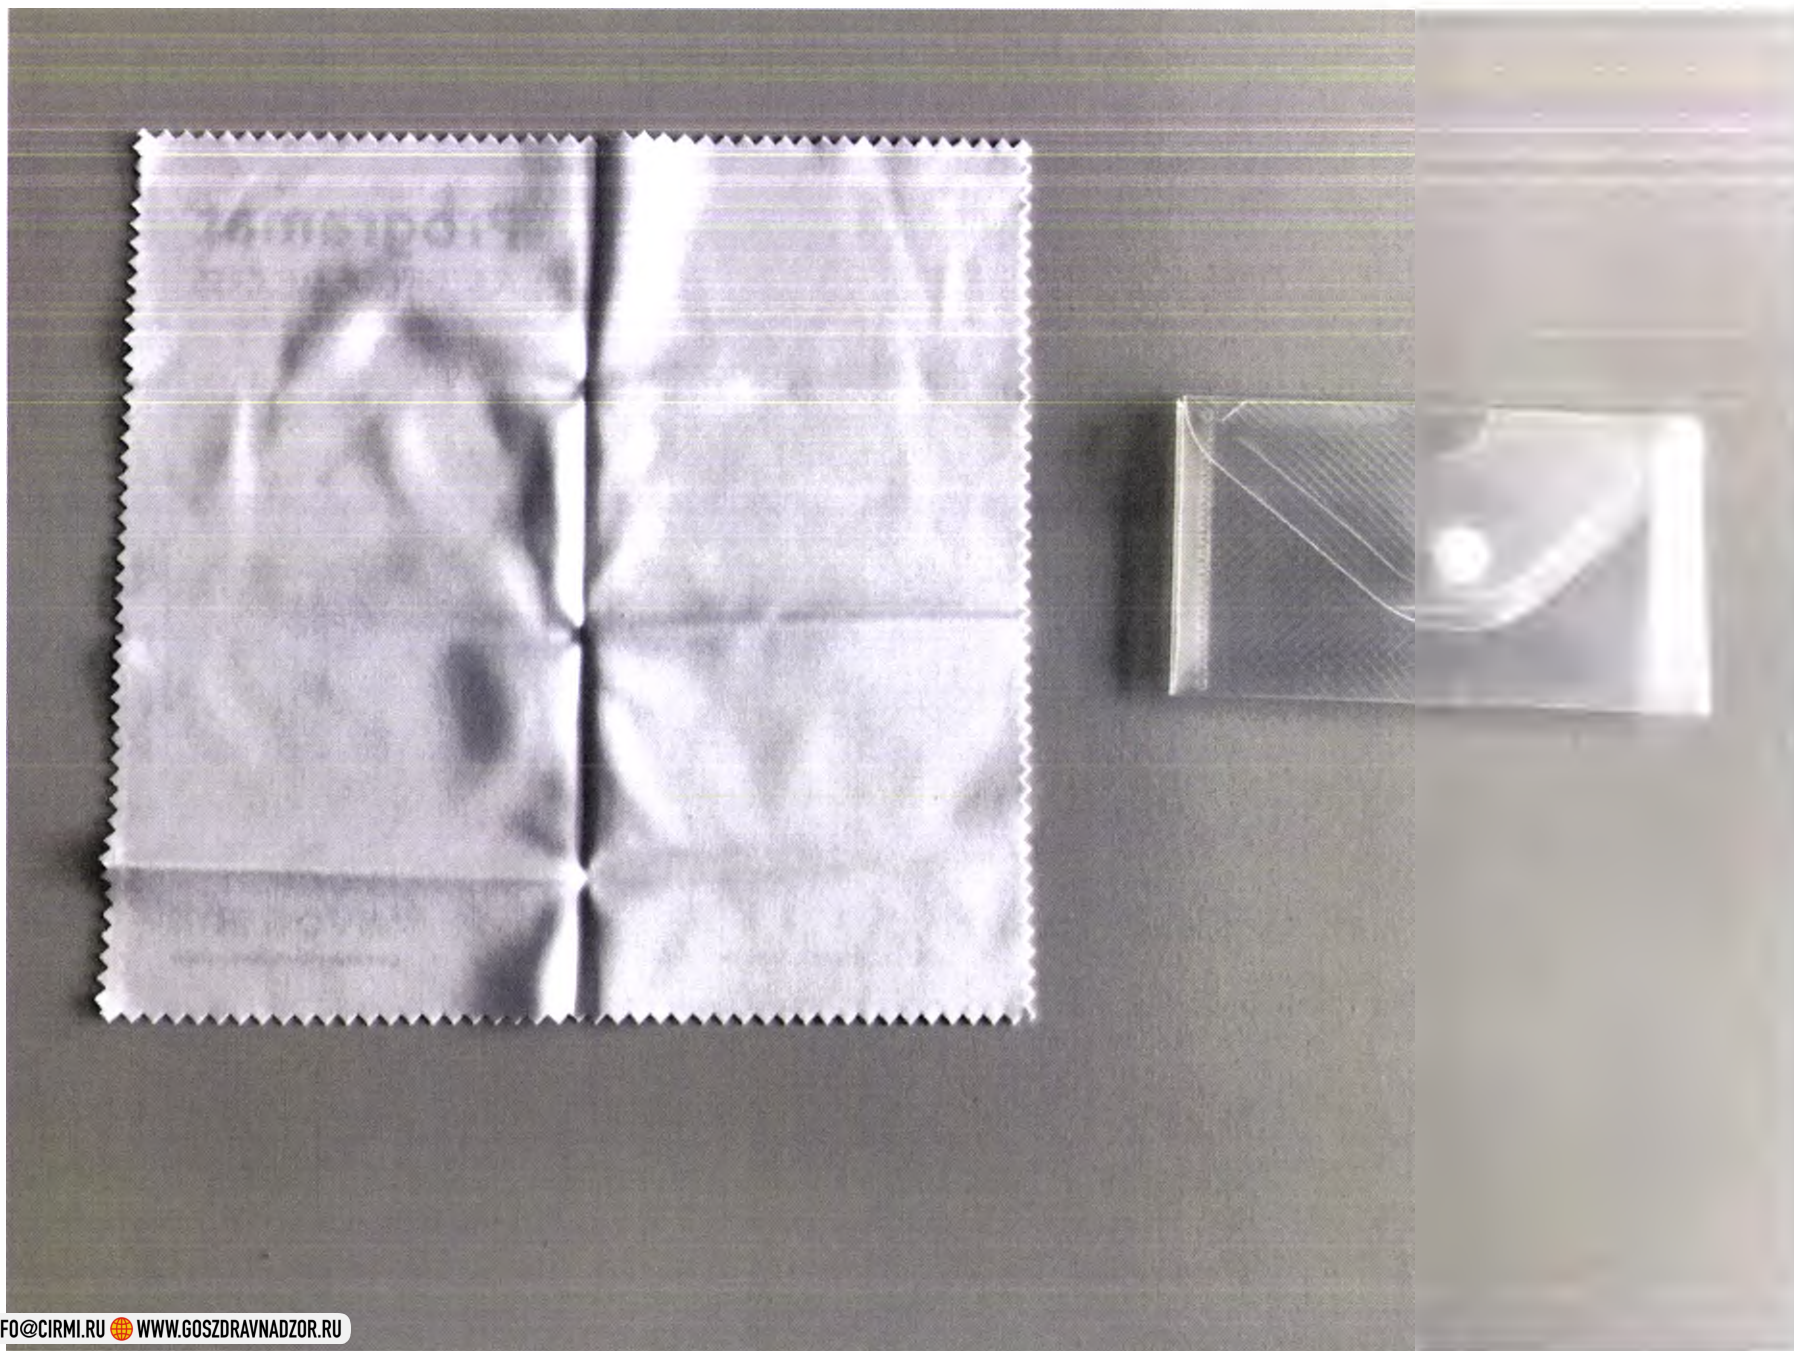

1.1. Набор Programat WLAN/Bluetooth Kit

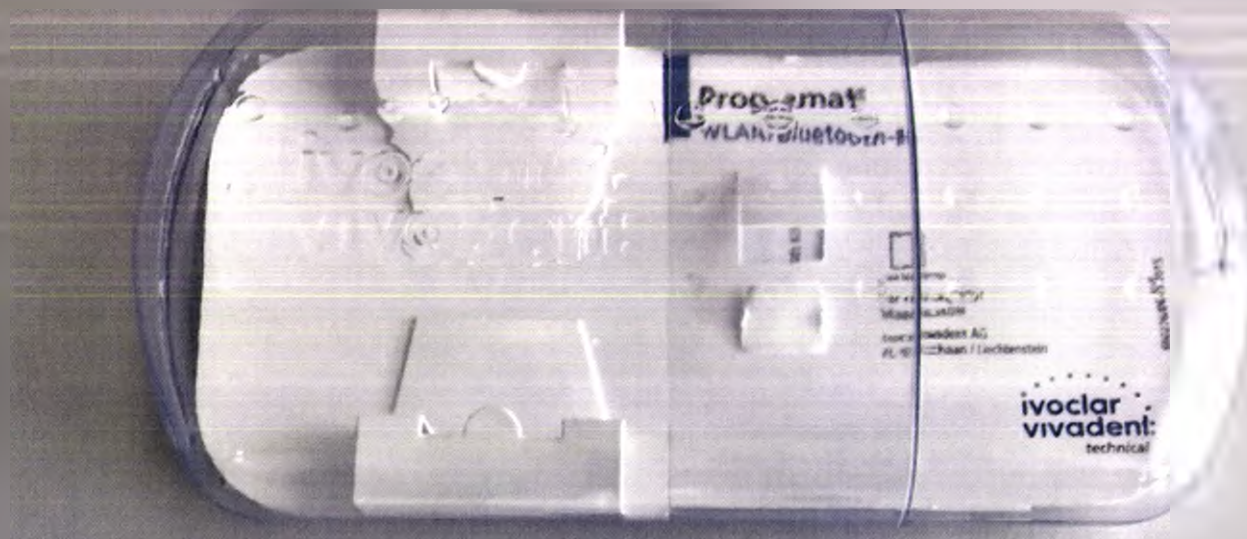

12. Расцветка A-D Shade Guide

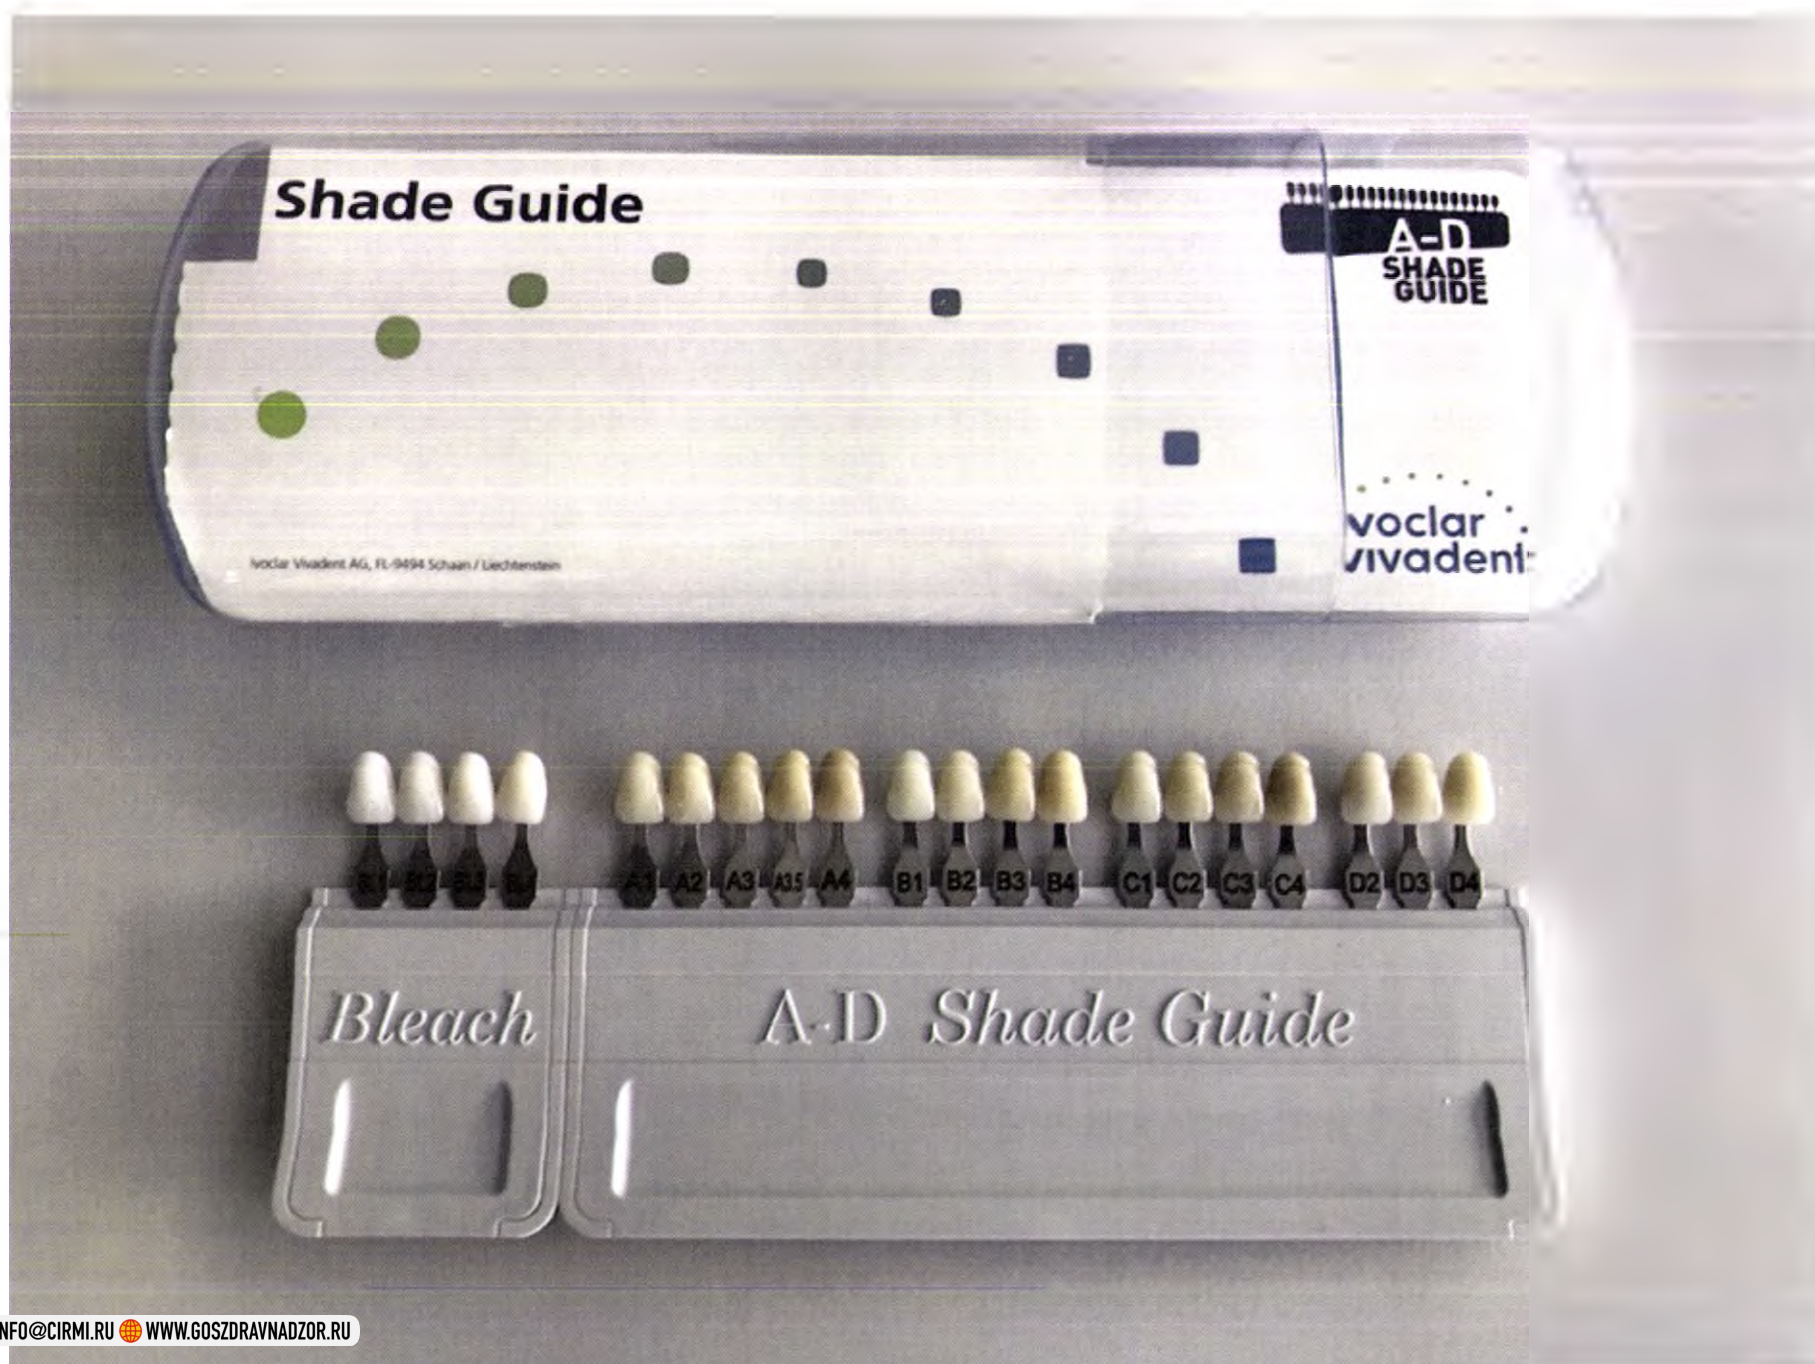

13. Держатель Digital Shade Assistant Holder Kit (2 шт./уп.)




14. Предохранитель Т8А (Ø5), Предохранитель ТЗ.15А (Ø5)



15. Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat P710 (маркировка)




16. Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat P710 (маркировка упаковки)

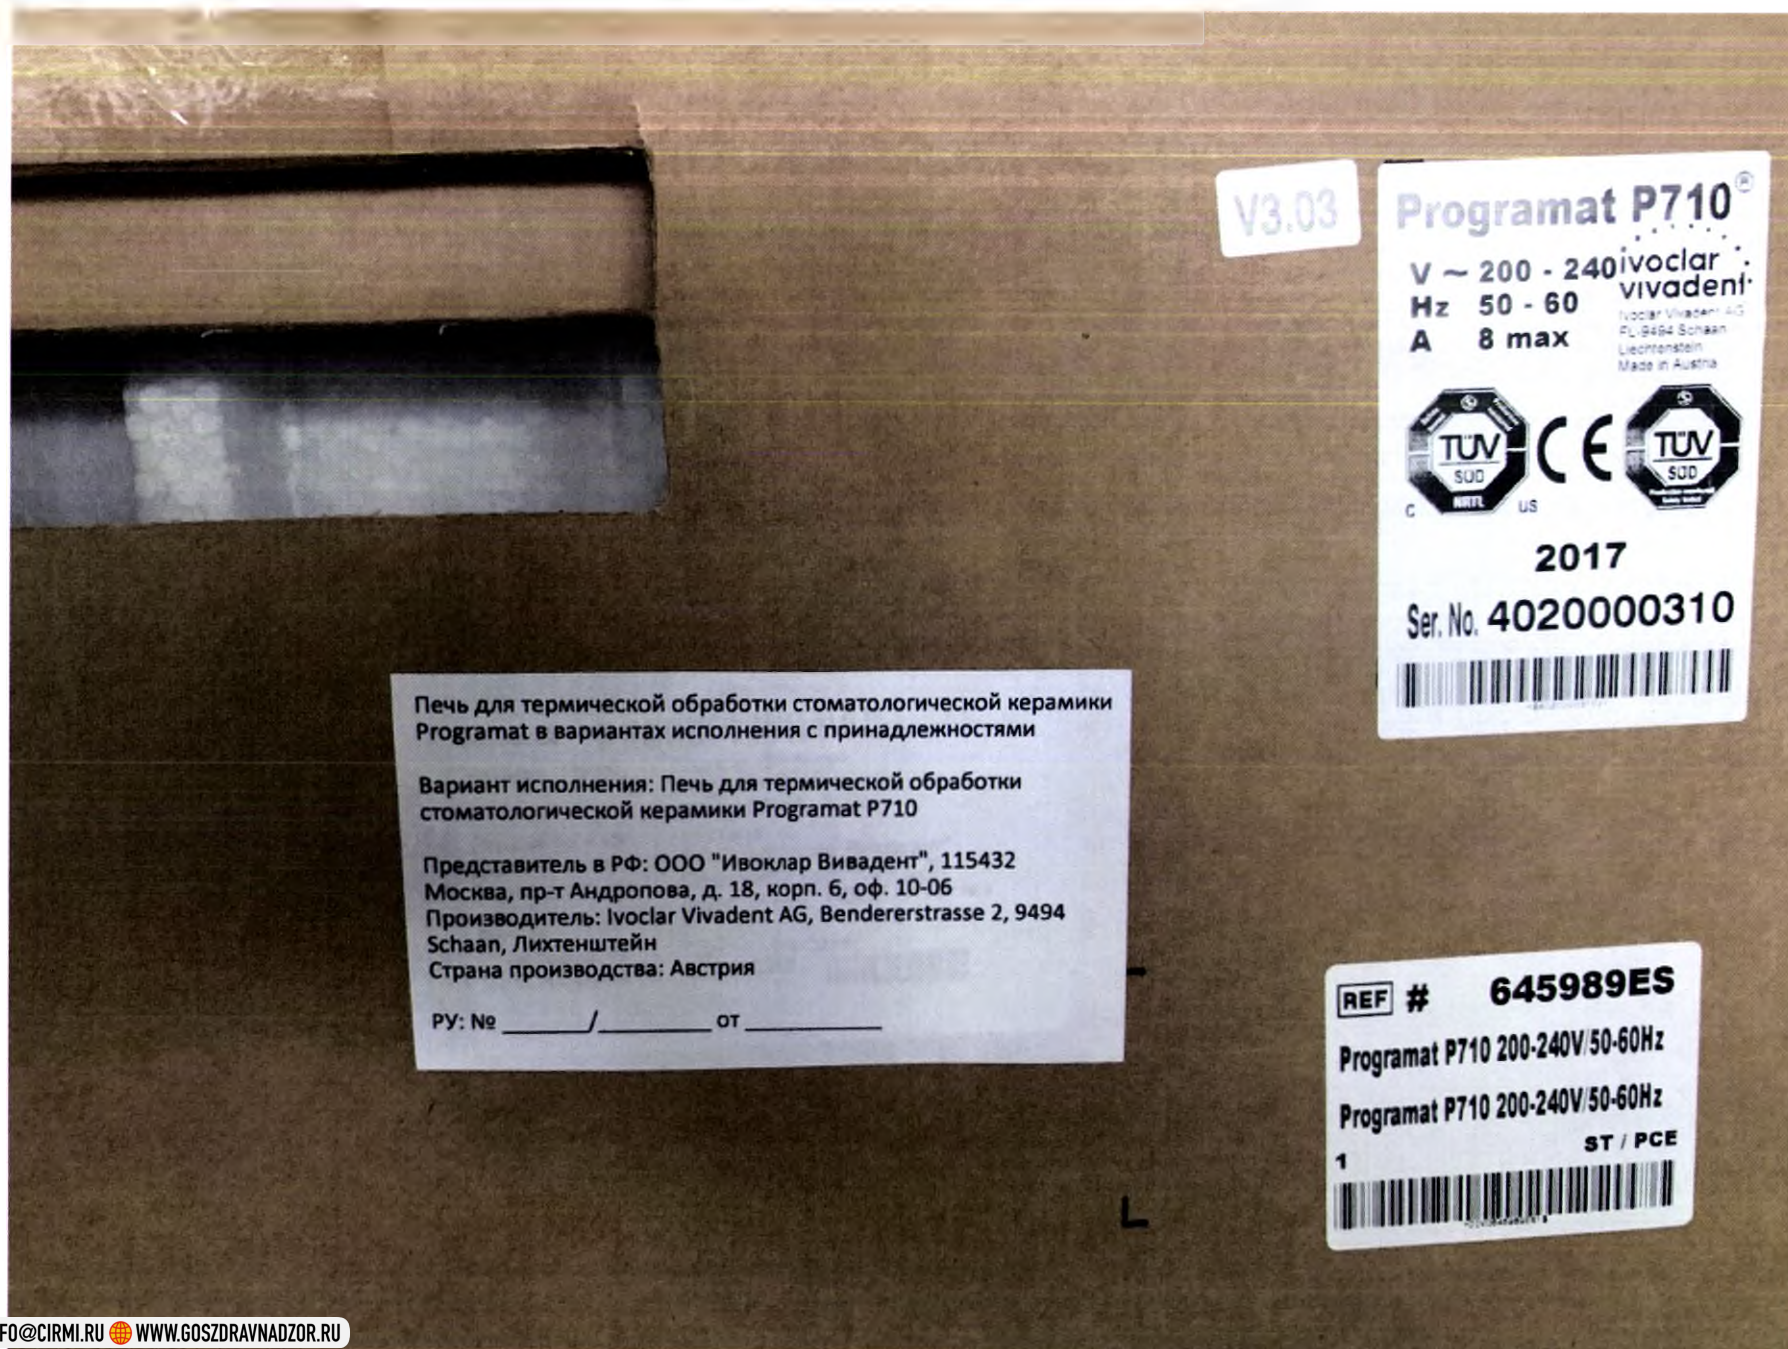


18. Принадлежность к Печи для термической обработки стоматологической керамики Programat P710: Вакуумная помпа Vacuum Pump VP5



20. Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat CS4

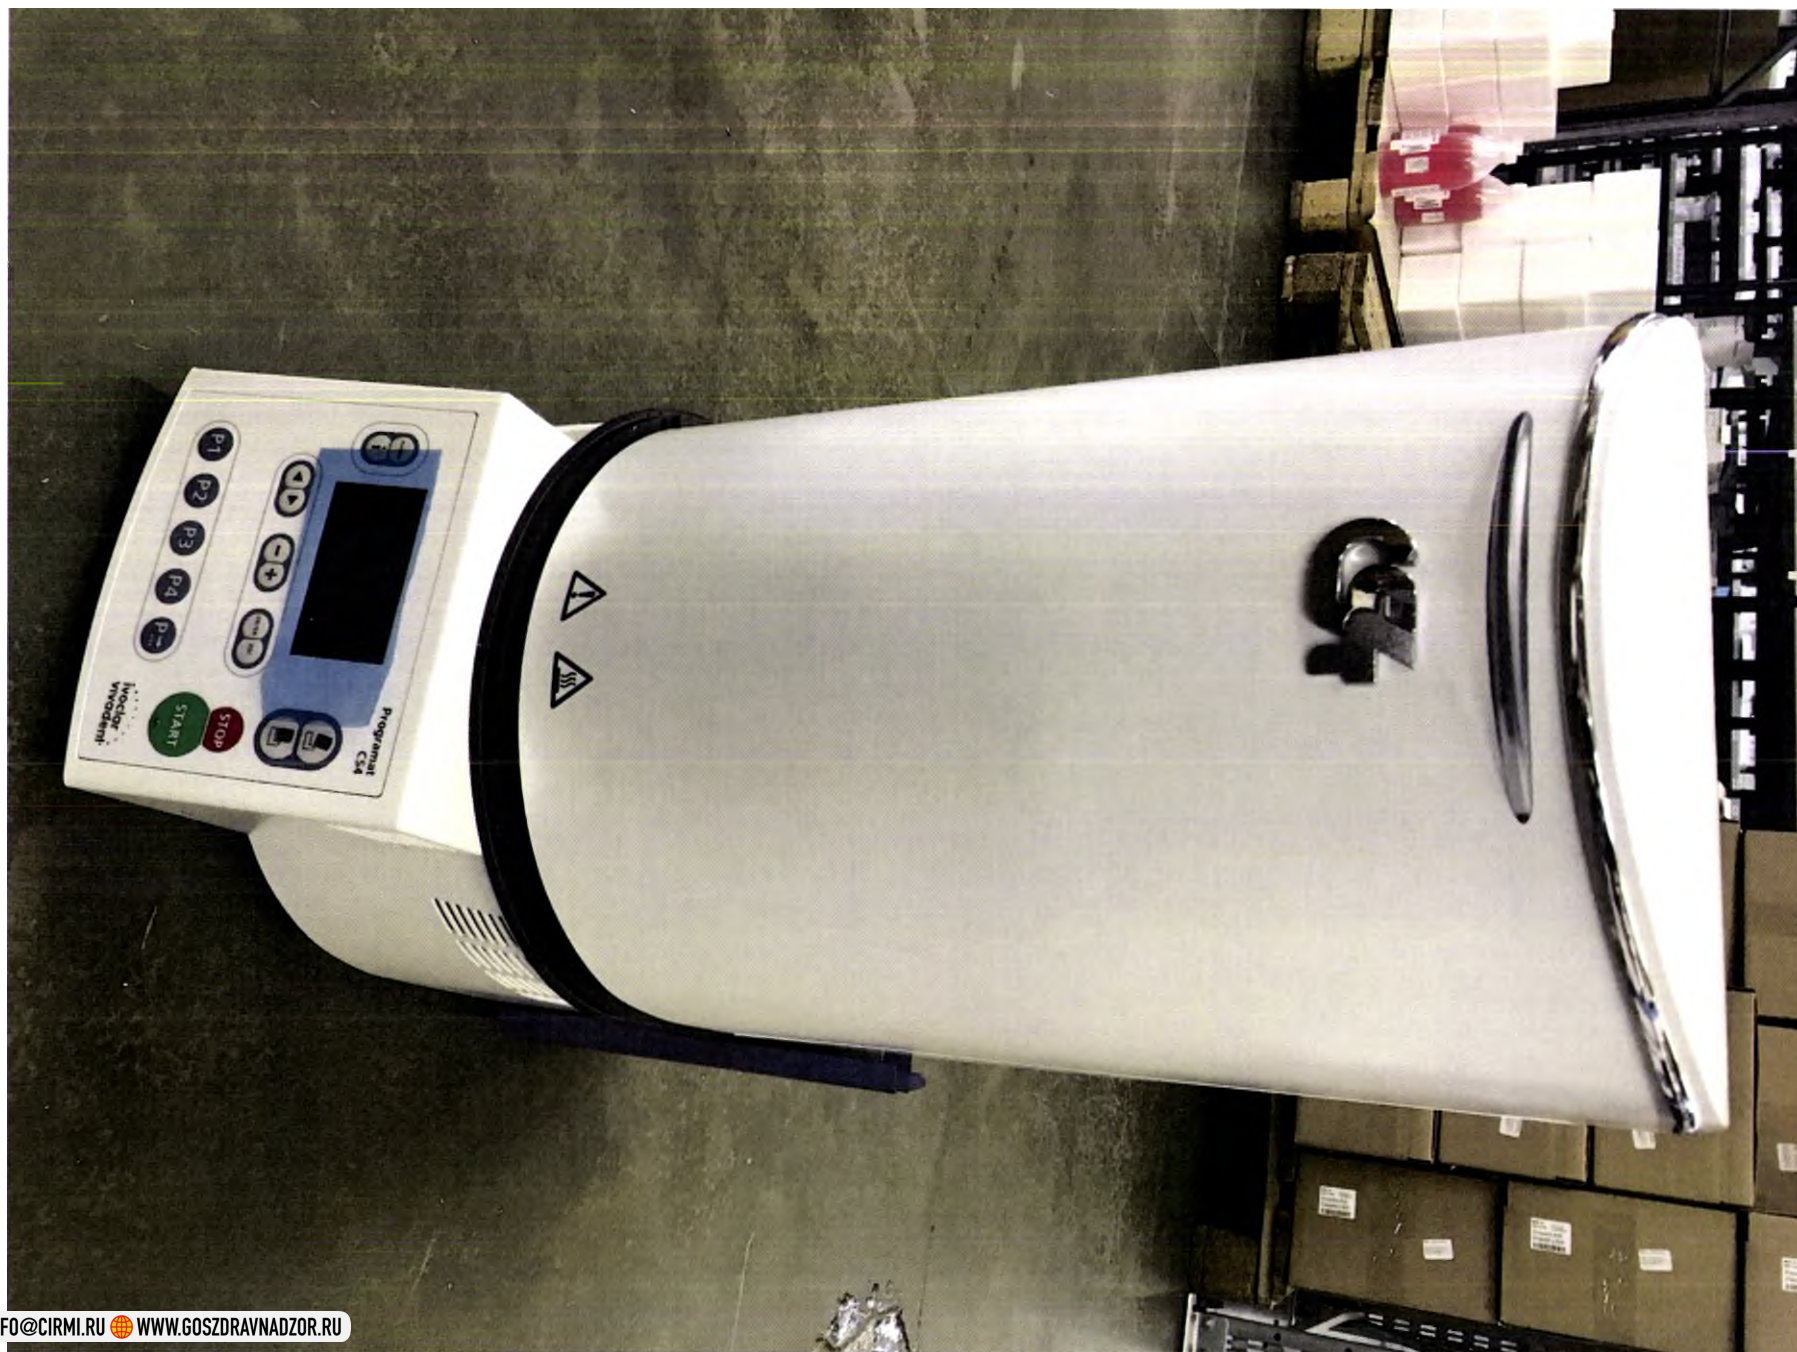


21. Печь для термической обработки стоматологической керамики Programat CS4 (маркировка)

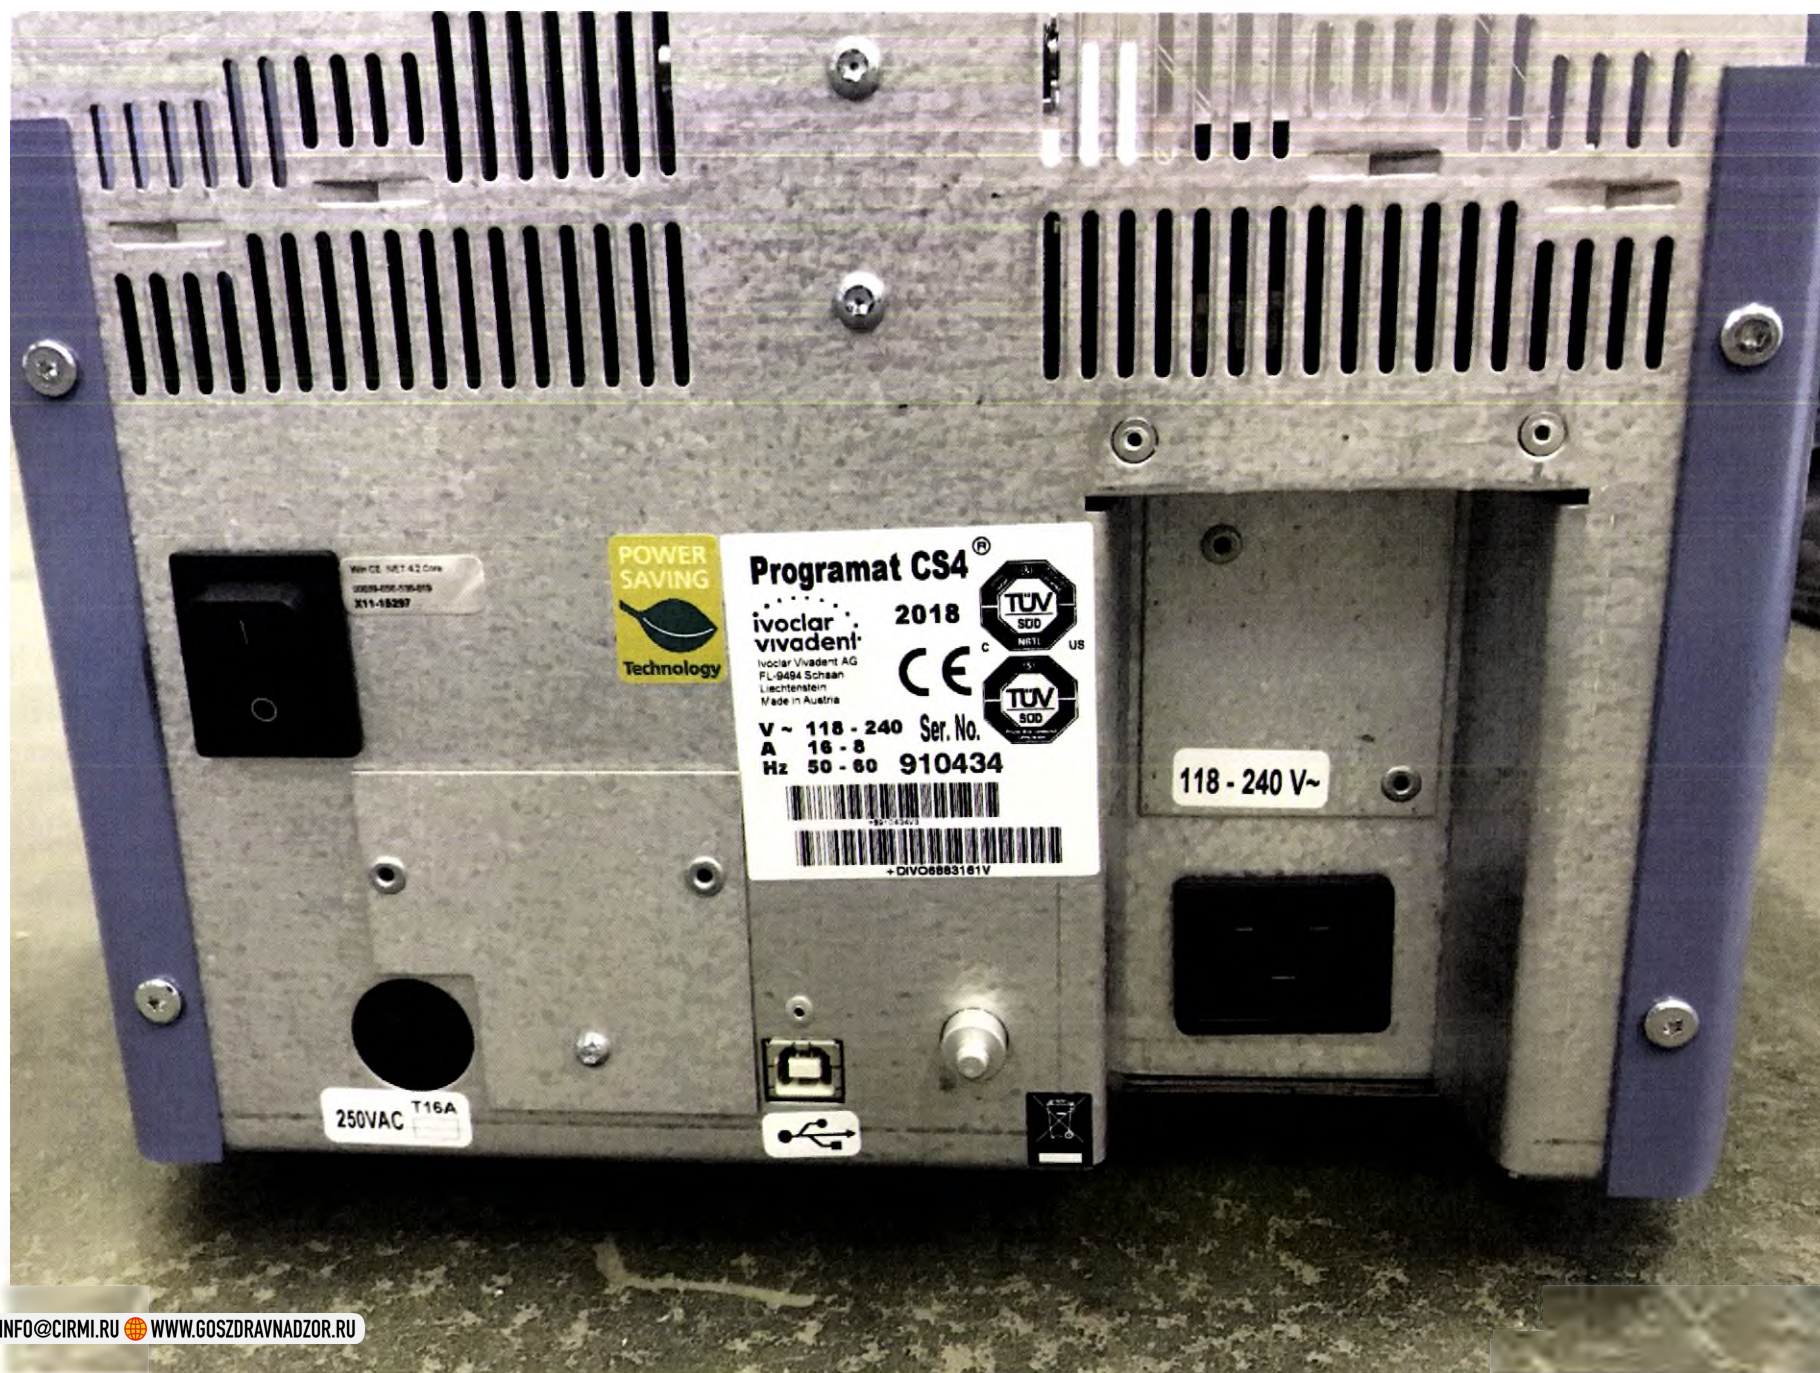


22. Подставка для объектов



23. Столик спекания Programat sinter tray

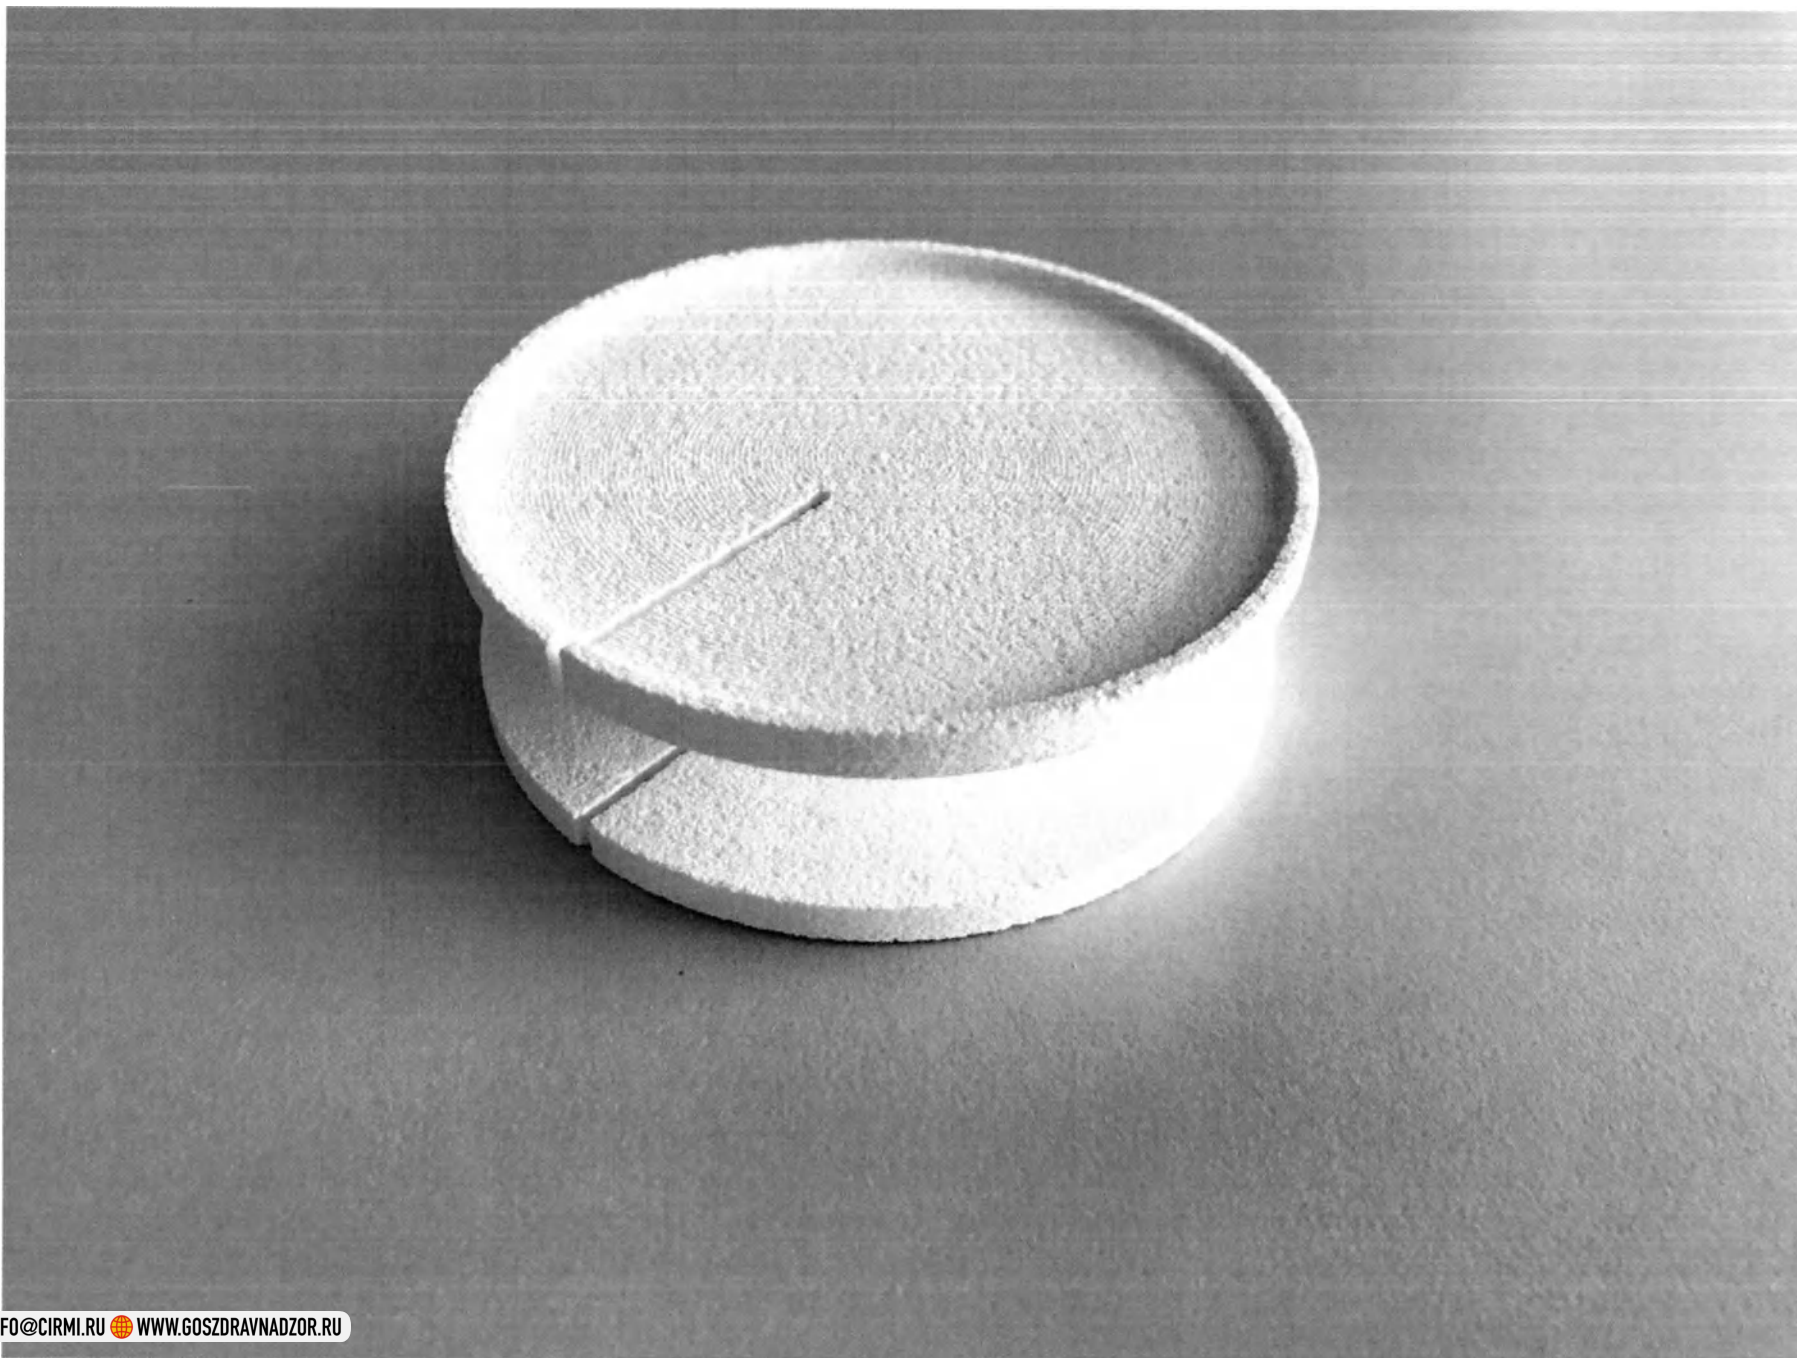

24. Набор контроля температуры Temperature Checking Set UTH (880°C)

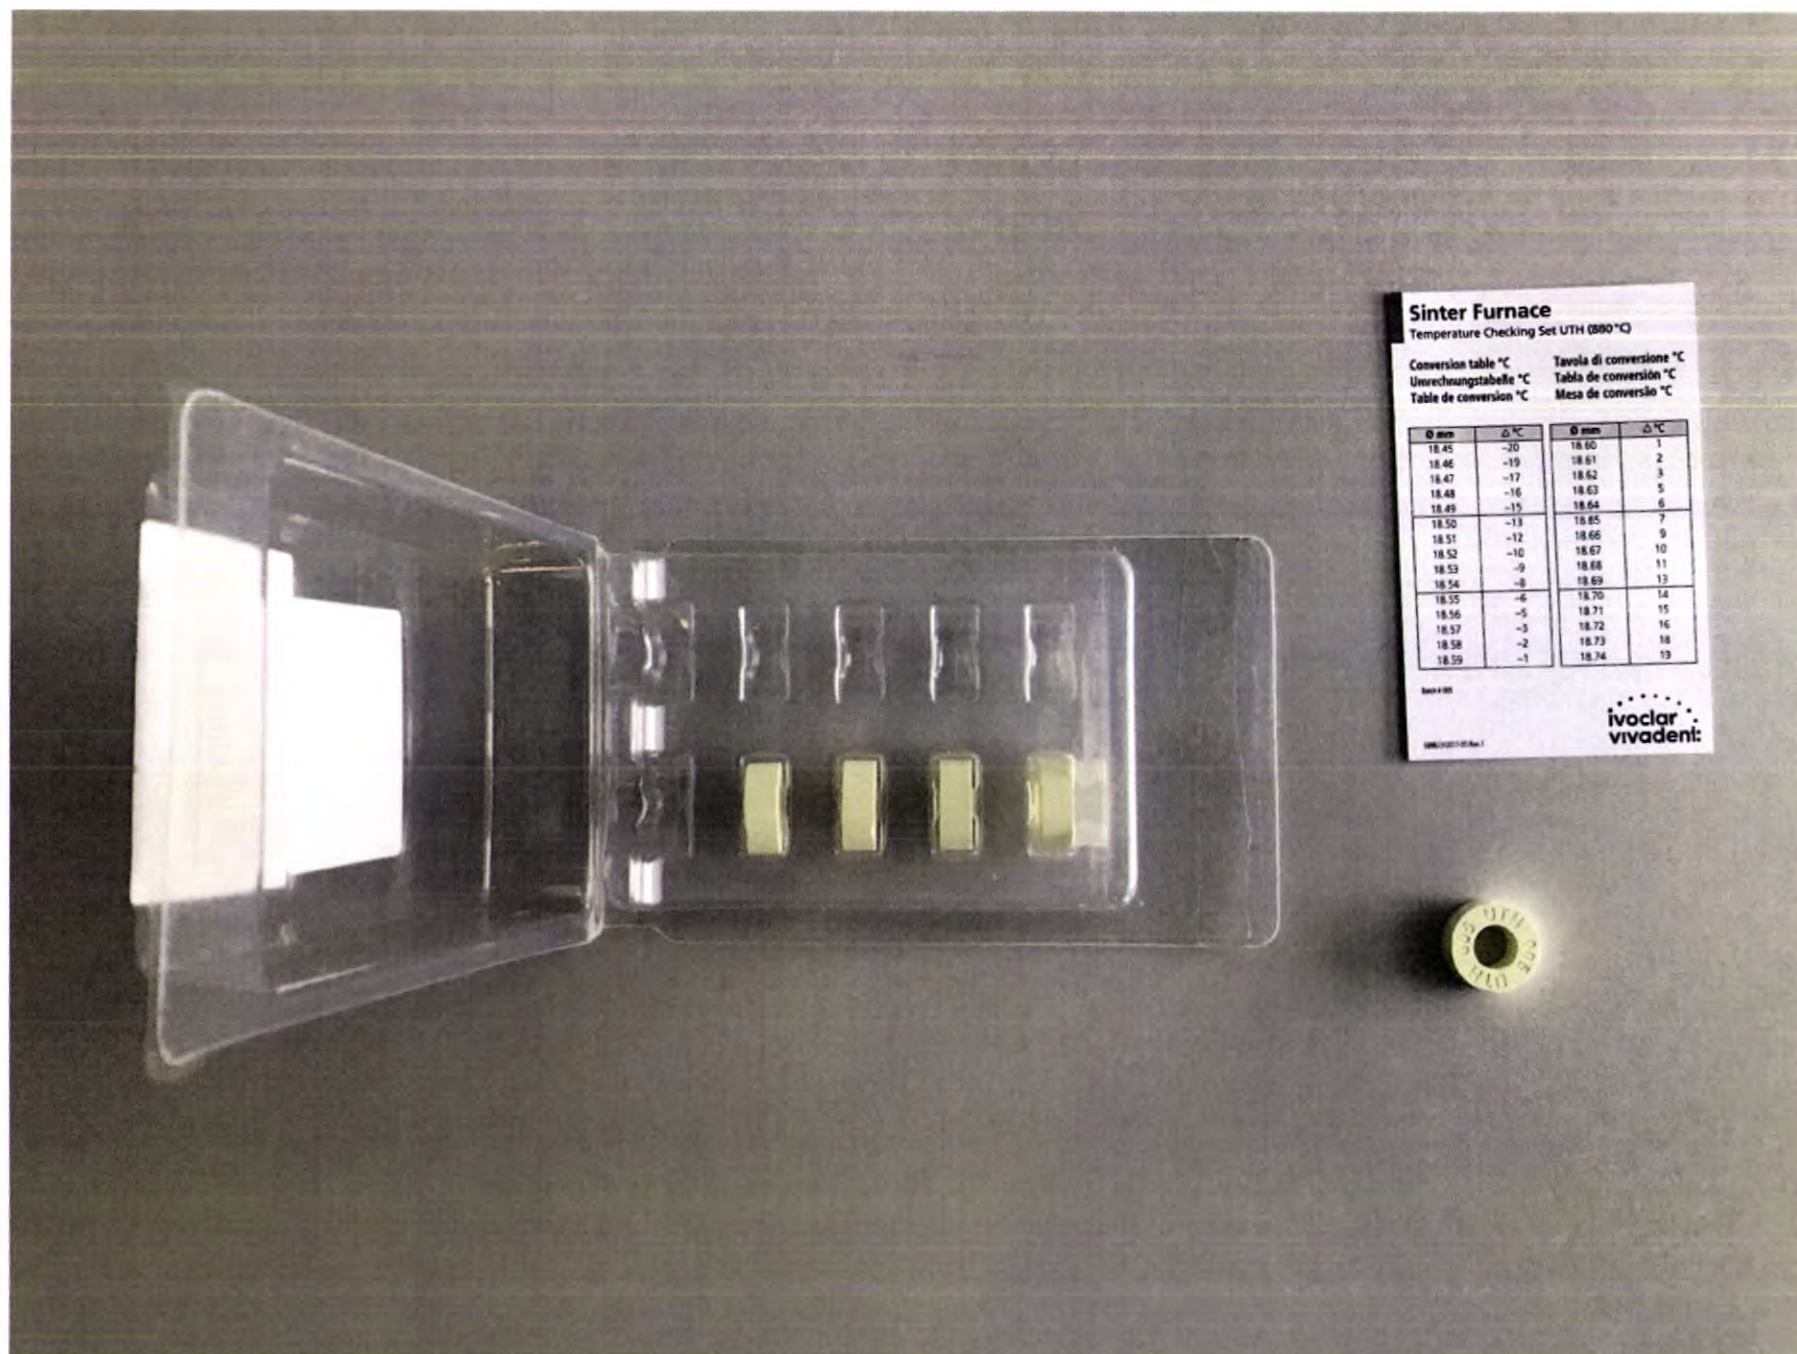


25. Набор контроля температуры Temperature Checking Set MTH (1500°C)




26. Кабель питания, 2.5 м



27. Кабель USB, 1.8 м

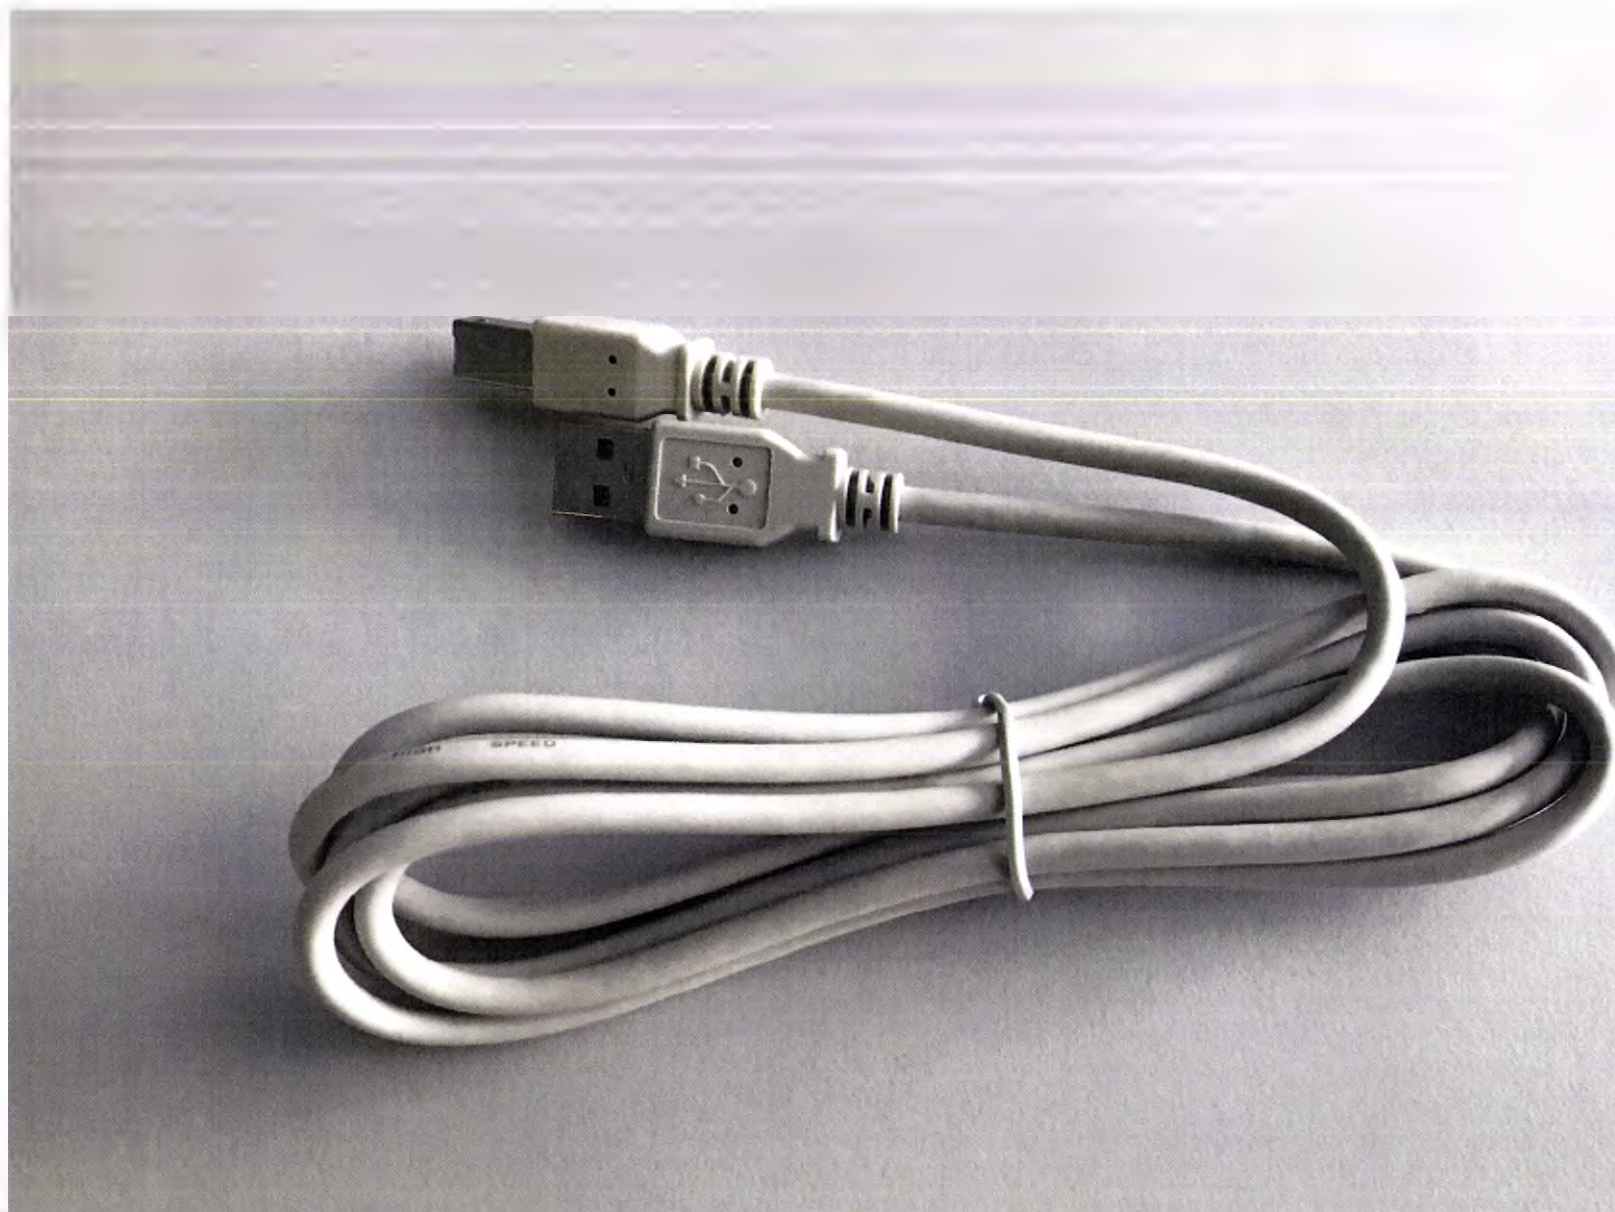


28. Столик кристаллизационный IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray

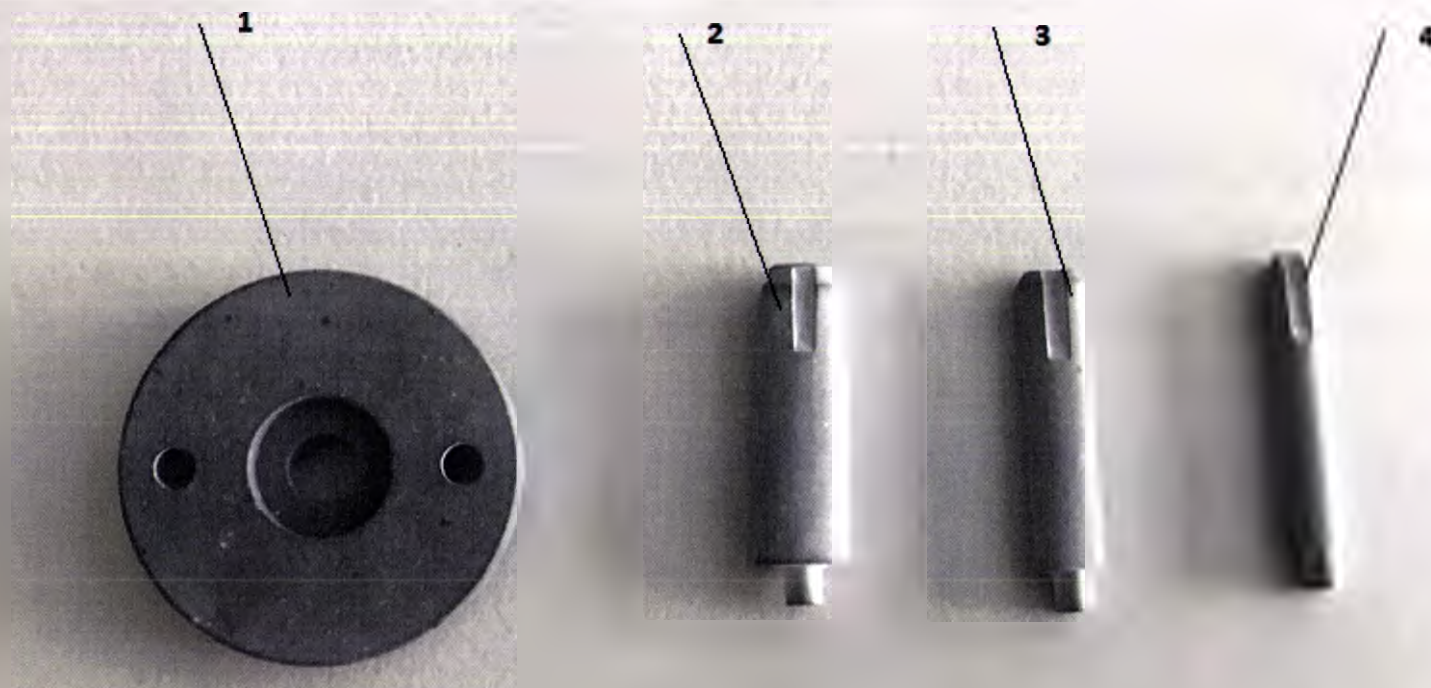

Столик кристаллизационный IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray, в составе:

1. Столик – 1 шт.
2. Пин тип L – 1 шт.
3. Пин тип M – 1 шт.
4. Пин тип S – 1 шт.

29. Элемент дистанционный

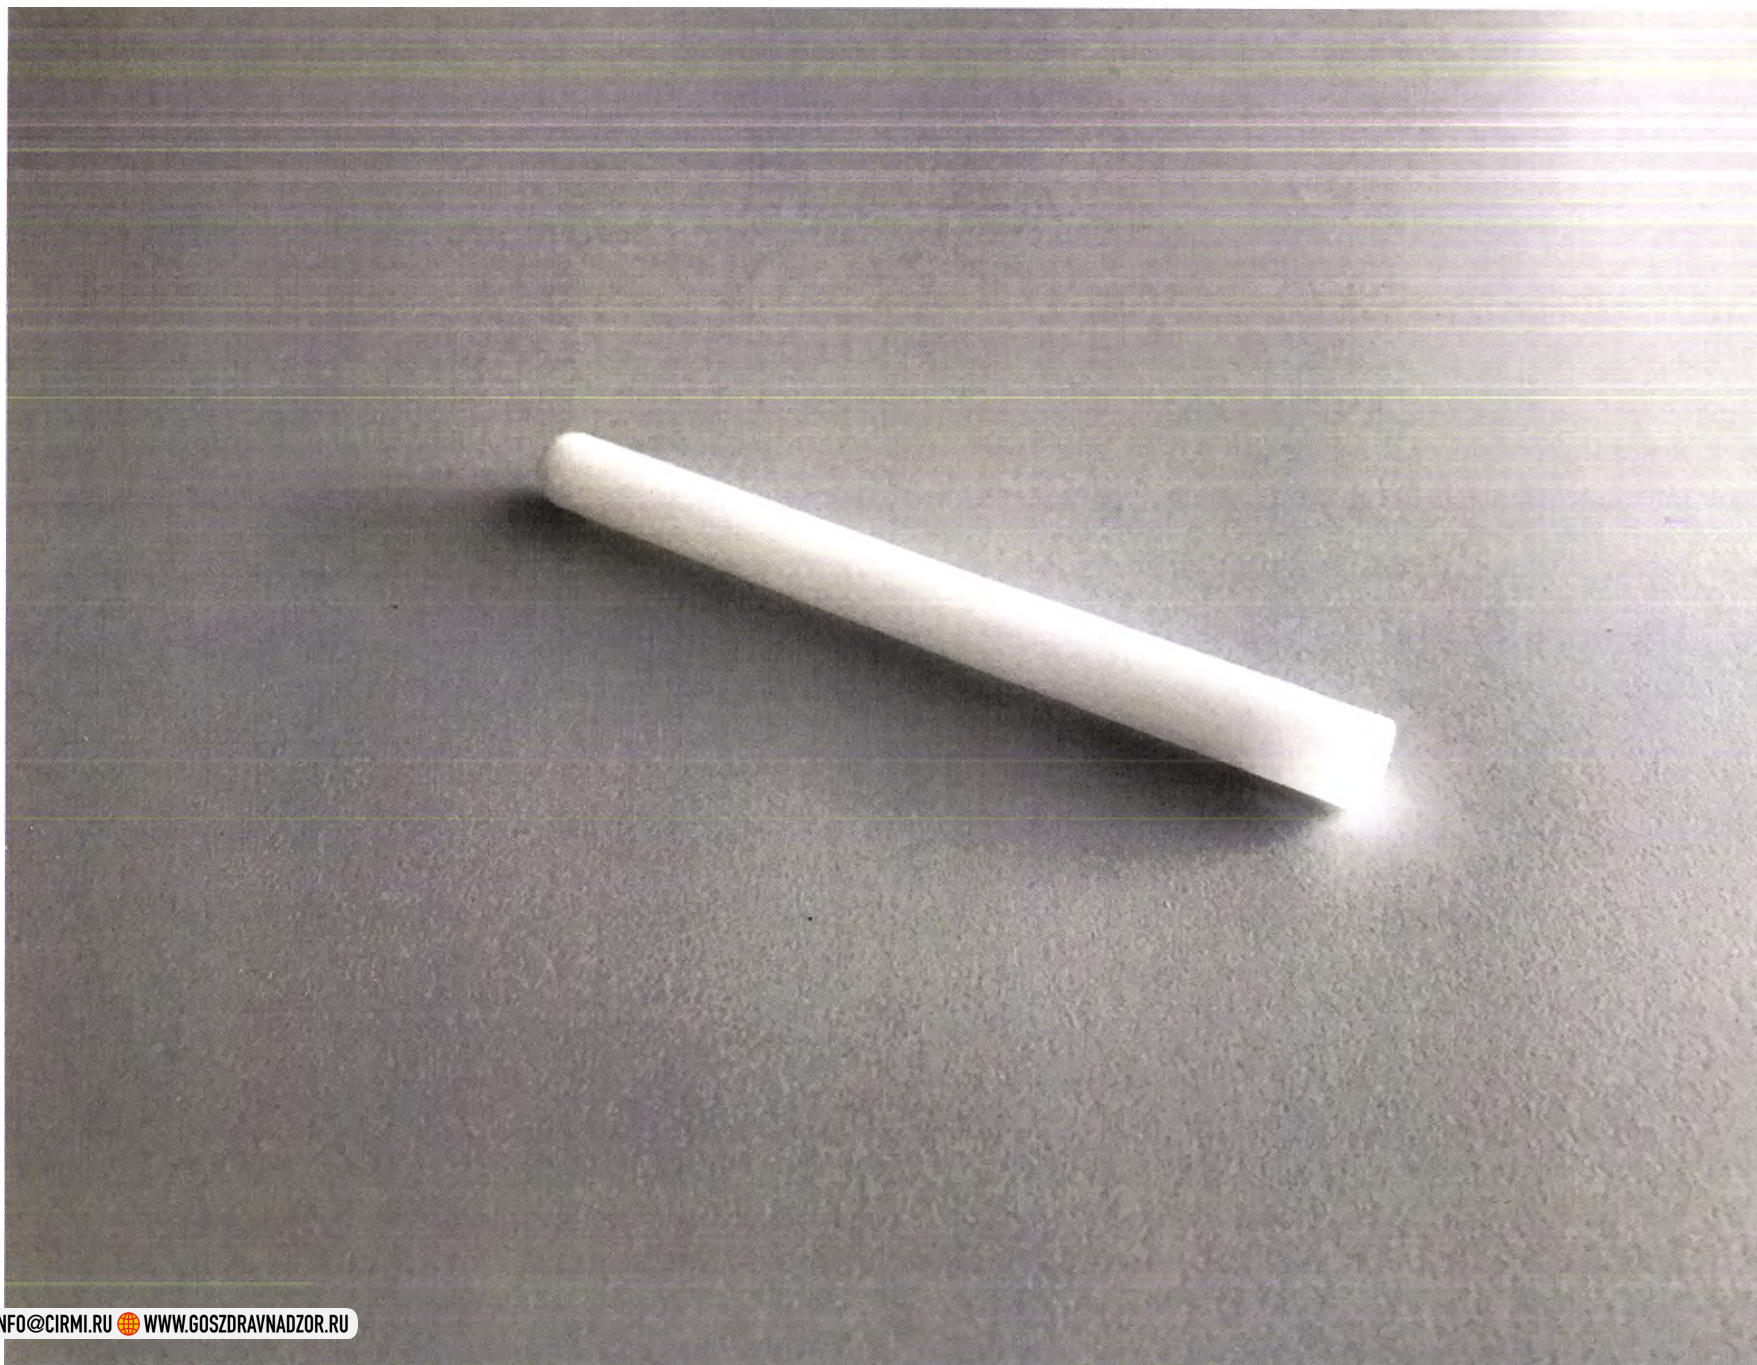

30. Вилка для столика спекания




31. Кисточка для очистки




32. Печь для термической обработки стоматологической керамики на основе оксида циркония Programat S1 1600




33. Печь для термической обработки стоматологической керамики на основе оксида циркония Programat S1 1600 (маркировка)

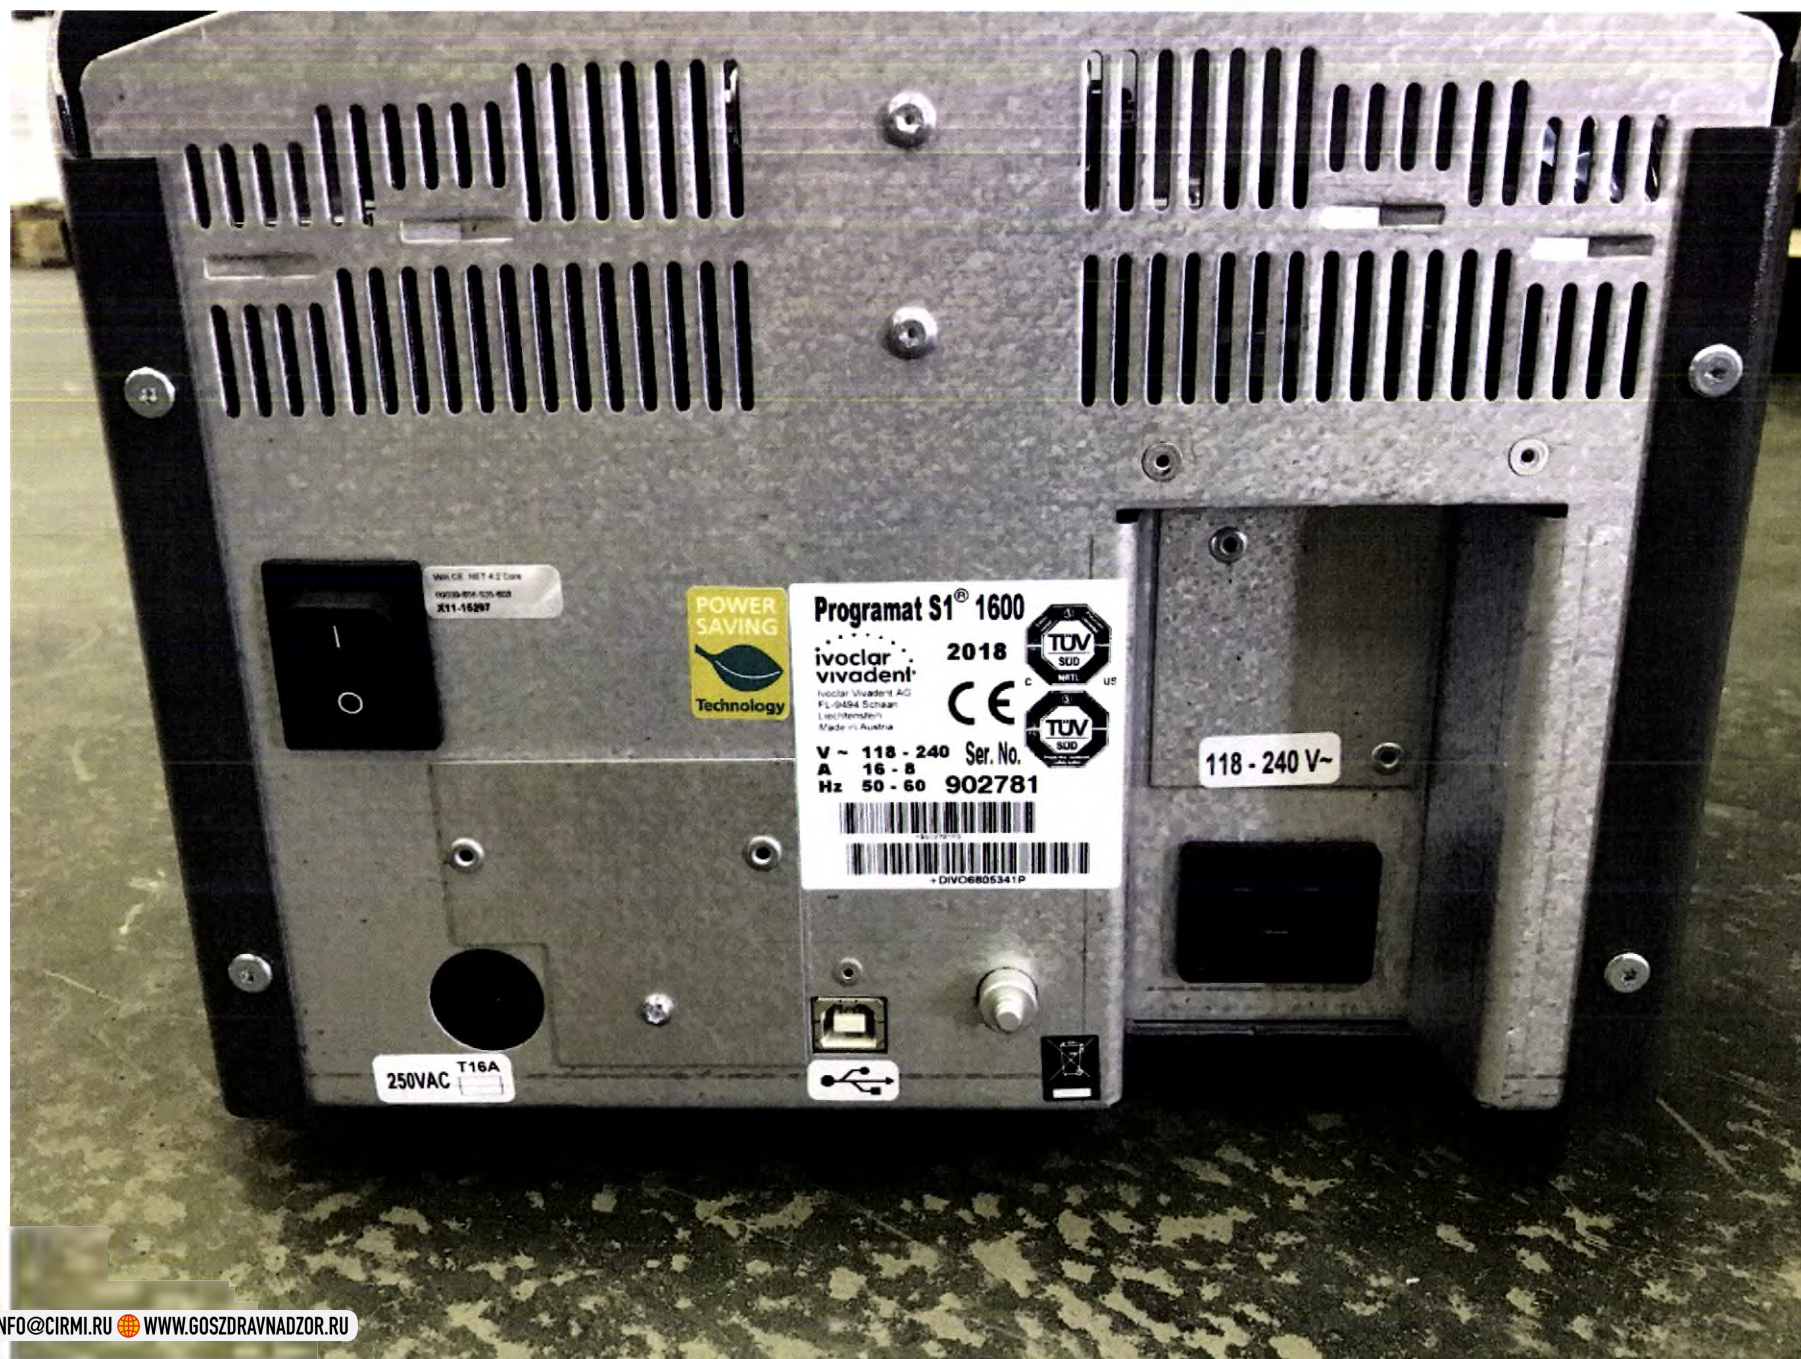


34. Подставка для объектов

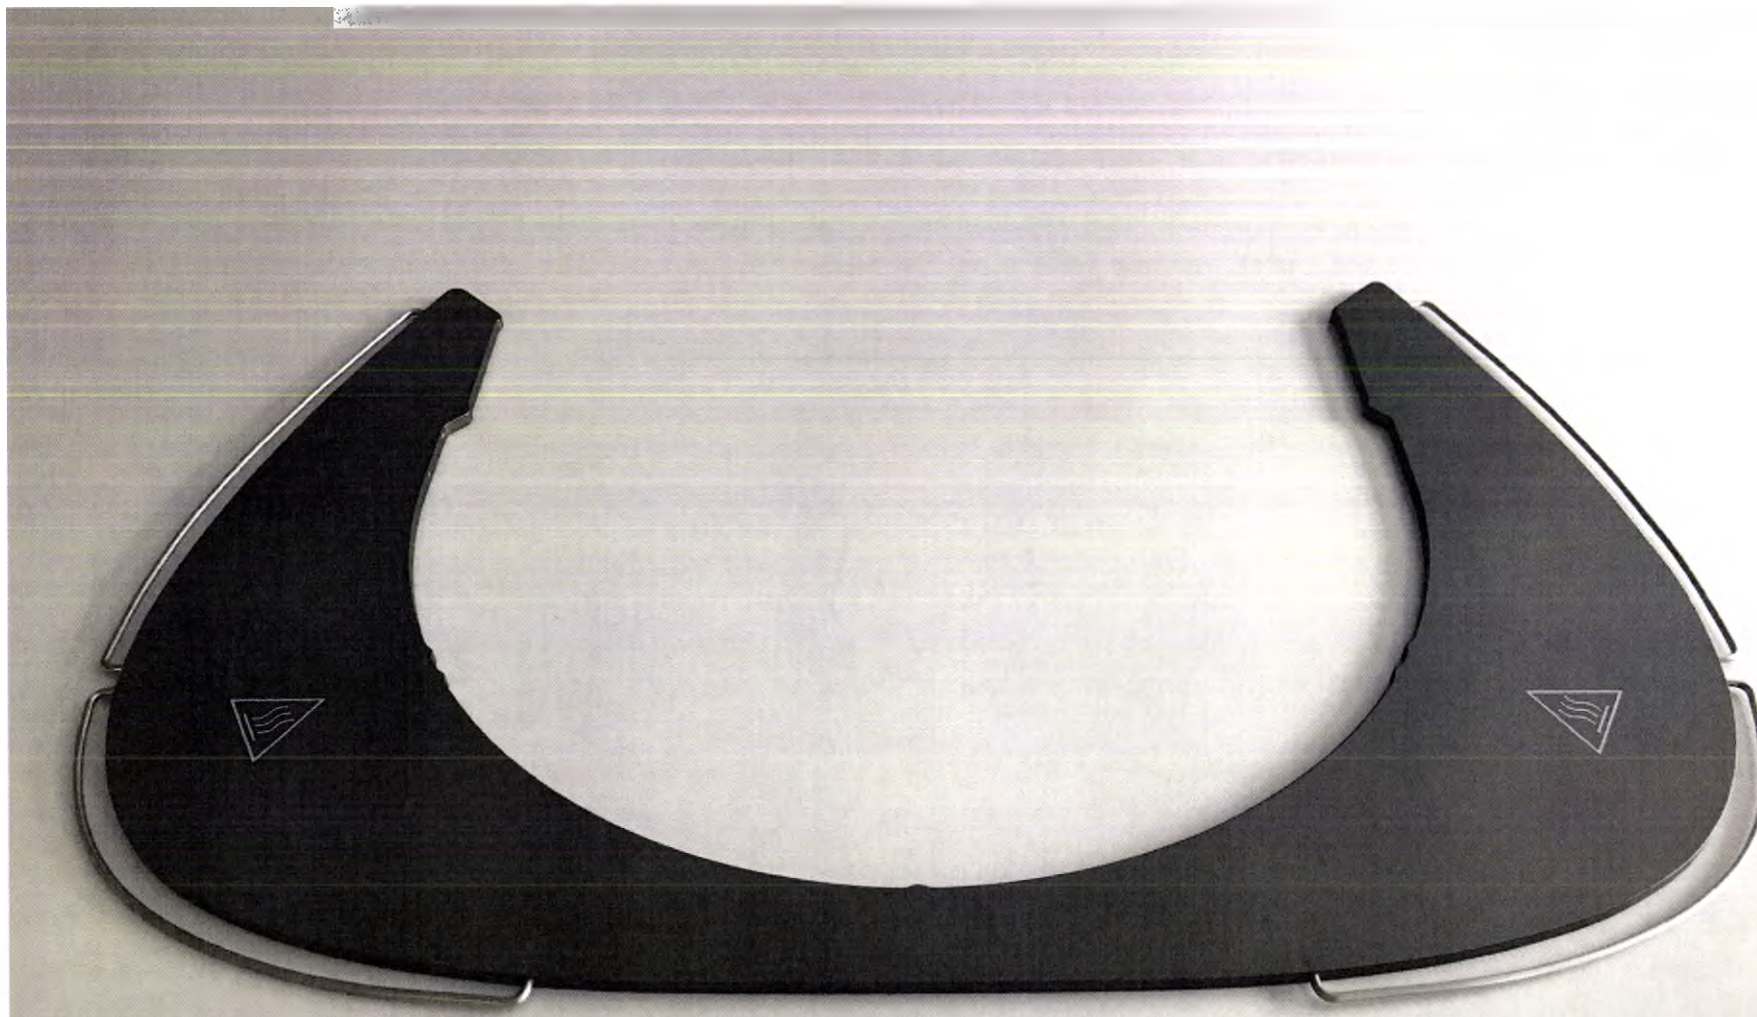

35. Столик спекания Programat sinter tray

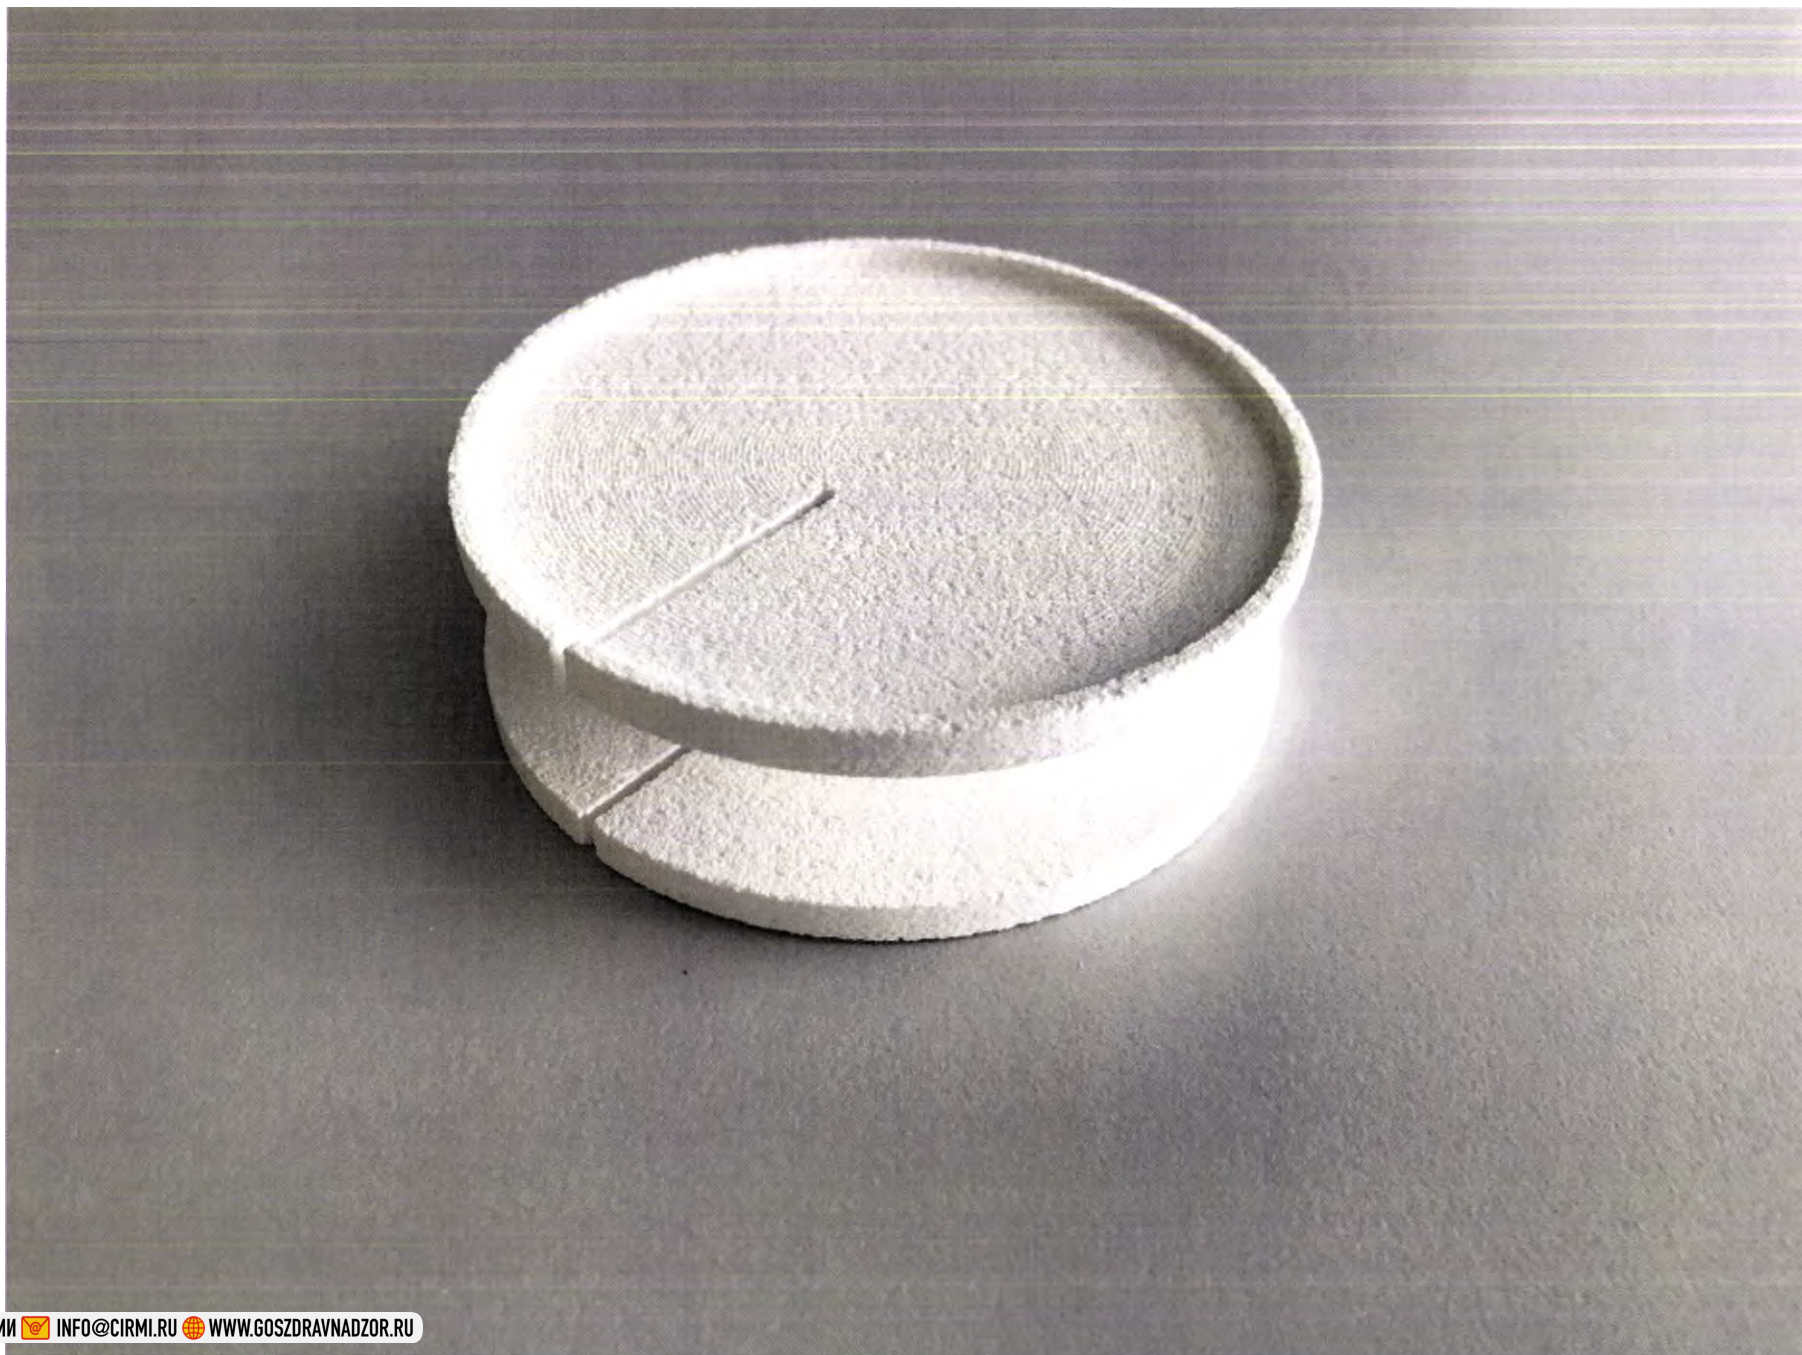

36. Столик спекания Programat Dosto

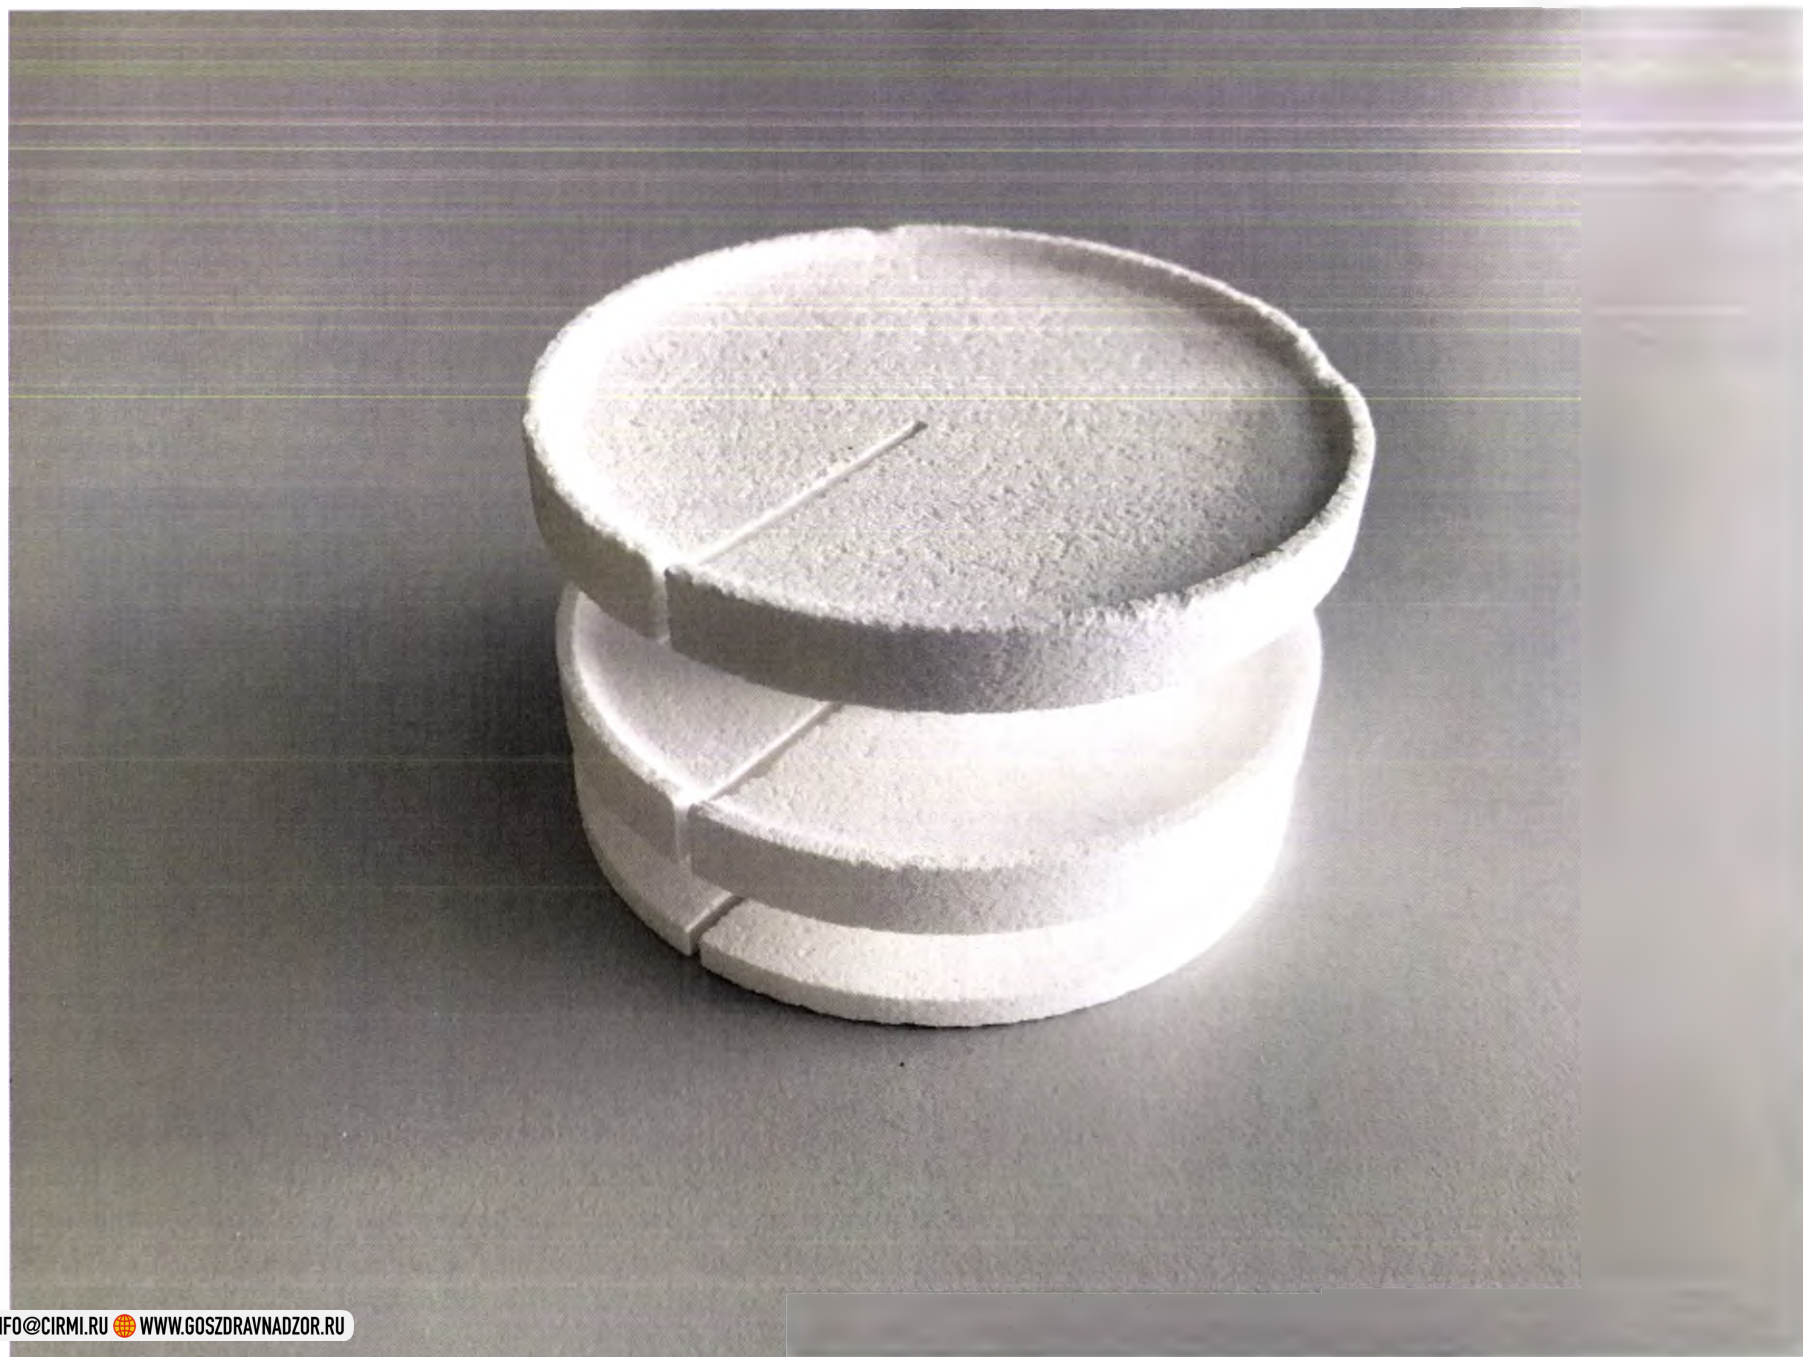


36. Набор контроля температуры Temperature Checking Set MTH (1500°C)



37. Кабель питания, 2.5 м




38. Кабель USB, 1.8 м

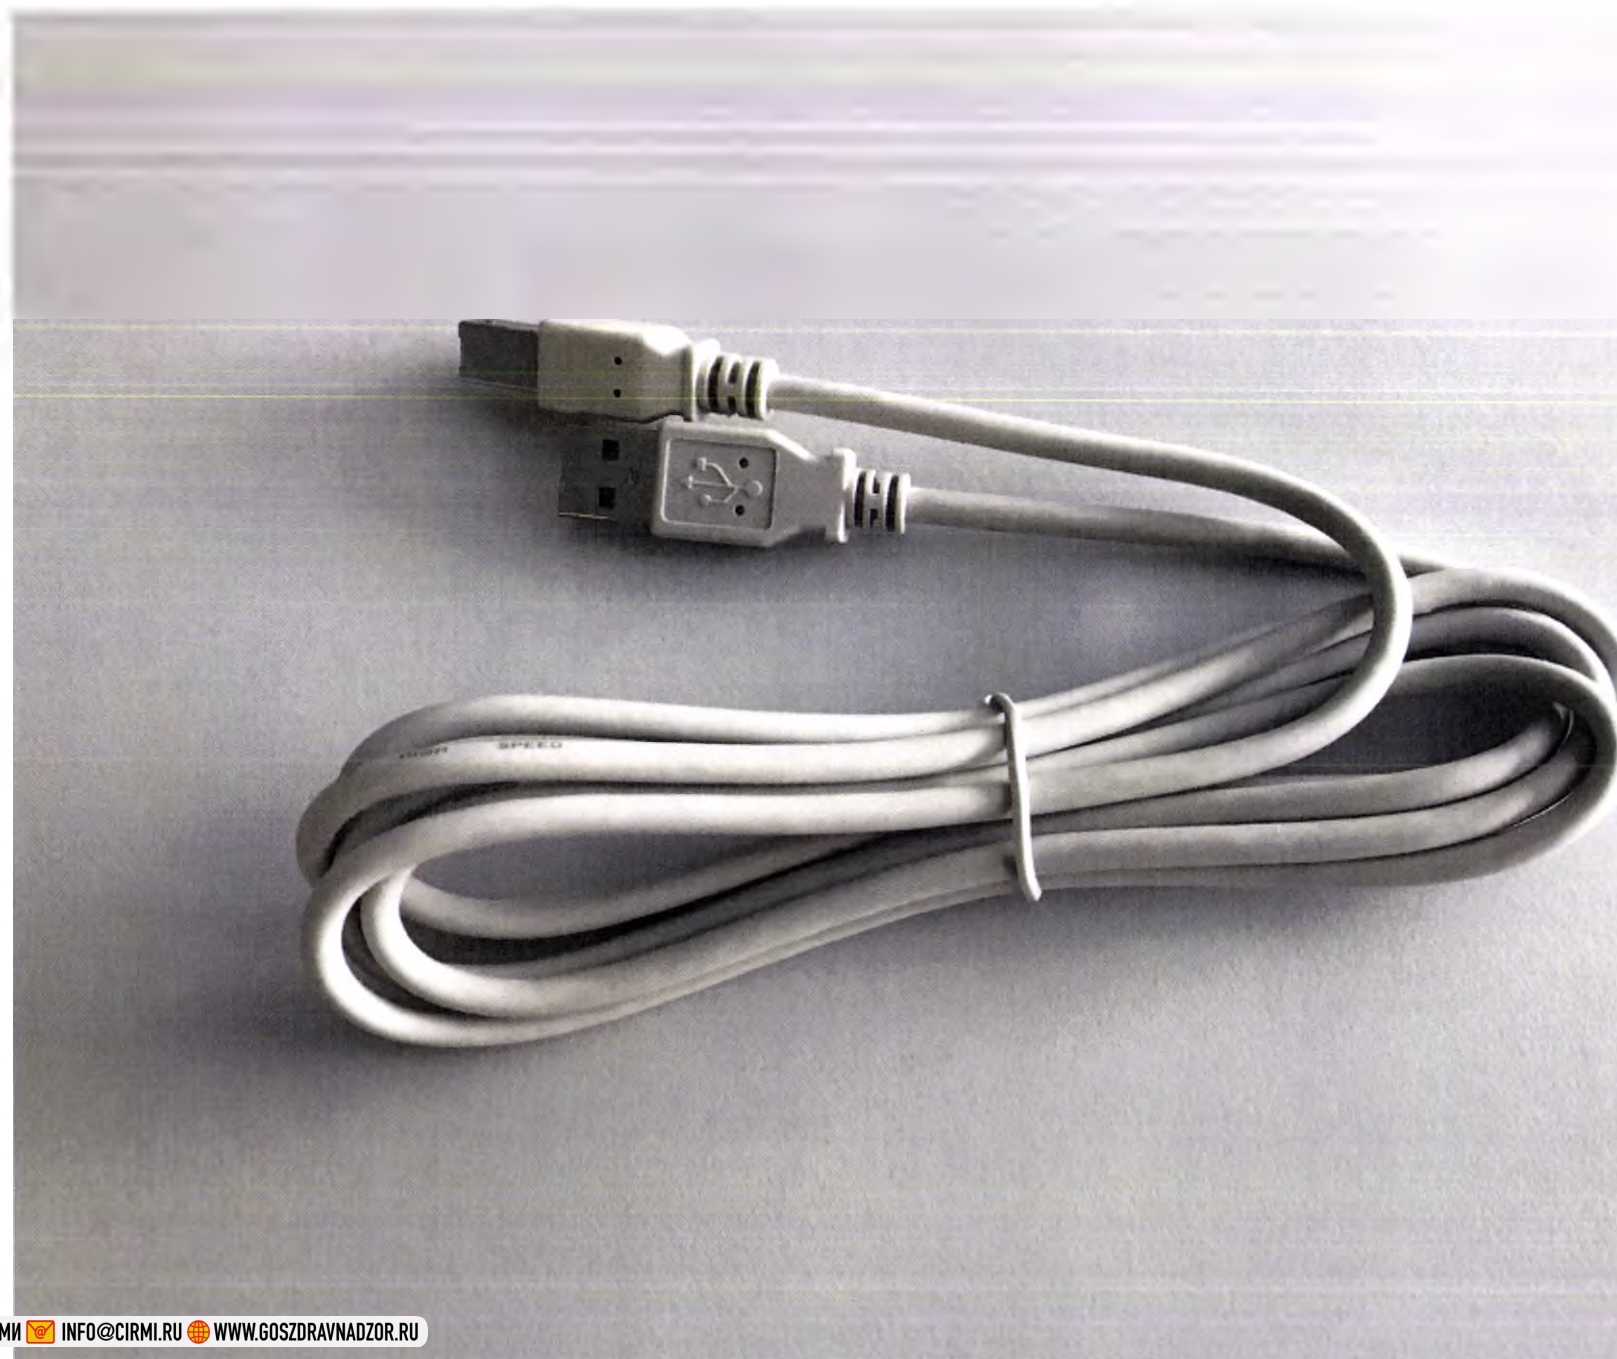

39. Элемент дистанционный



40. Вилка для столика спекания

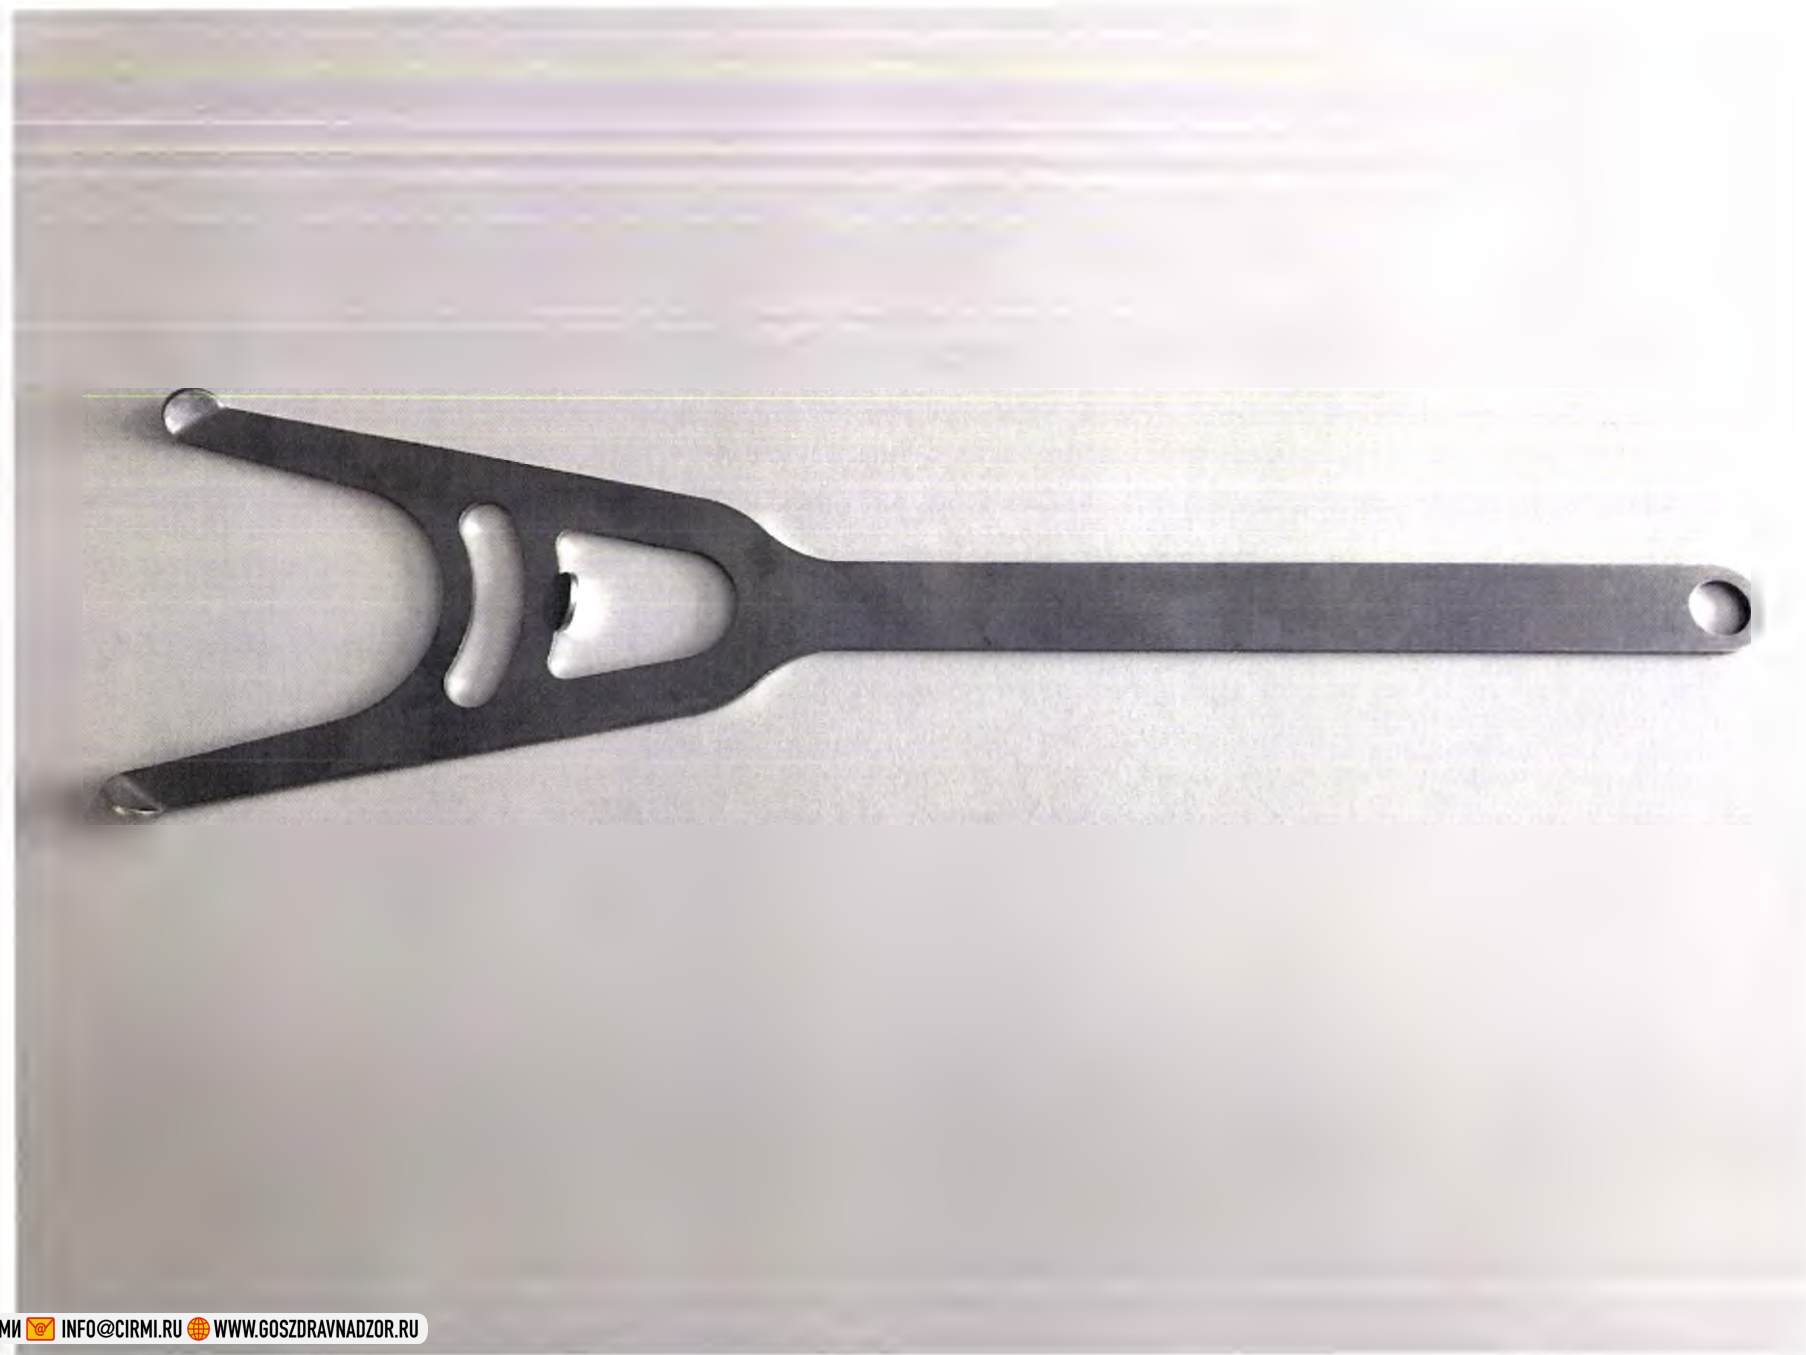

41. Кисточка для очистки



Пронумеровано, прошито, скреплено печатью
45 листов

ООО Ивоклад Вивадент

Штефан Ульманн
Генеральный директор

