



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система фототерапии для новорожденных Lullaby
LED с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ


Директор департамента регистрации и сертификации
Россия и СНГ ООО «ДжиИ Хэлскеа»



С.Б. Парахина

« 17 » июля 2018г.

1. Система фототерапии Lullaby LED.

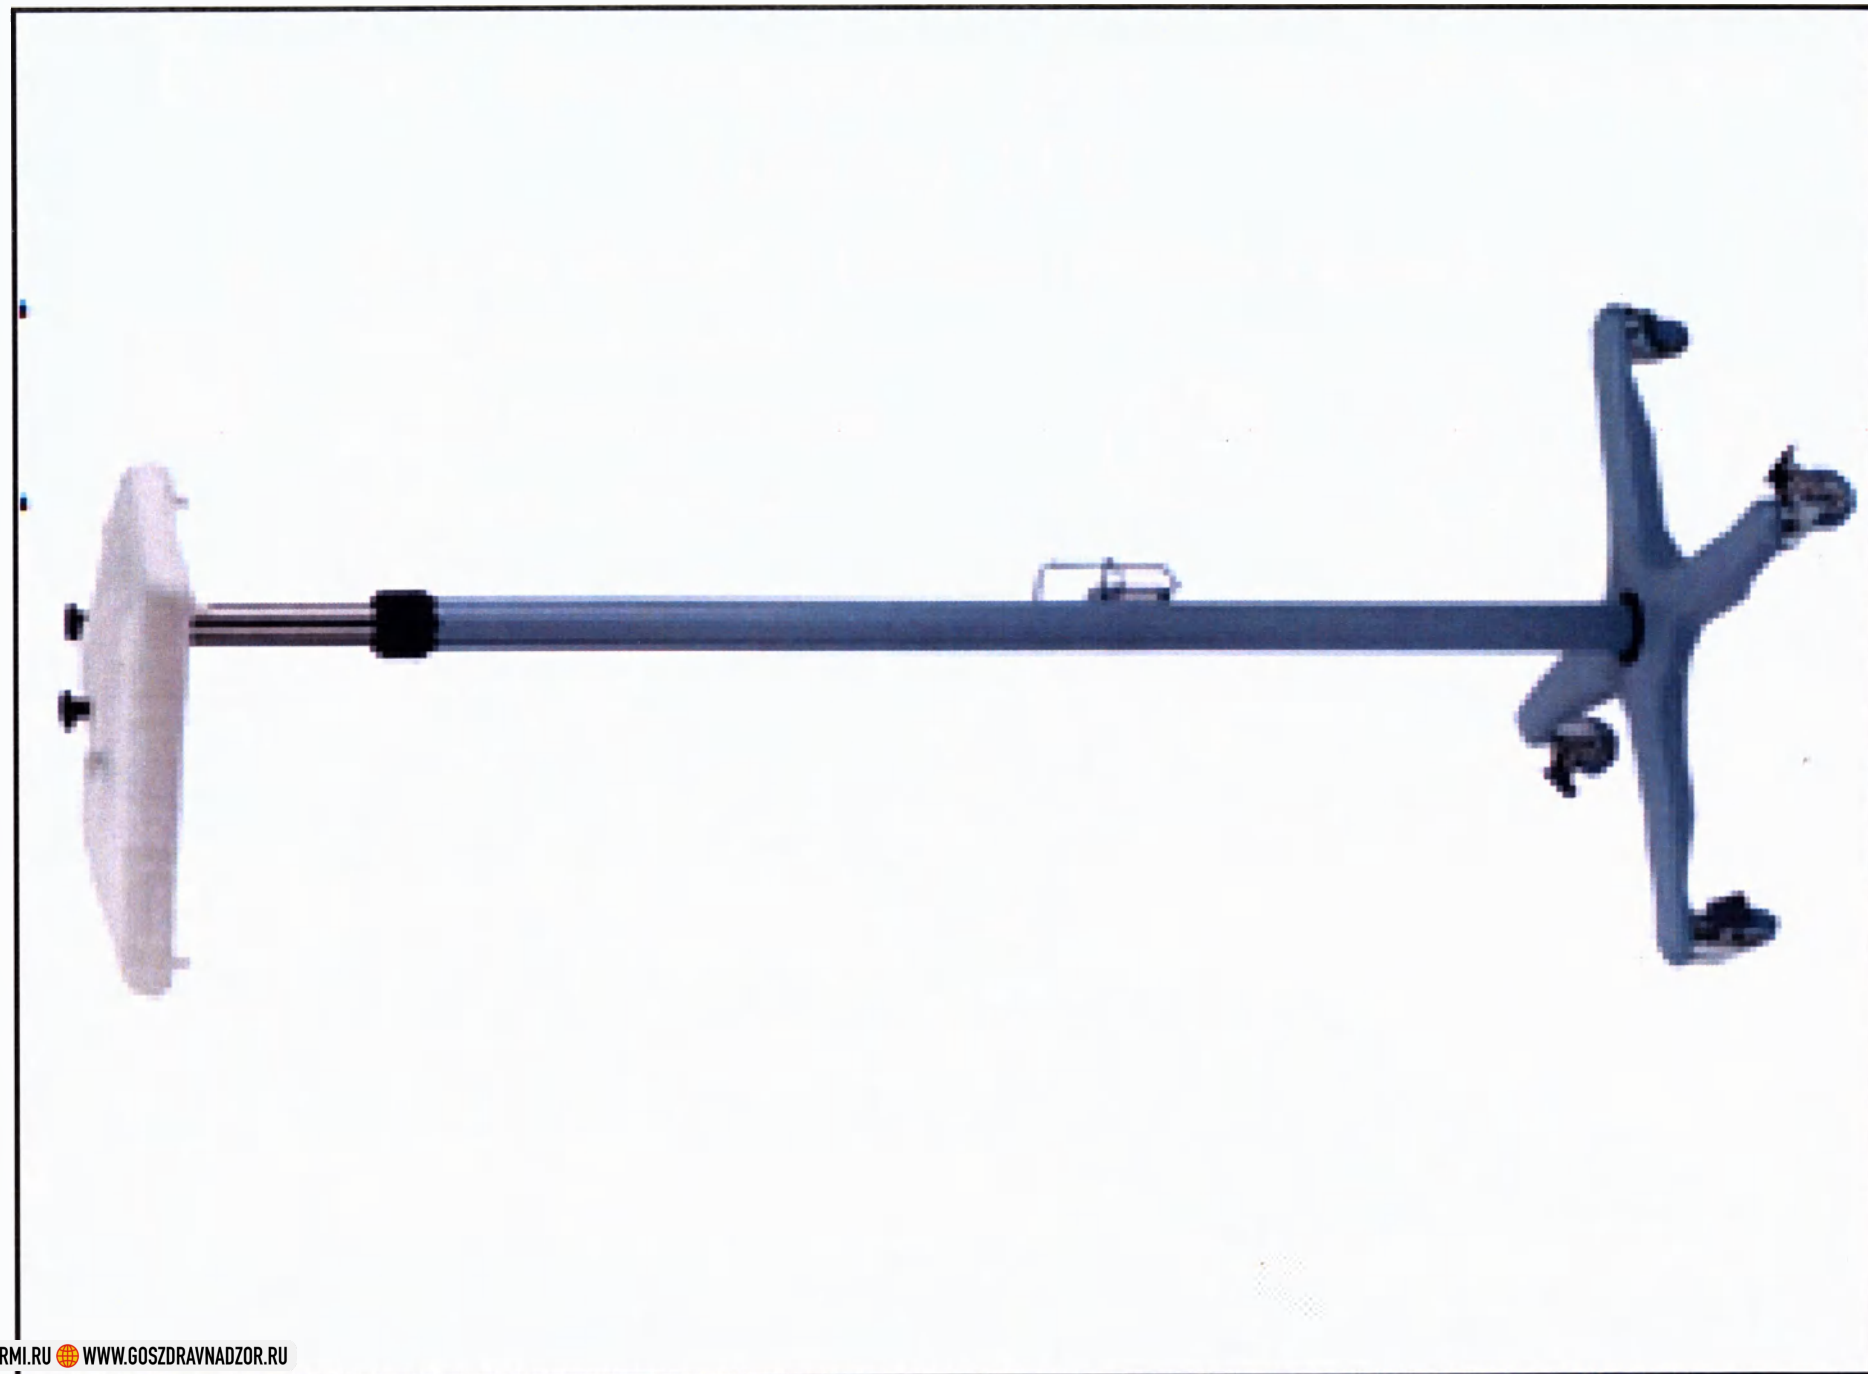

Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED



Ohmeda Medical, a Division of Datex-Ohmeda, Inc.
8880 Gorman Road
Laurel, MD 20723 USA
Сделано в Индии



== 24V / 1.0A

C € 0086

~10Kg

REF: 2052663-001



Rx ONLY U.S



SN: SGTYYFW0000SM



2018-12-03



XXXXXXXX-XXX REV A

GE Healthcare

Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED

Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию



Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED
Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию




3. Кабель питания.



II. Принадлежности: 1. Светодиодные лампы (не более 50 шт.)



2. Электрические адаптеры (не более 10 шт.)

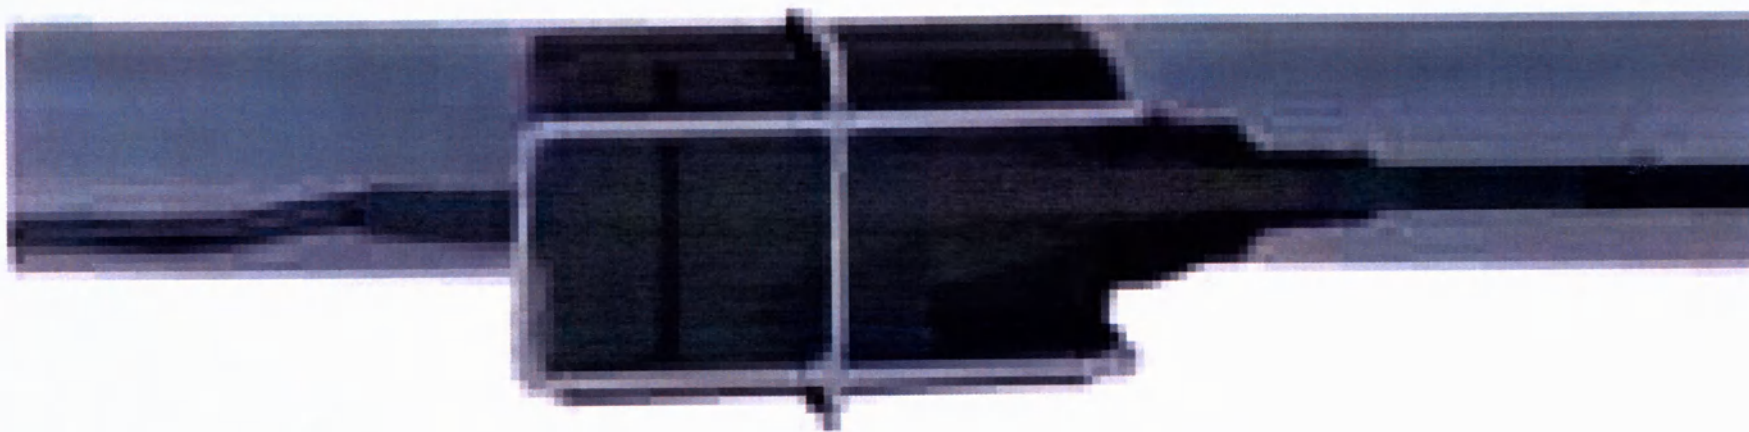

3. Измерители интенсивности светового излучения подушки (не более 10 шт.)




4. Датчик (не более 10 шт.)



5. Крышка для датчика (не более 10 шт.)



6. Ремень для датчика (не более 10 шт.)

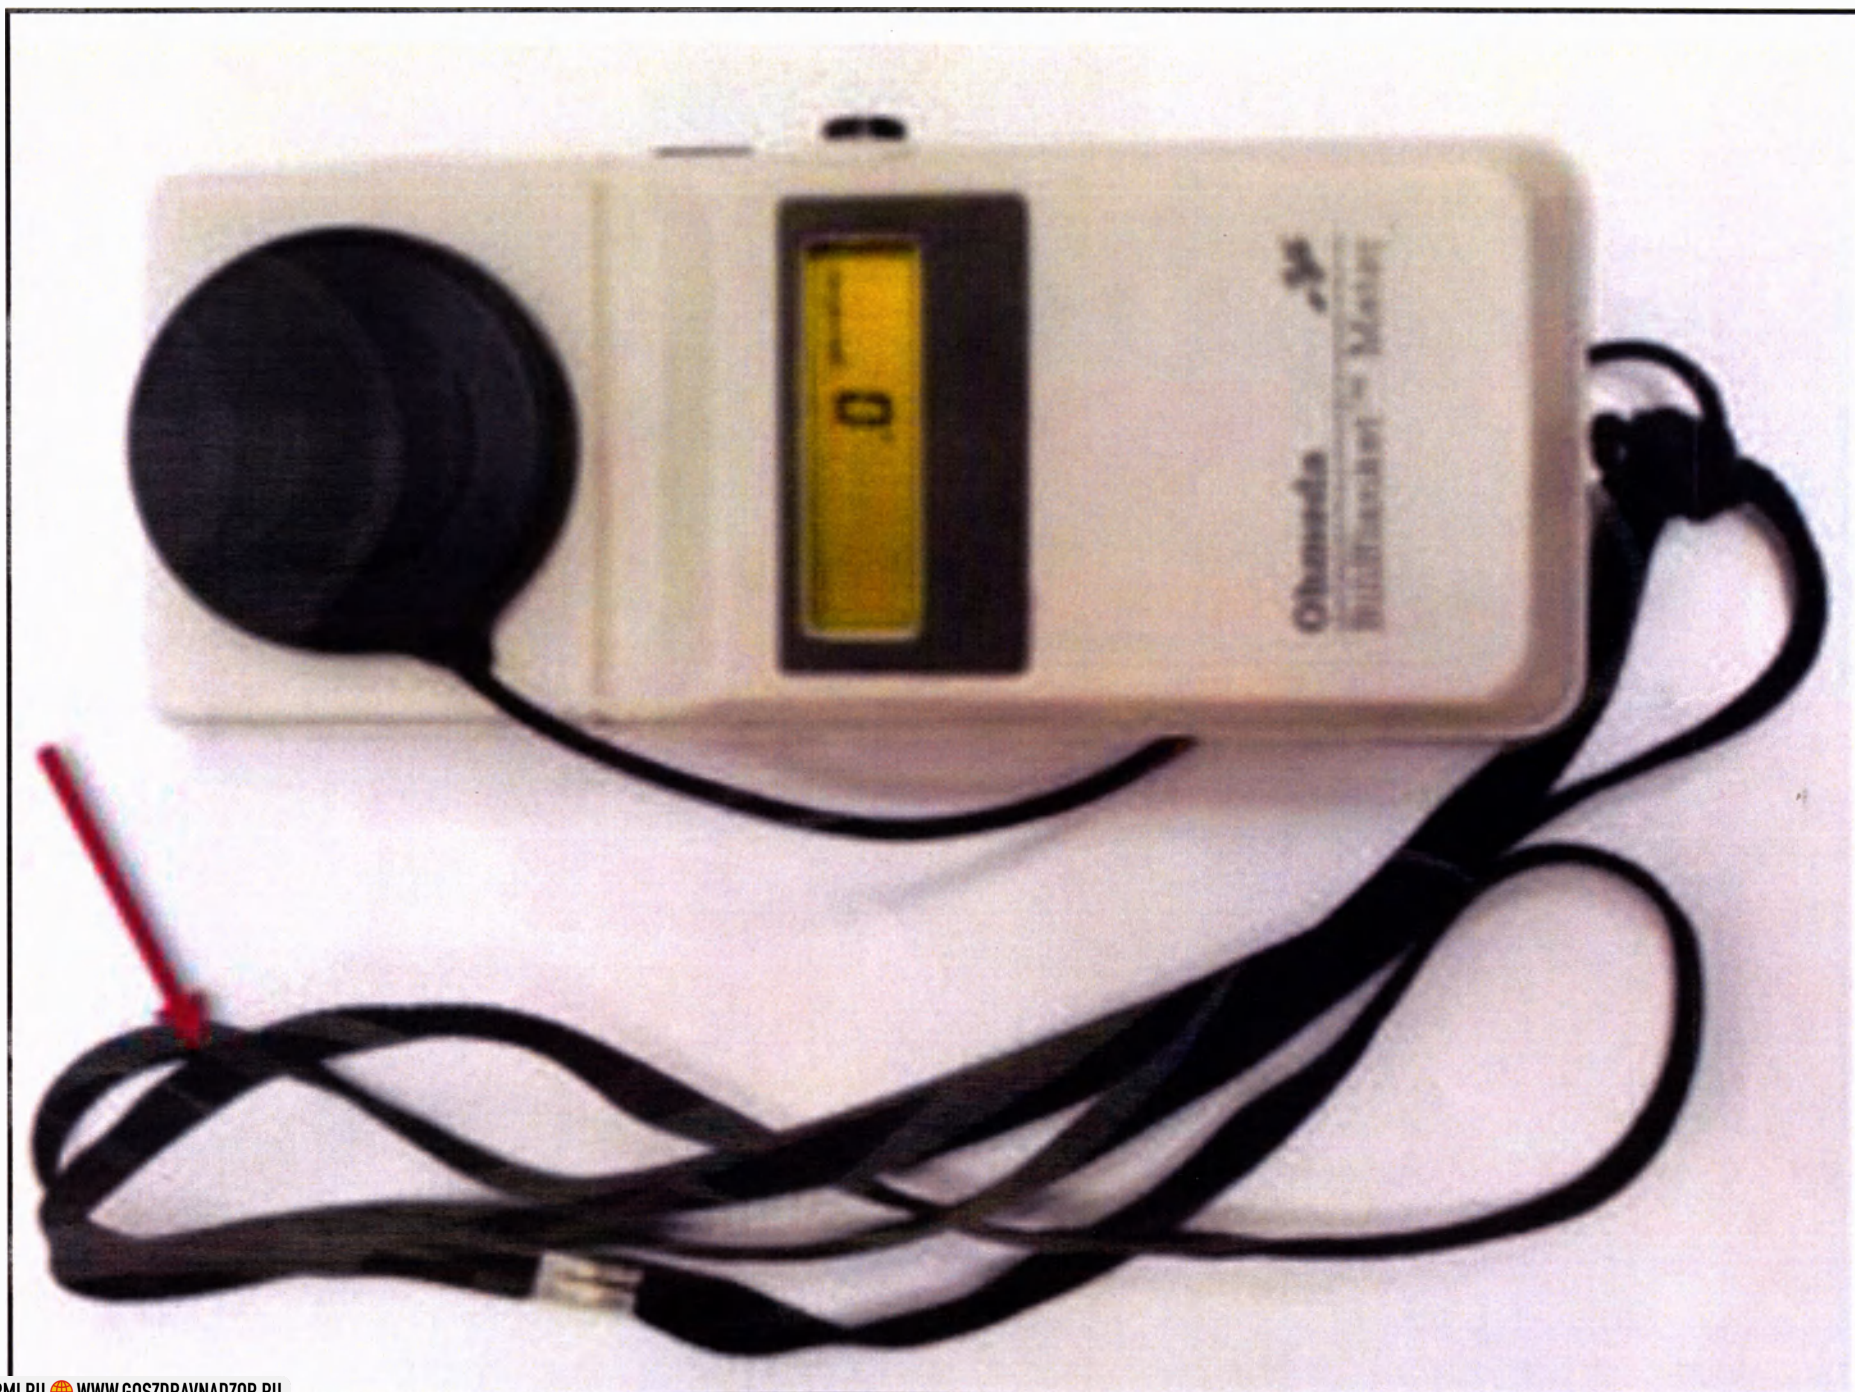

7. Сумка для переноски измерителя интенсивности светового излучения подушки (не более 10 шт.)

