

Фотографические изображения
медицинского изделия

Система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby Warmer с принадлежностями


I. Система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby Warmer: 1. Система открытая реанимационная Lullaby Warmer.



GE Healthcare


Система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby™ Warmer

Руководство по эксплуатации
и техническому обслуживанию

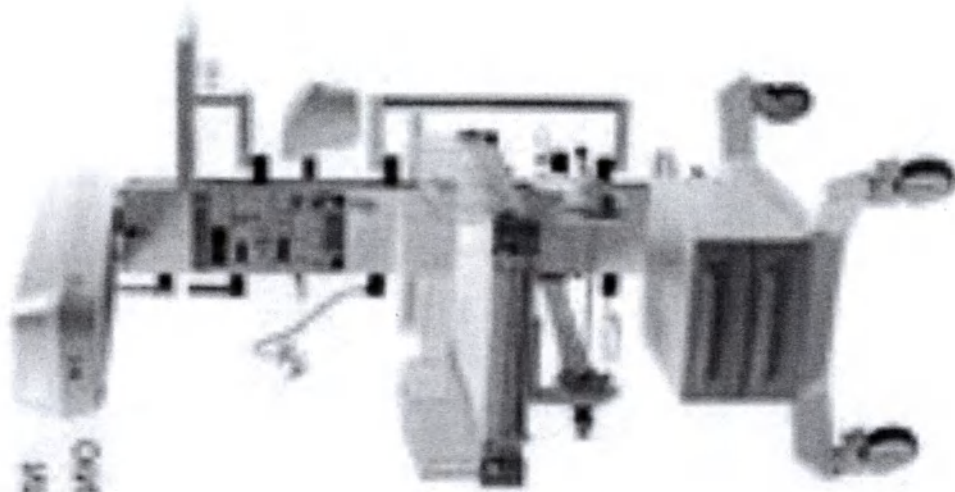


Система открытая реанимационная для
новорожденных Lullaby™ Warmer
Руководство по эксплуатации
и техническому обслуживанию
GE Healthcare (Russia)
P04C1309-0013
Авг. 11.


II. Принадлежности: 1. Устройство управления с дисплеем, панелью управления.

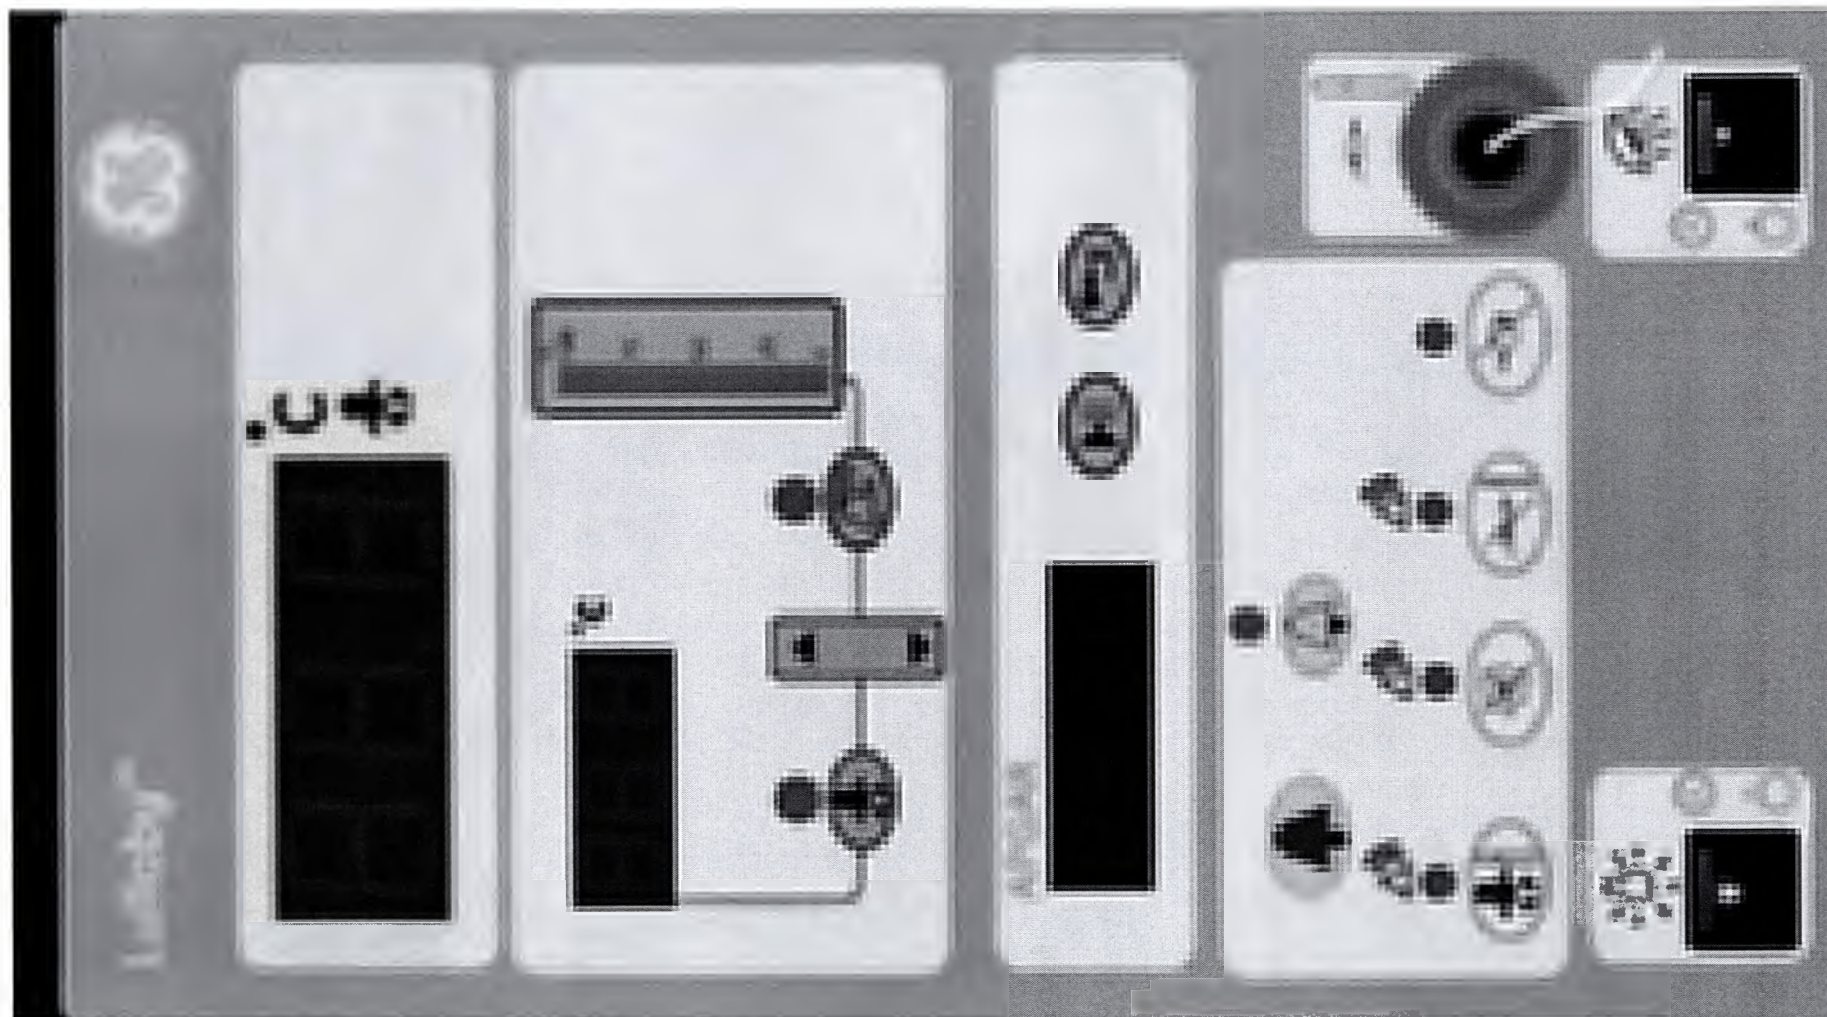


2. Нагревательные элементы с кабелями подключения (не более 5 шт.).

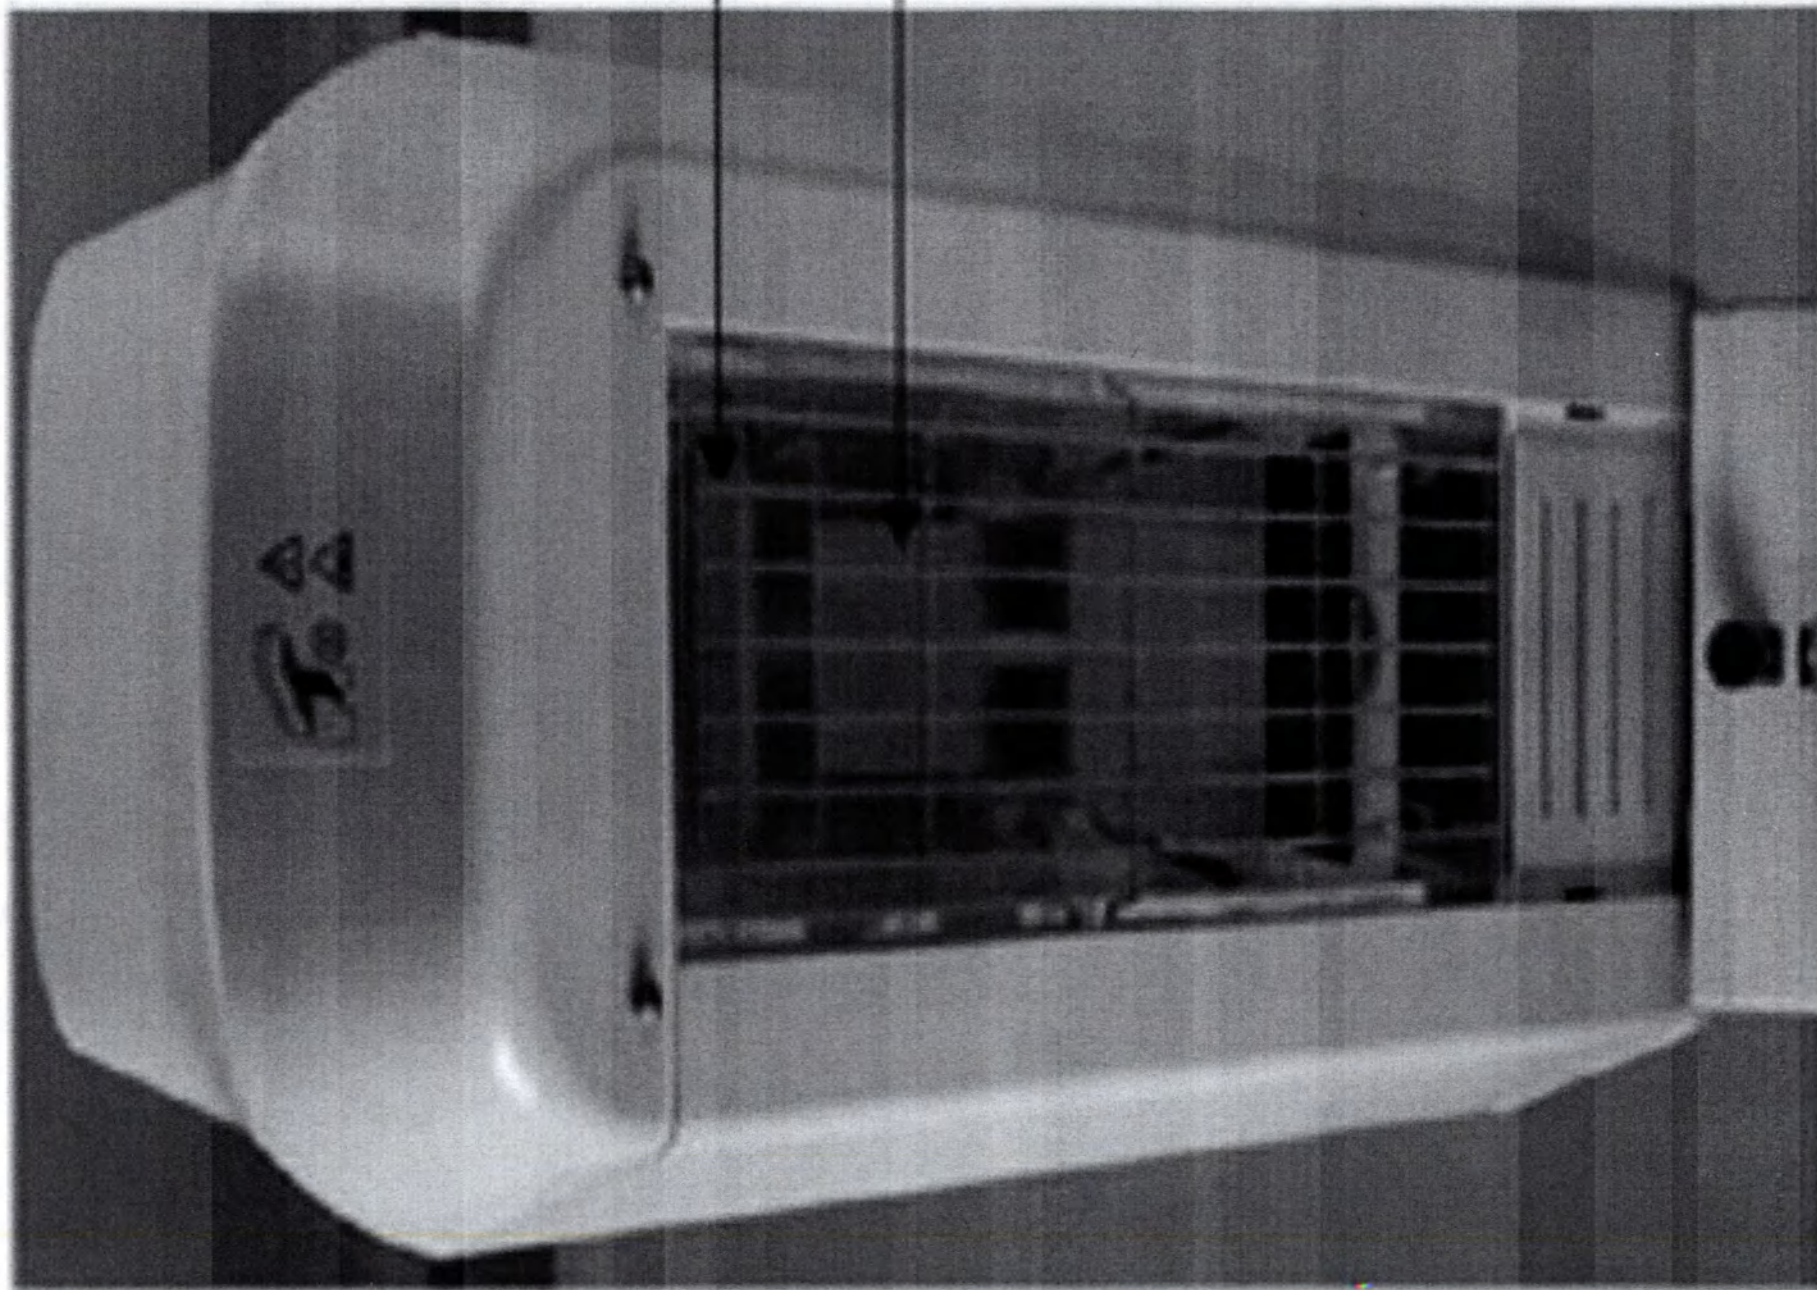


3. Панель для подключения датчиков.

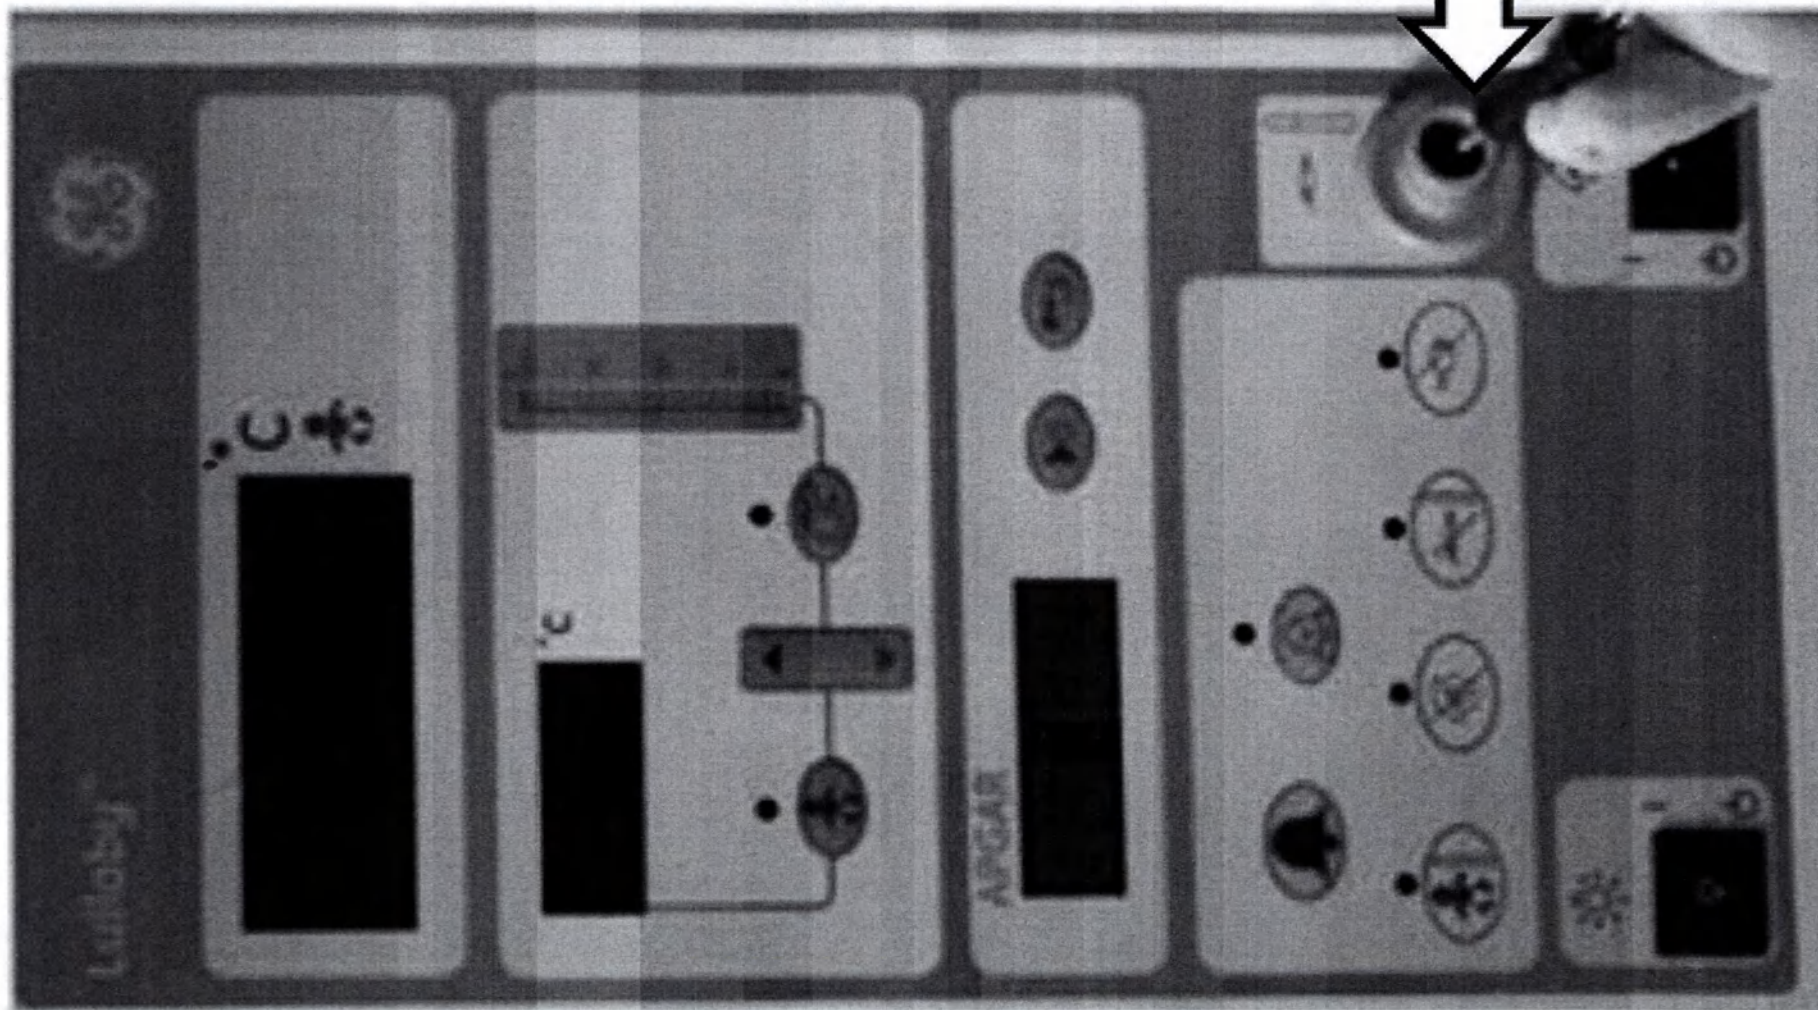


4. Направляющая для приборов.

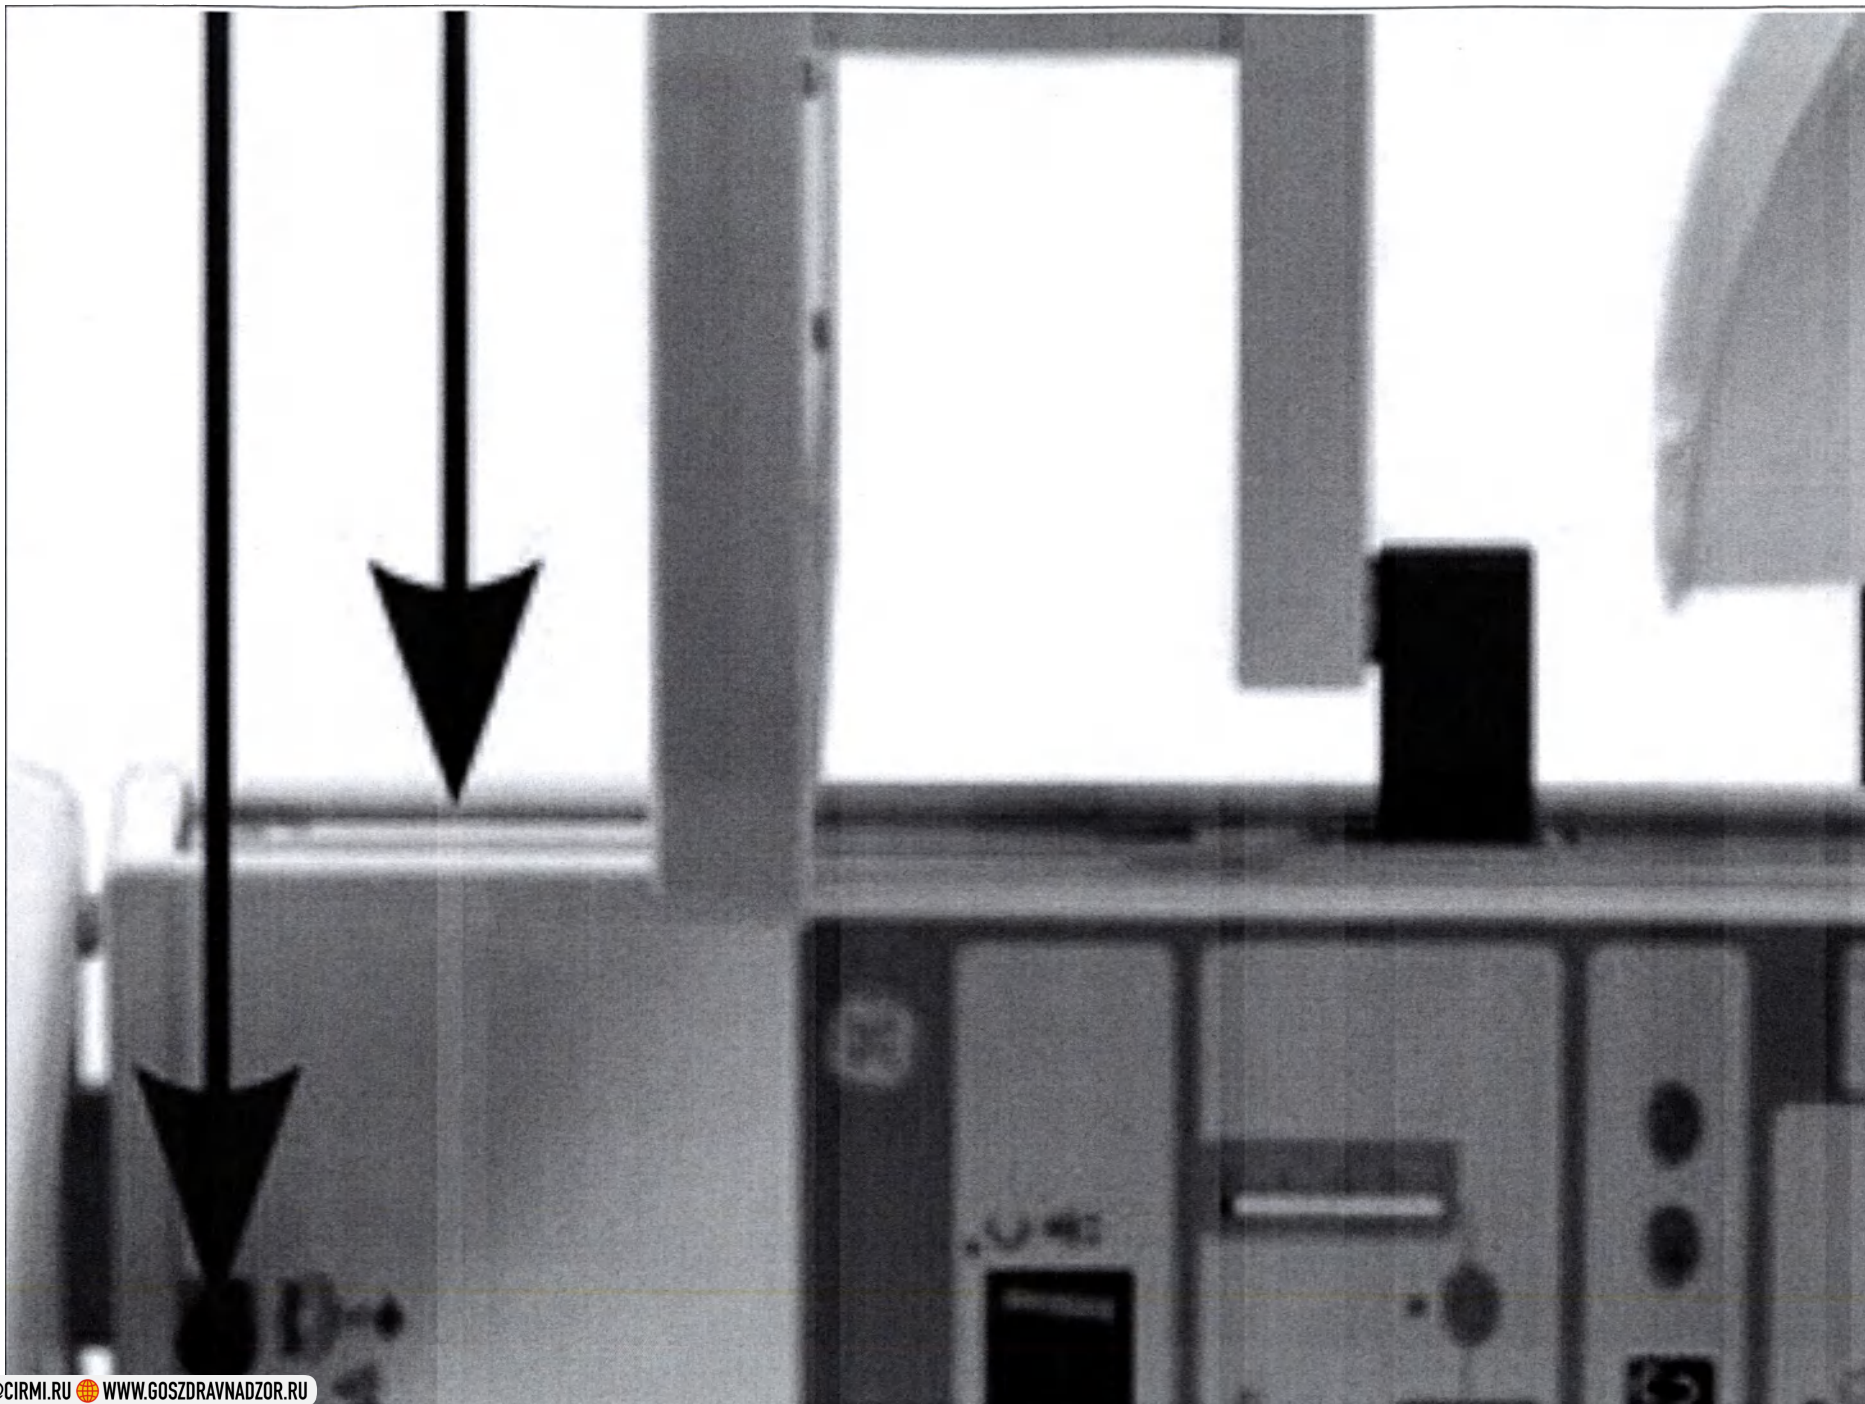


5. Рельса для крепления дополнительного медицинского оборудования.

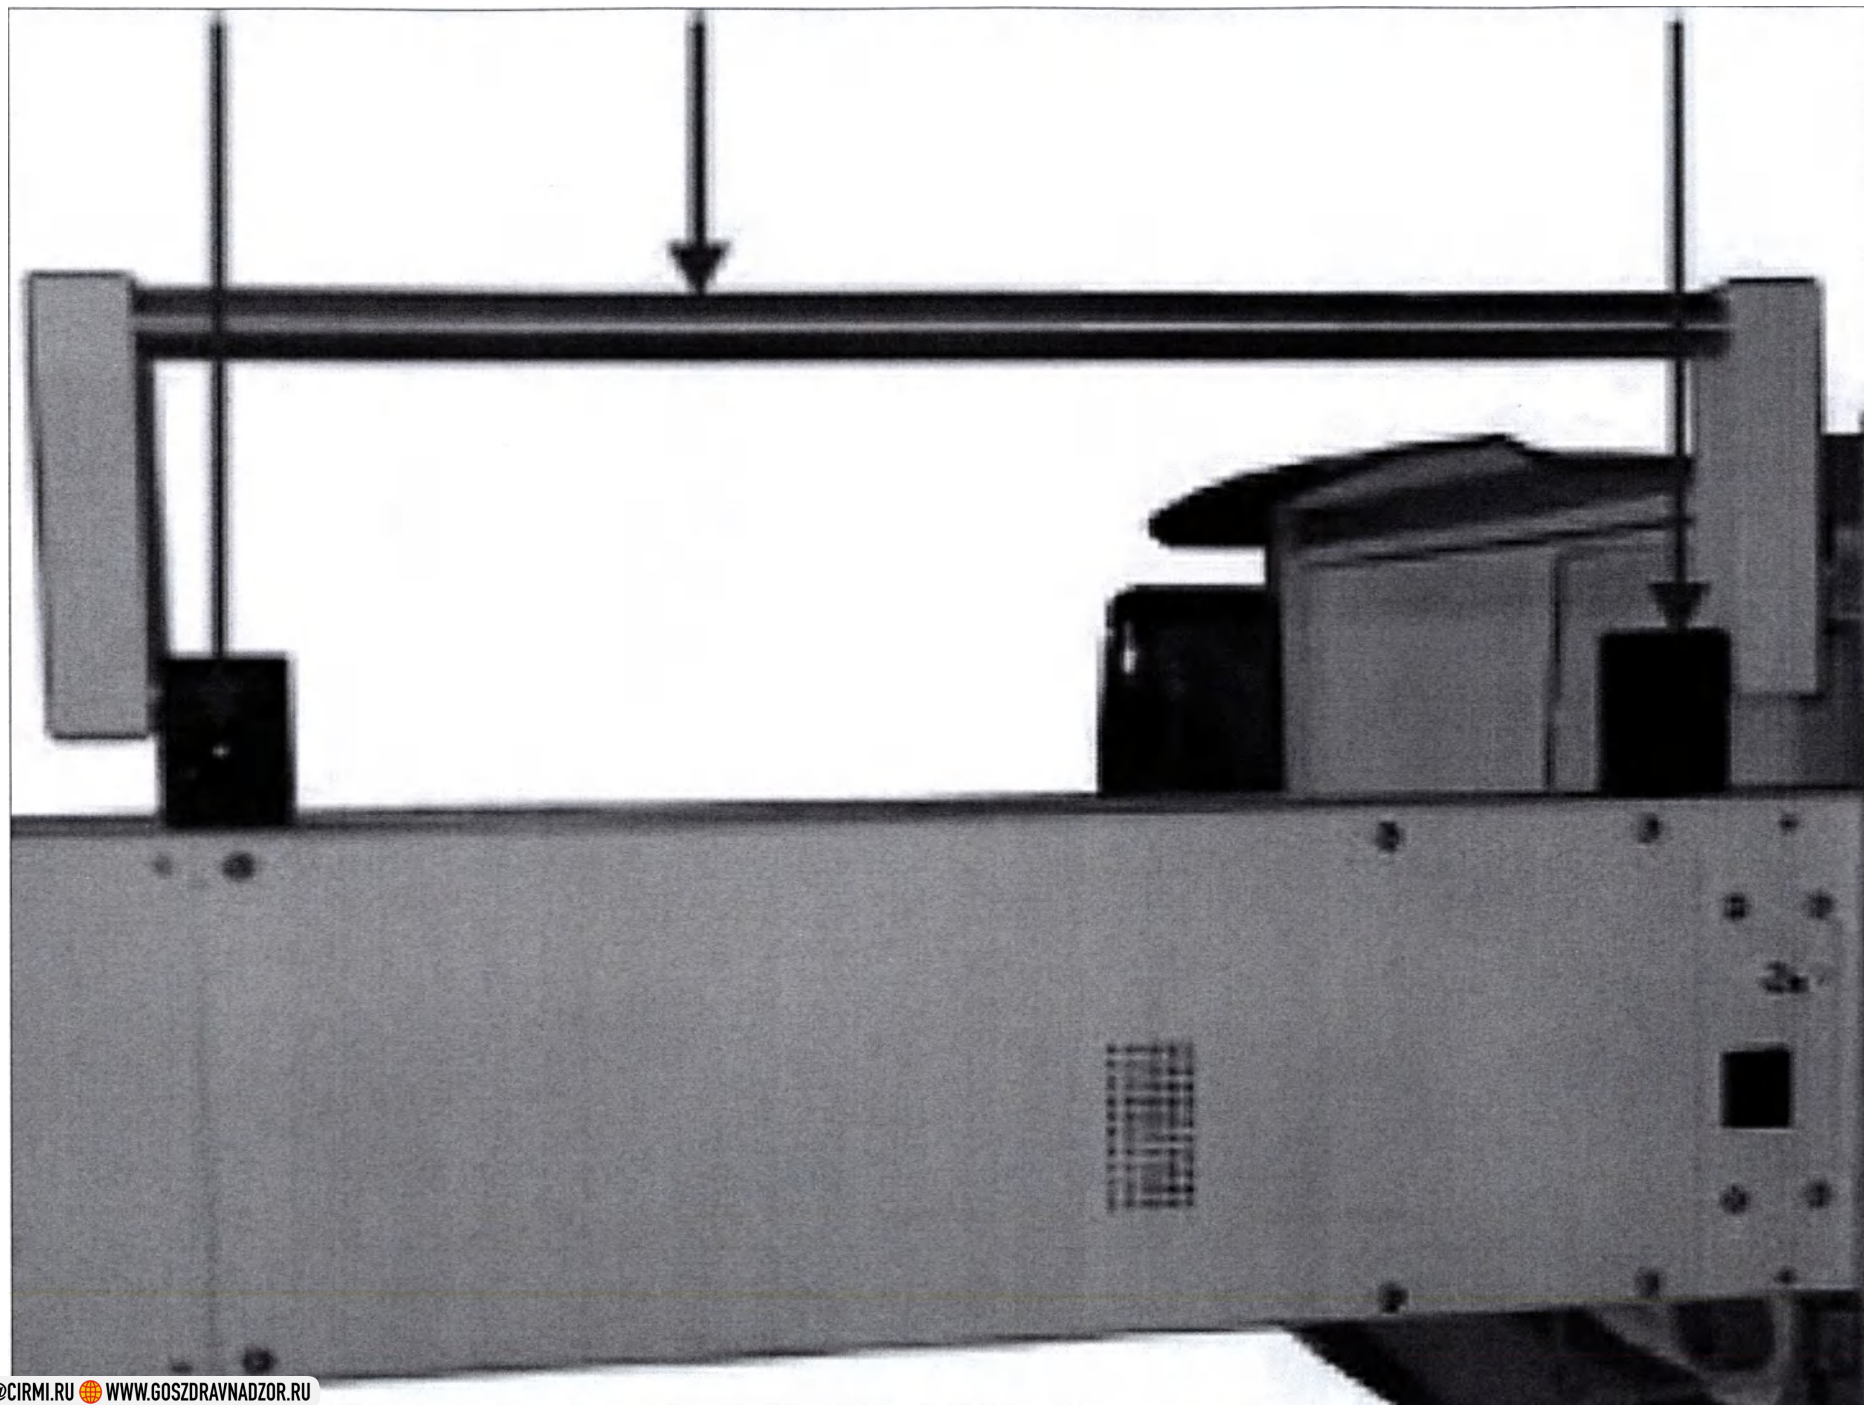


6. Крепежи (не более 5 шт.).

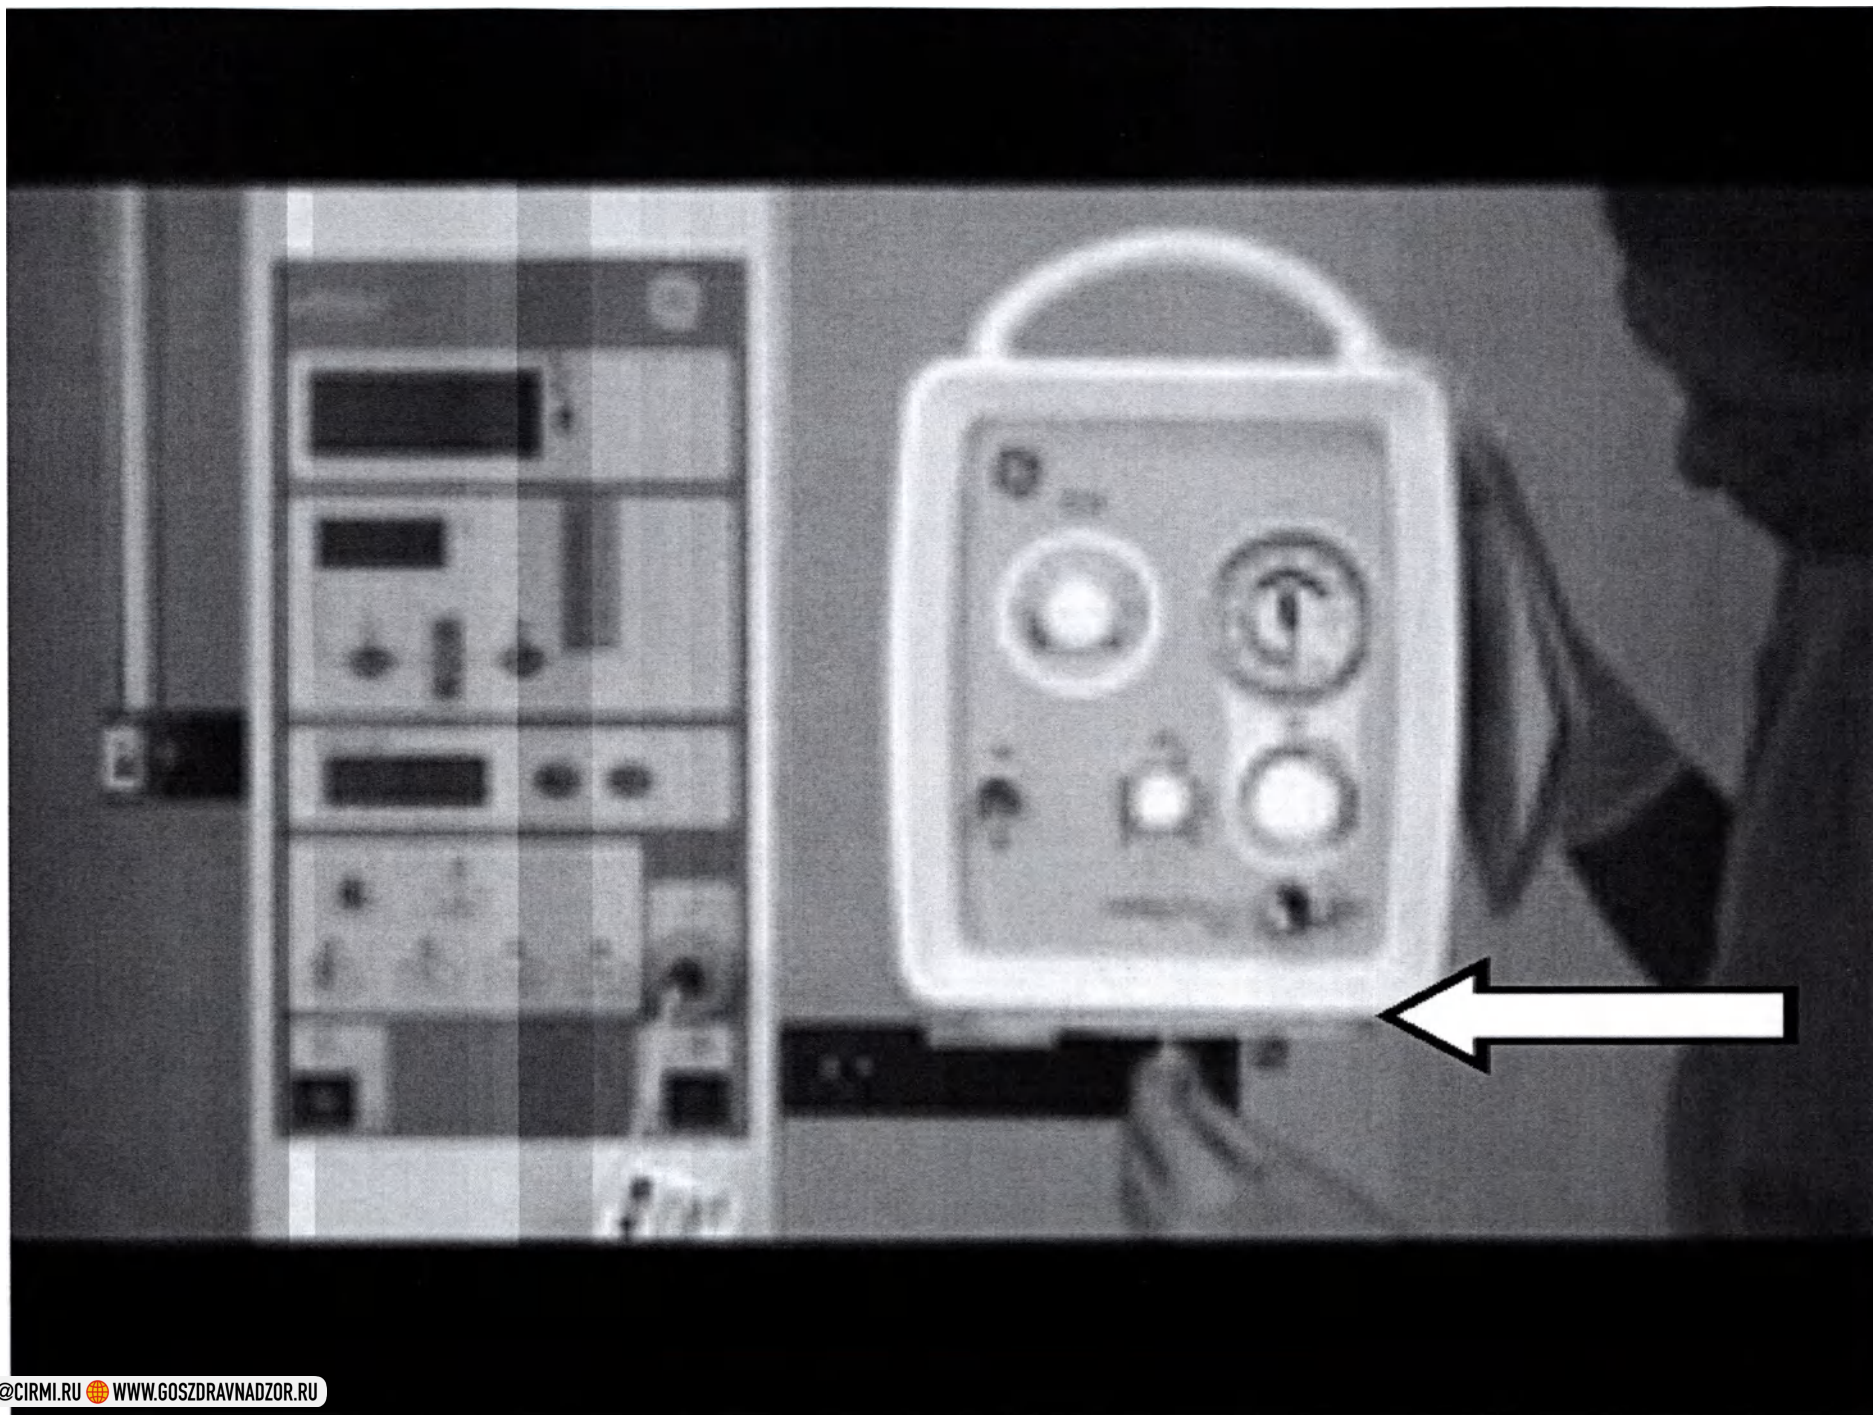


7. Держатели (не более 10 шт.).

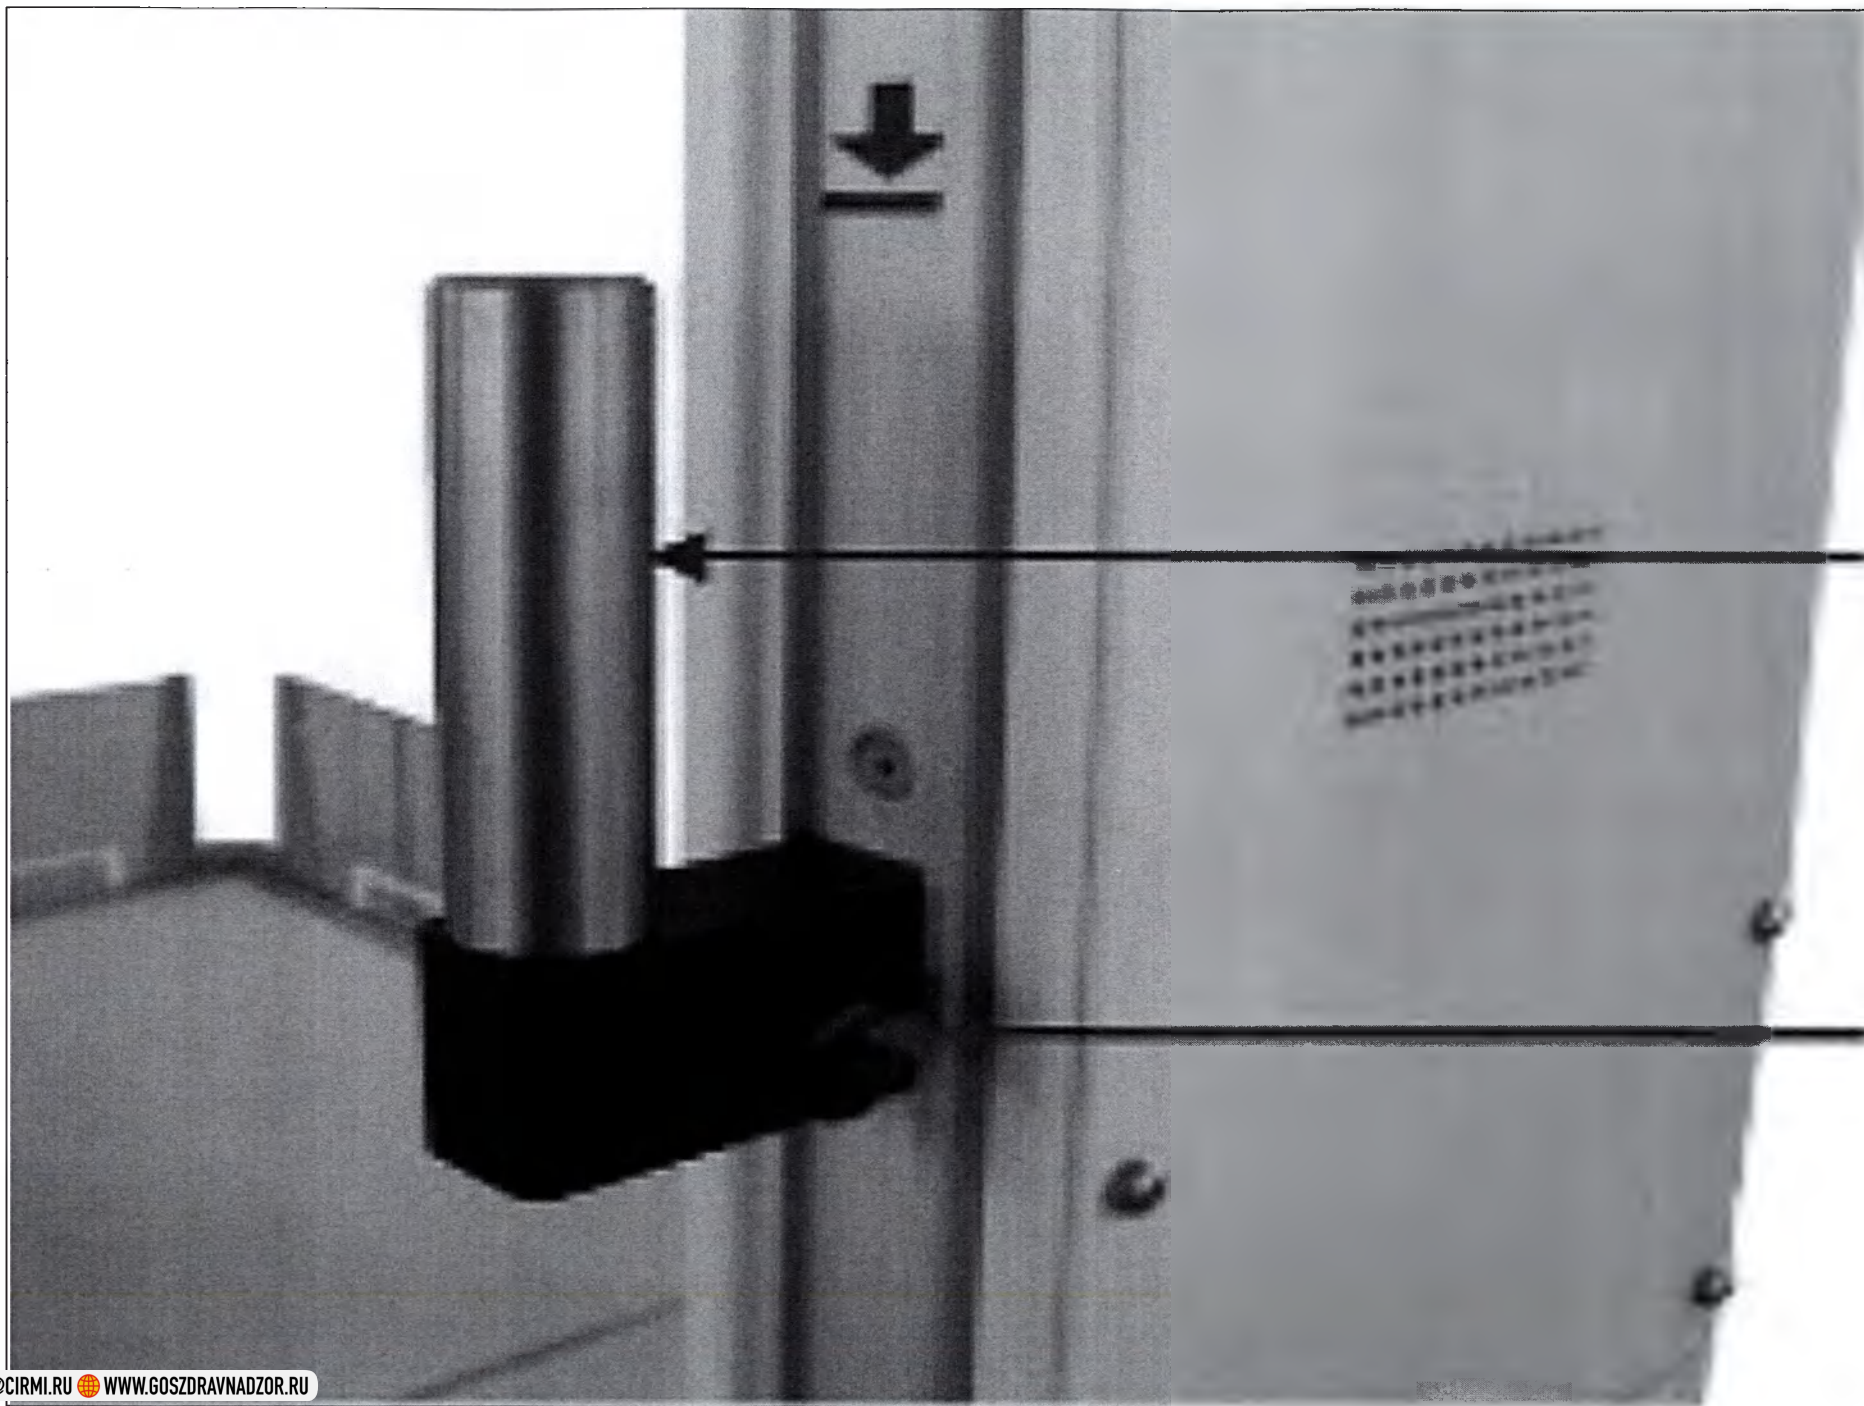


8. Крепежи для трубок (не более 10 шт.).

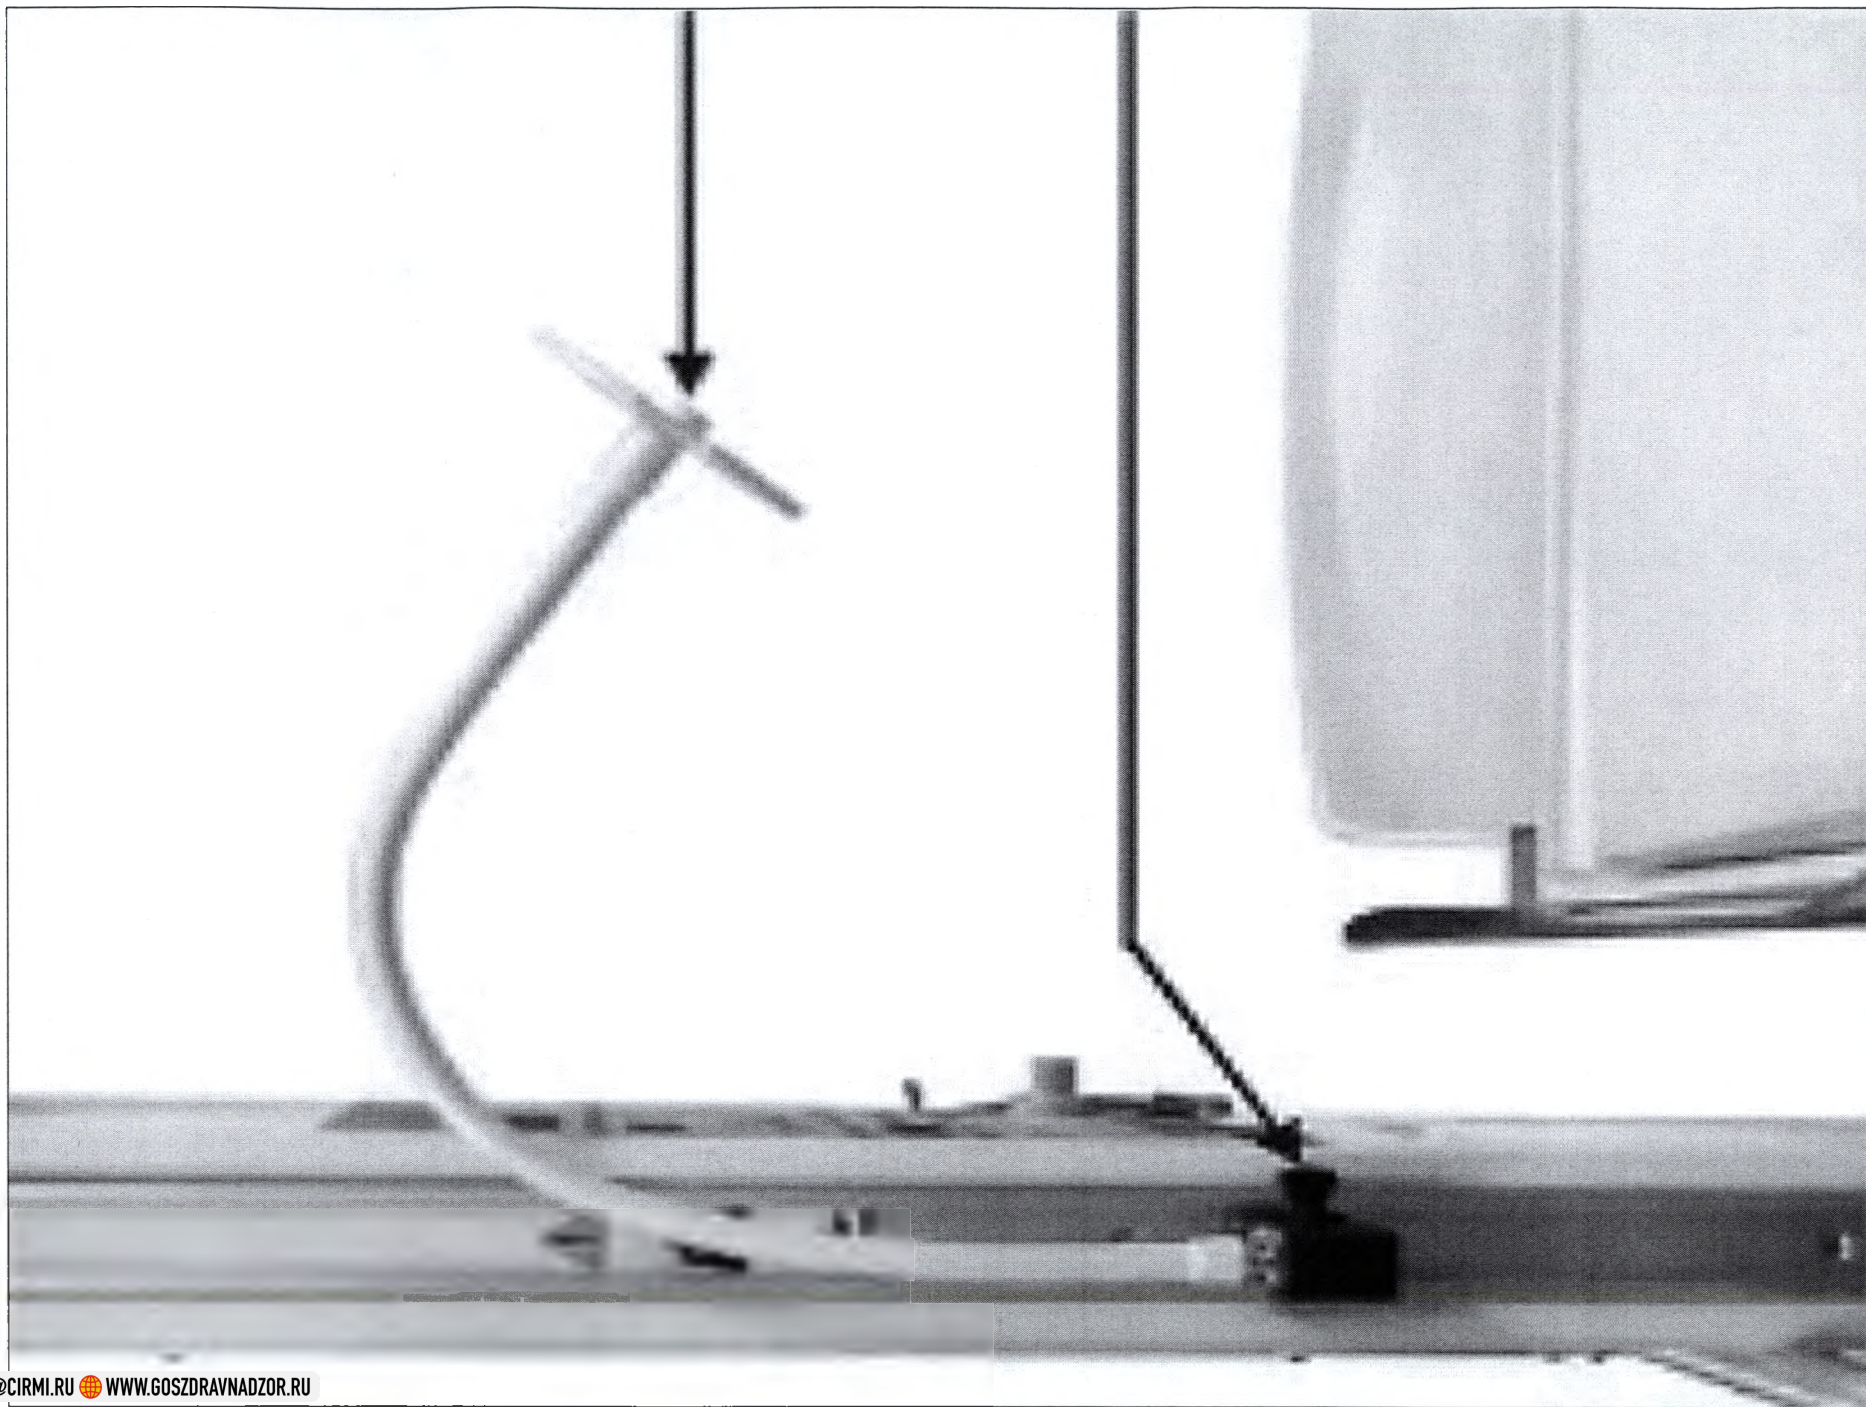


8. Крепежи для трубок (не более 10 шт.).

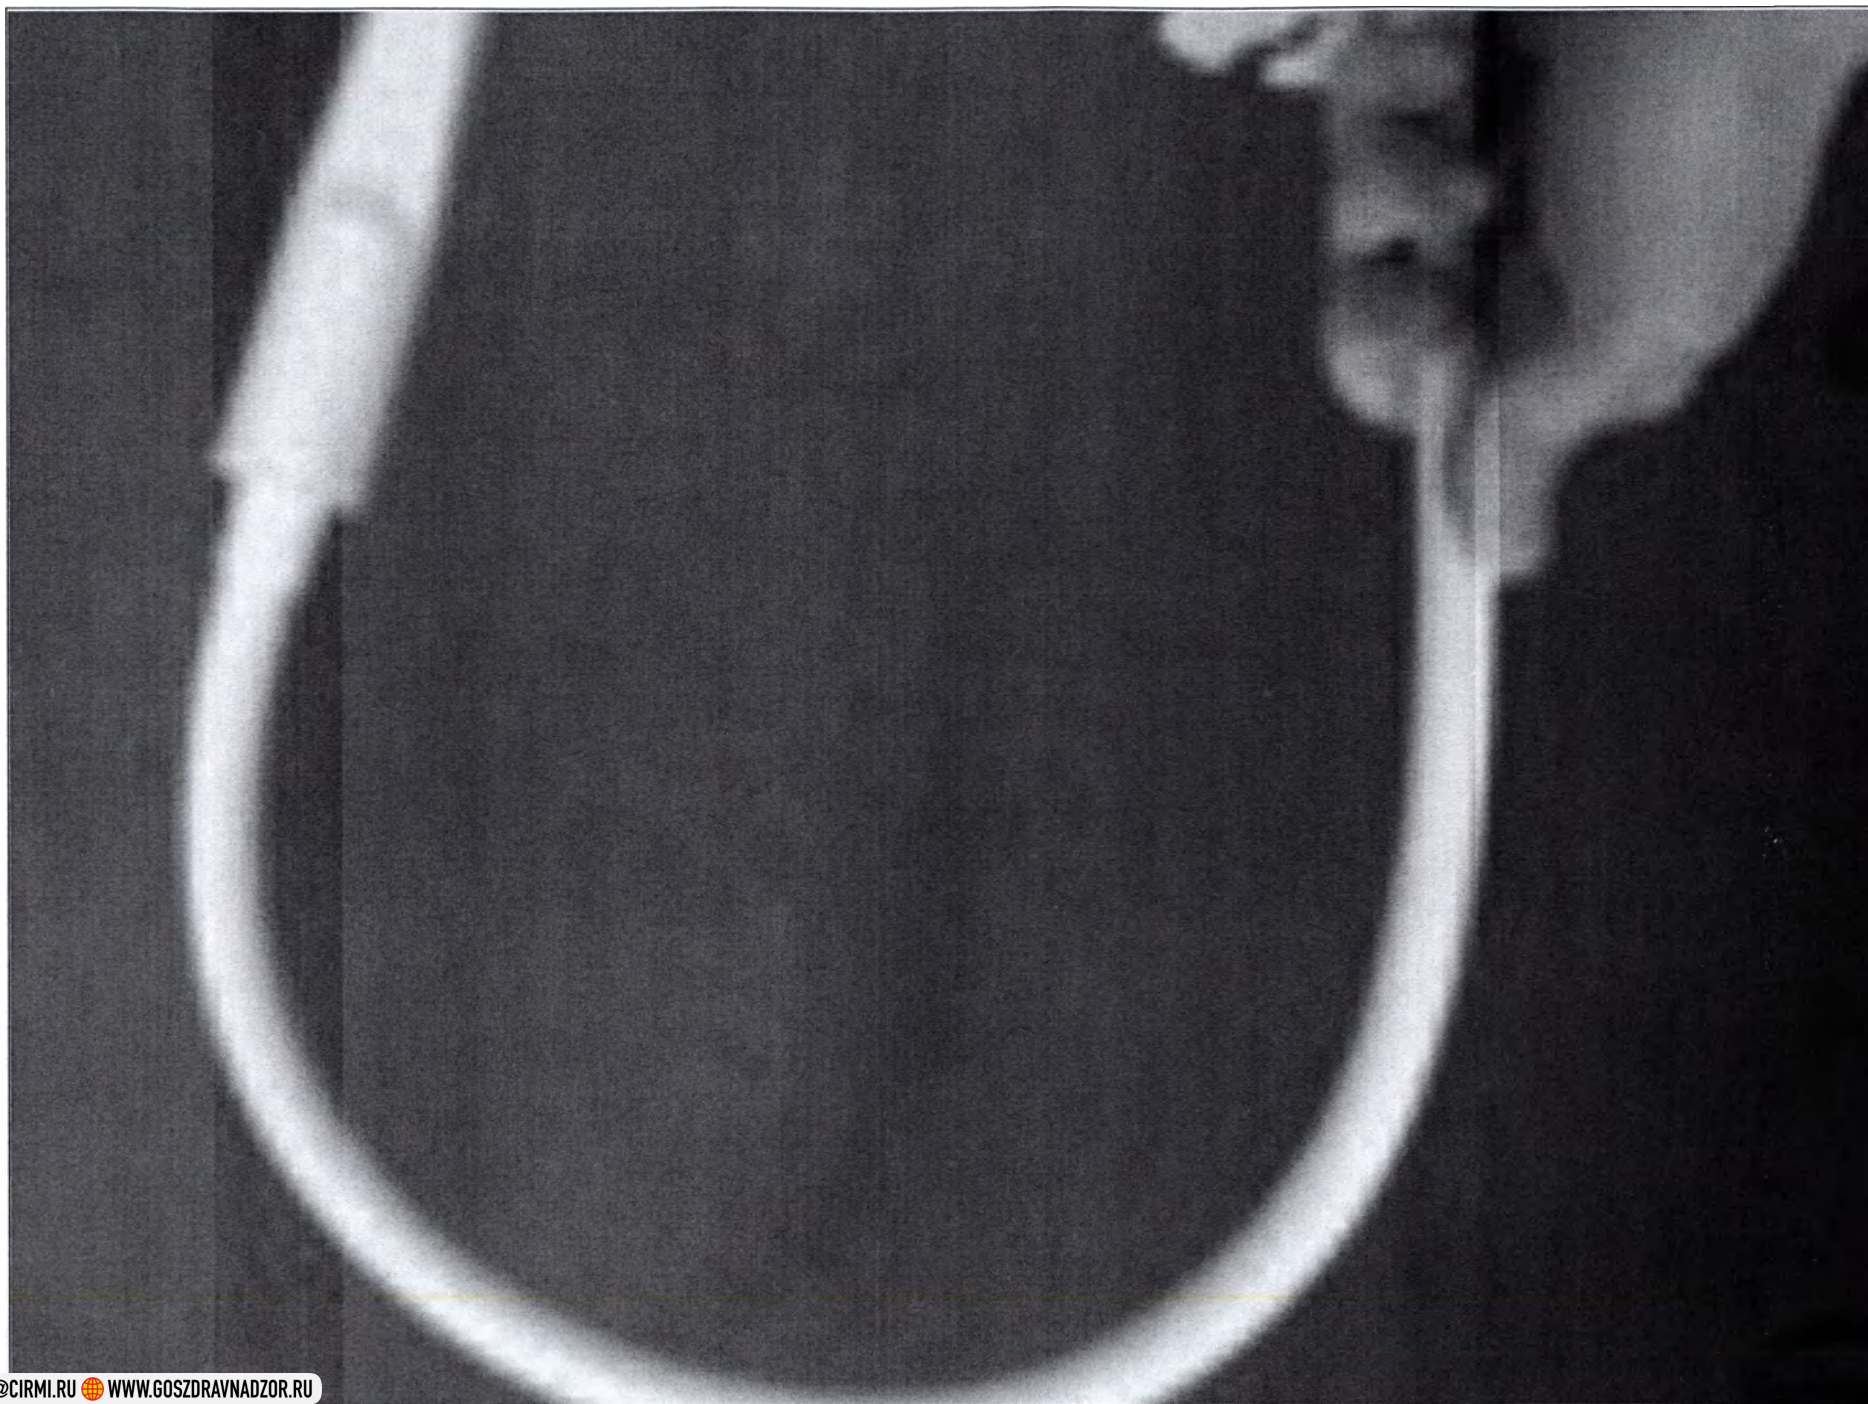


9. Крепежи для газовых баллонов (не более 10 шт.).

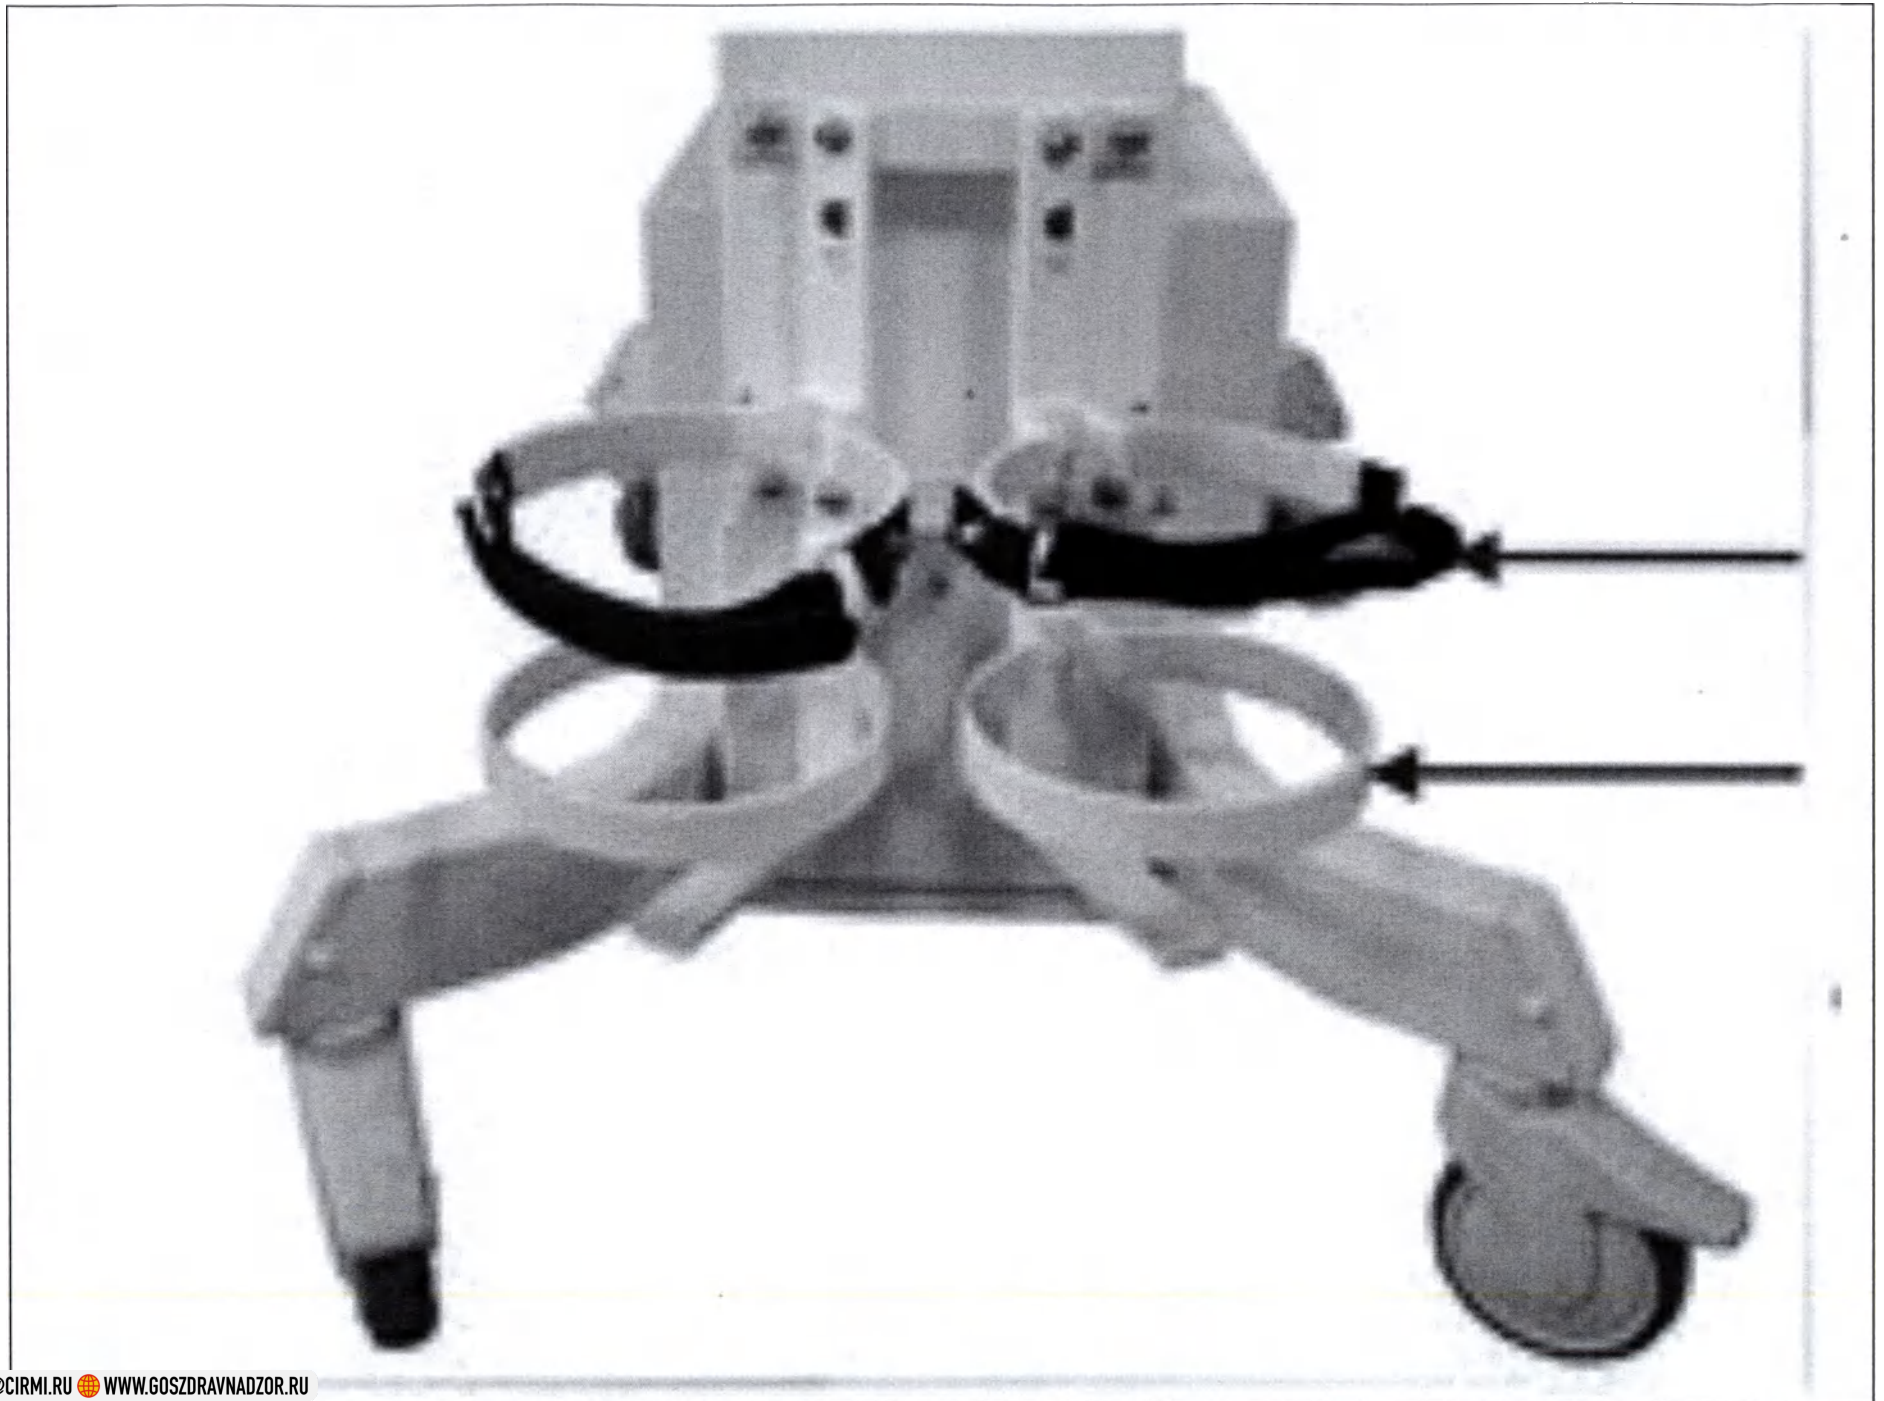


9. Крепежи для газовых баллонов (не более 10 шт.).

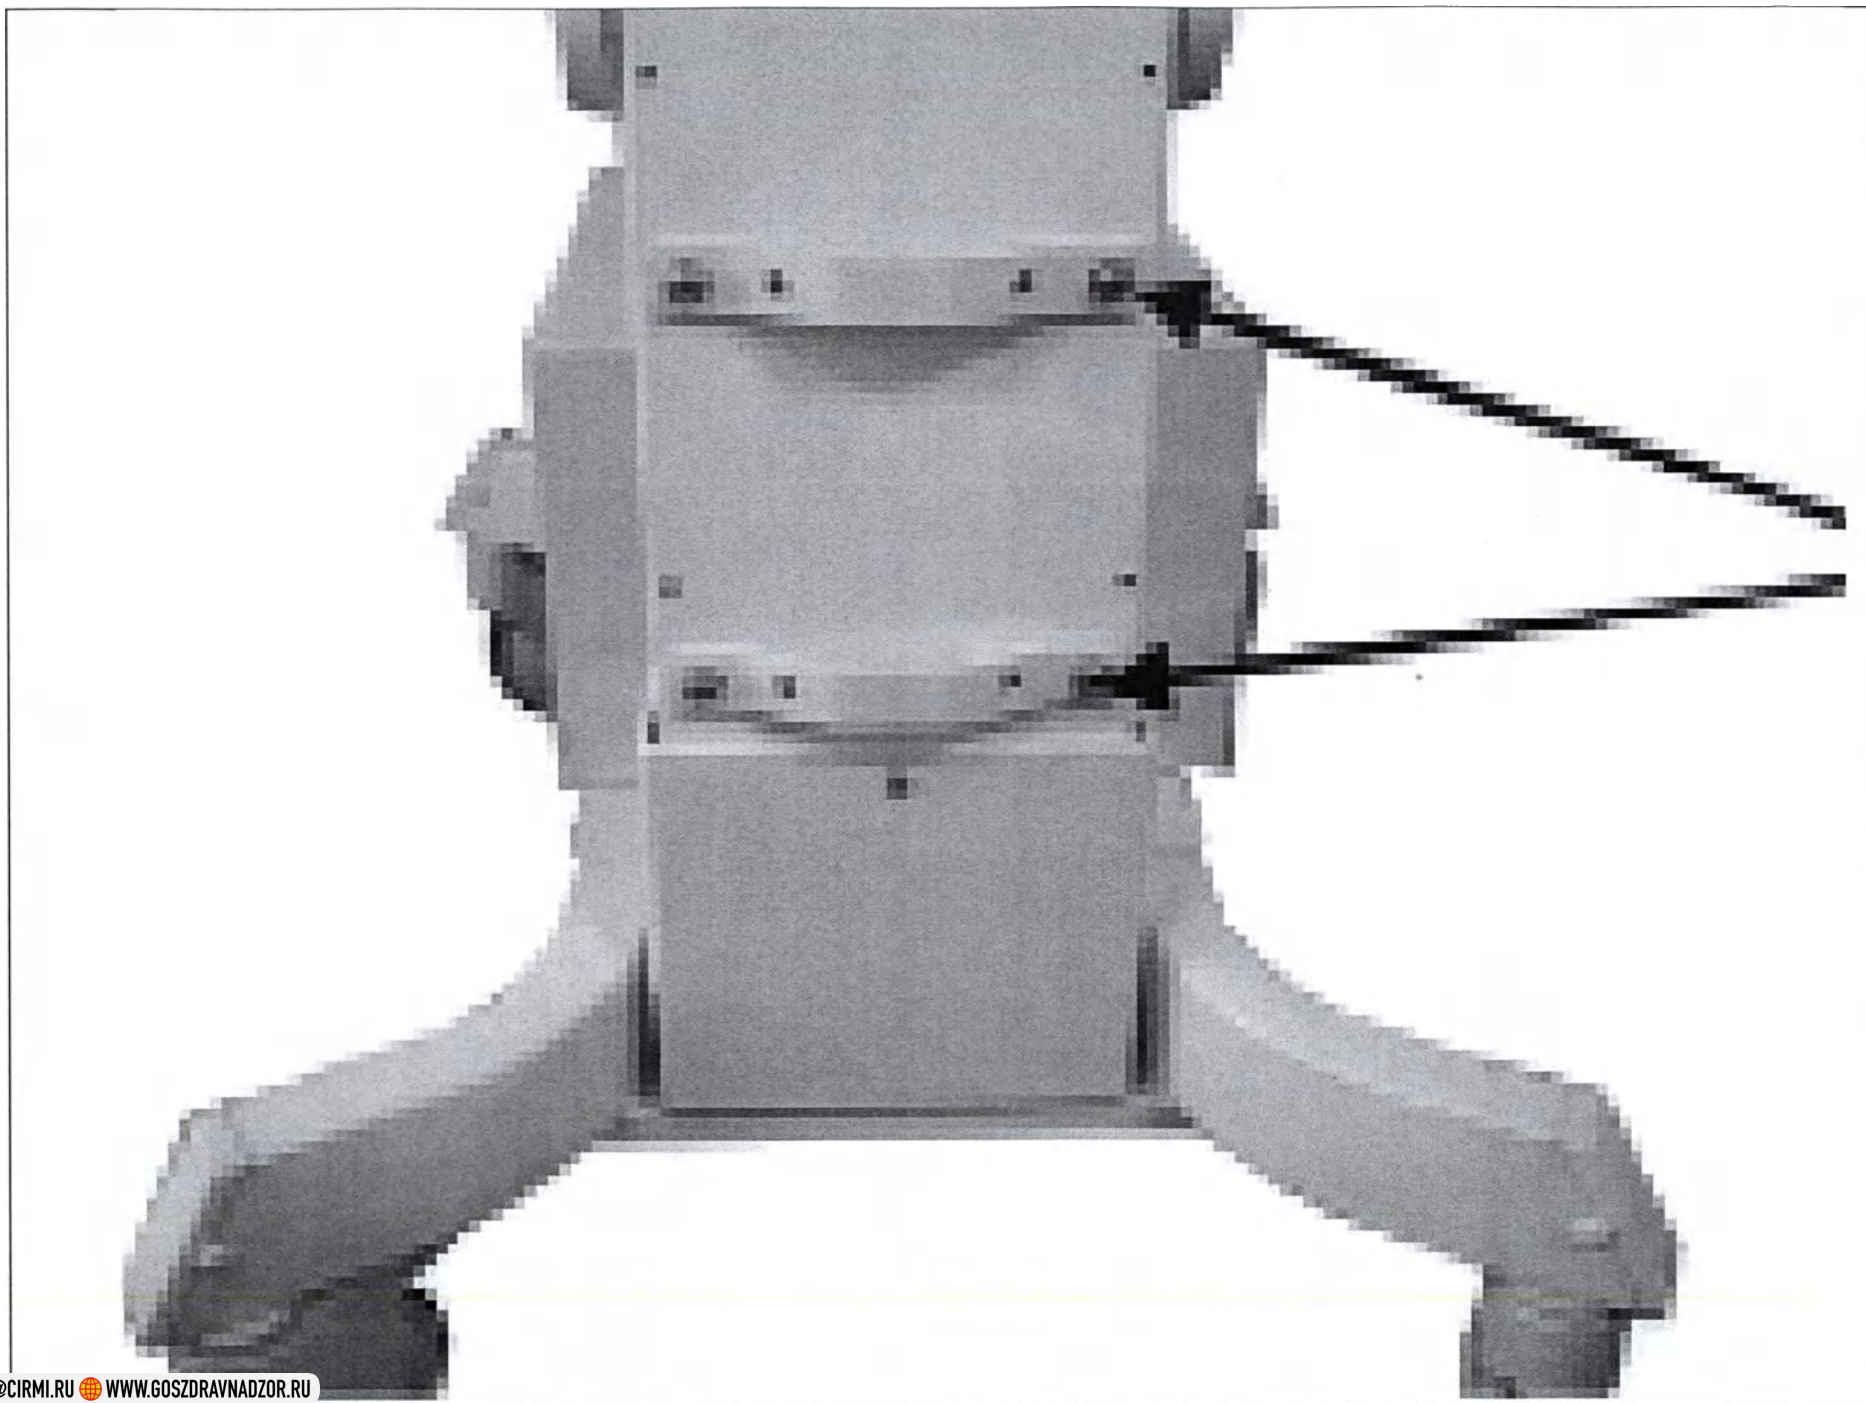


10. Крепежи для приборов (не более 10 шт.).

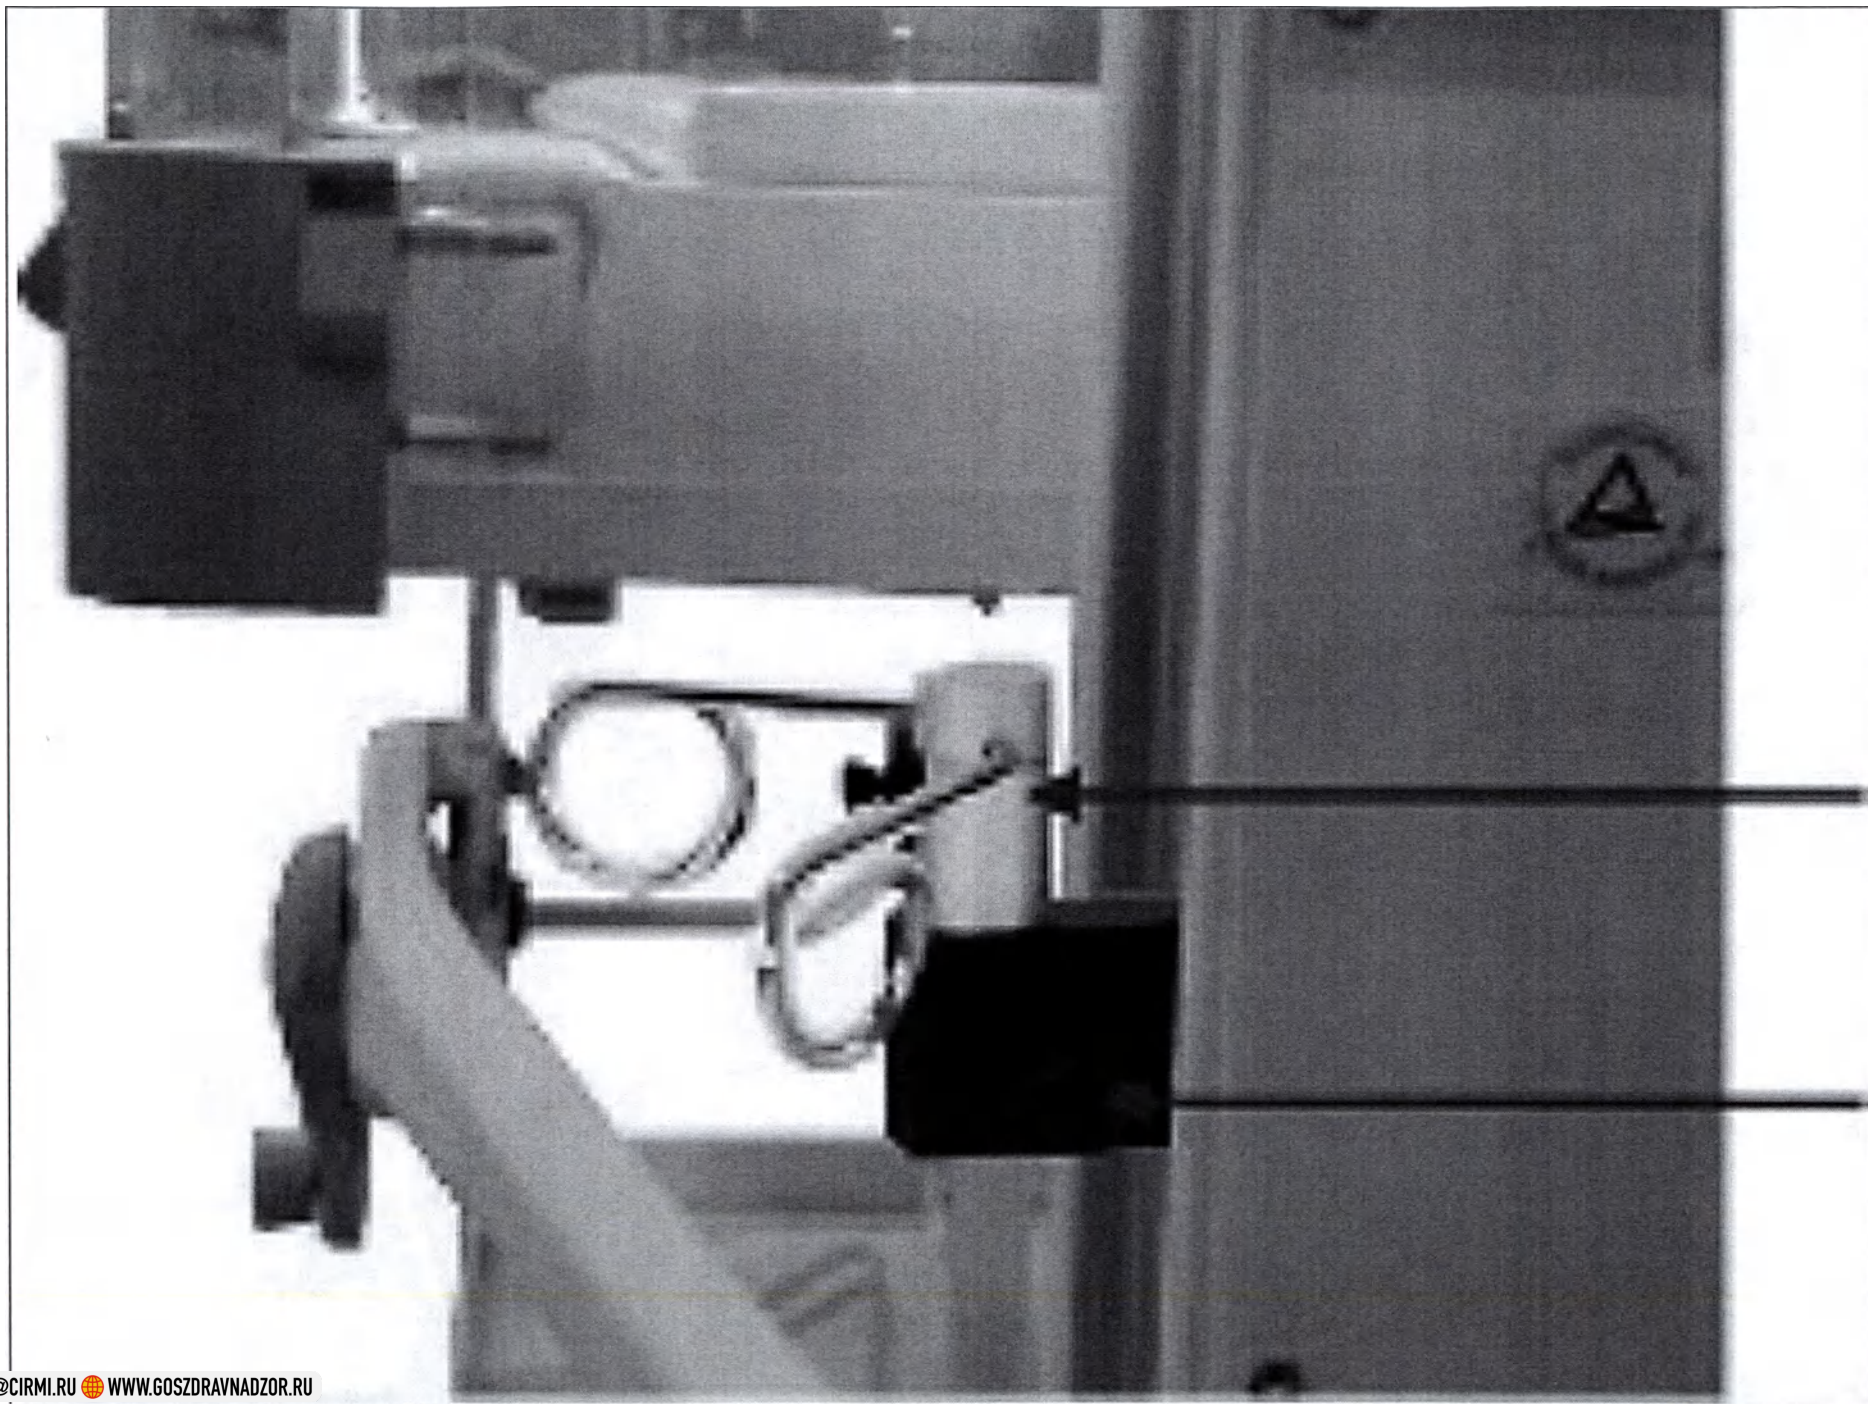


11. Стойка на колесах с фиксированным основанием.

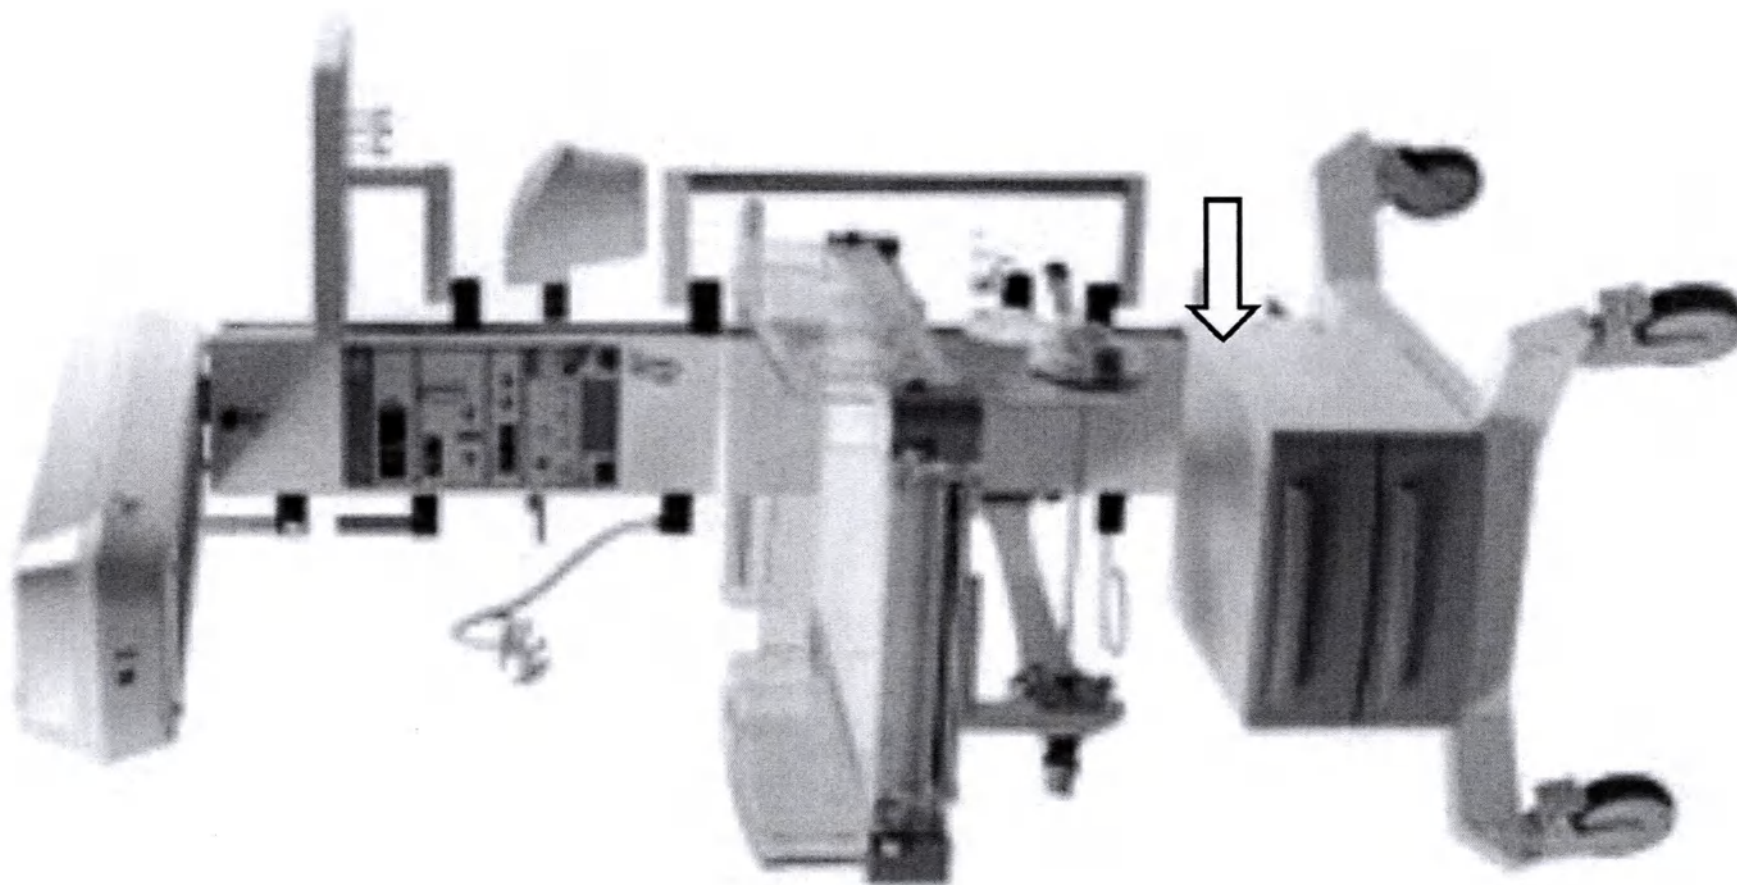

12. Стойка на колесах с подъемным механизмом.

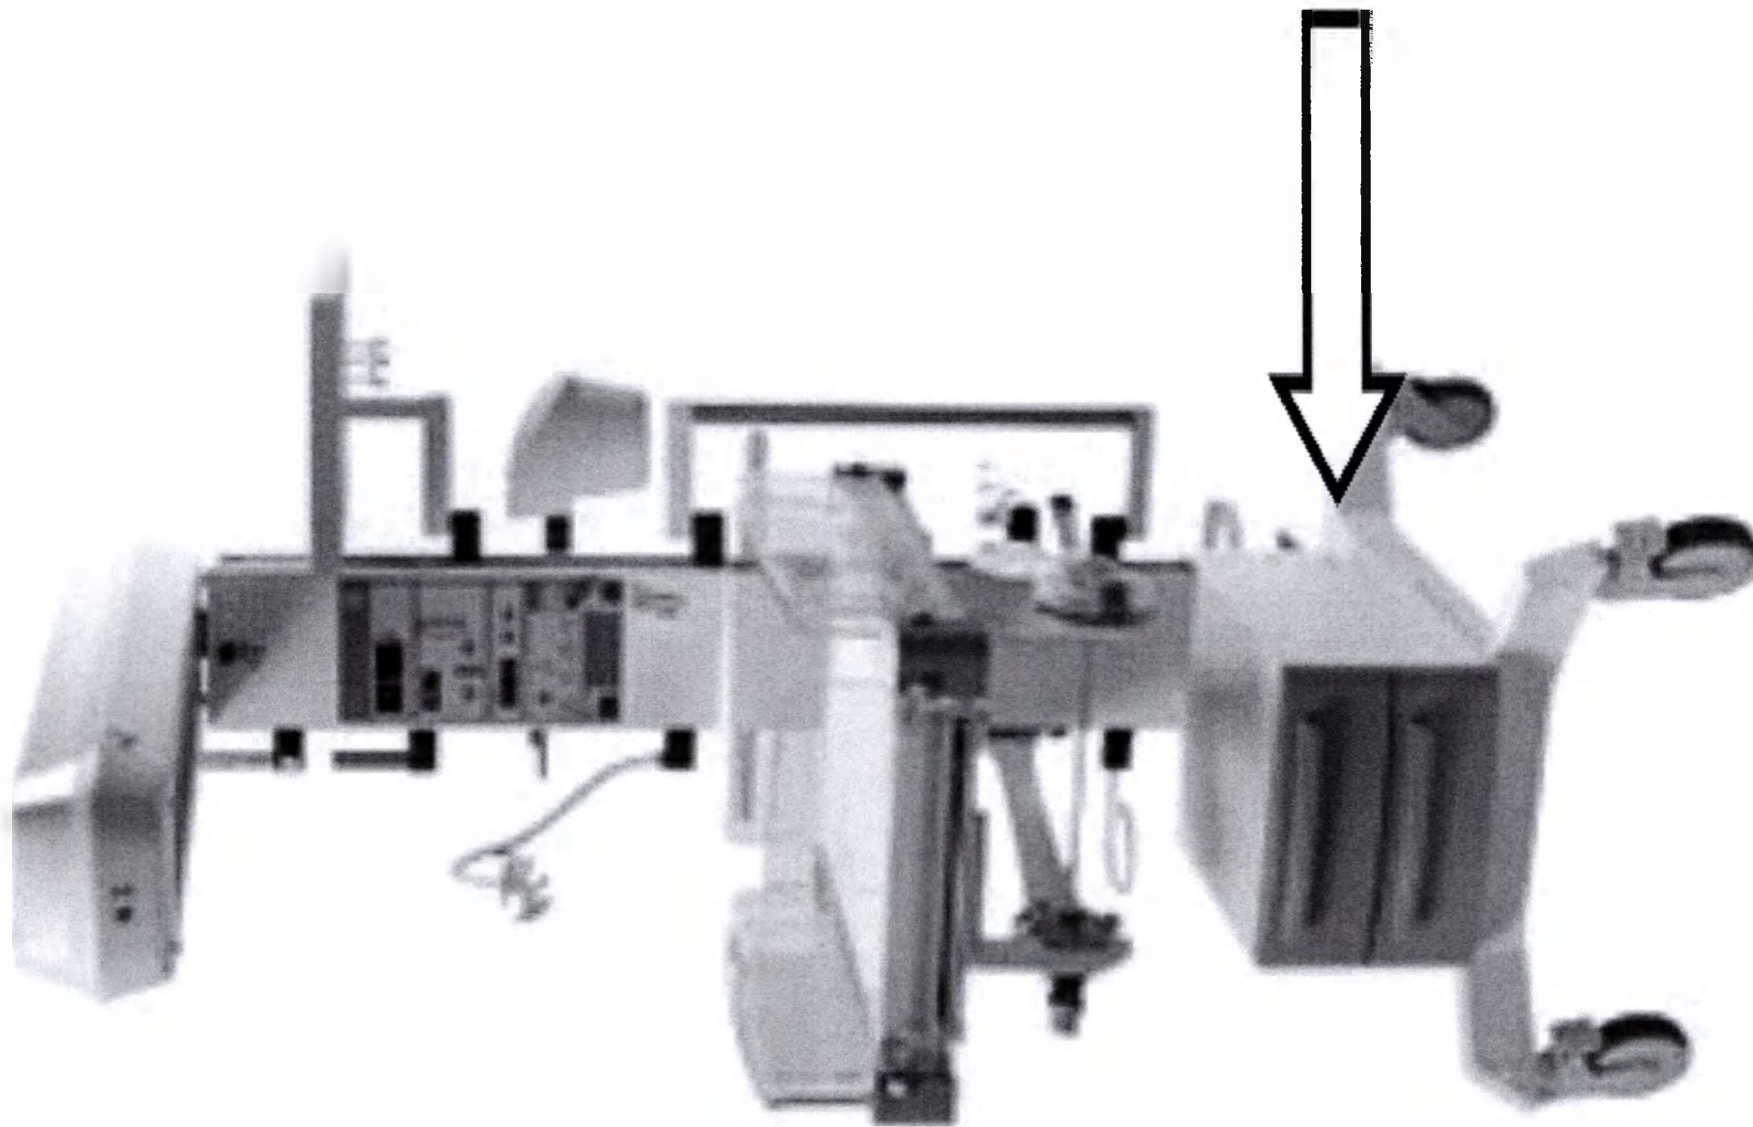

13. Панели для ложа пациента (не более 5 шт.).

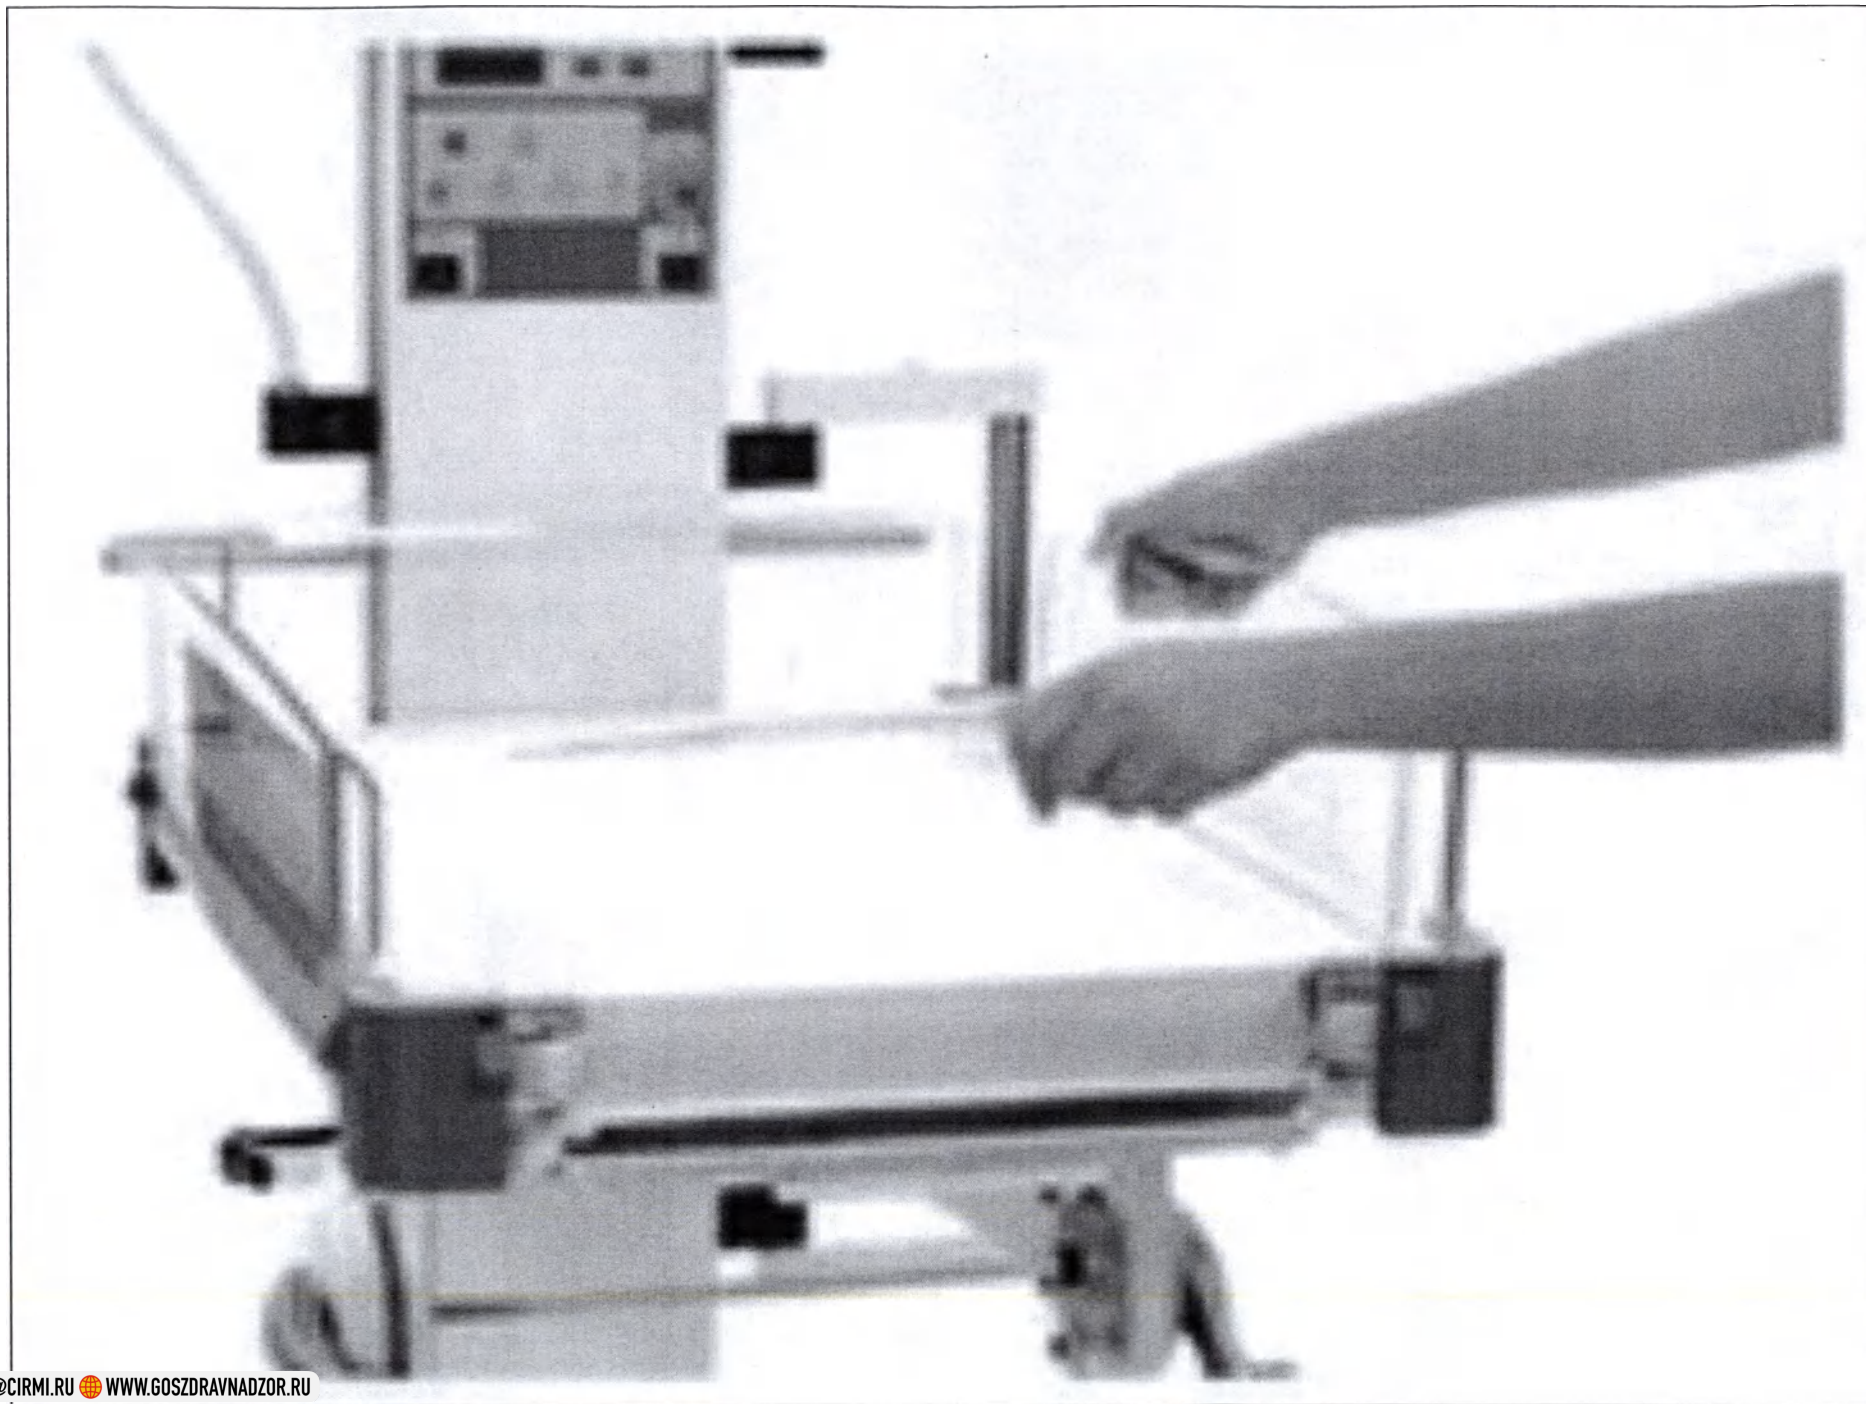


14. Матрасики (не более 5 шт.).




15. Защитные покрывала (не более 5 шт.).




16. Защитные чехлы для матрасиков (не более 5 шт.).

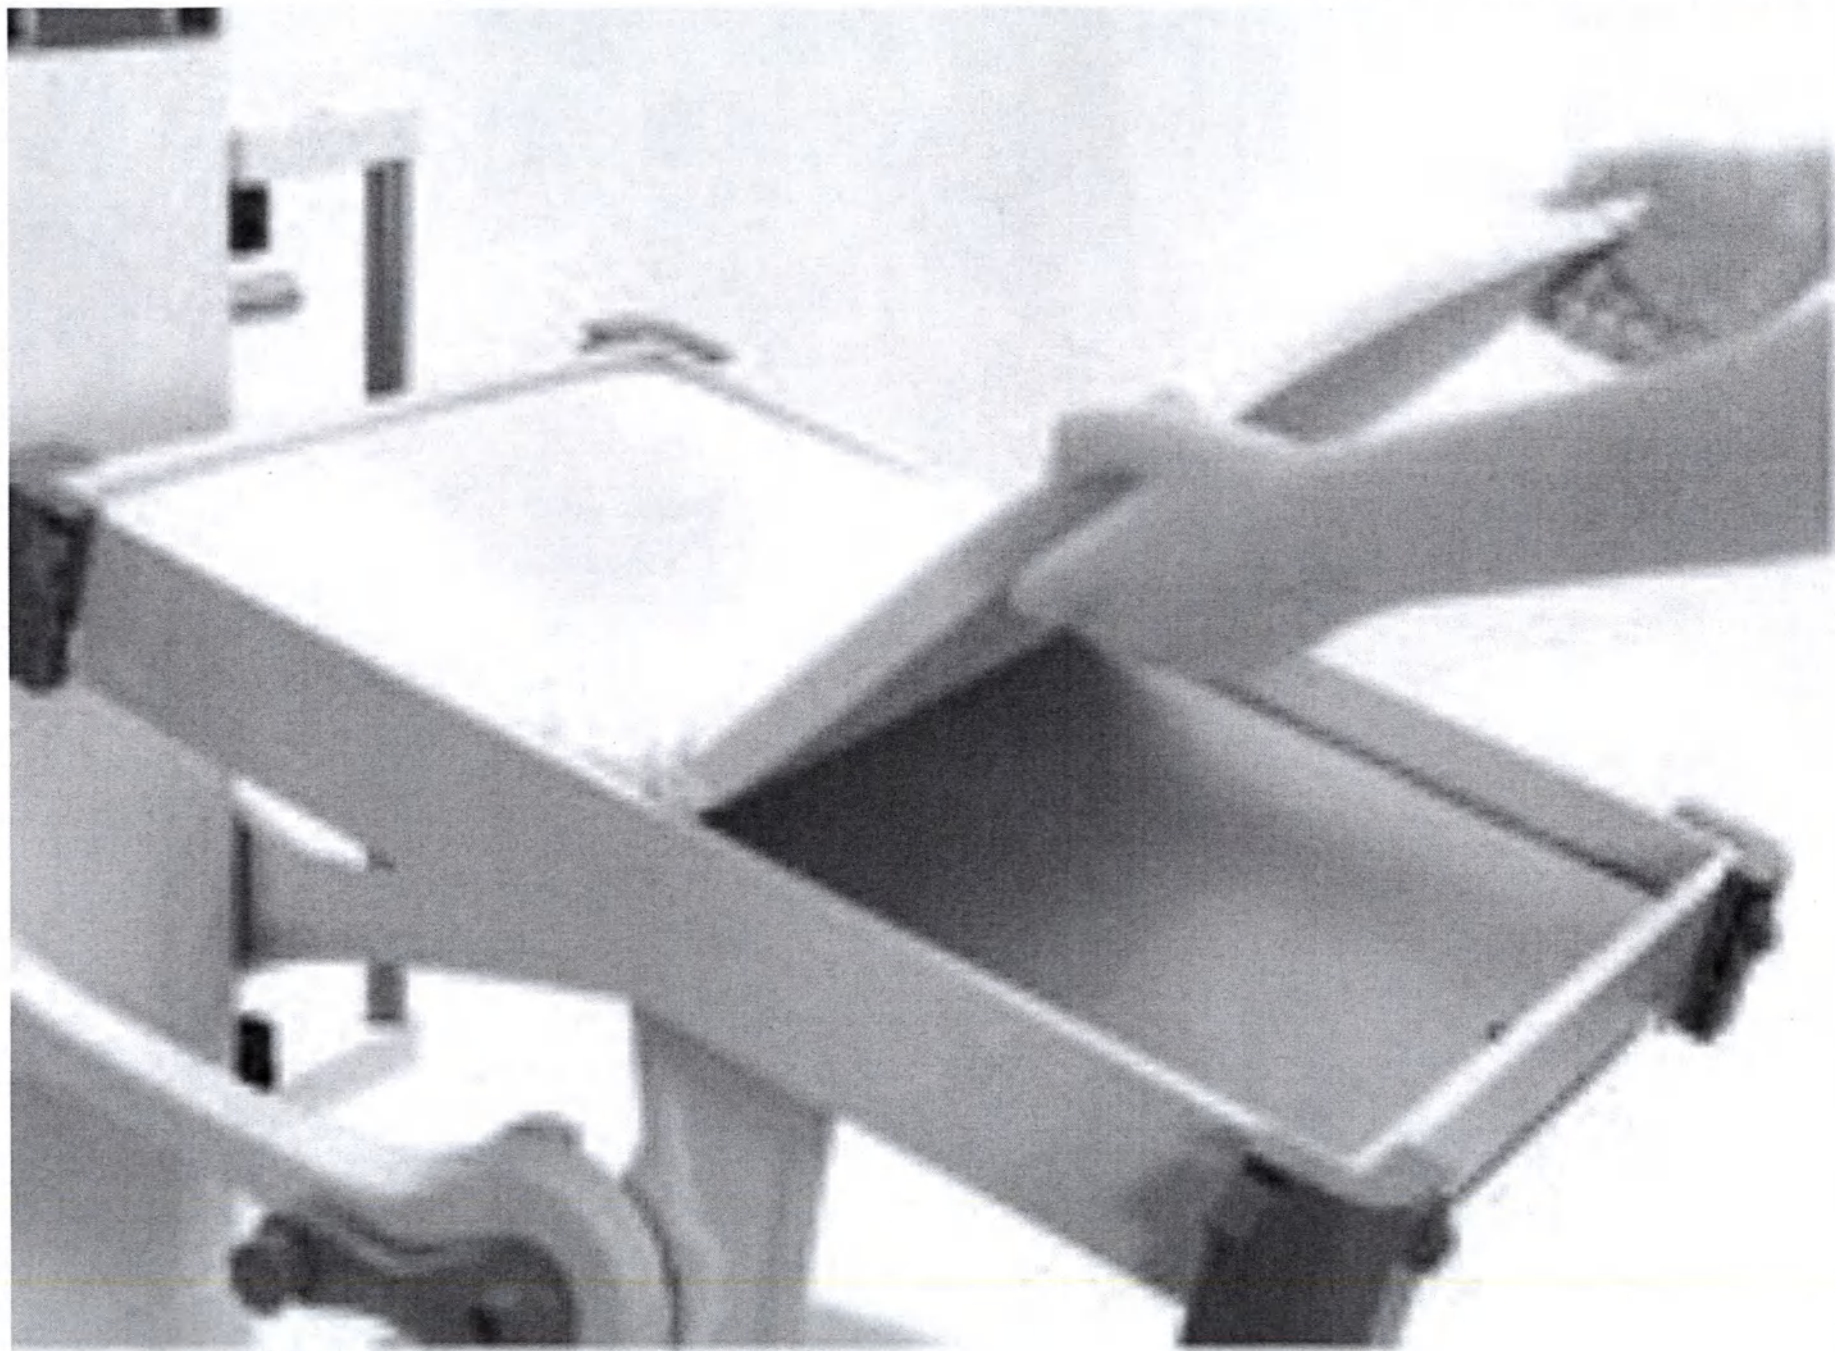


17. Укладки-гнездышко для новорожденных (не более 5 шт.).

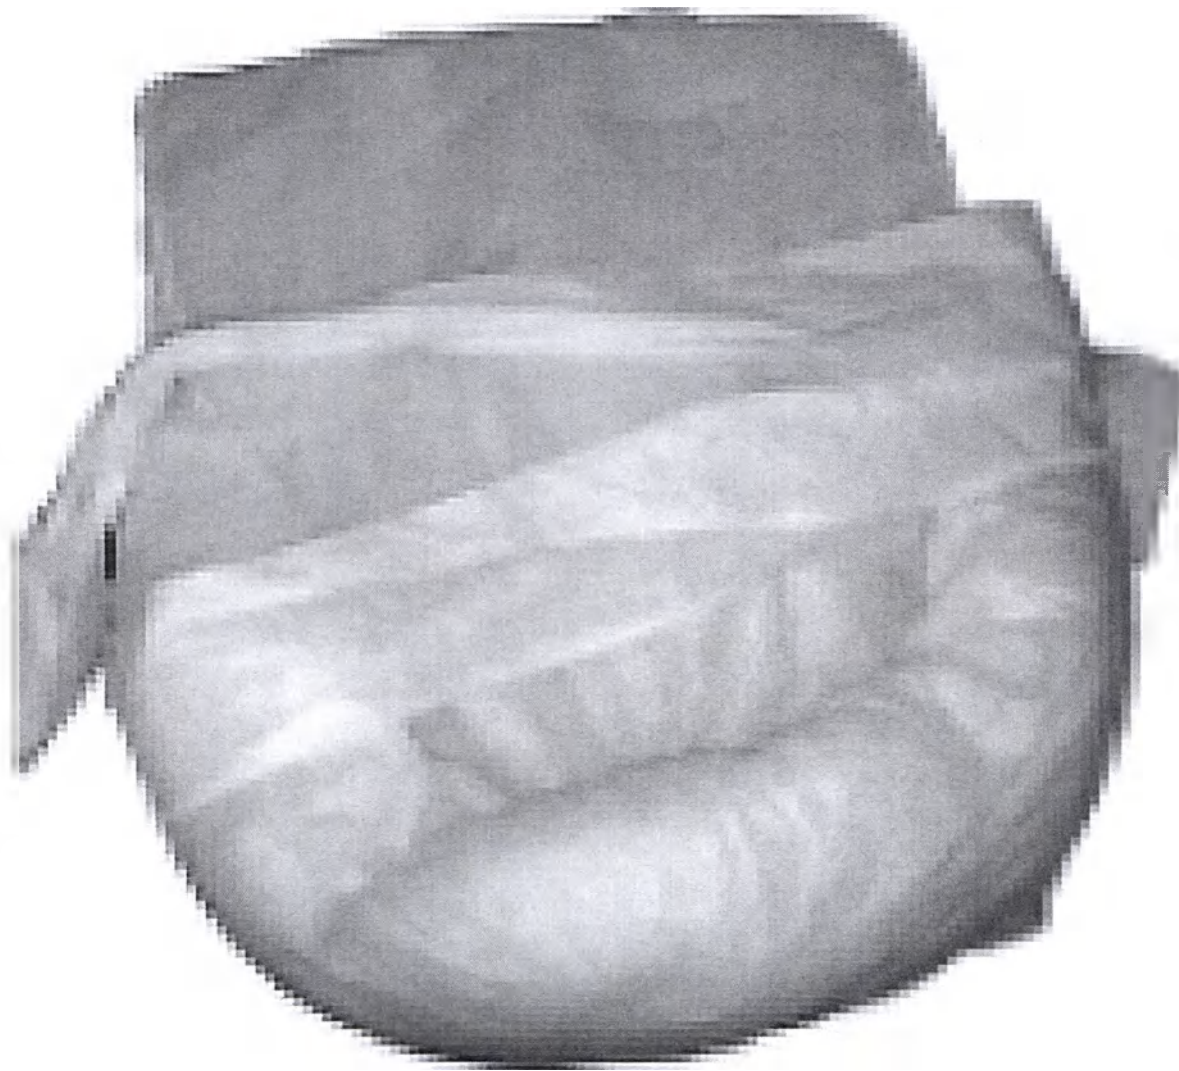


18. Ящики для хранения принадлежностей (не более 4 шт.).

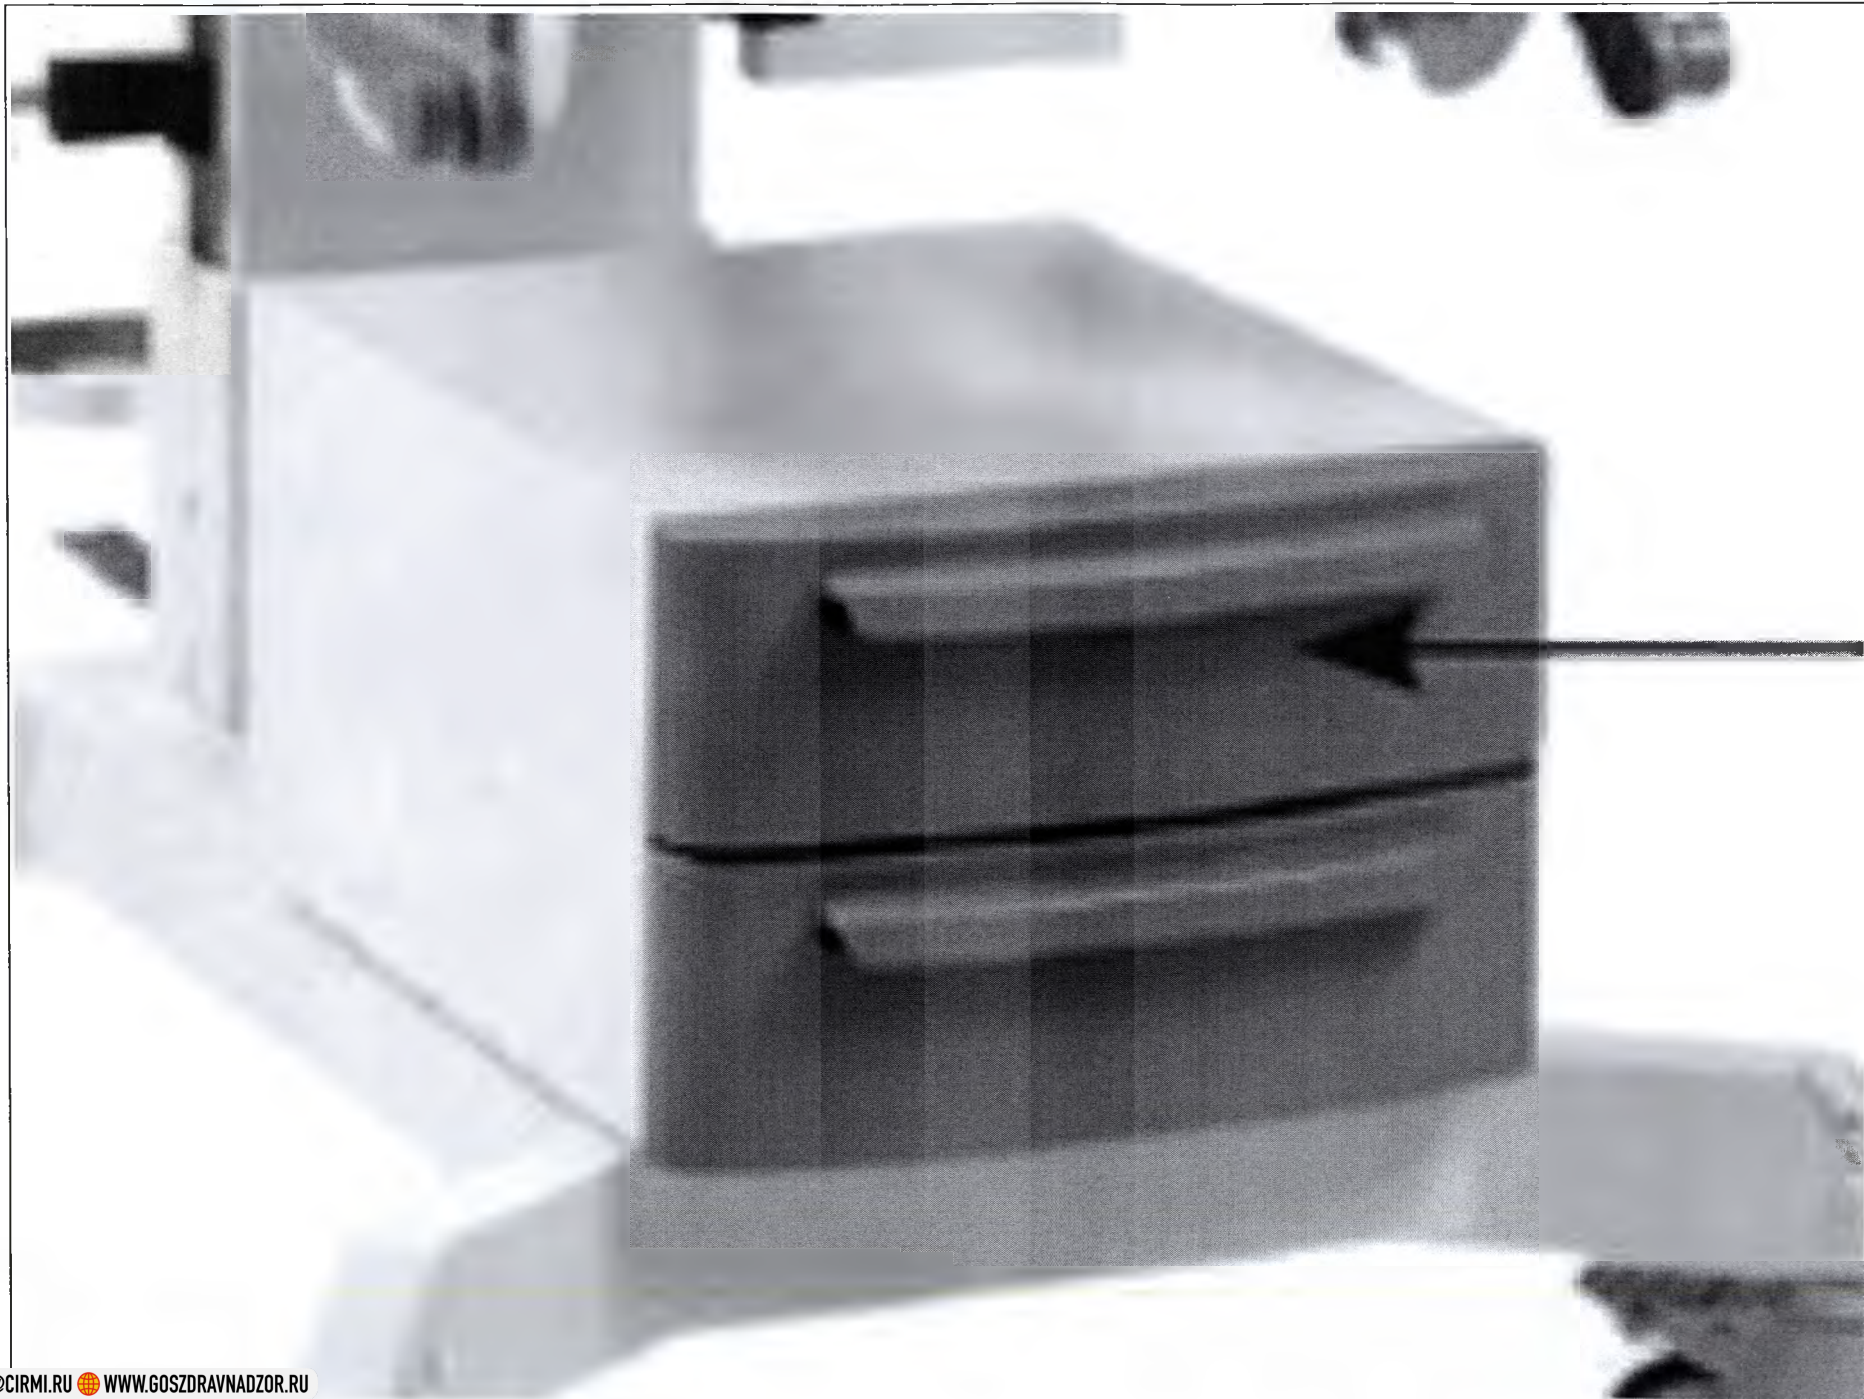


19. Лотки угловые (не более 5 шт.).

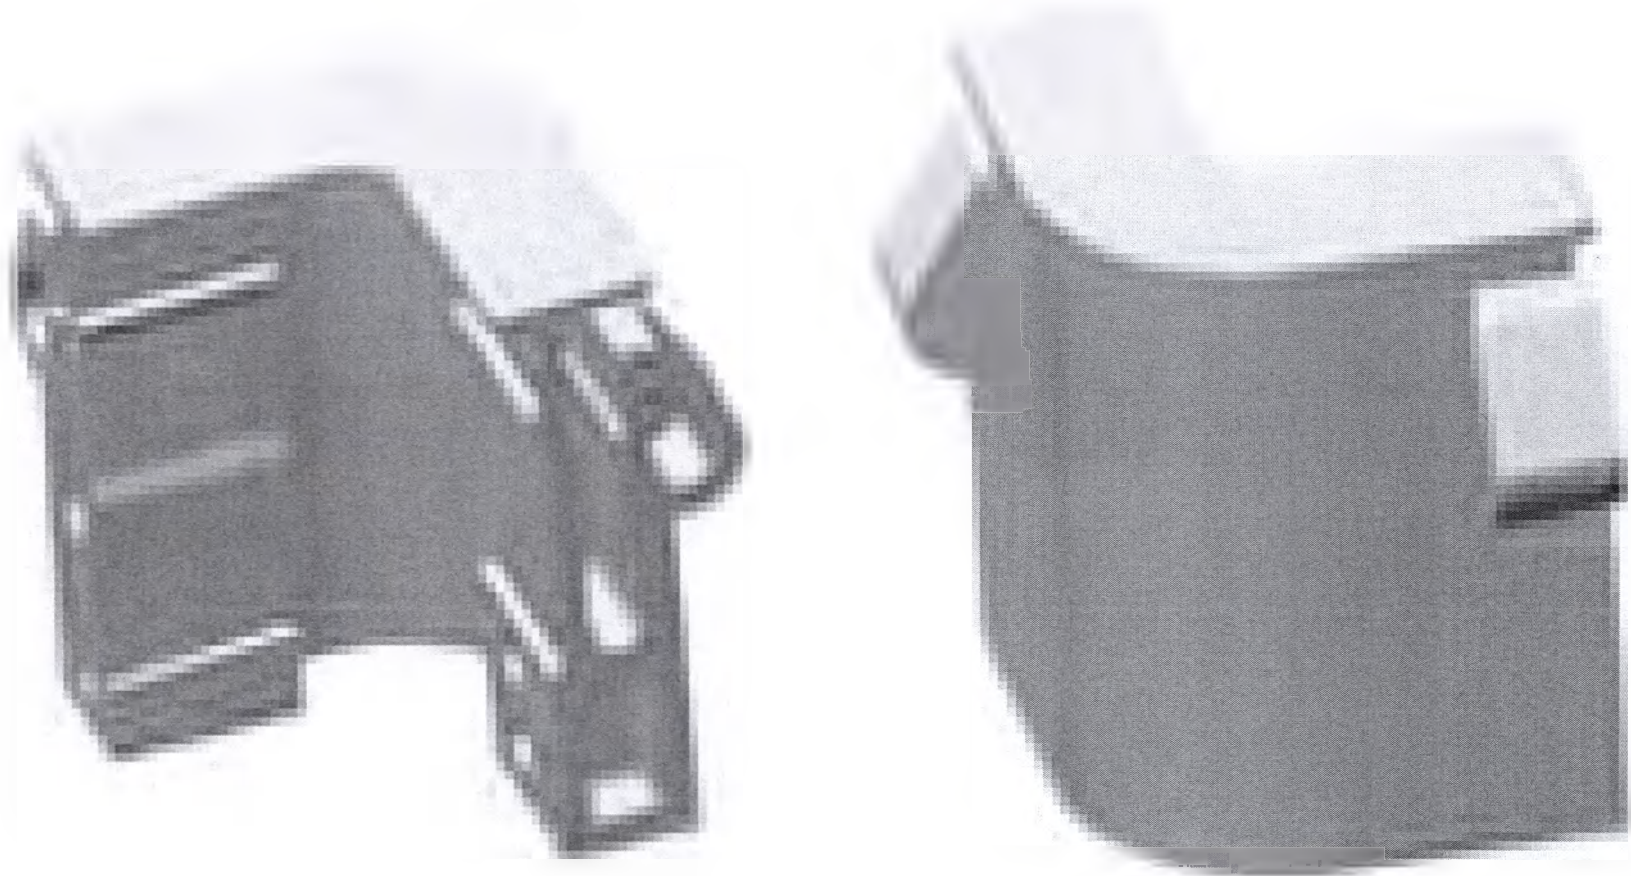


19. Лотки угловые (не более 5 шт.).

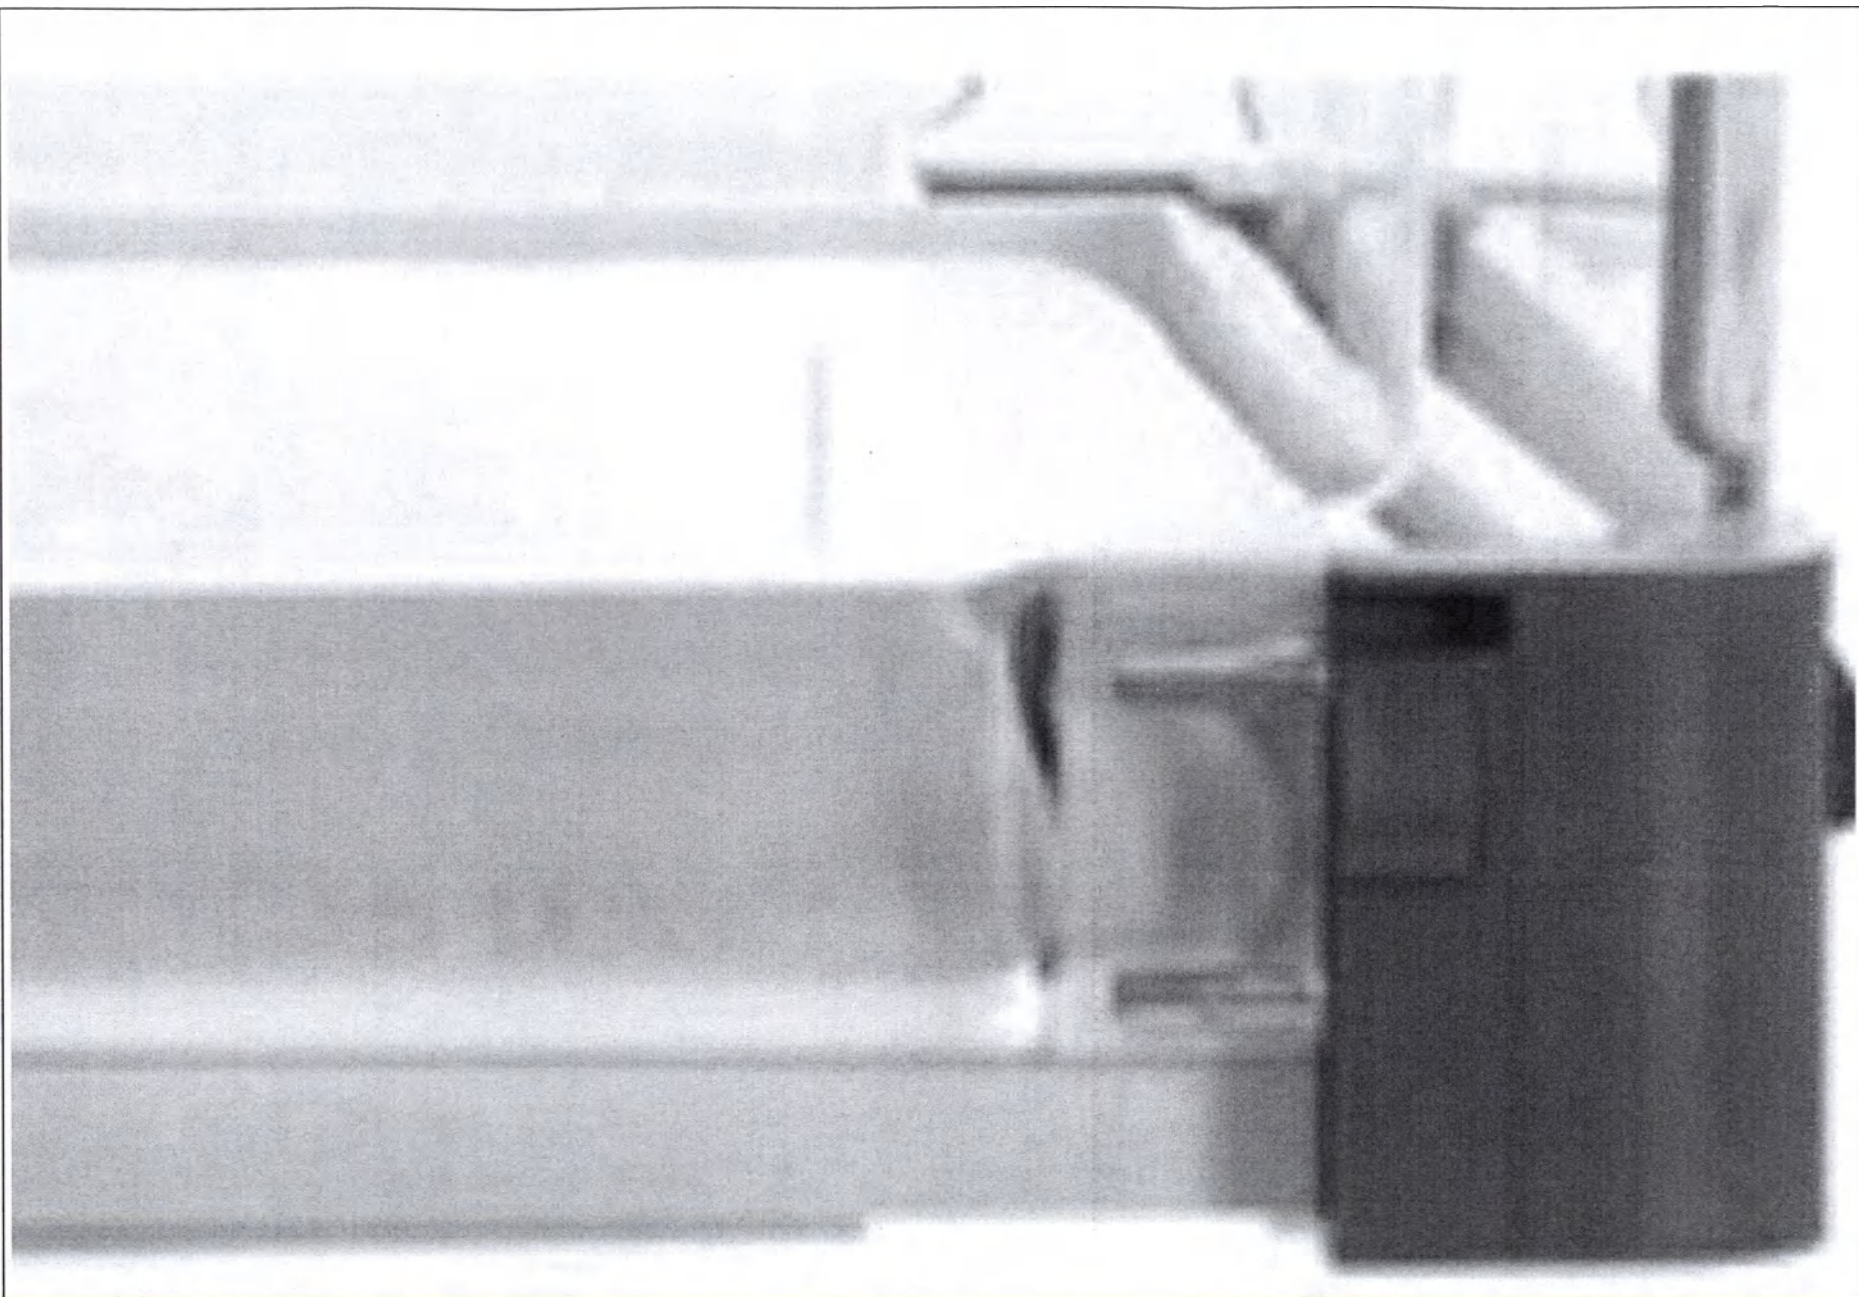


20. Лотки для рентген кассеты (не более 5 шт.).

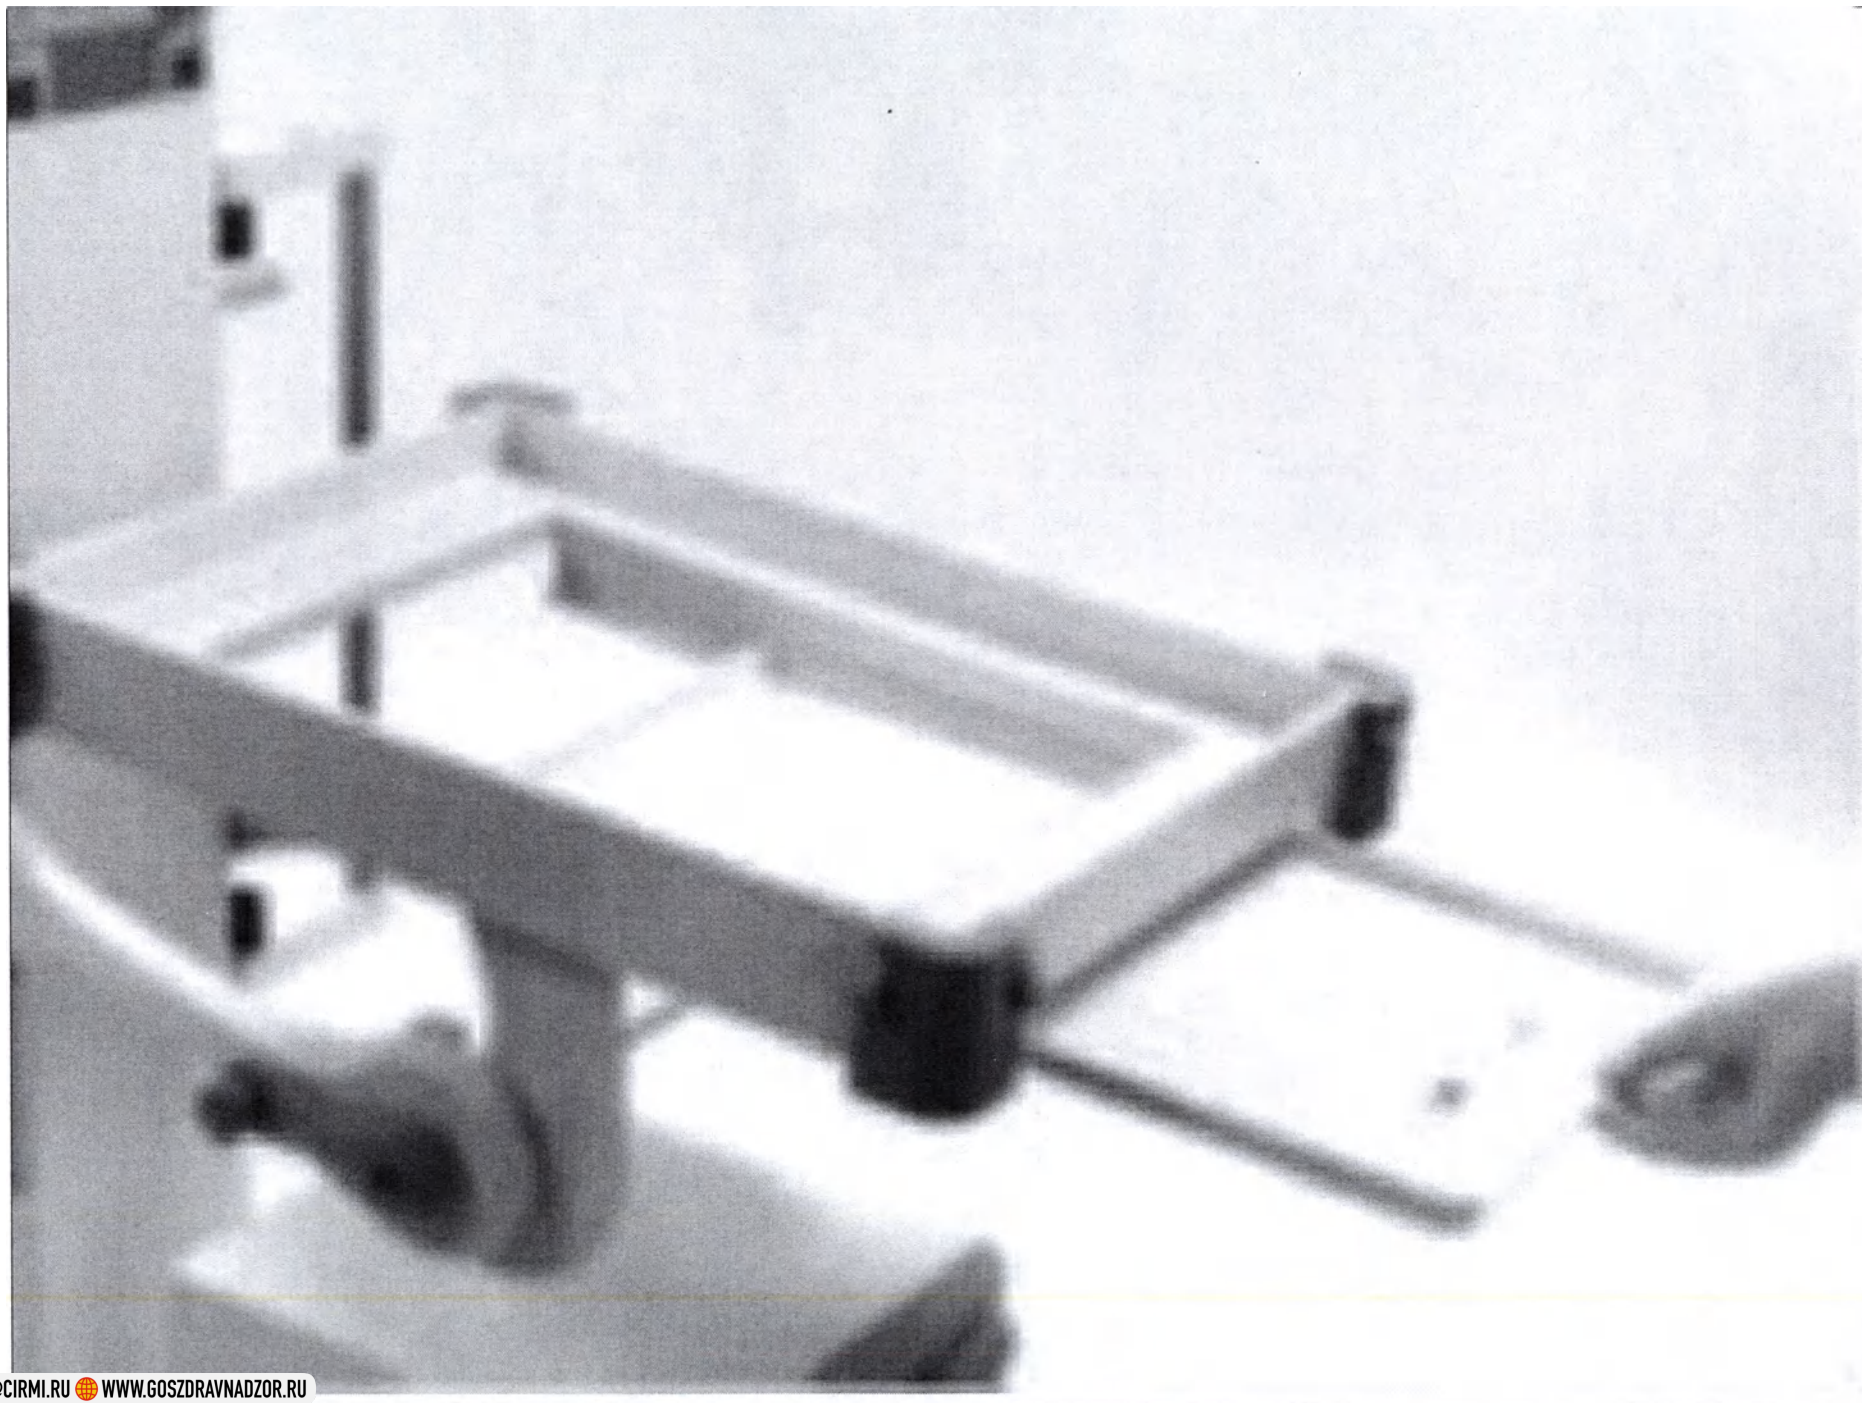


21. Полки мониторные (не более 5 шт.).

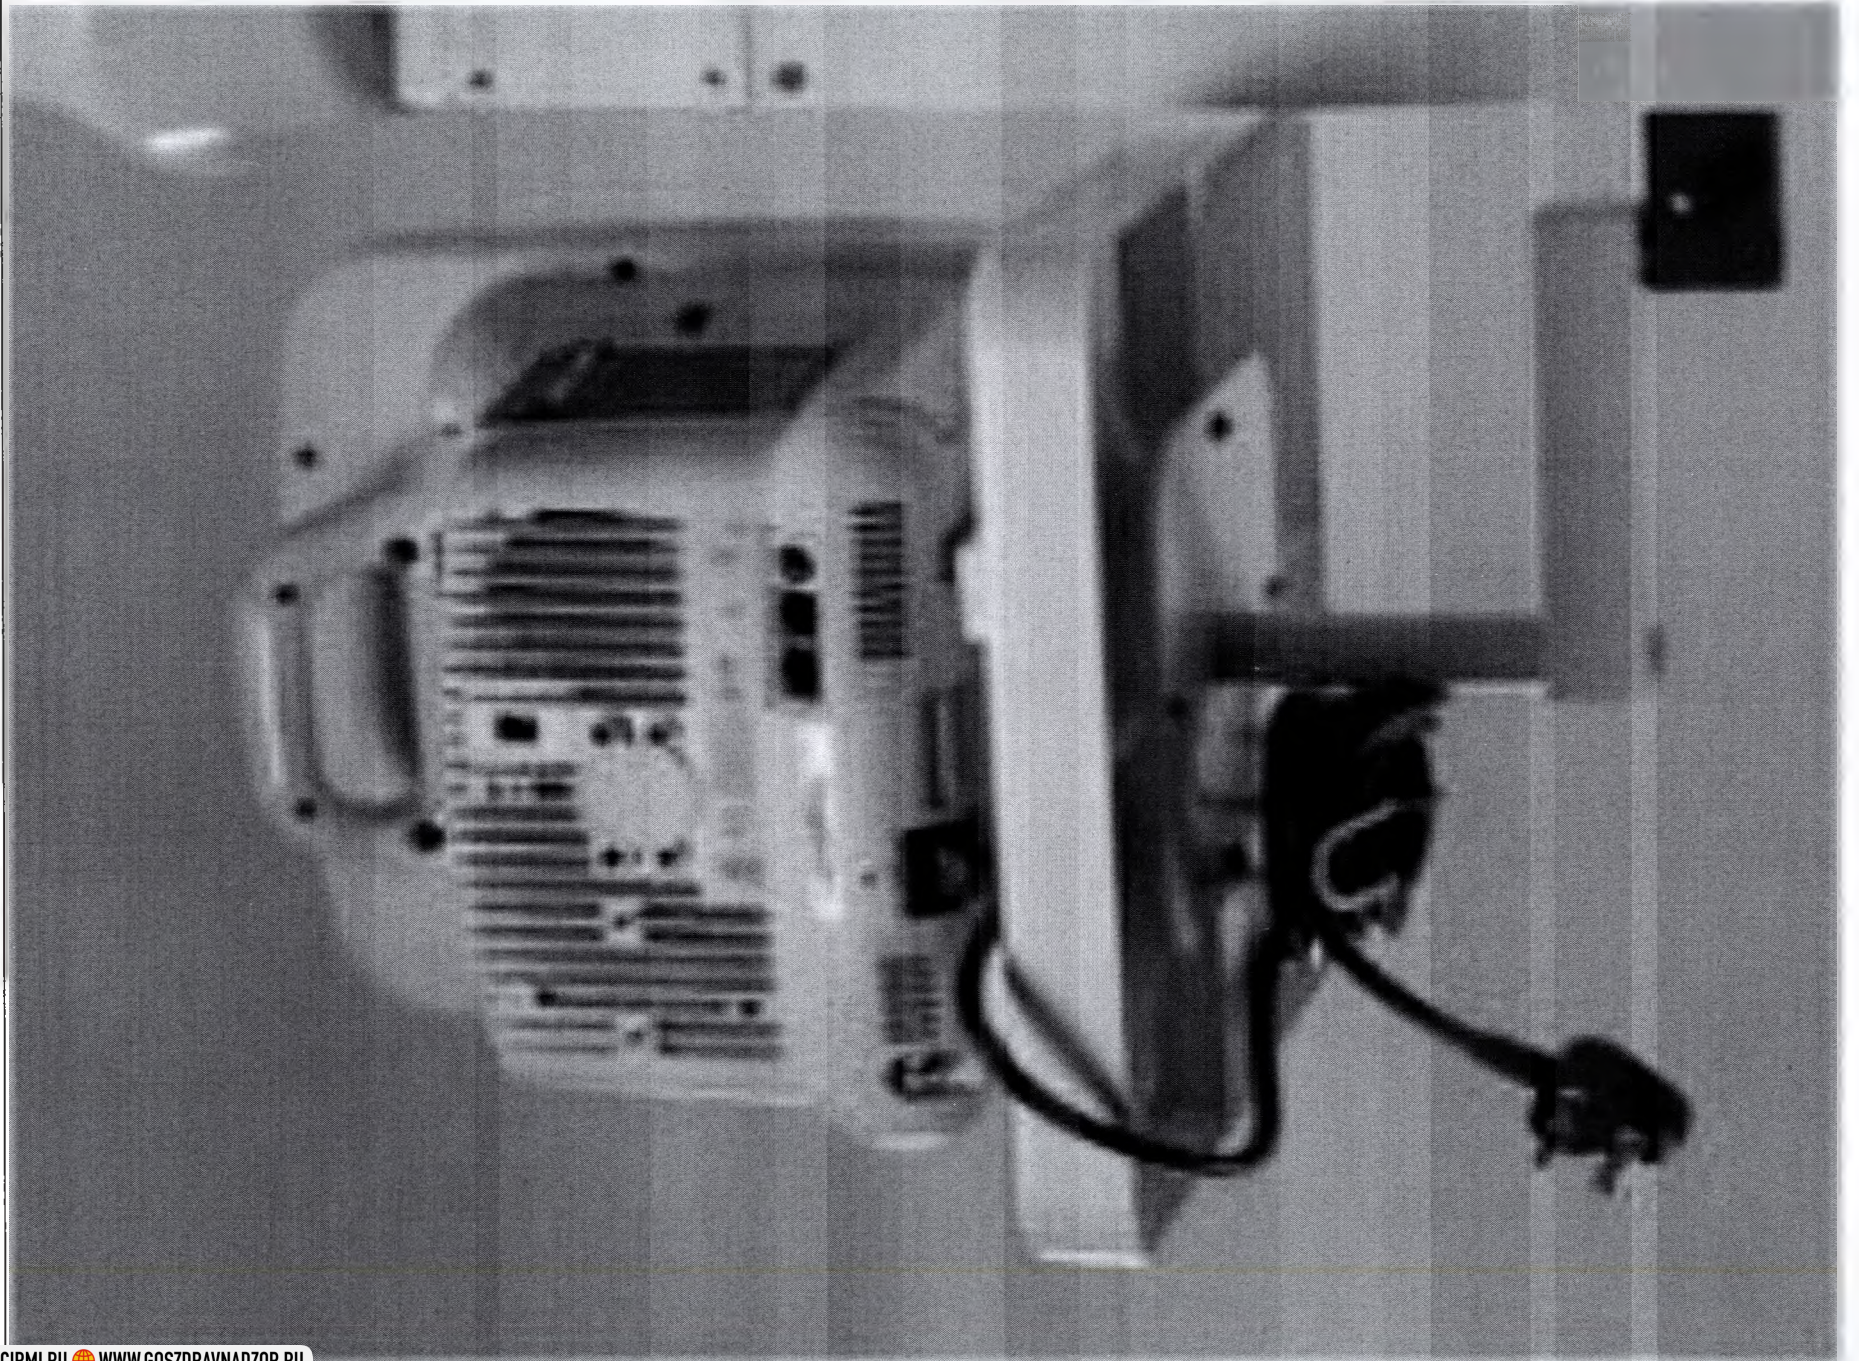


22. Полки инструментальные (не более 5 шт.).

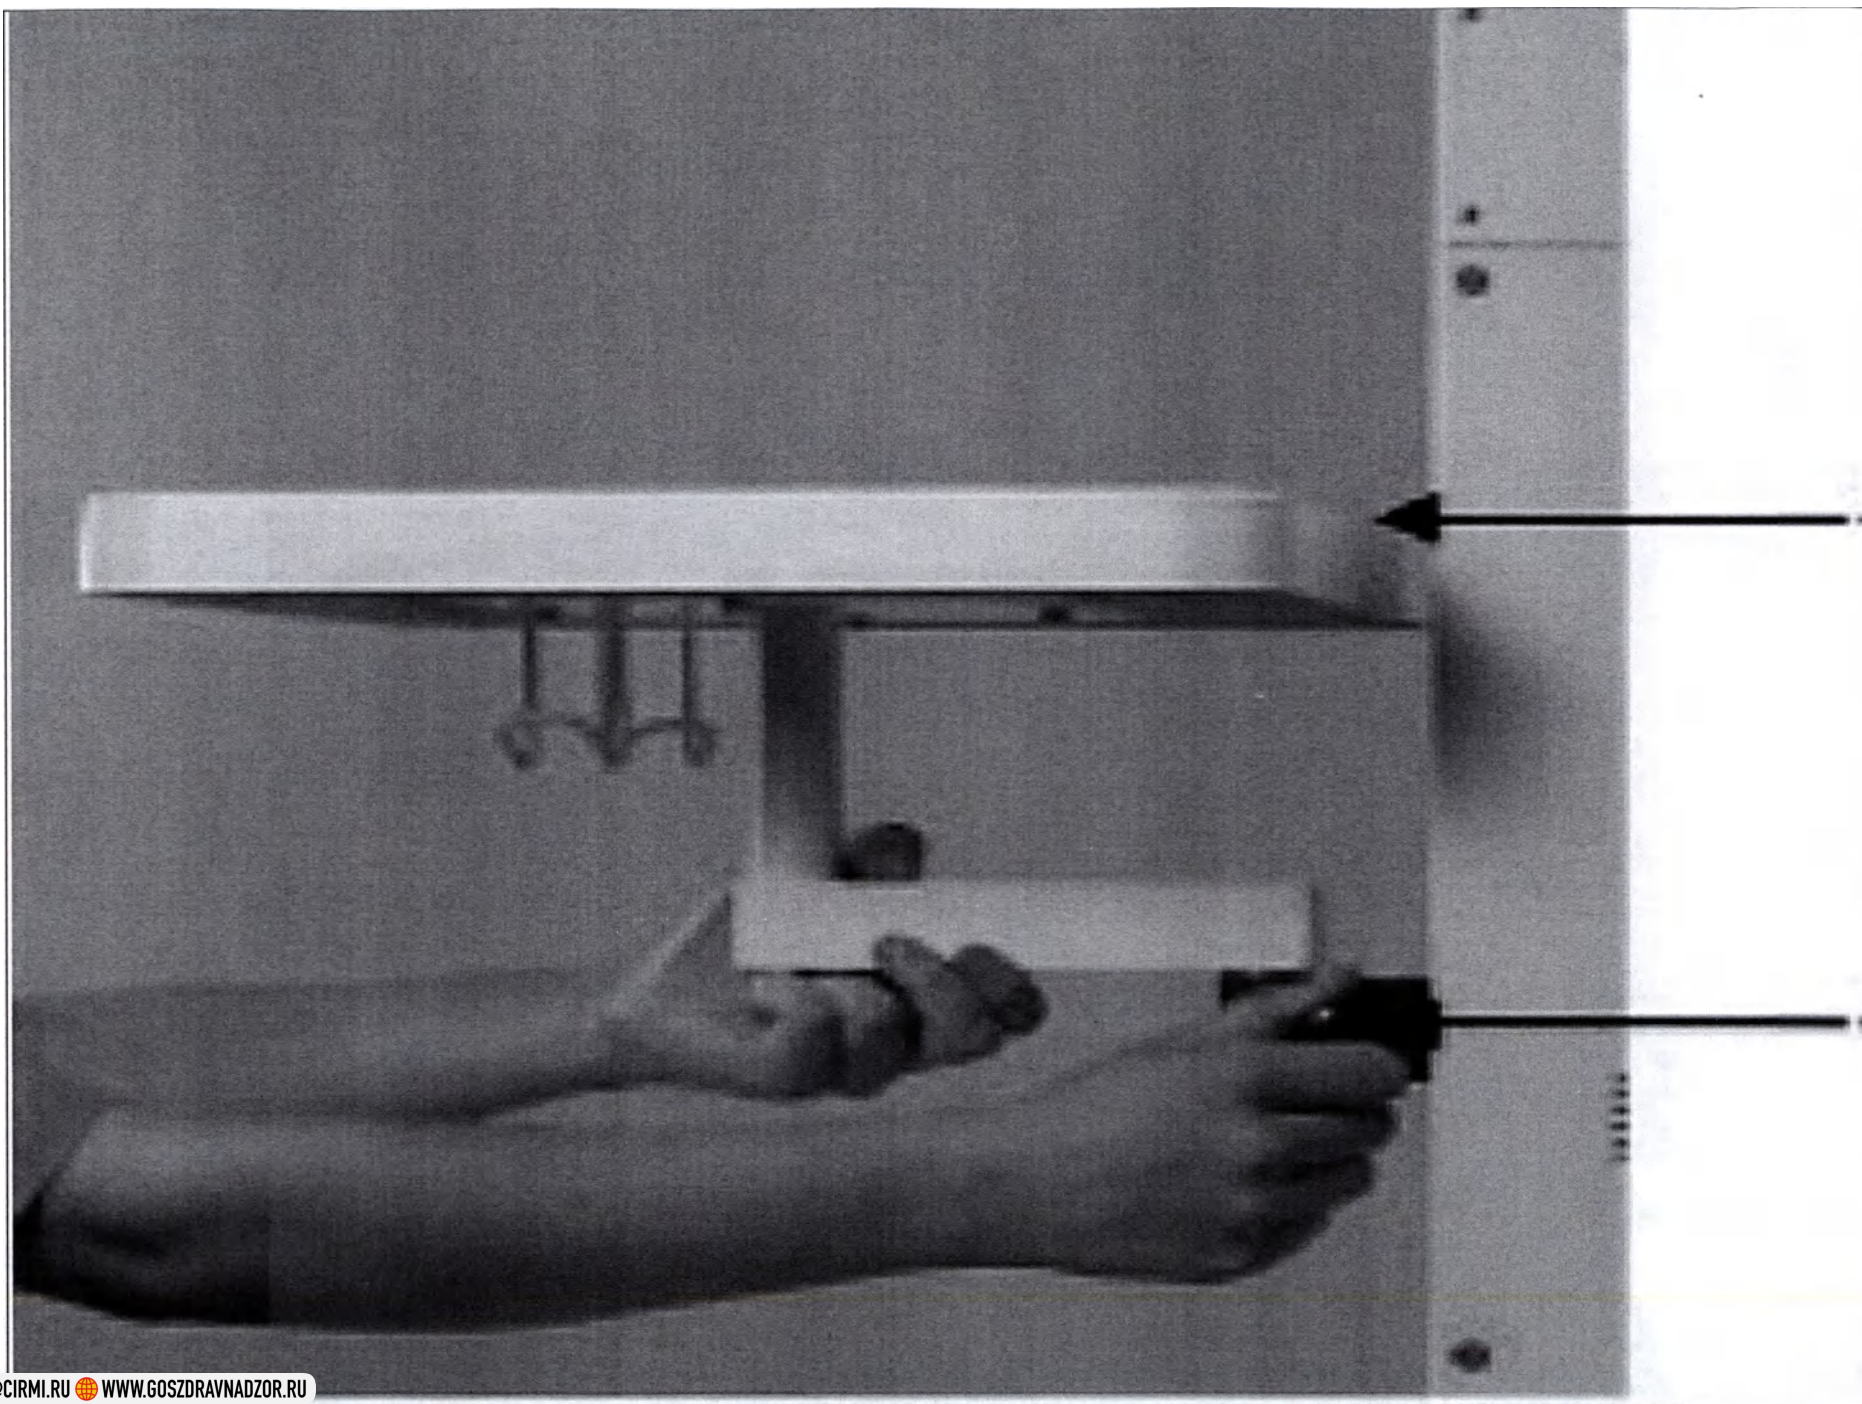

23. Инфузионные стойки (не более до 5 шт.).

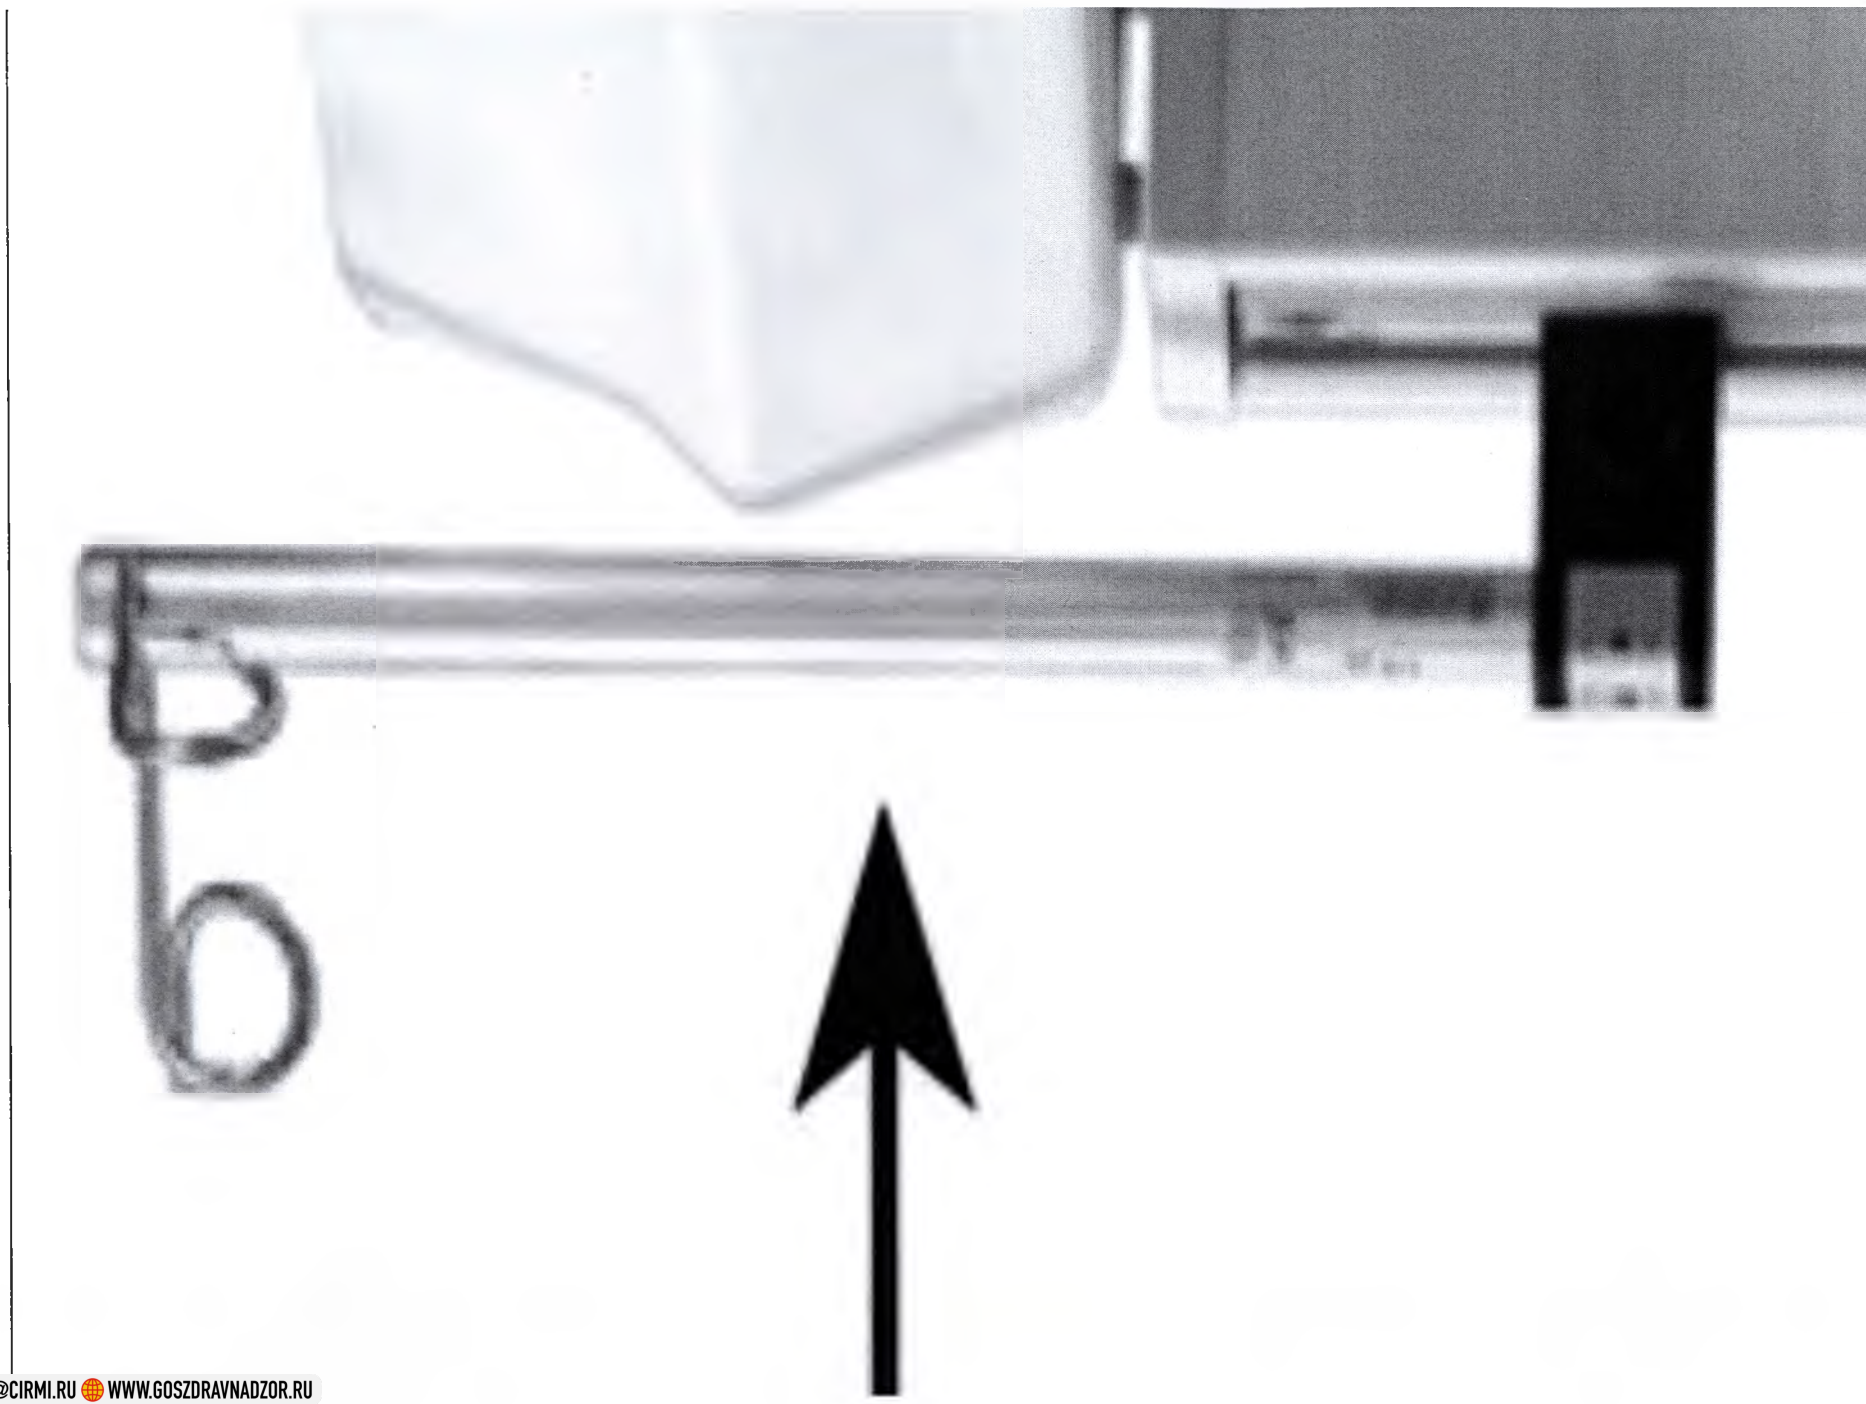


24. Контуры пациента (не более 30 шт.).

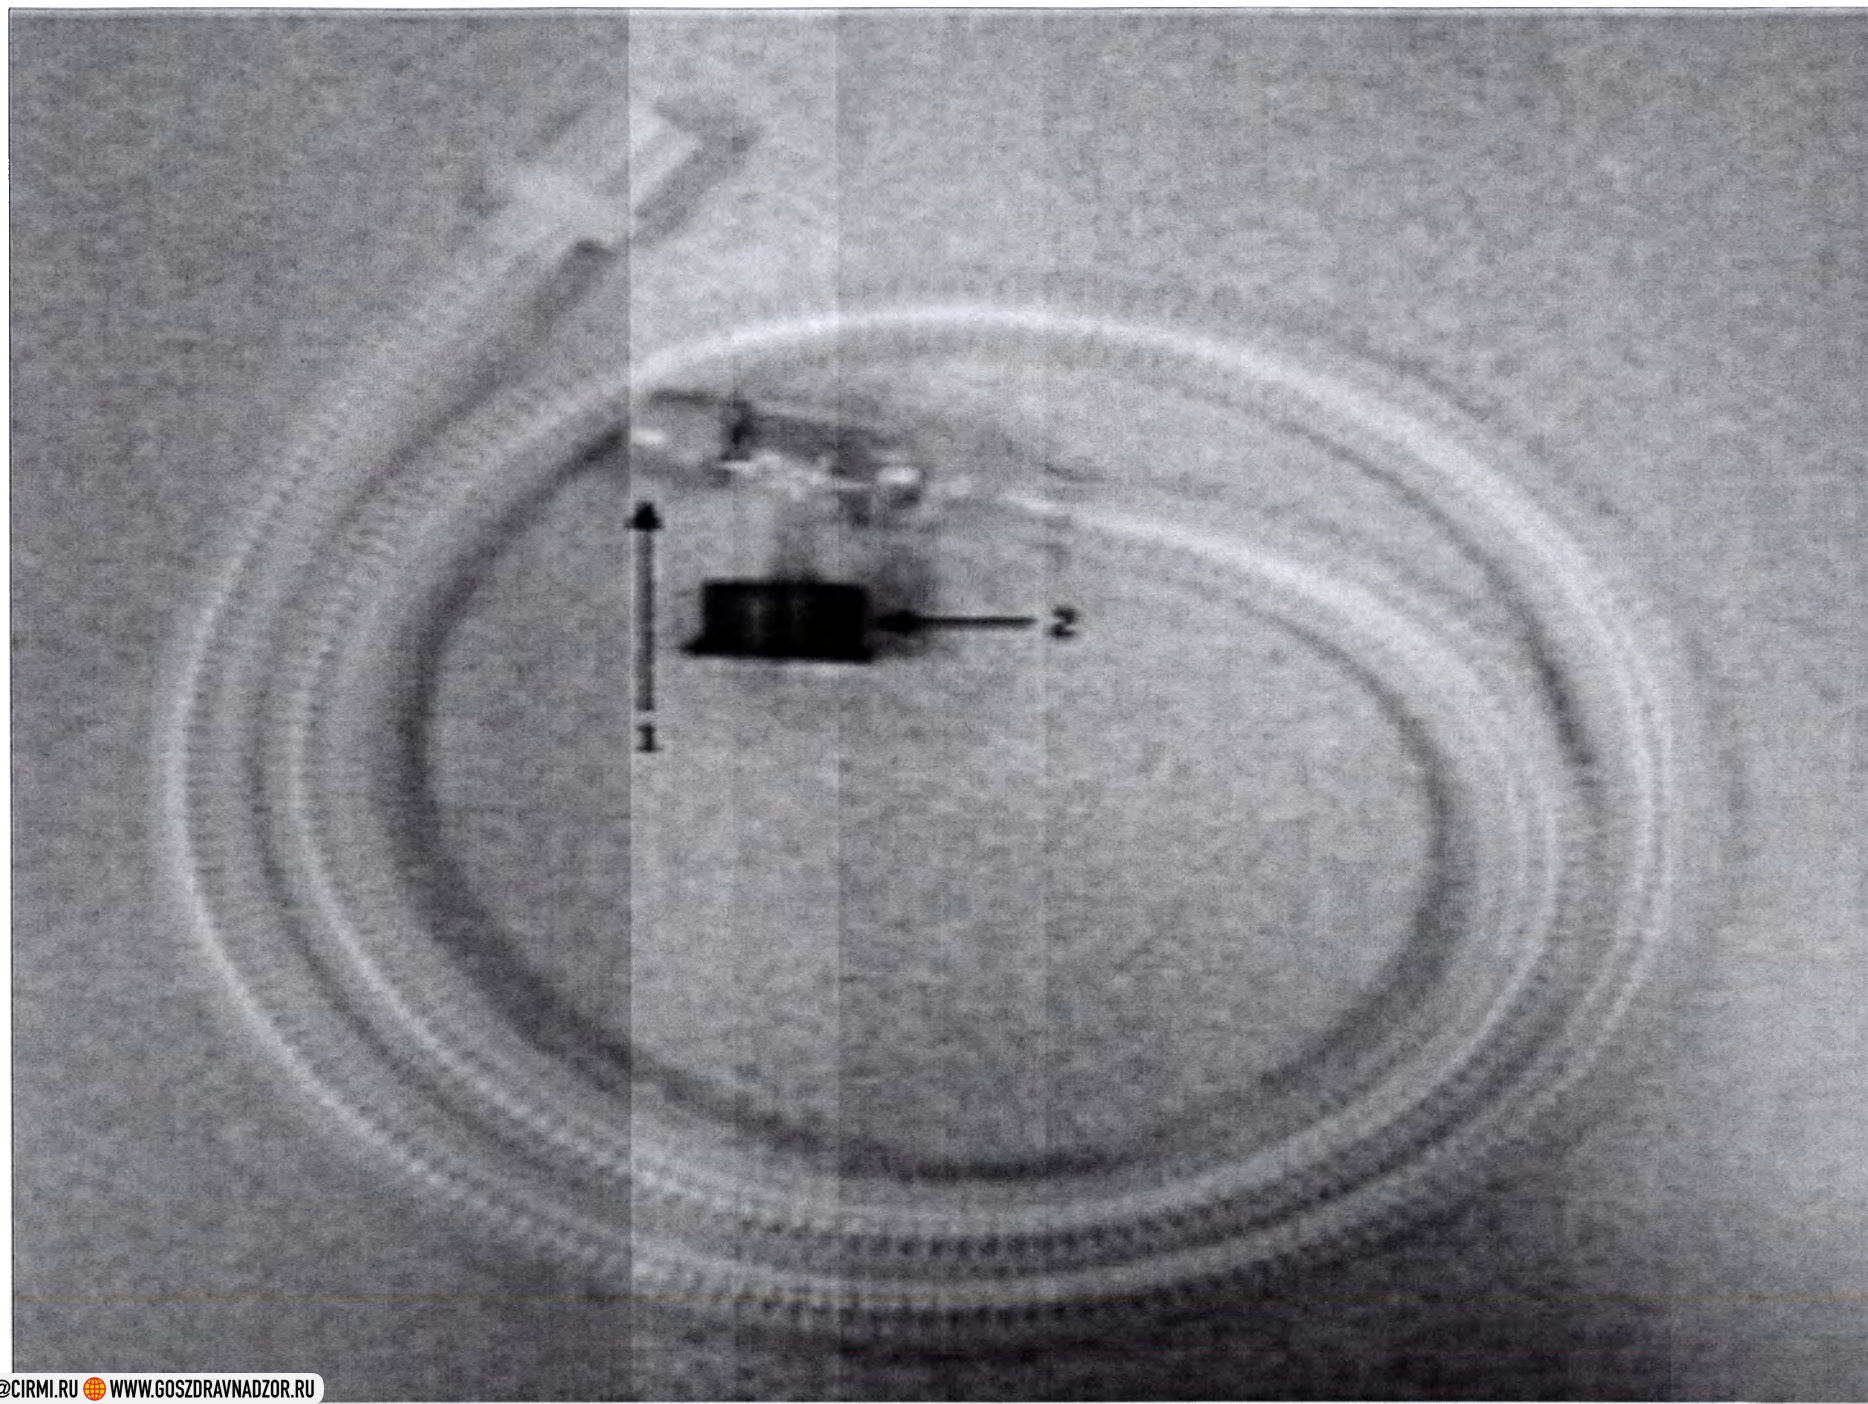


24. Контуры пациента (не более 30 шт.).



24. Контуры пациента (не более 30 шт.).

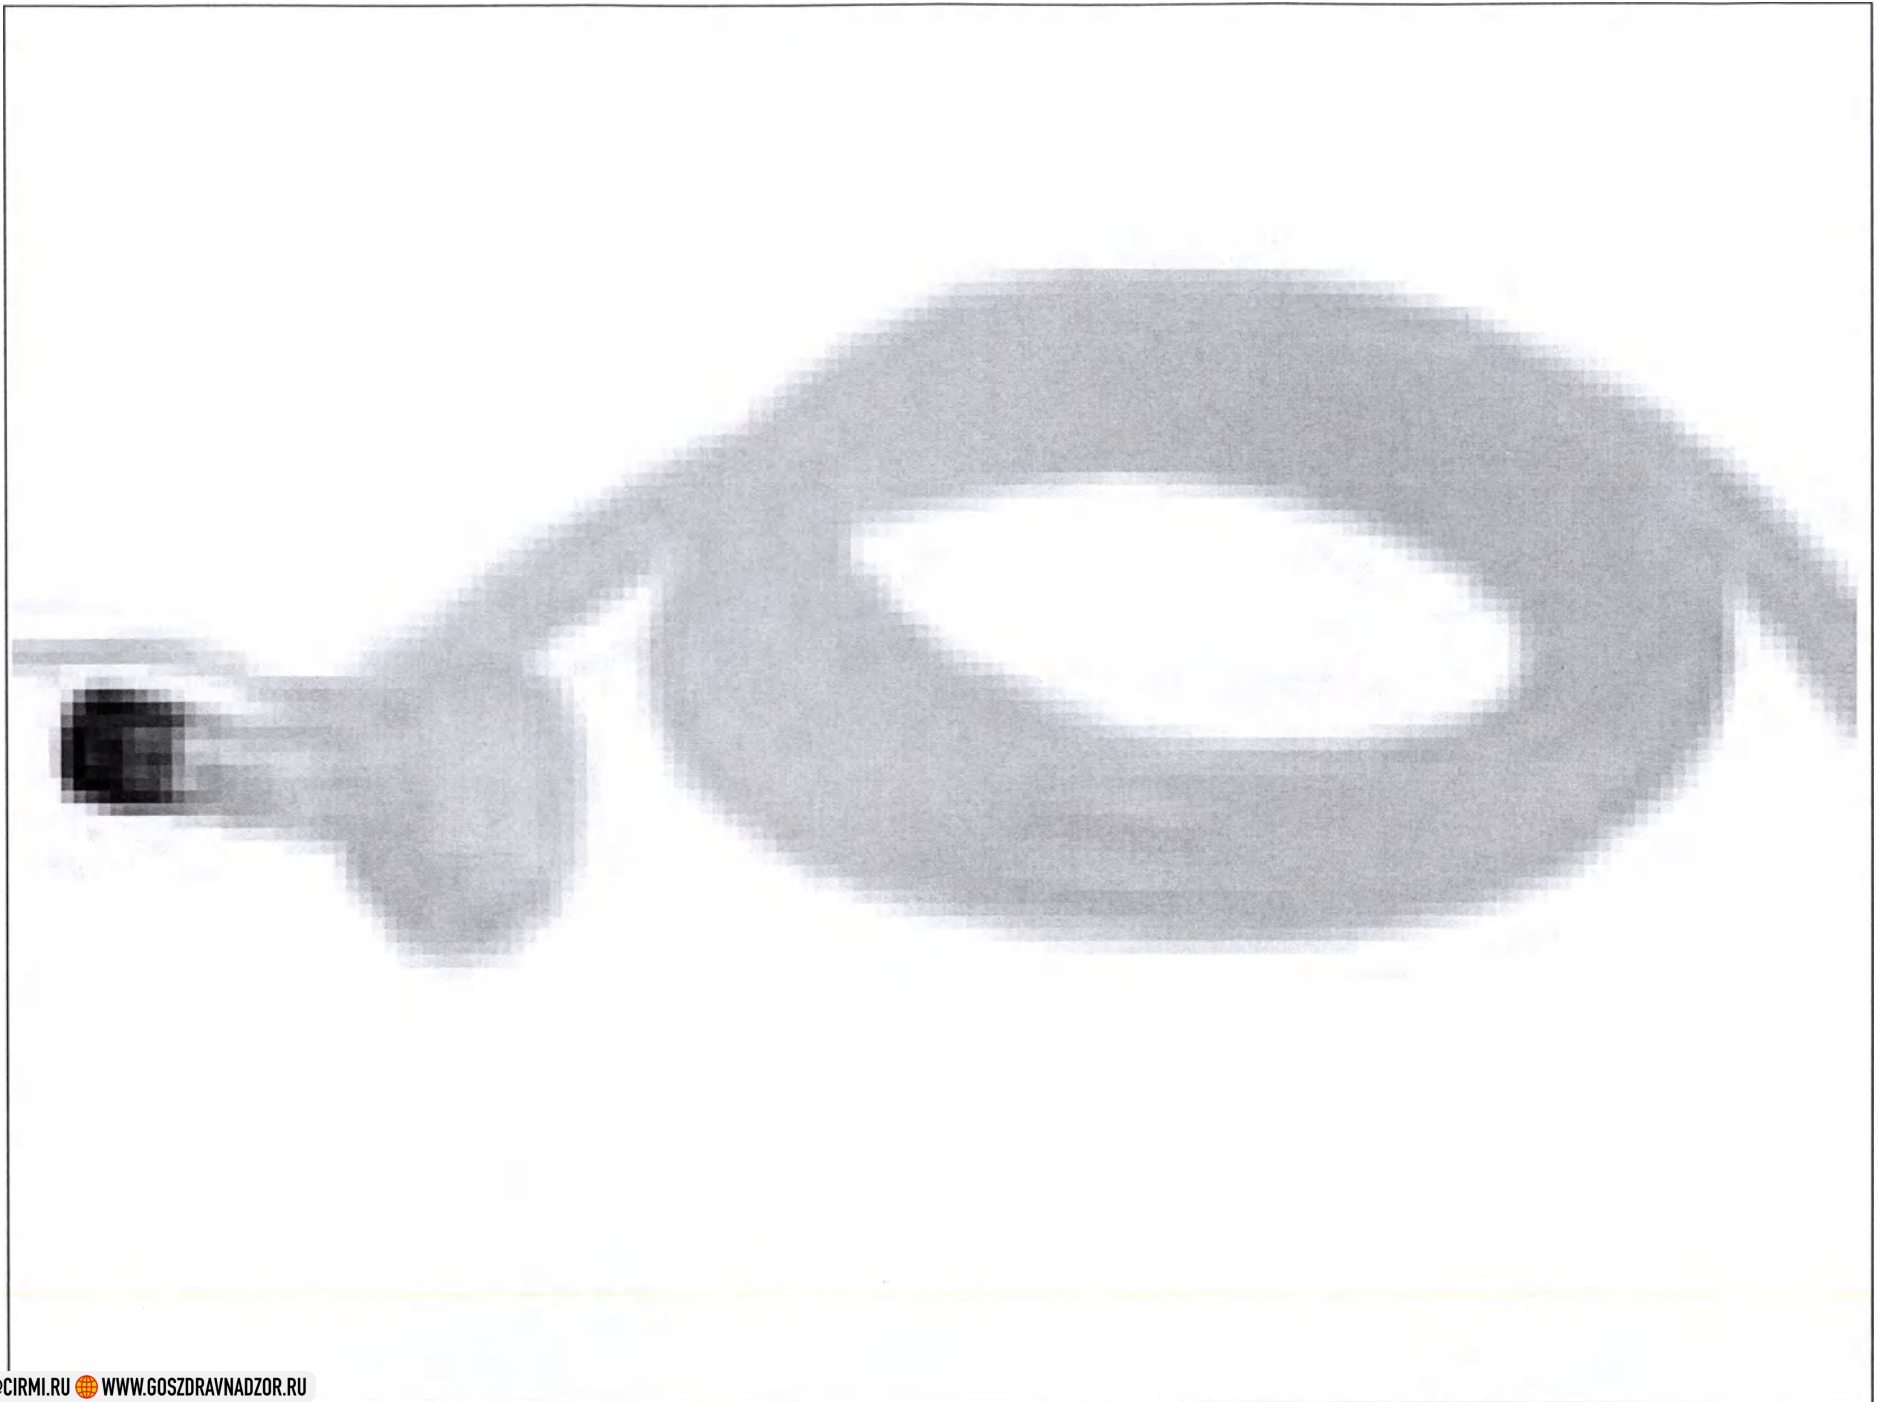


25. Дыхательные мешки (не более 30 шт.).

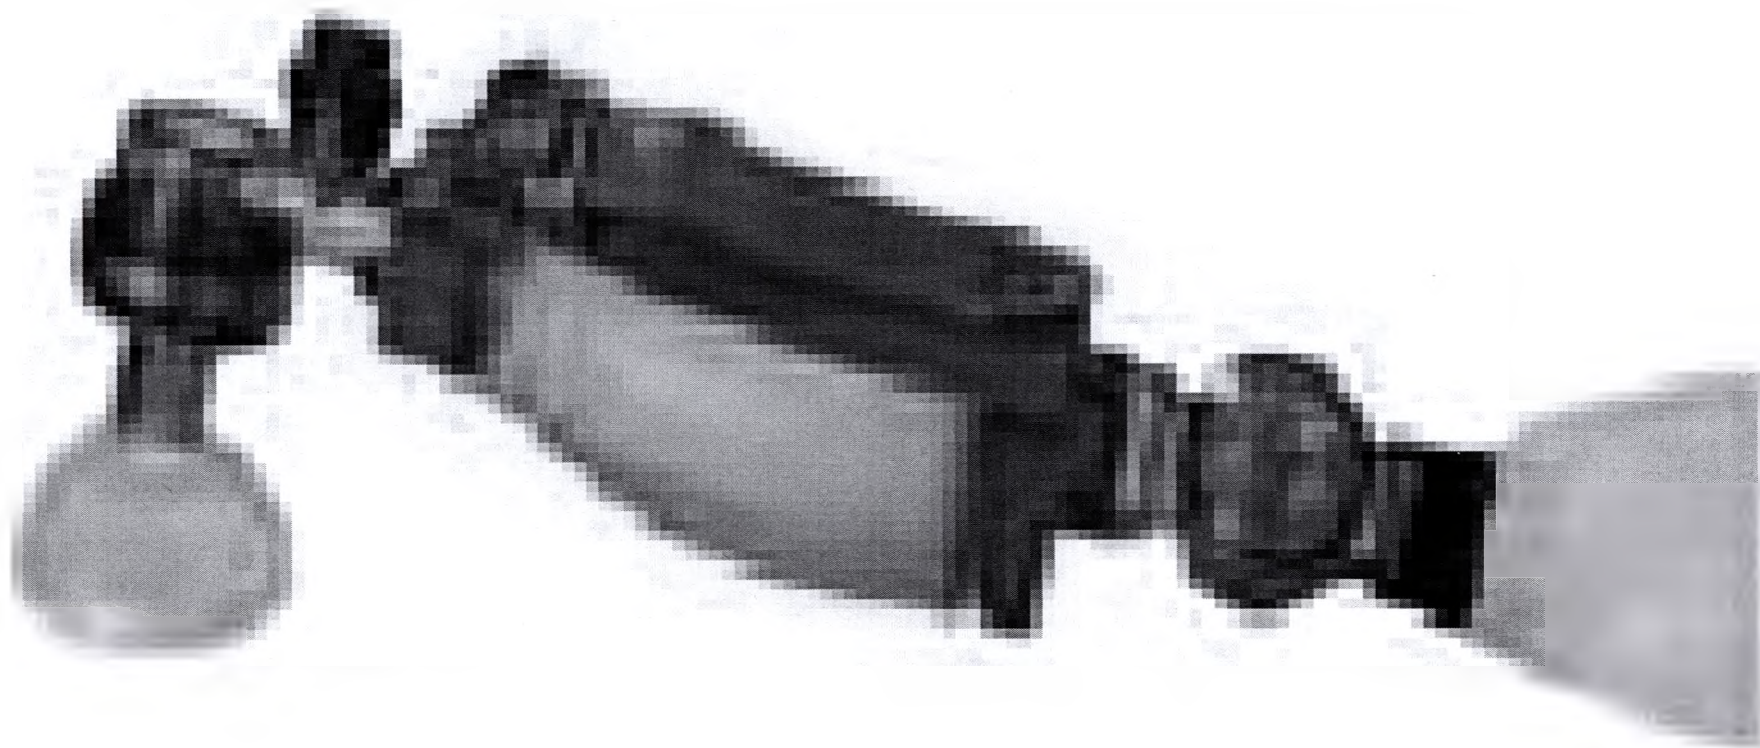

25. Дыхательные мешки (не более 30 шт.).



25. Дыхательные мешки (не более 30 шт.).

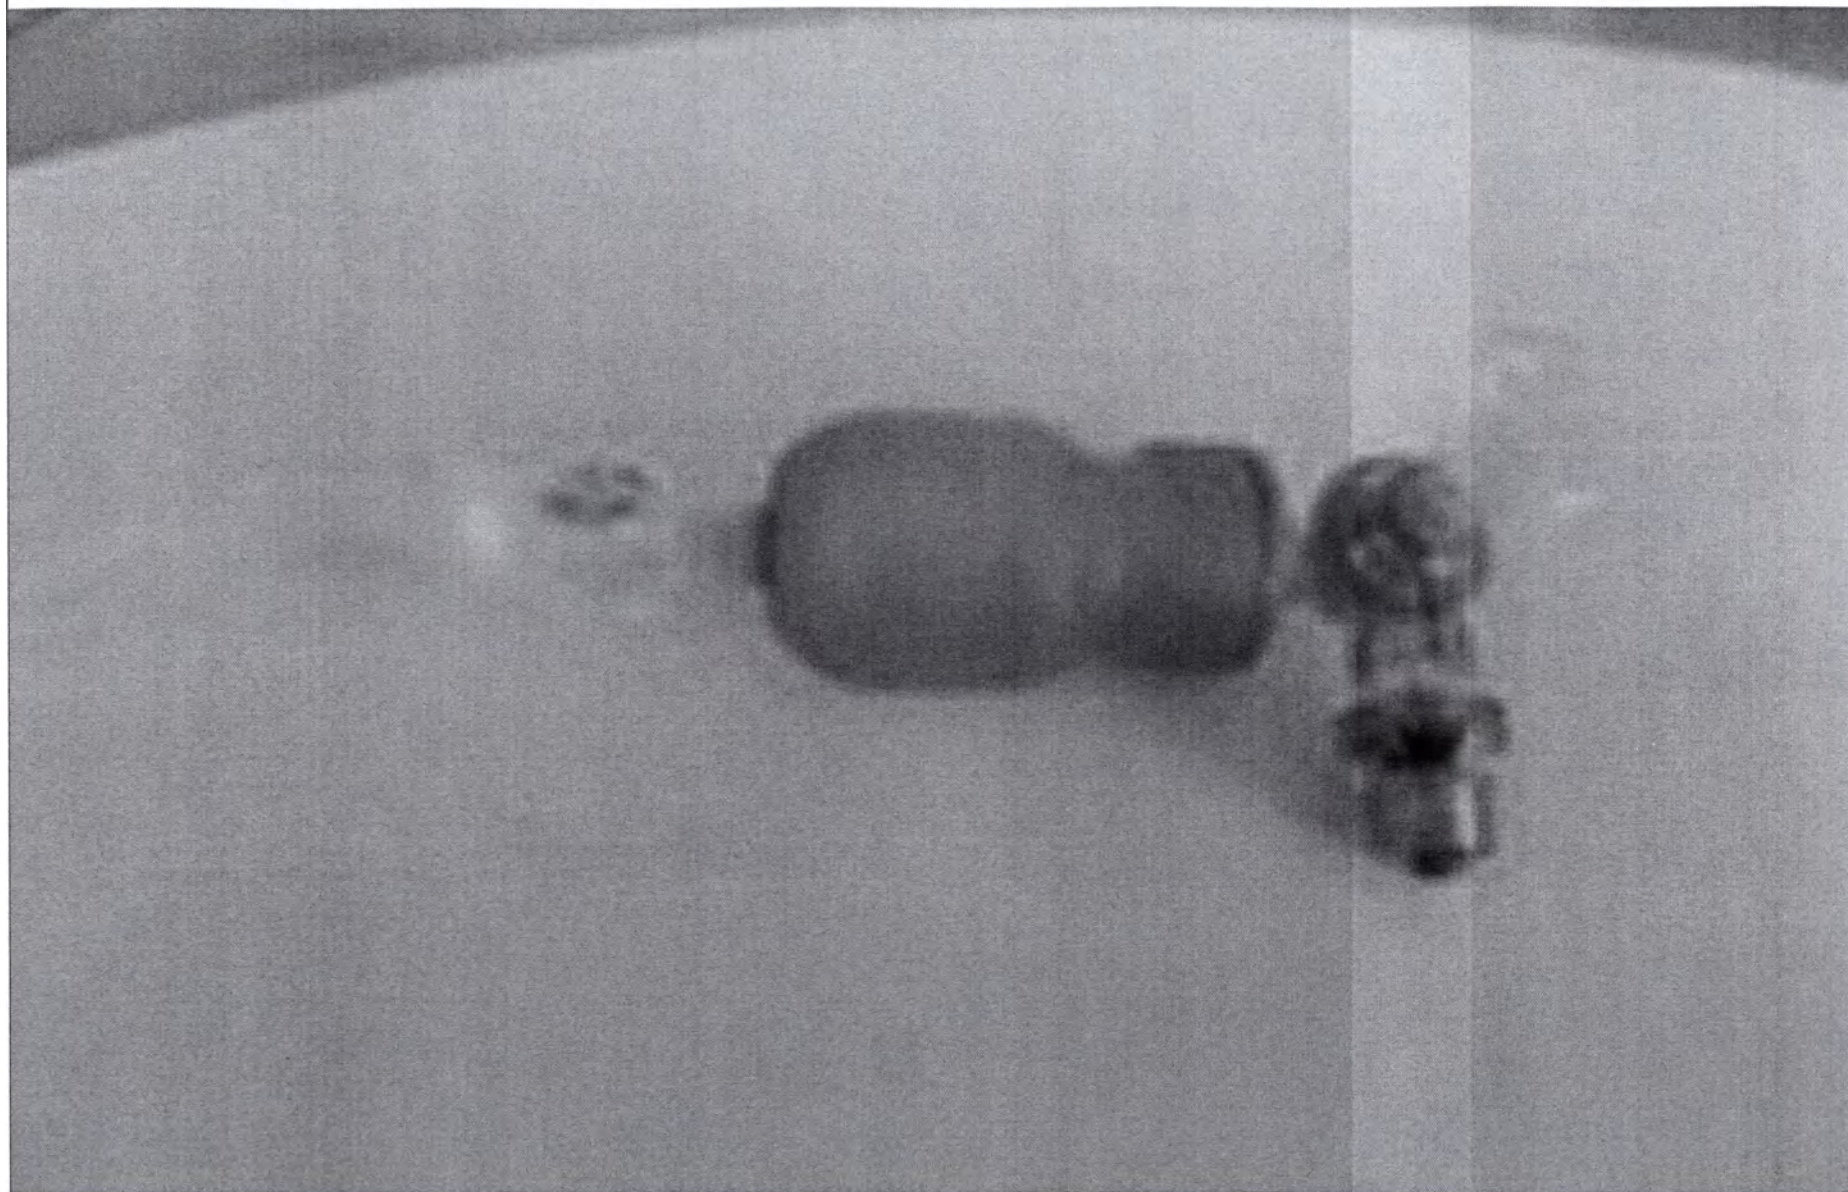

26. Маски дыхательные различных размеров (не более 200 шт.).



26. Маски дыхательные различных размеров (не более 200 шт.).



27. Маски анестезиологические различных размеров (не более 200 шт.).



27. Маски анестезиологические различных размеров (не более 200 шт.).



28. Трубки дыхательные (не более 30 шт.).



29. Трубки забора газовой смеси (не более 30 шт.).




30. Канюли (не более 30 шт.).




31. Трубки эндотрахеальные (не более 30 шт.).




32. Адаптеры (не более 5 шт.).

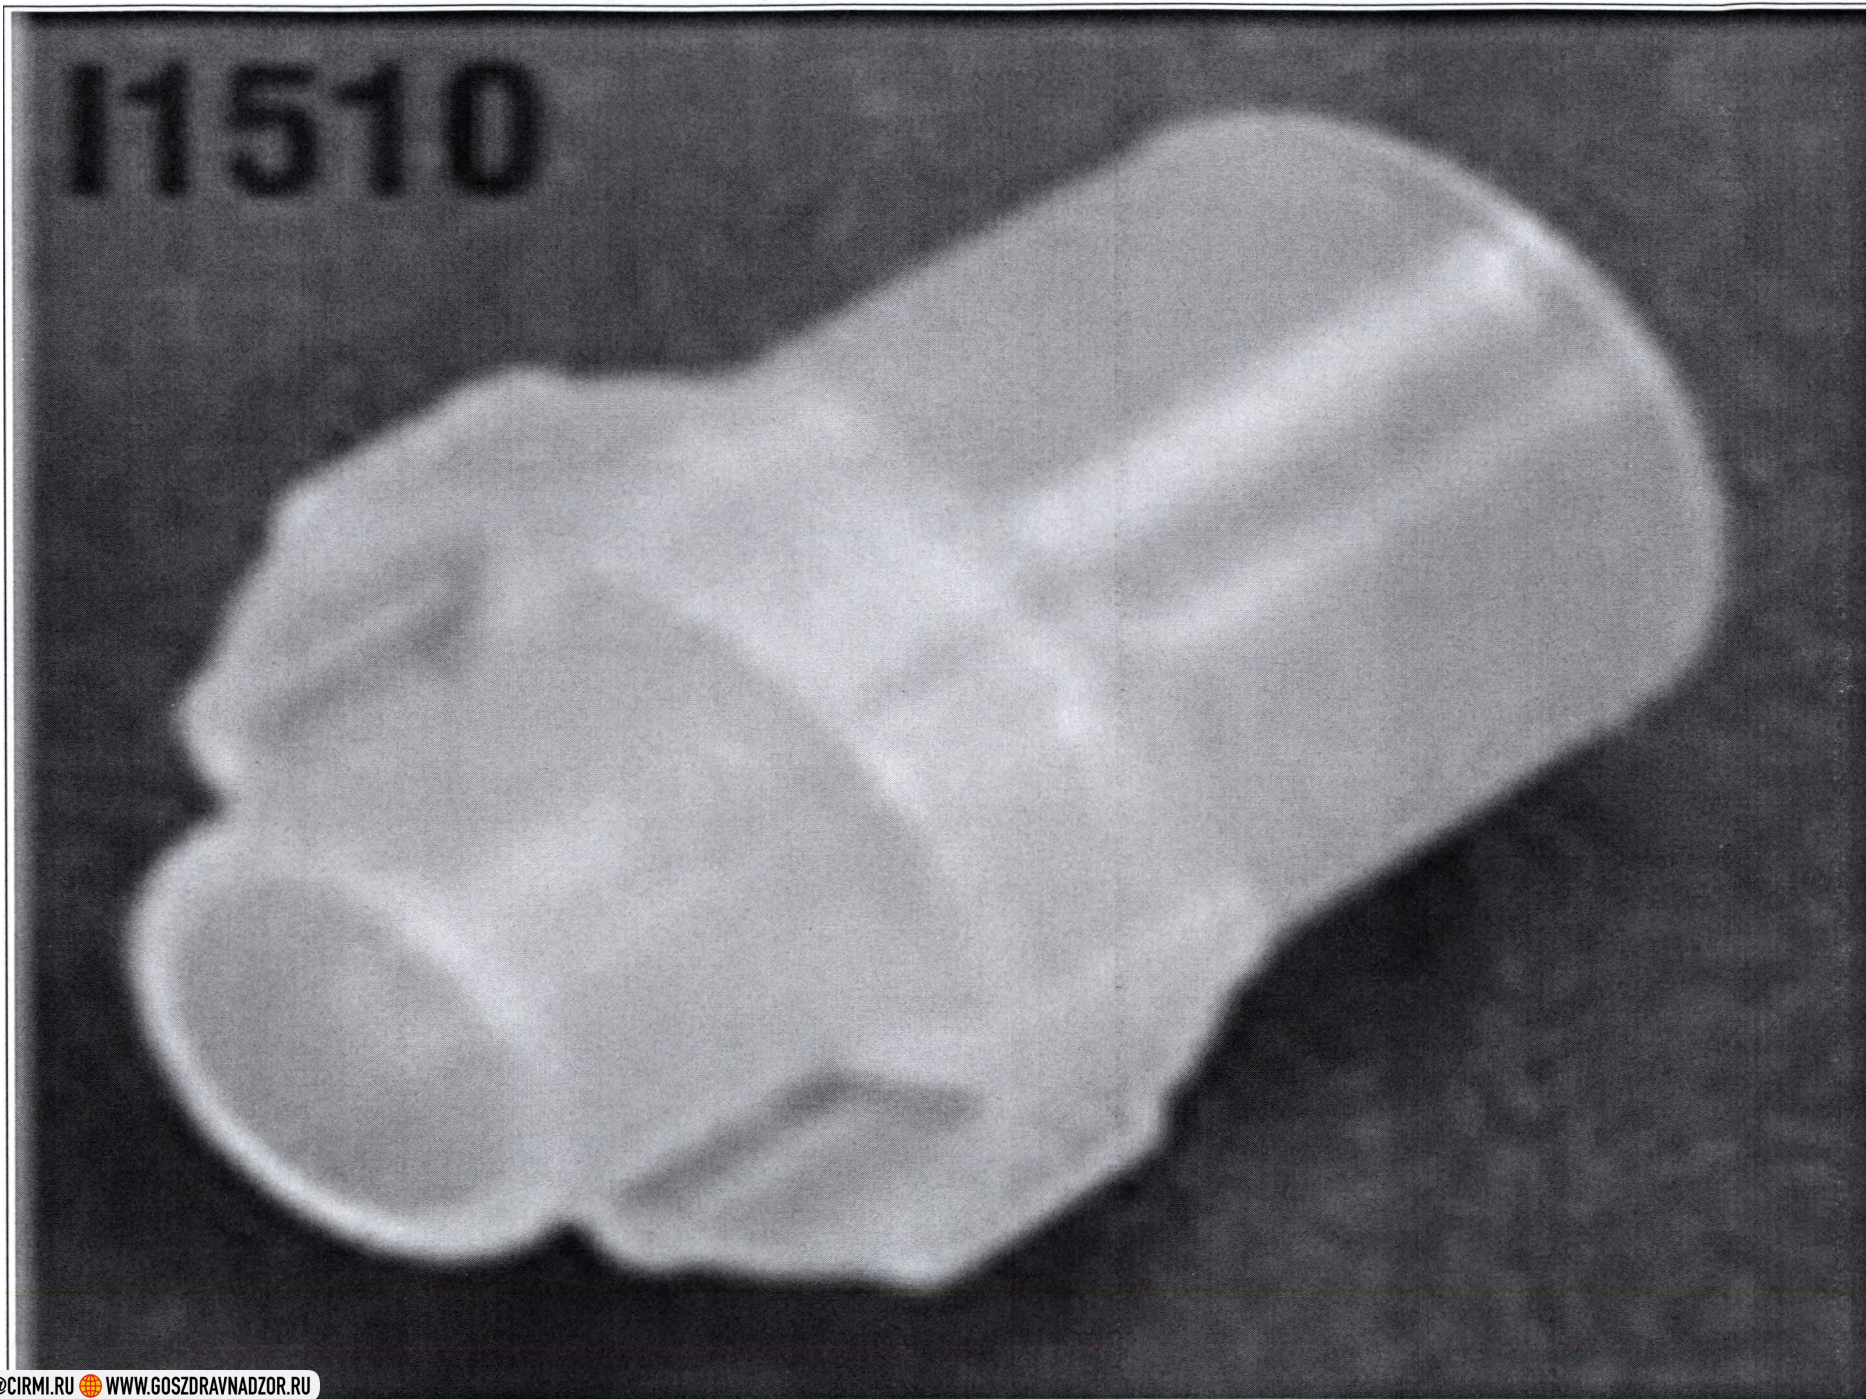



33. Коннекторы (не более 5 шт.).

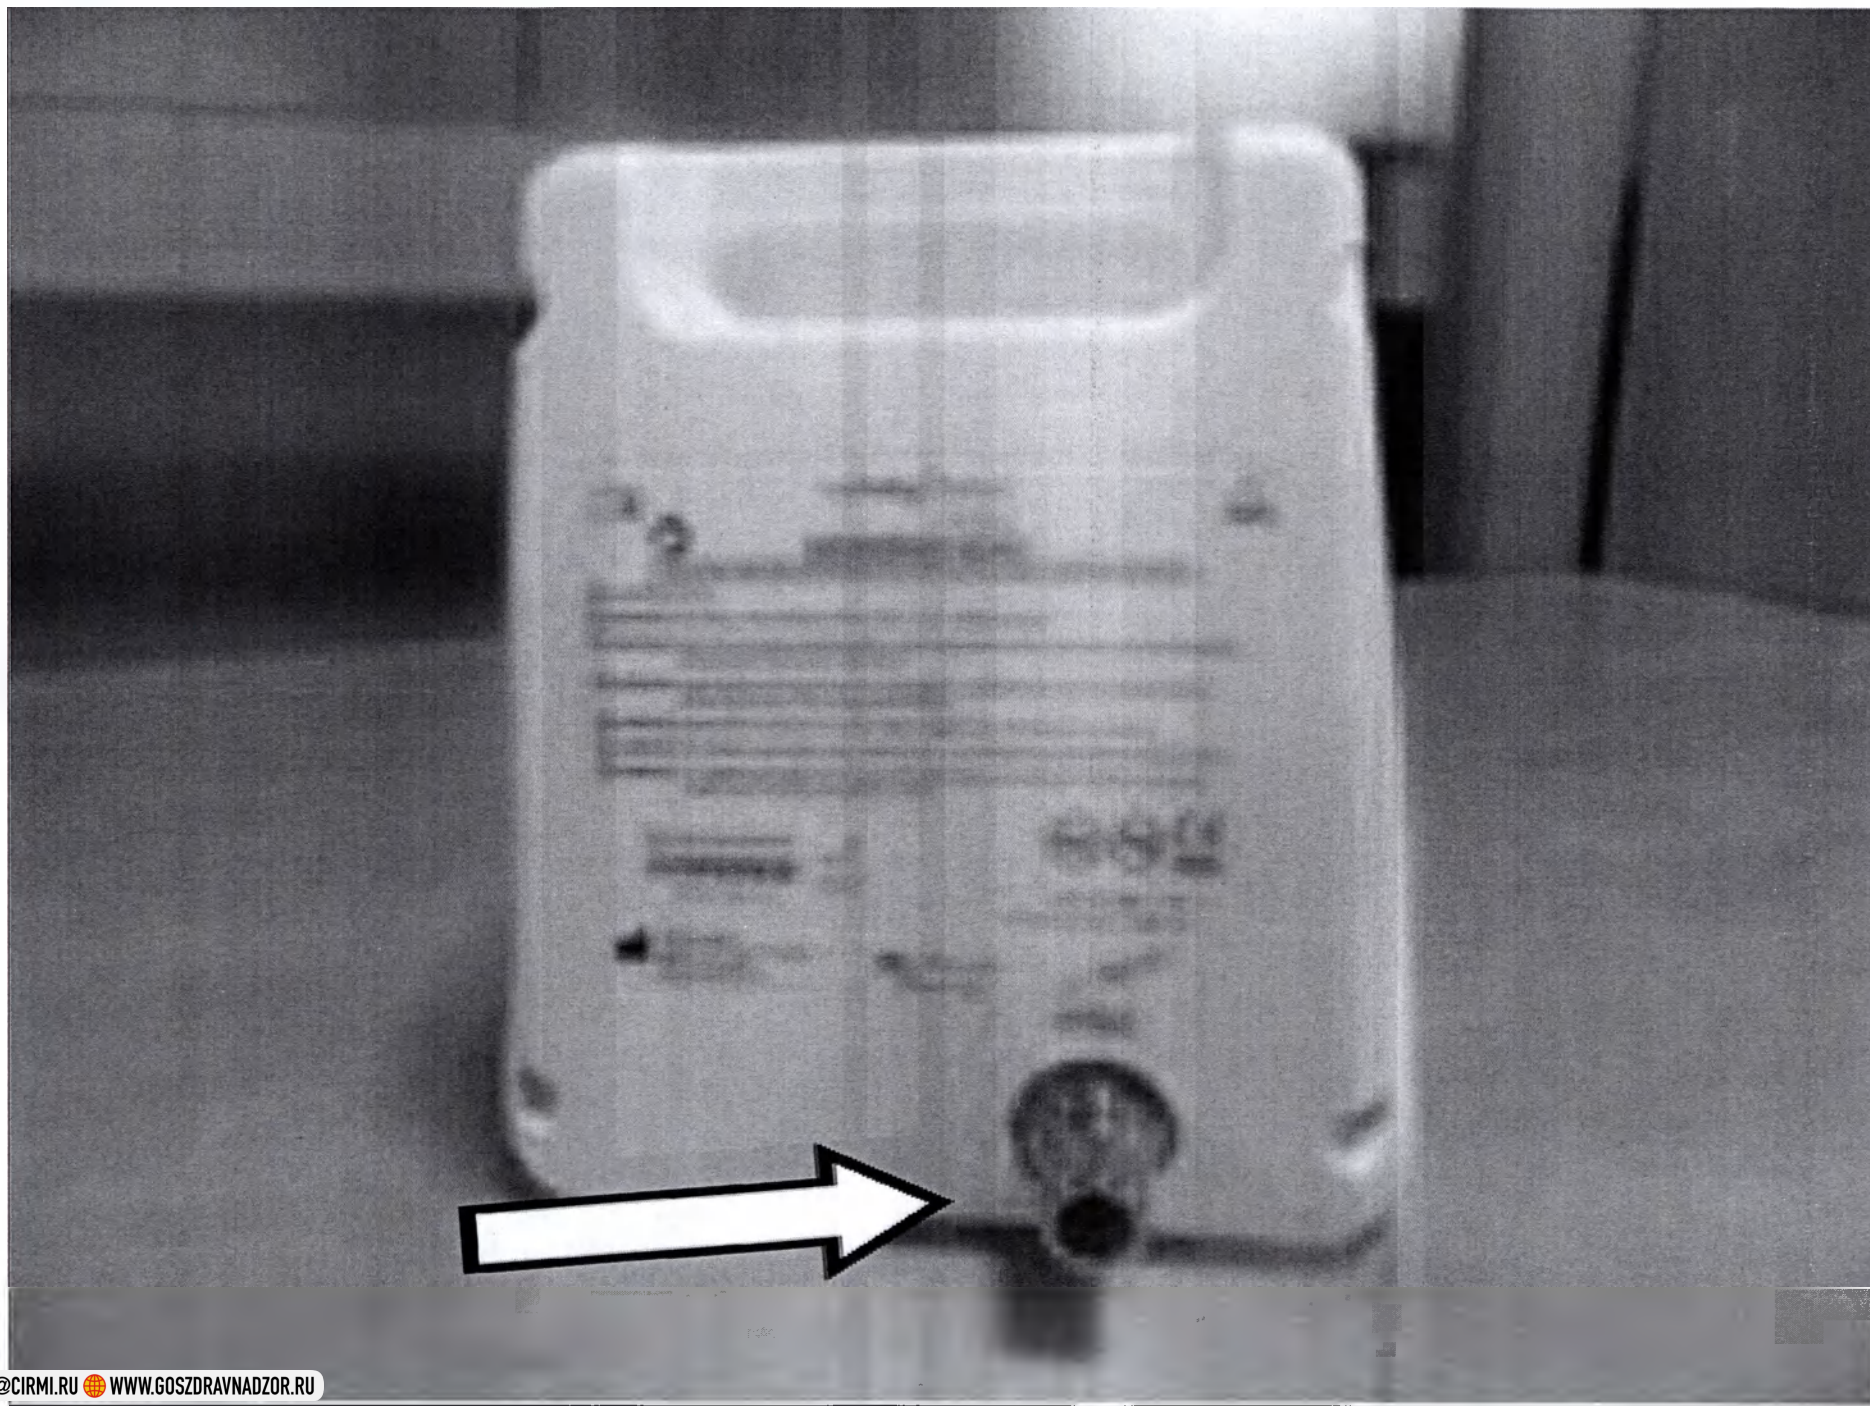


34. Датчики давления (не более 10 шт.).

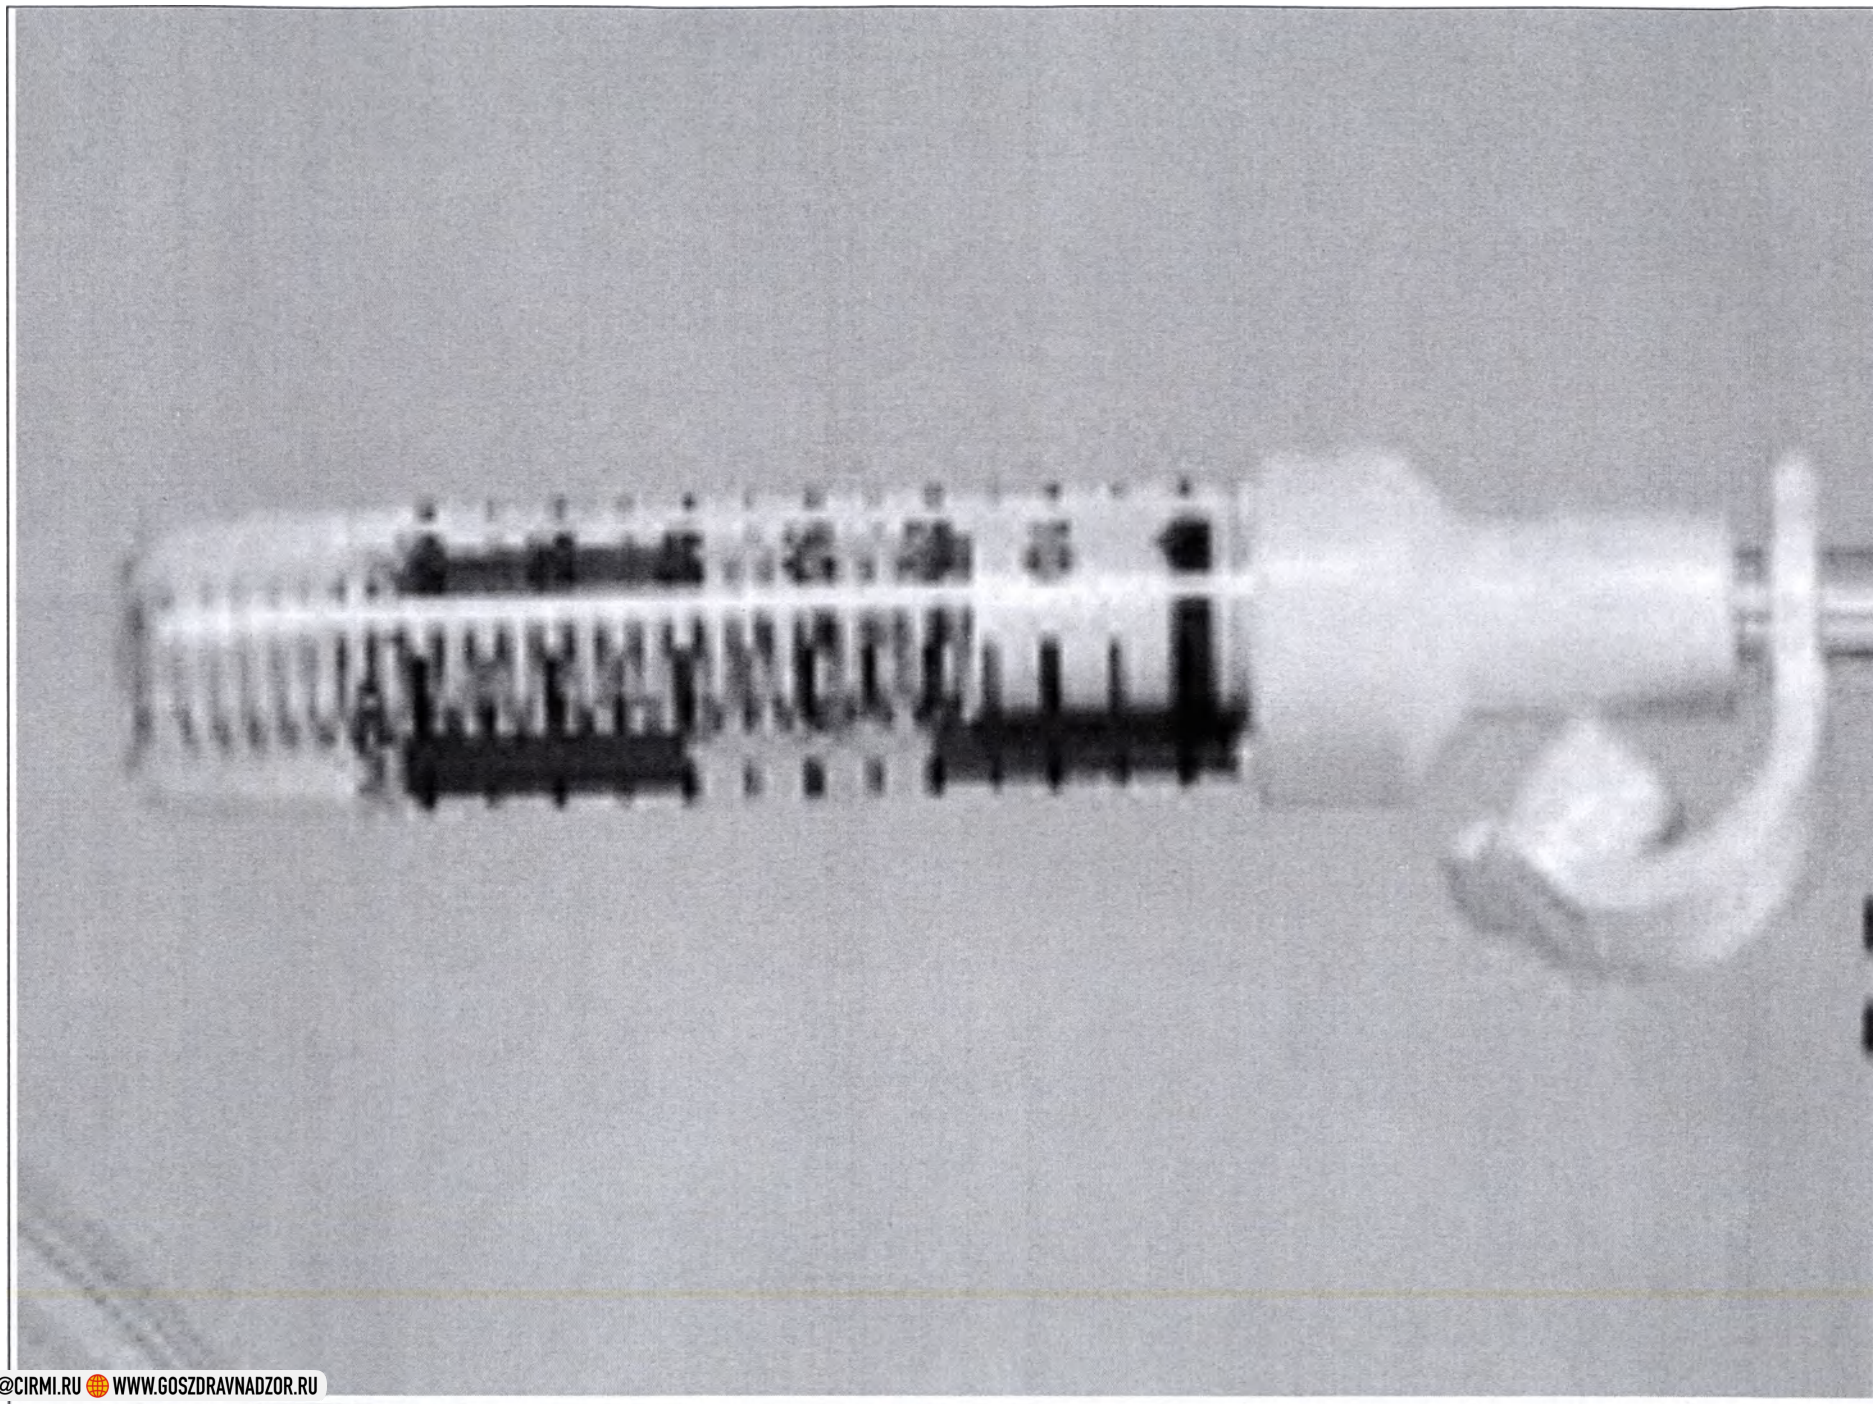

35. Датчики контроля (не более 10 шт.).

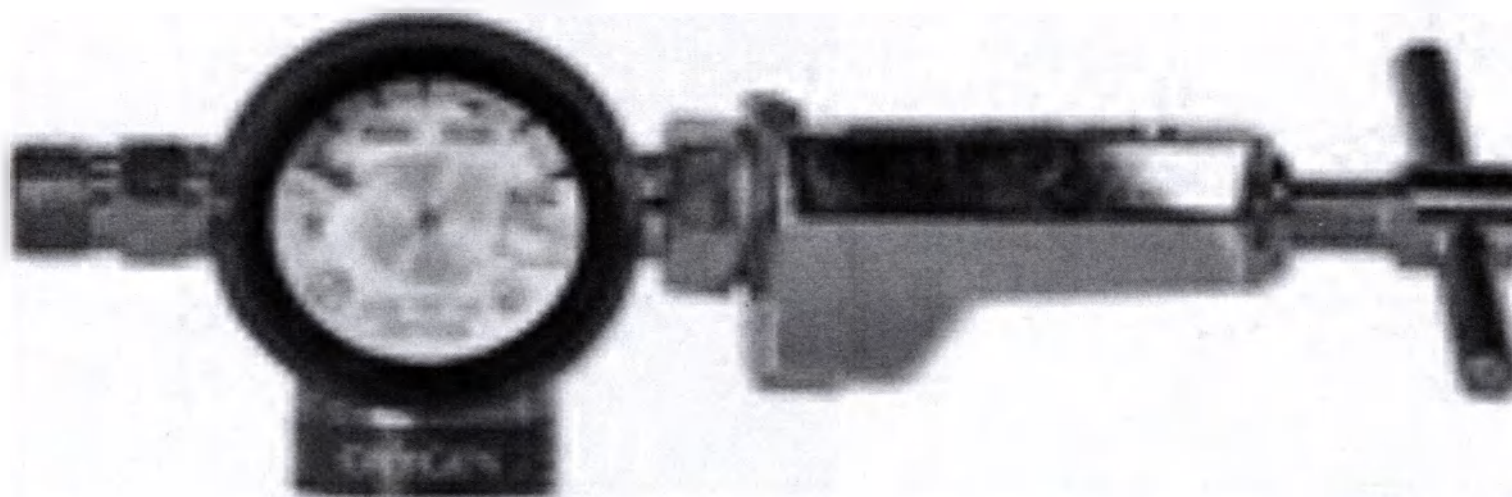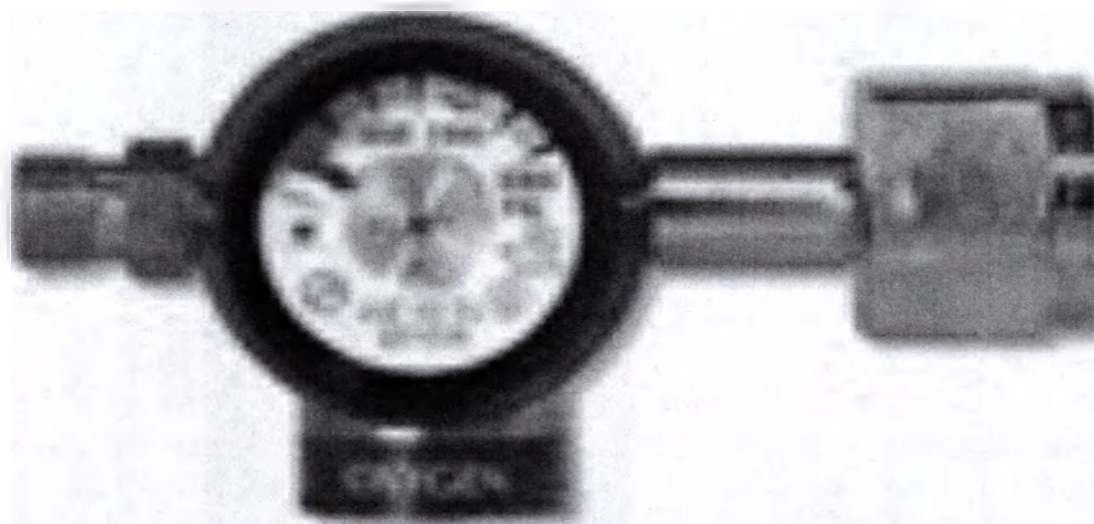


36. Кабели связи с ПК (не более 5 шт.).

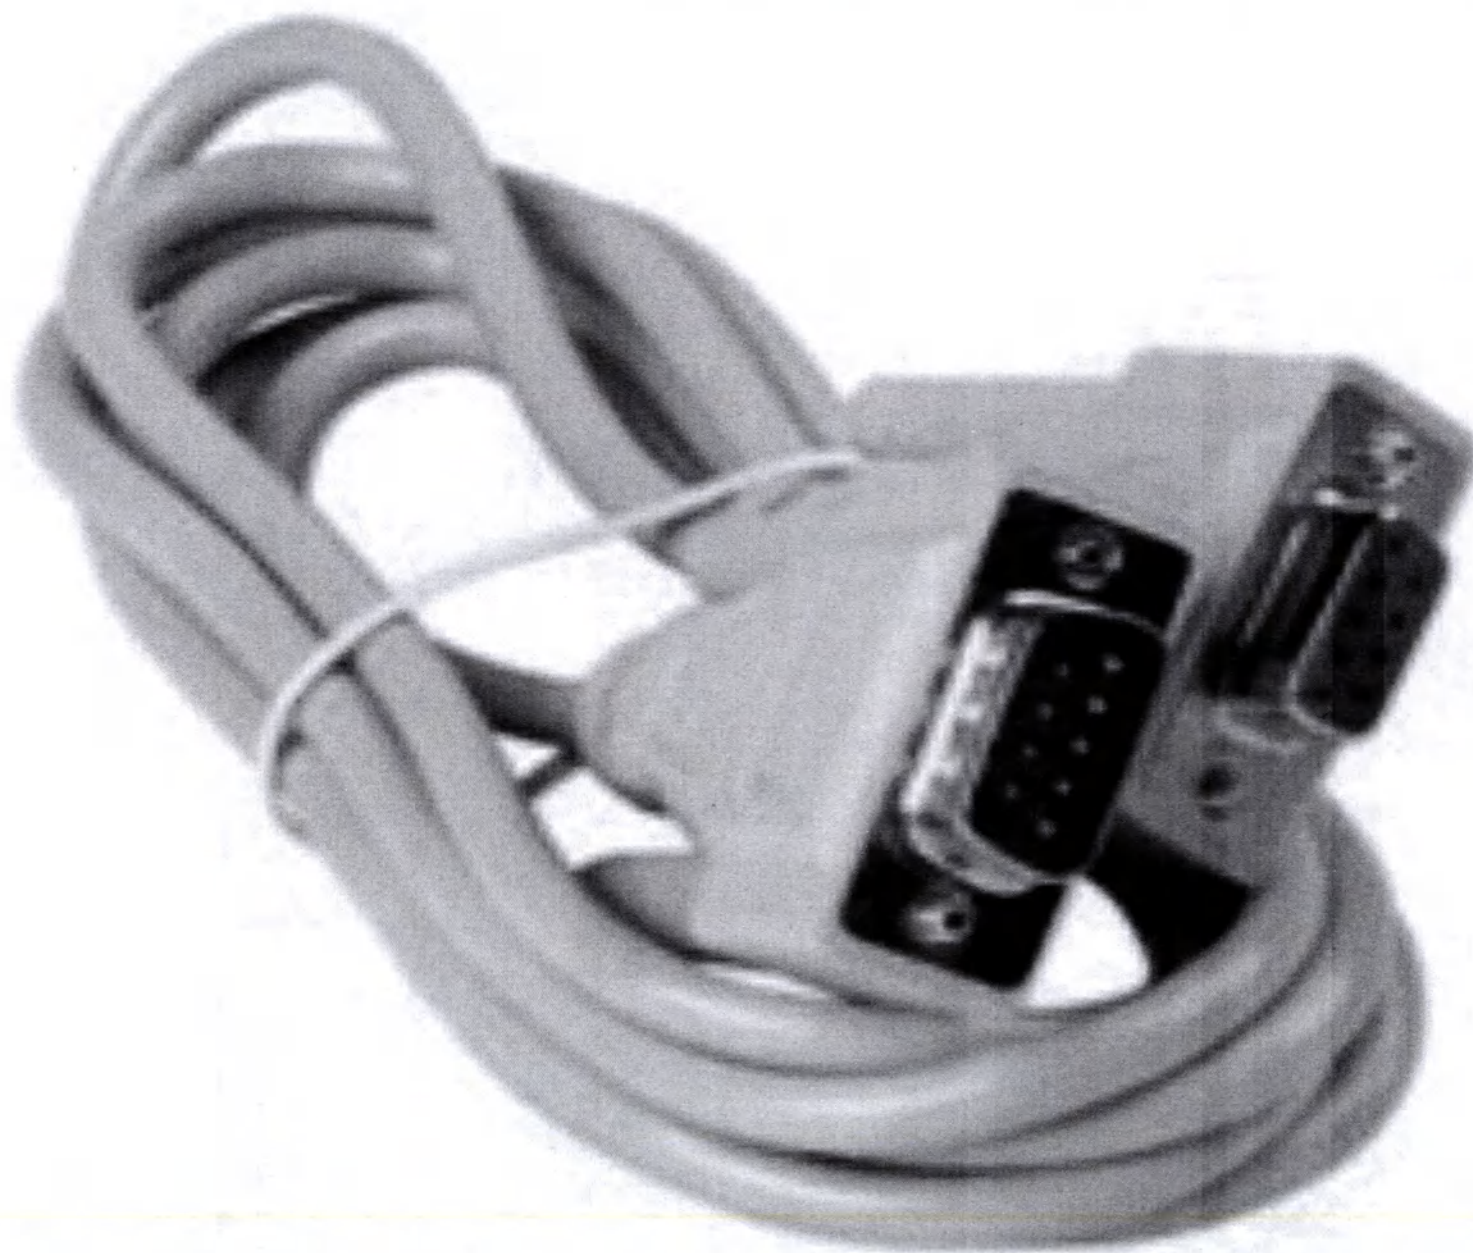

37. Кабели соединительные (не более 5 шт.).




38. Кабель питания.

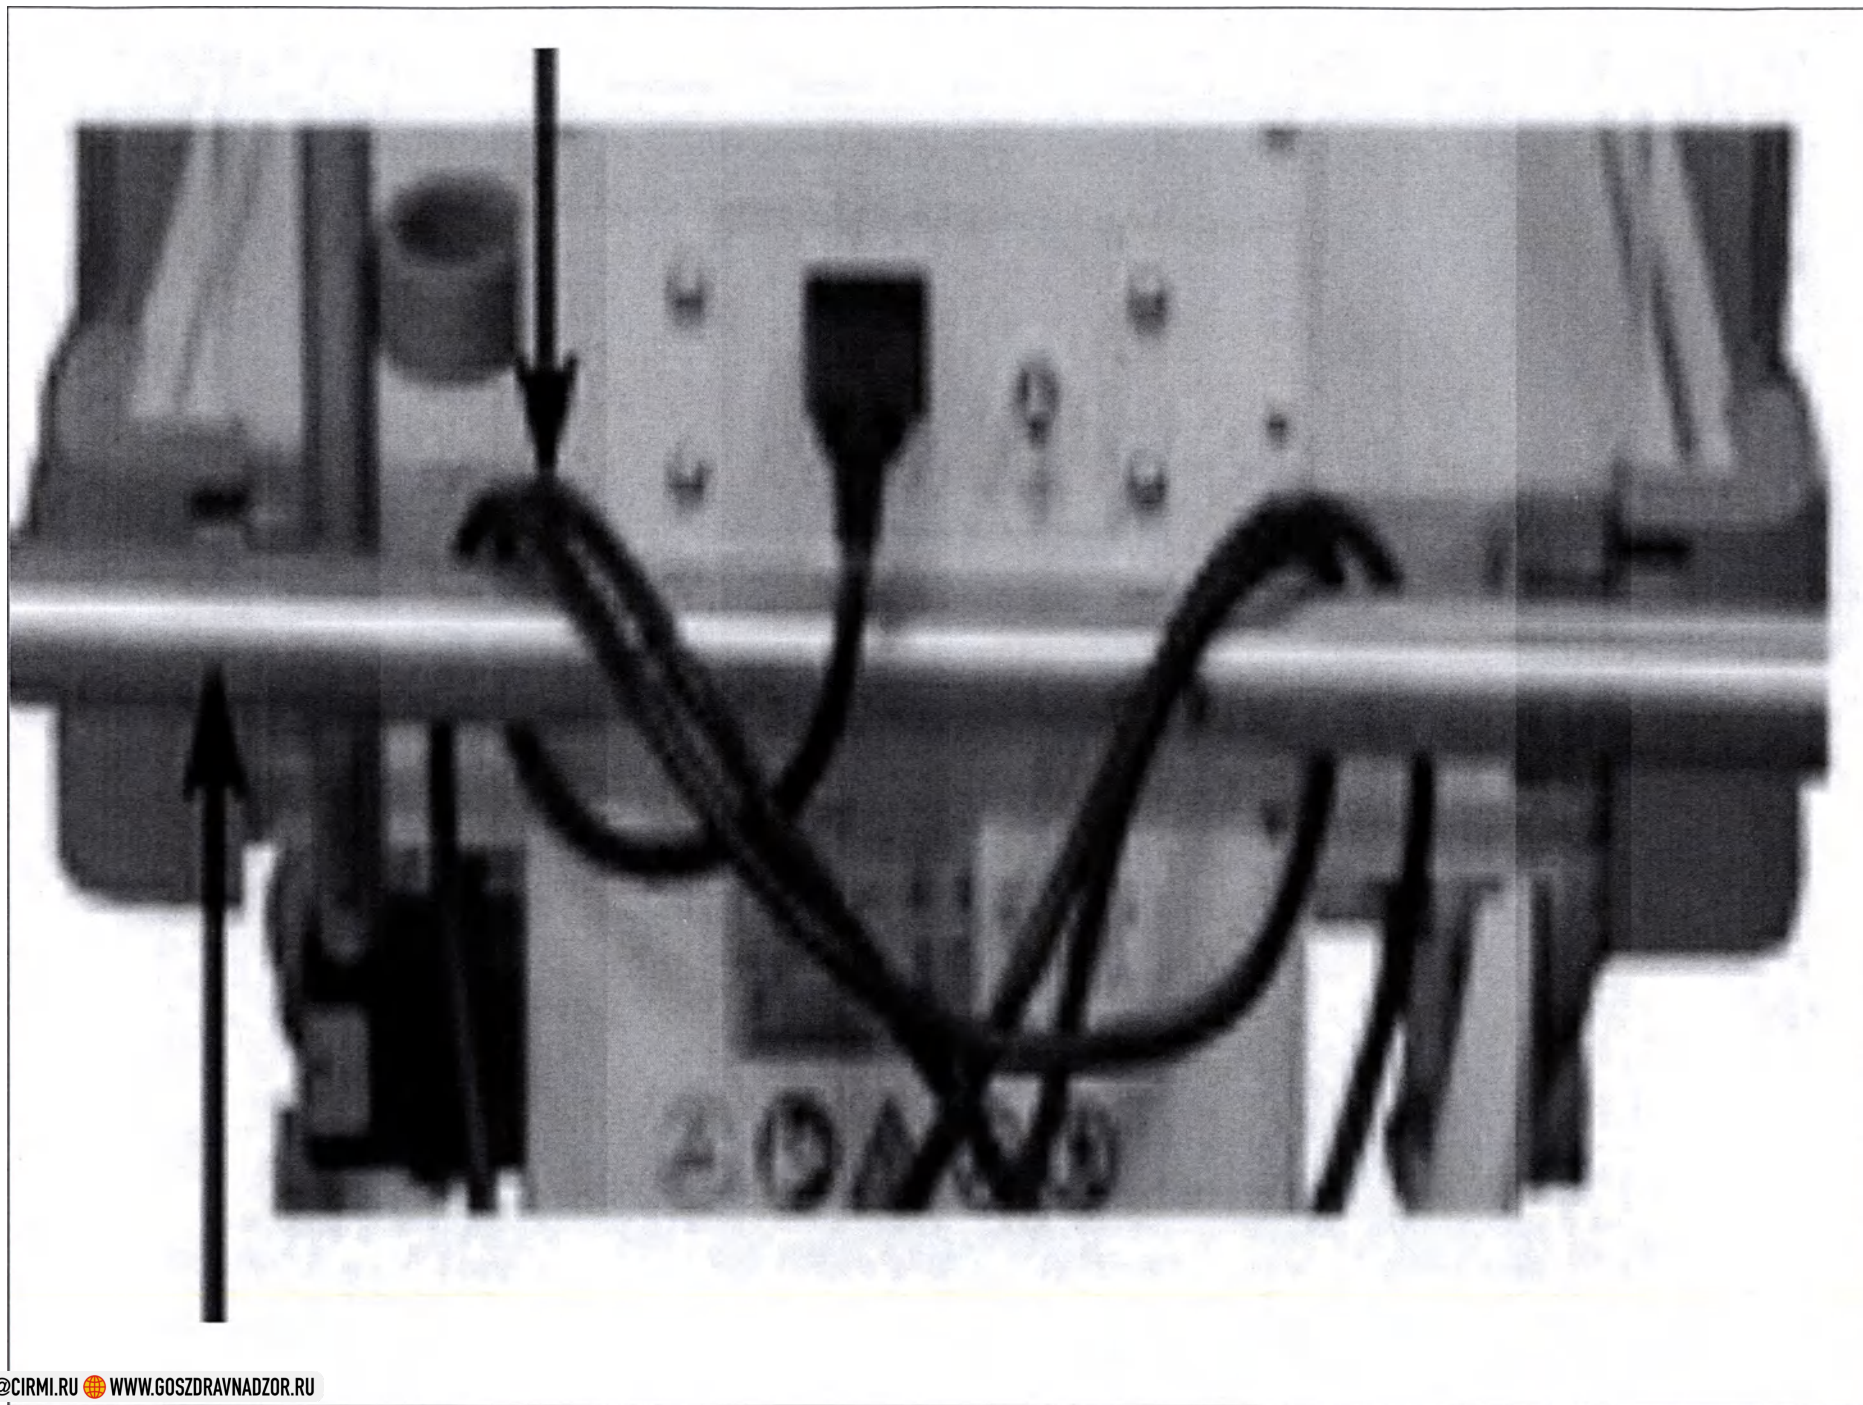


39. Теплоотражающие пластины для датчиков (не более 100 шт.).




40. Датчики для измерения температуры (не более 100 шт.).

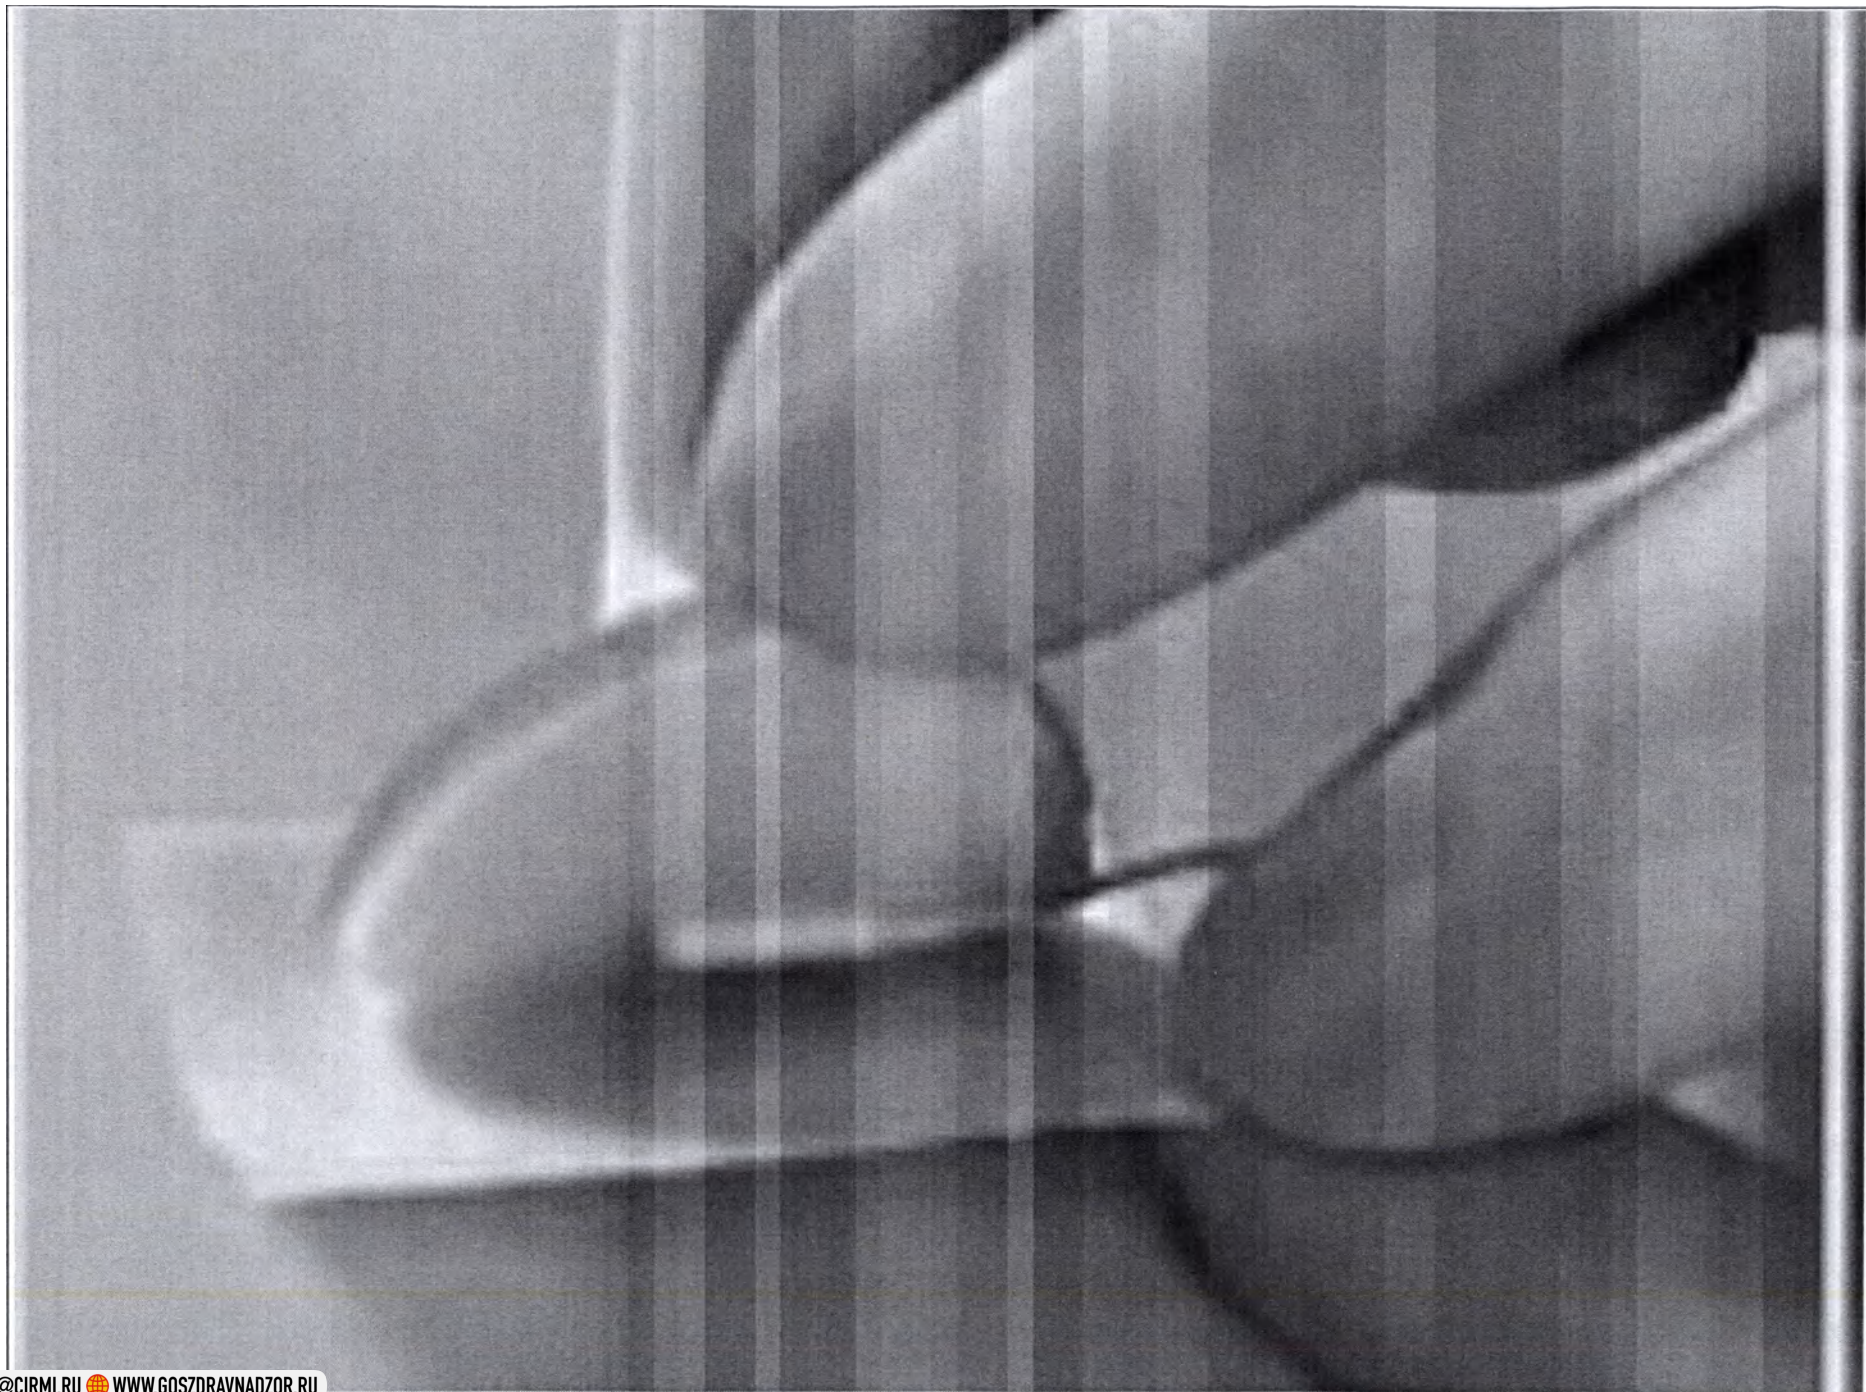


40. Датчики для измерения температуры (не более 100 шт.).

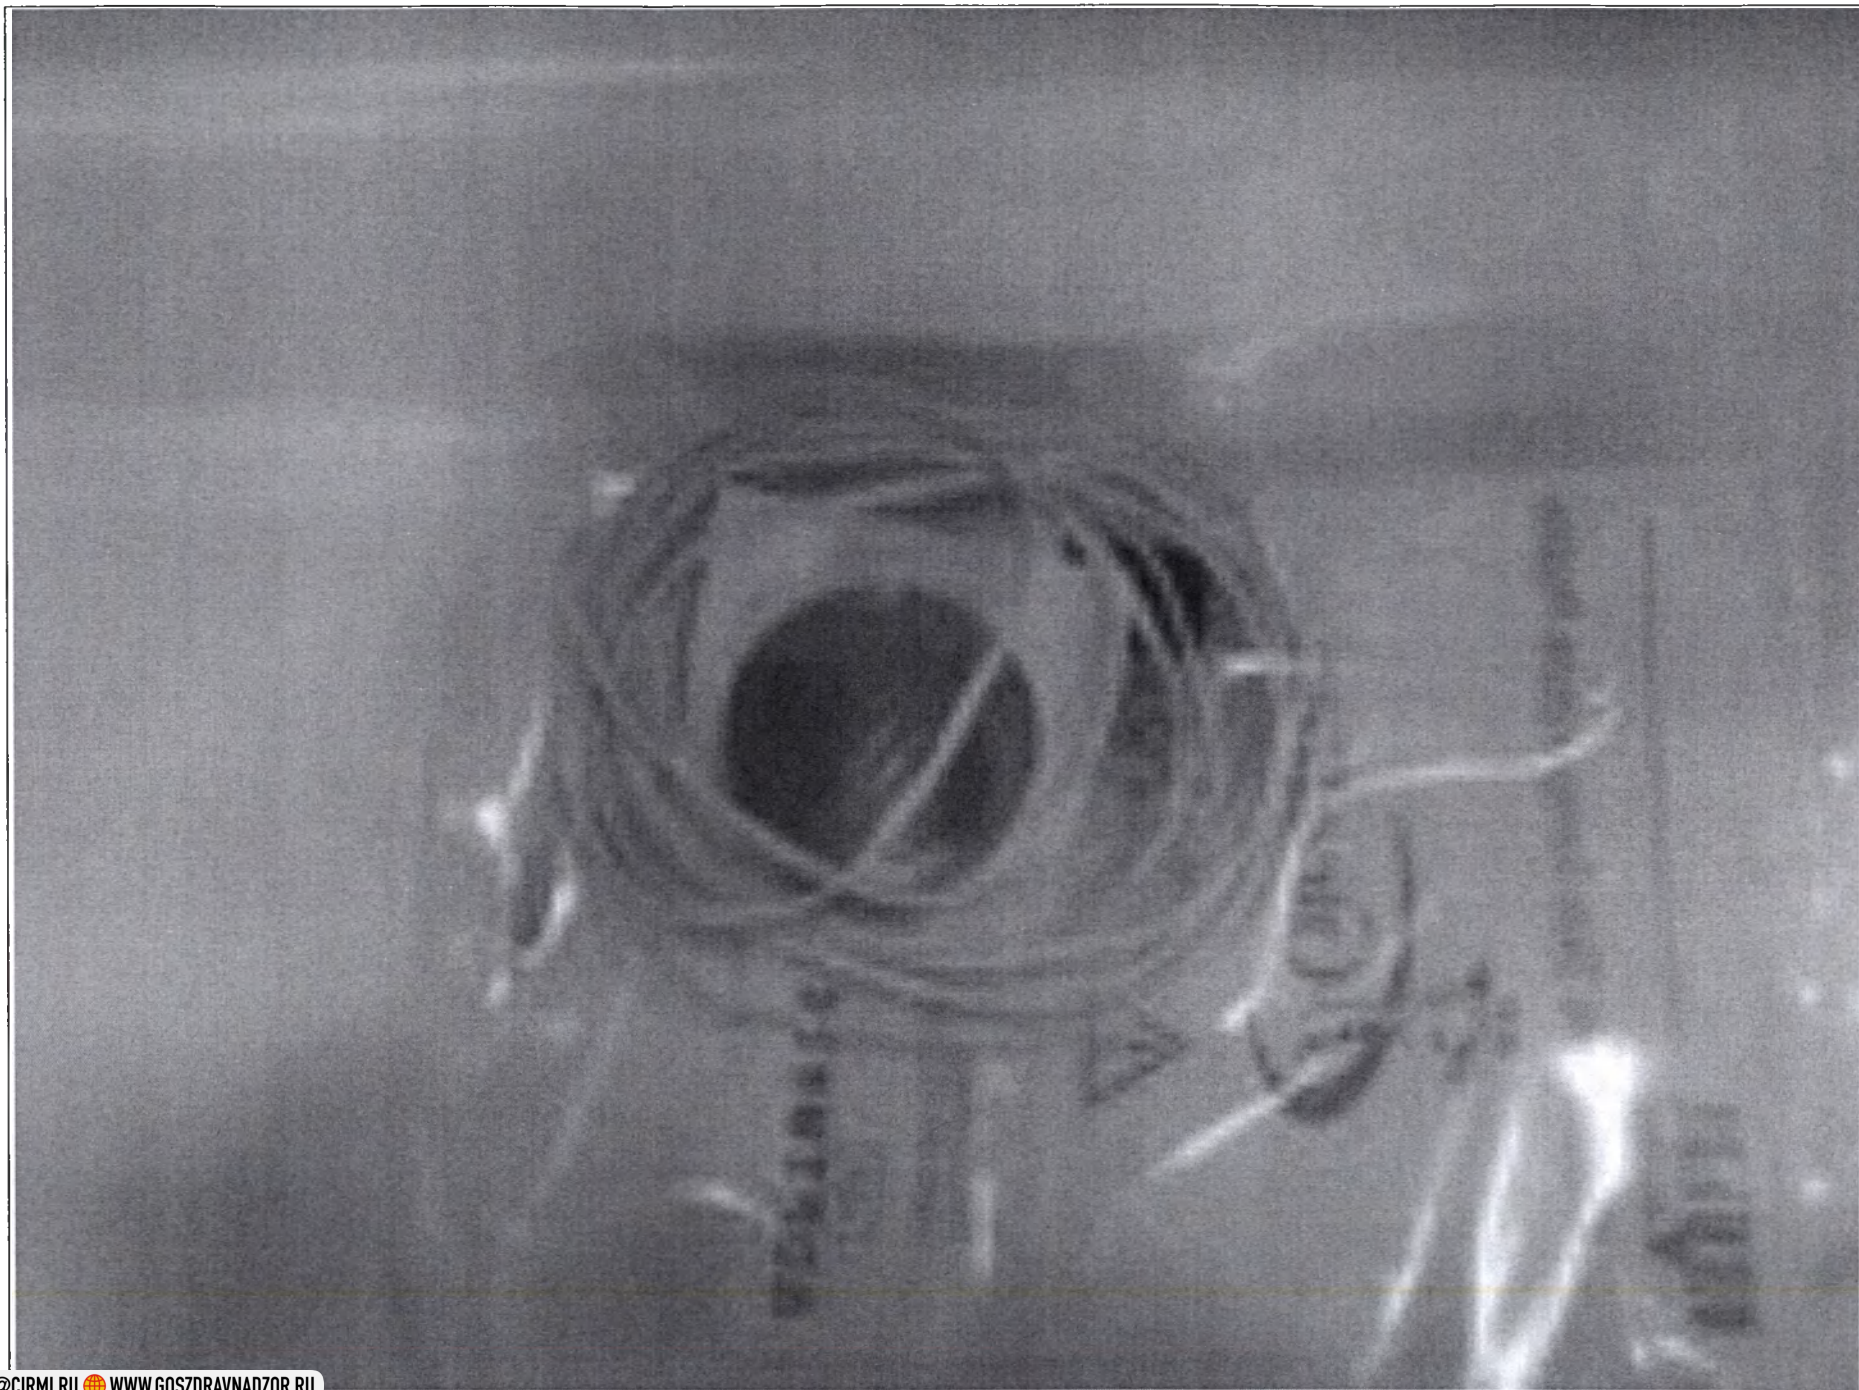


40. Датчики для измерения температуры (не более 100 шт.).

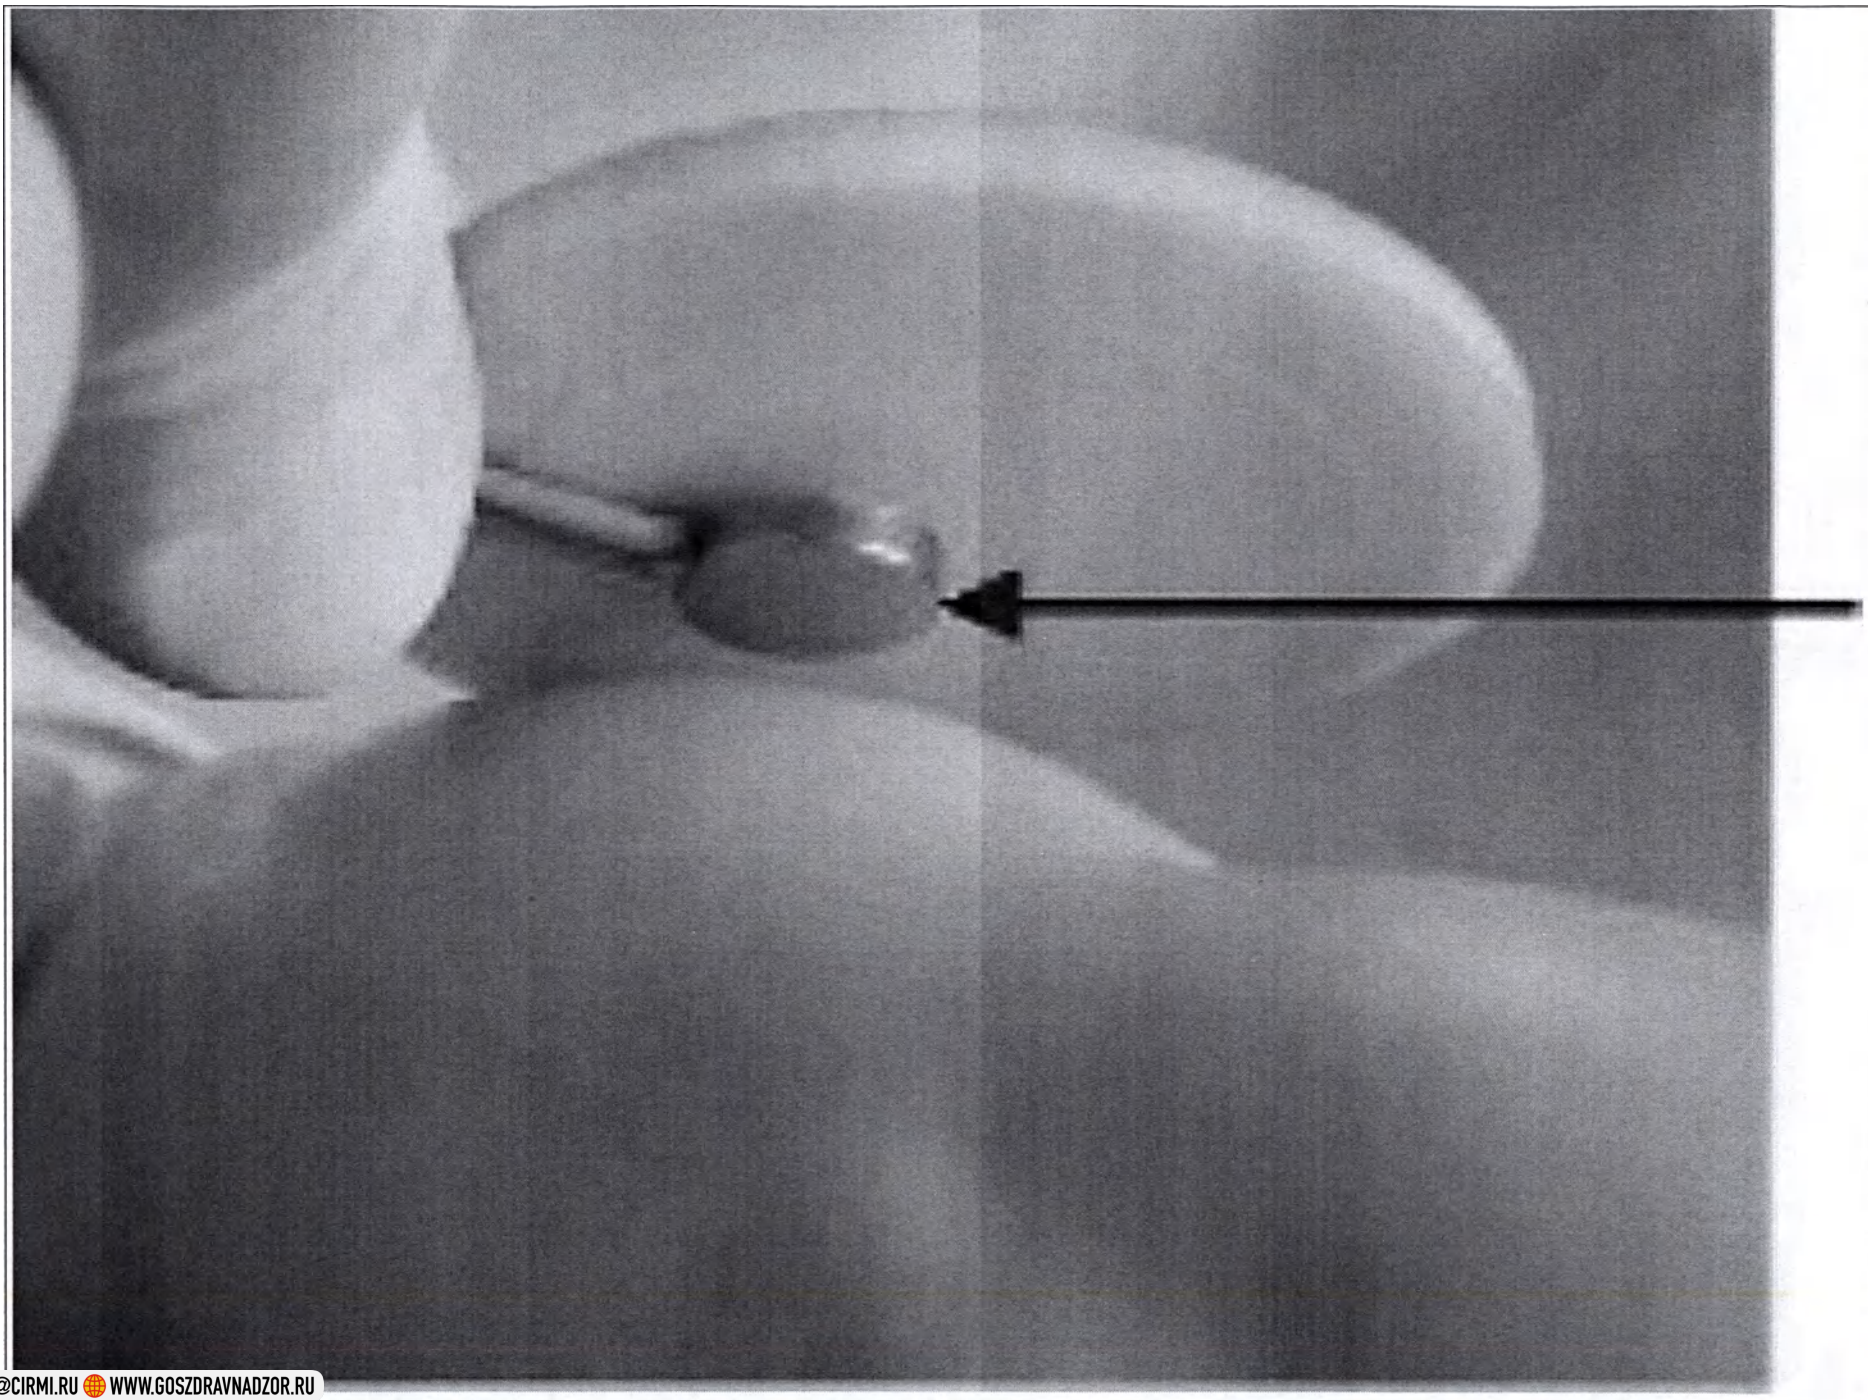

40. Датчики для измерения температуры (не более 100 шт.).

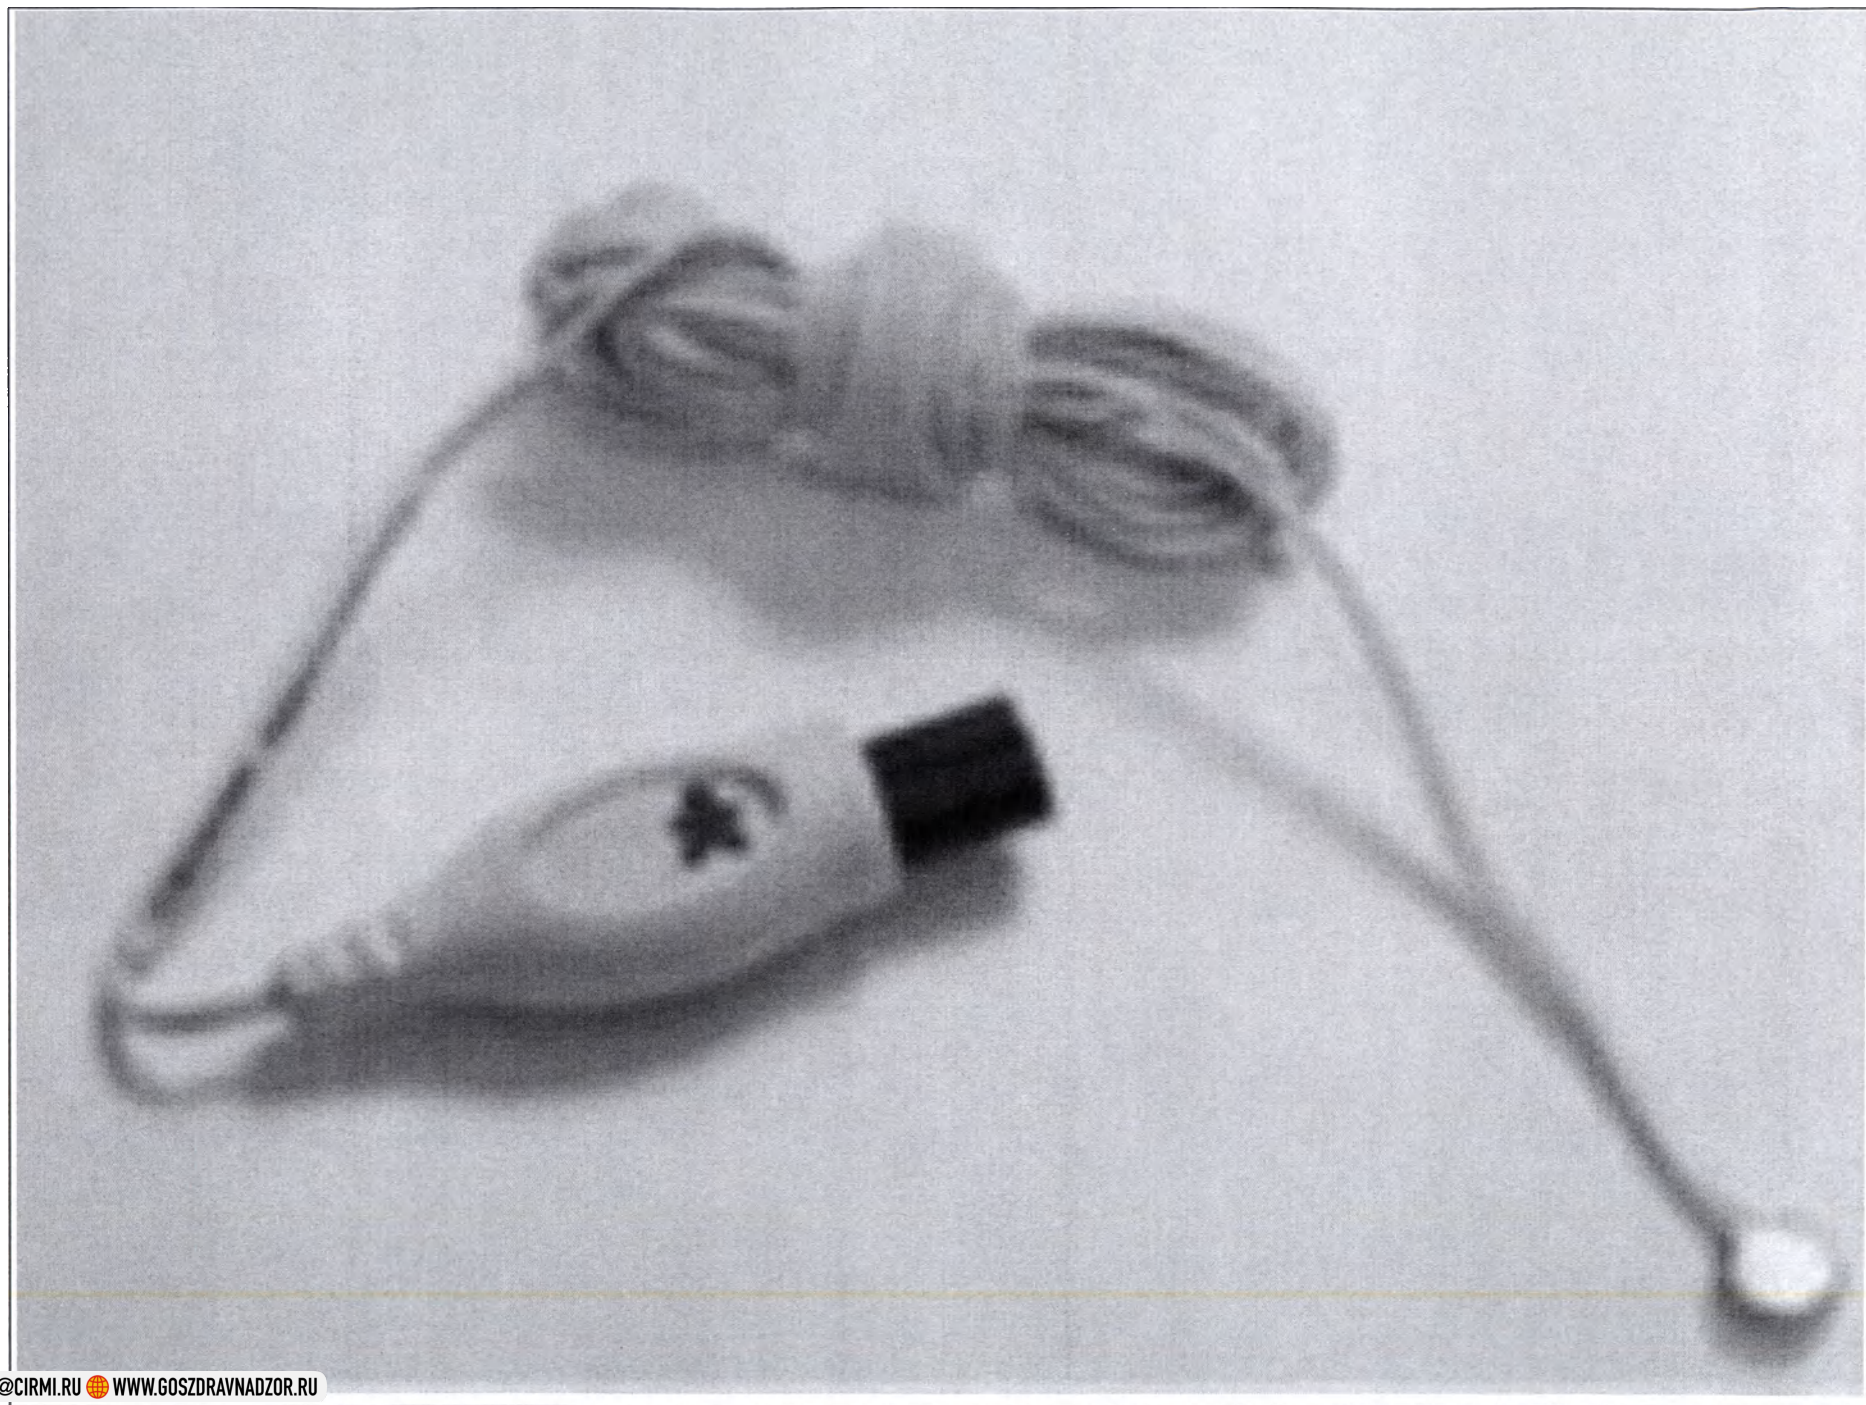


41. Шланги для кислорода (не более 5 шт.).

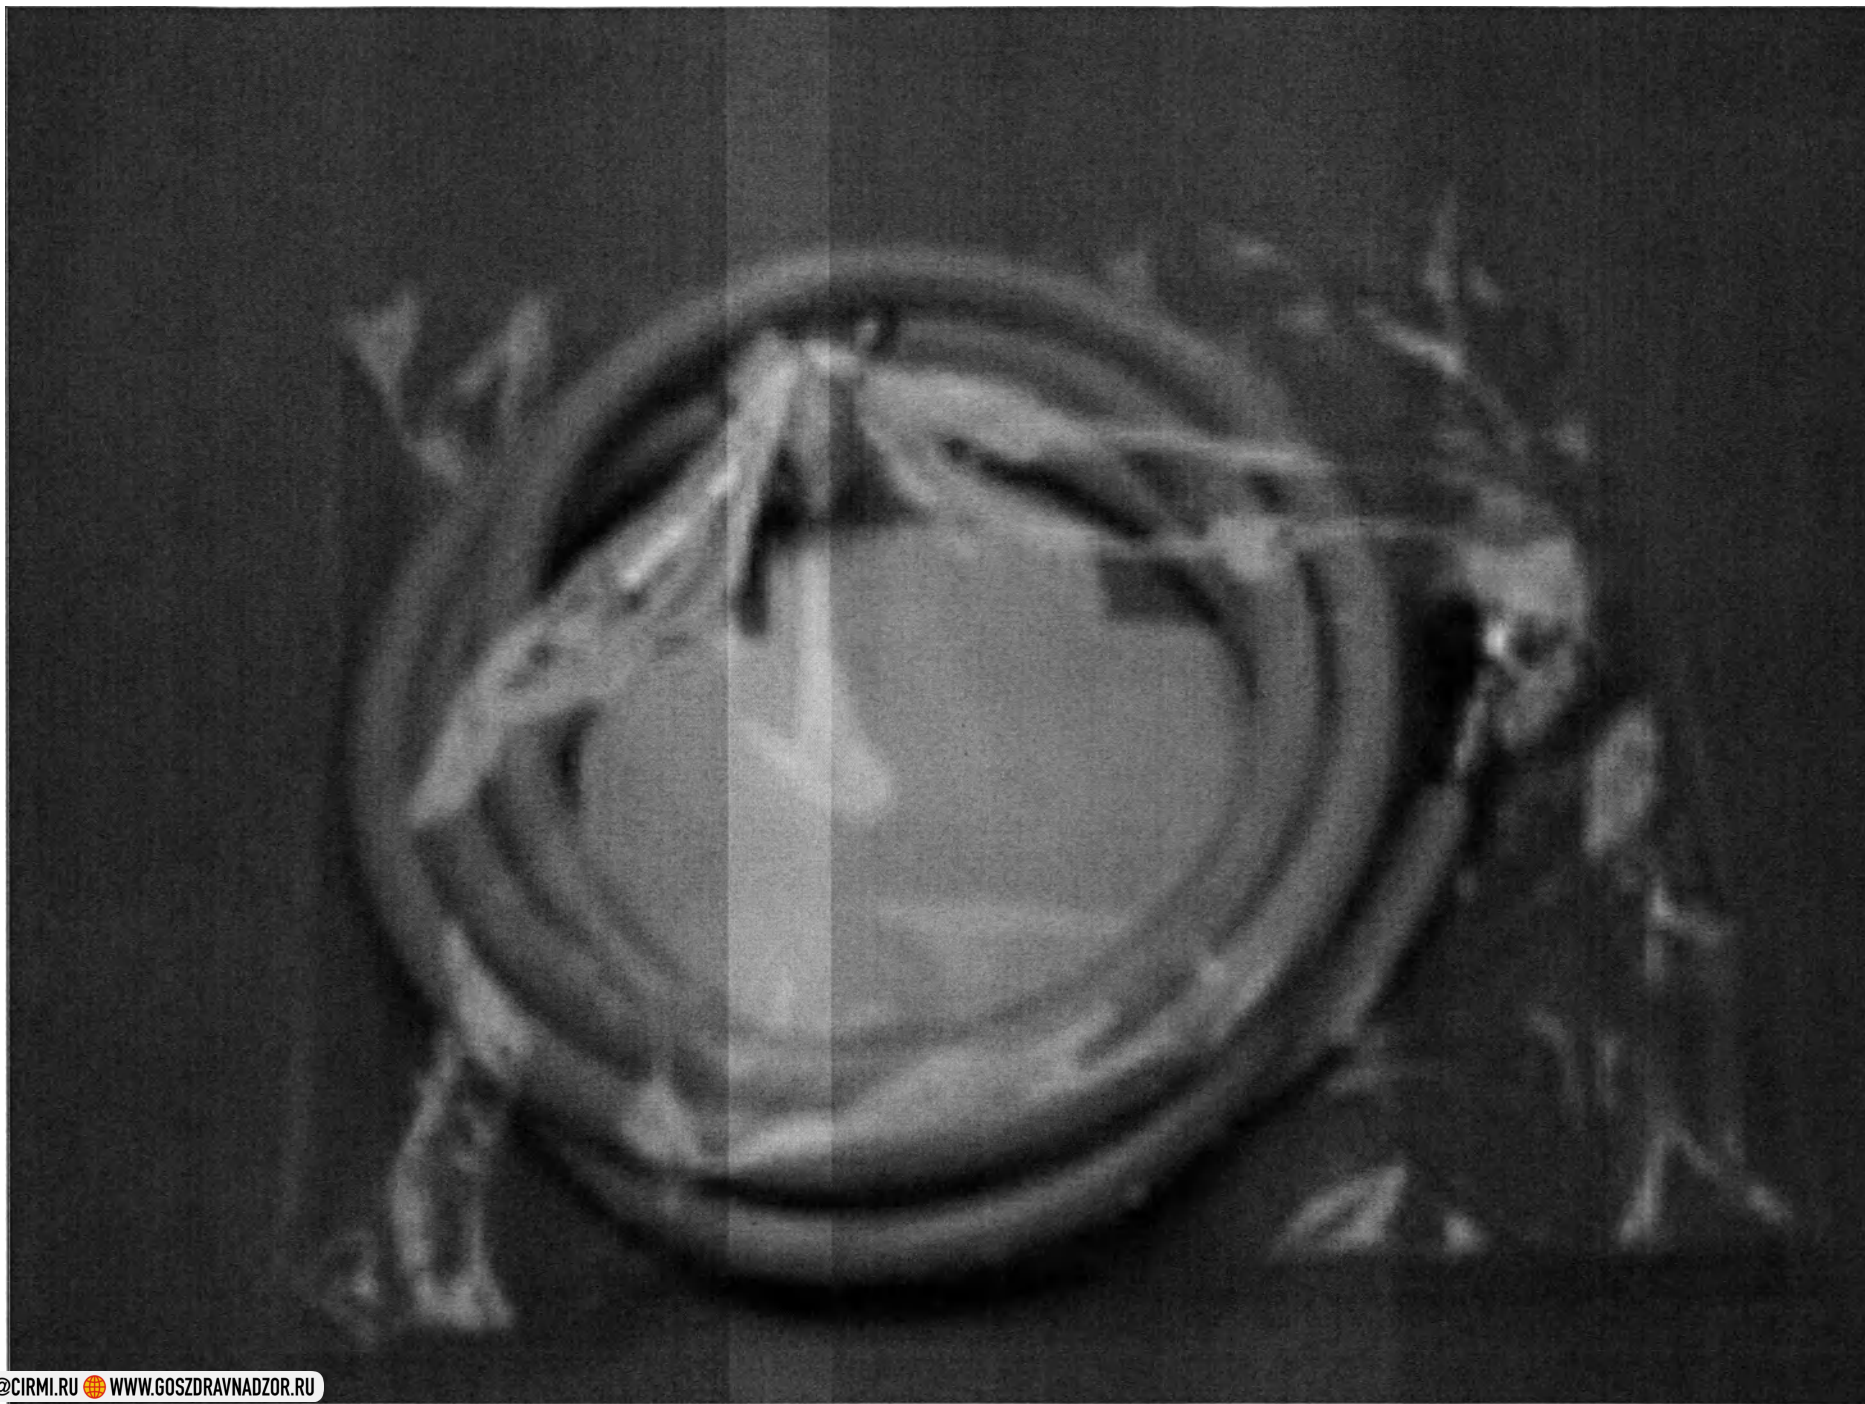


42. Шланги для воздуха (не более 5 шт.).




43. Шланги для аспиратора (не более 5 шт.).

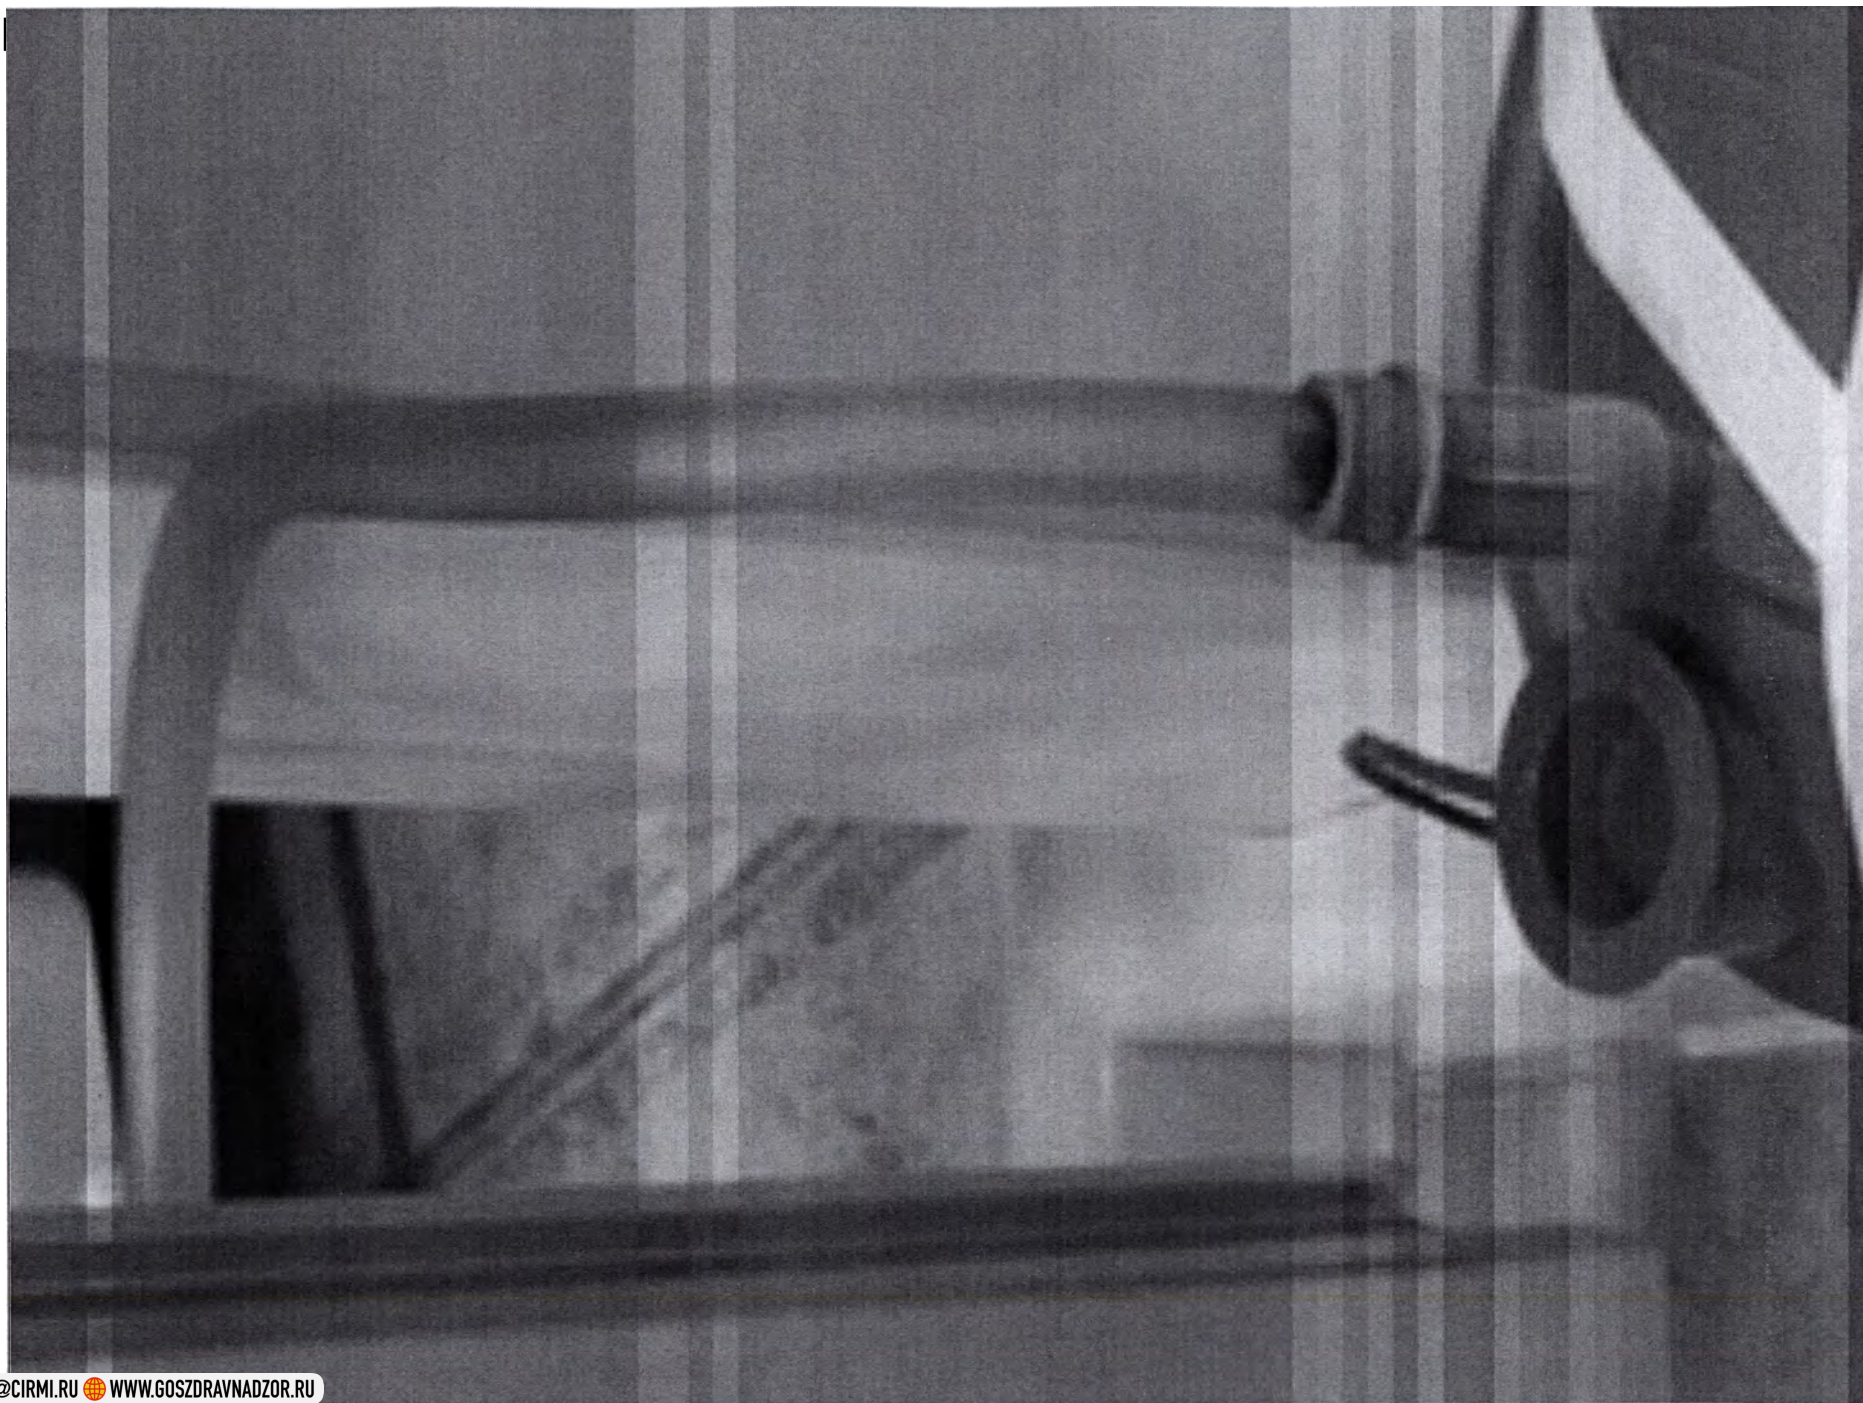

43. Шланги для аспиратора (не более 5 шт.).

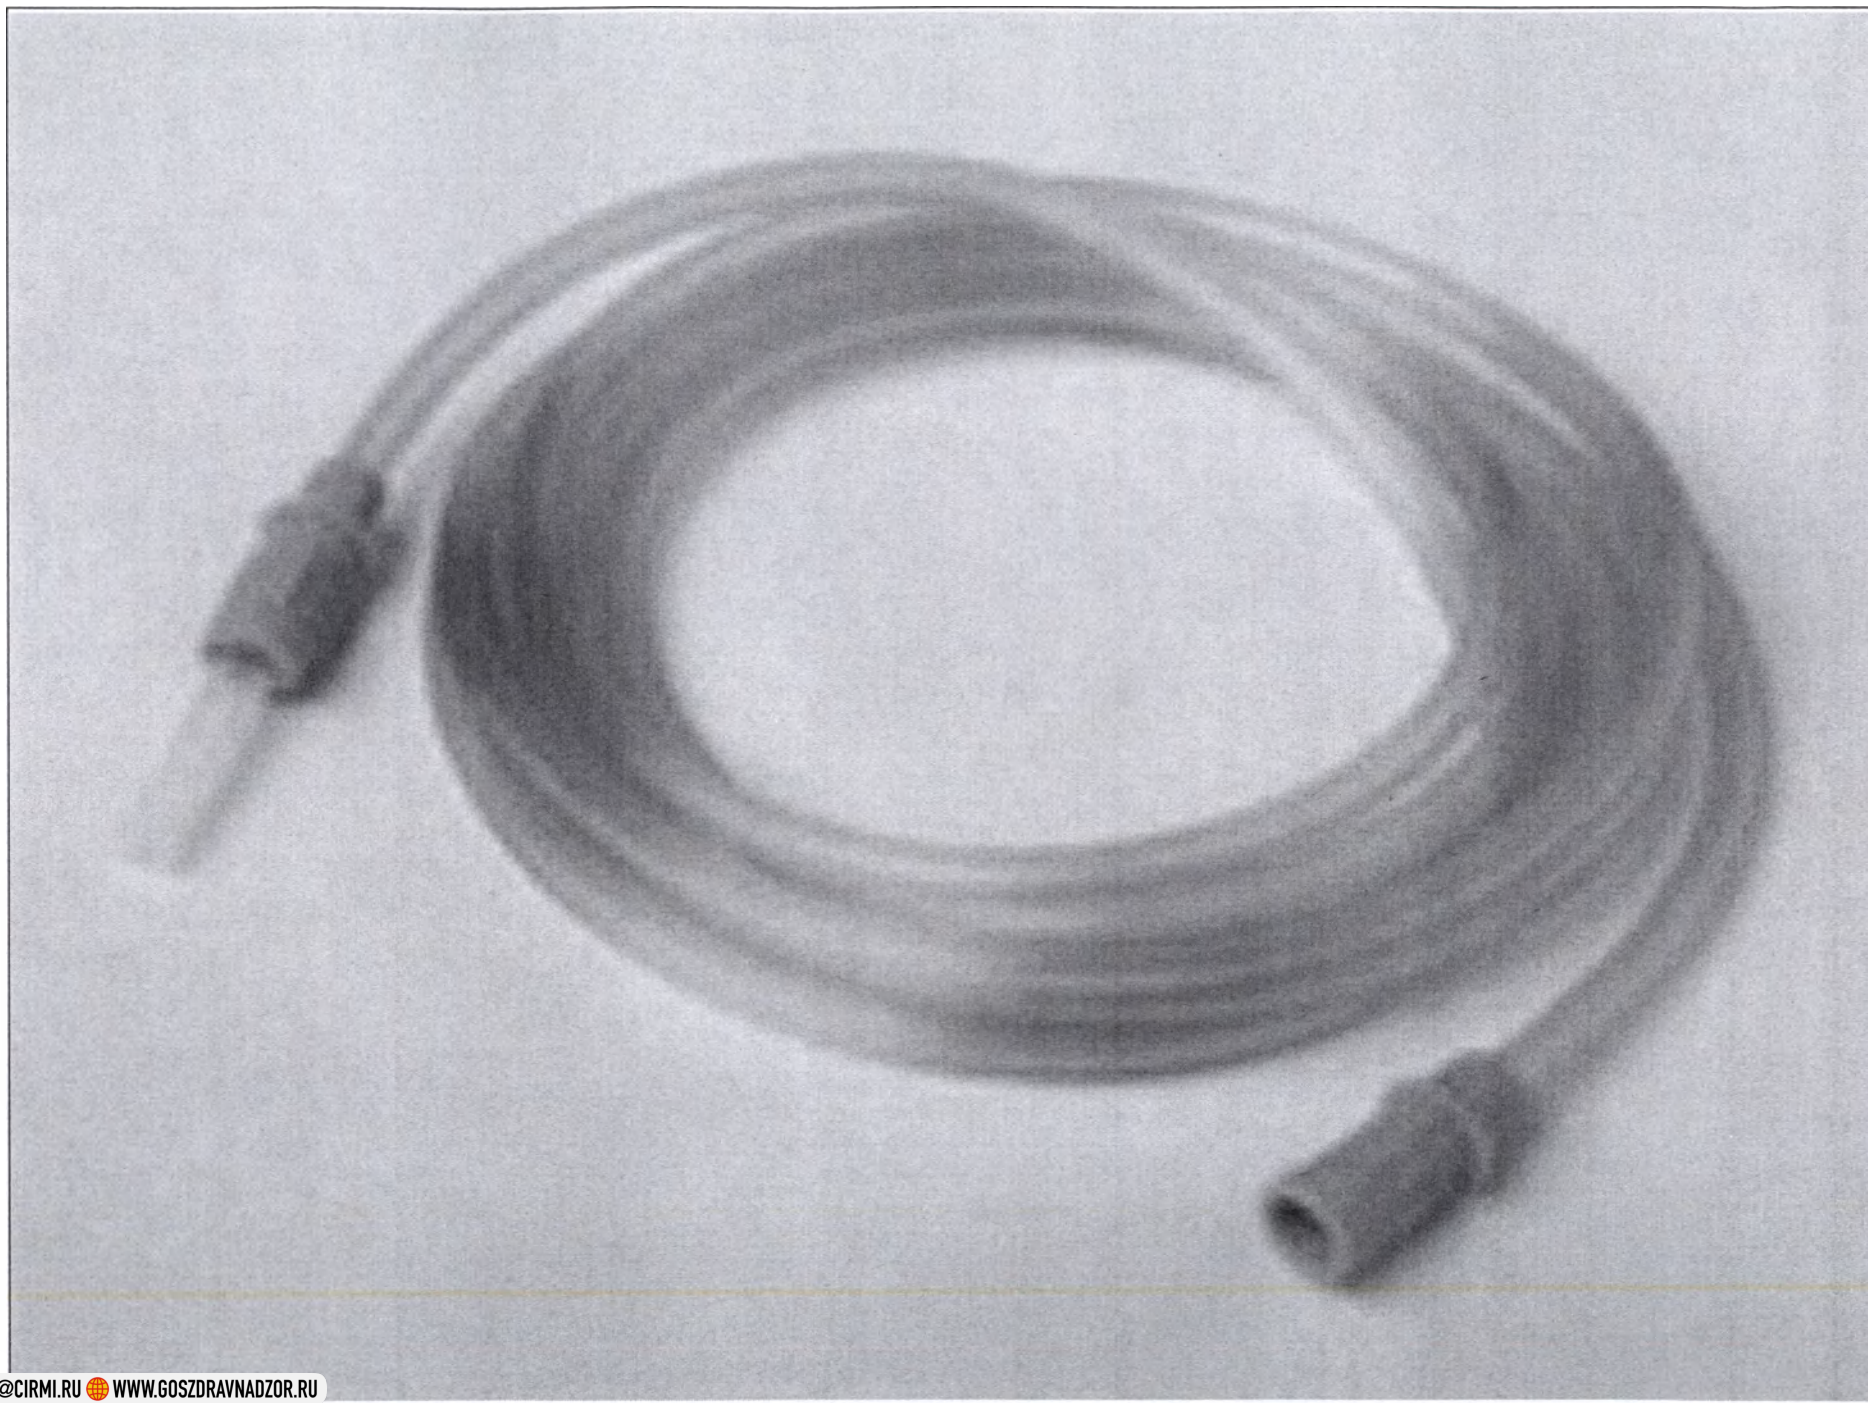


44. Вакуумные аспираторы (не более 5 шт.).

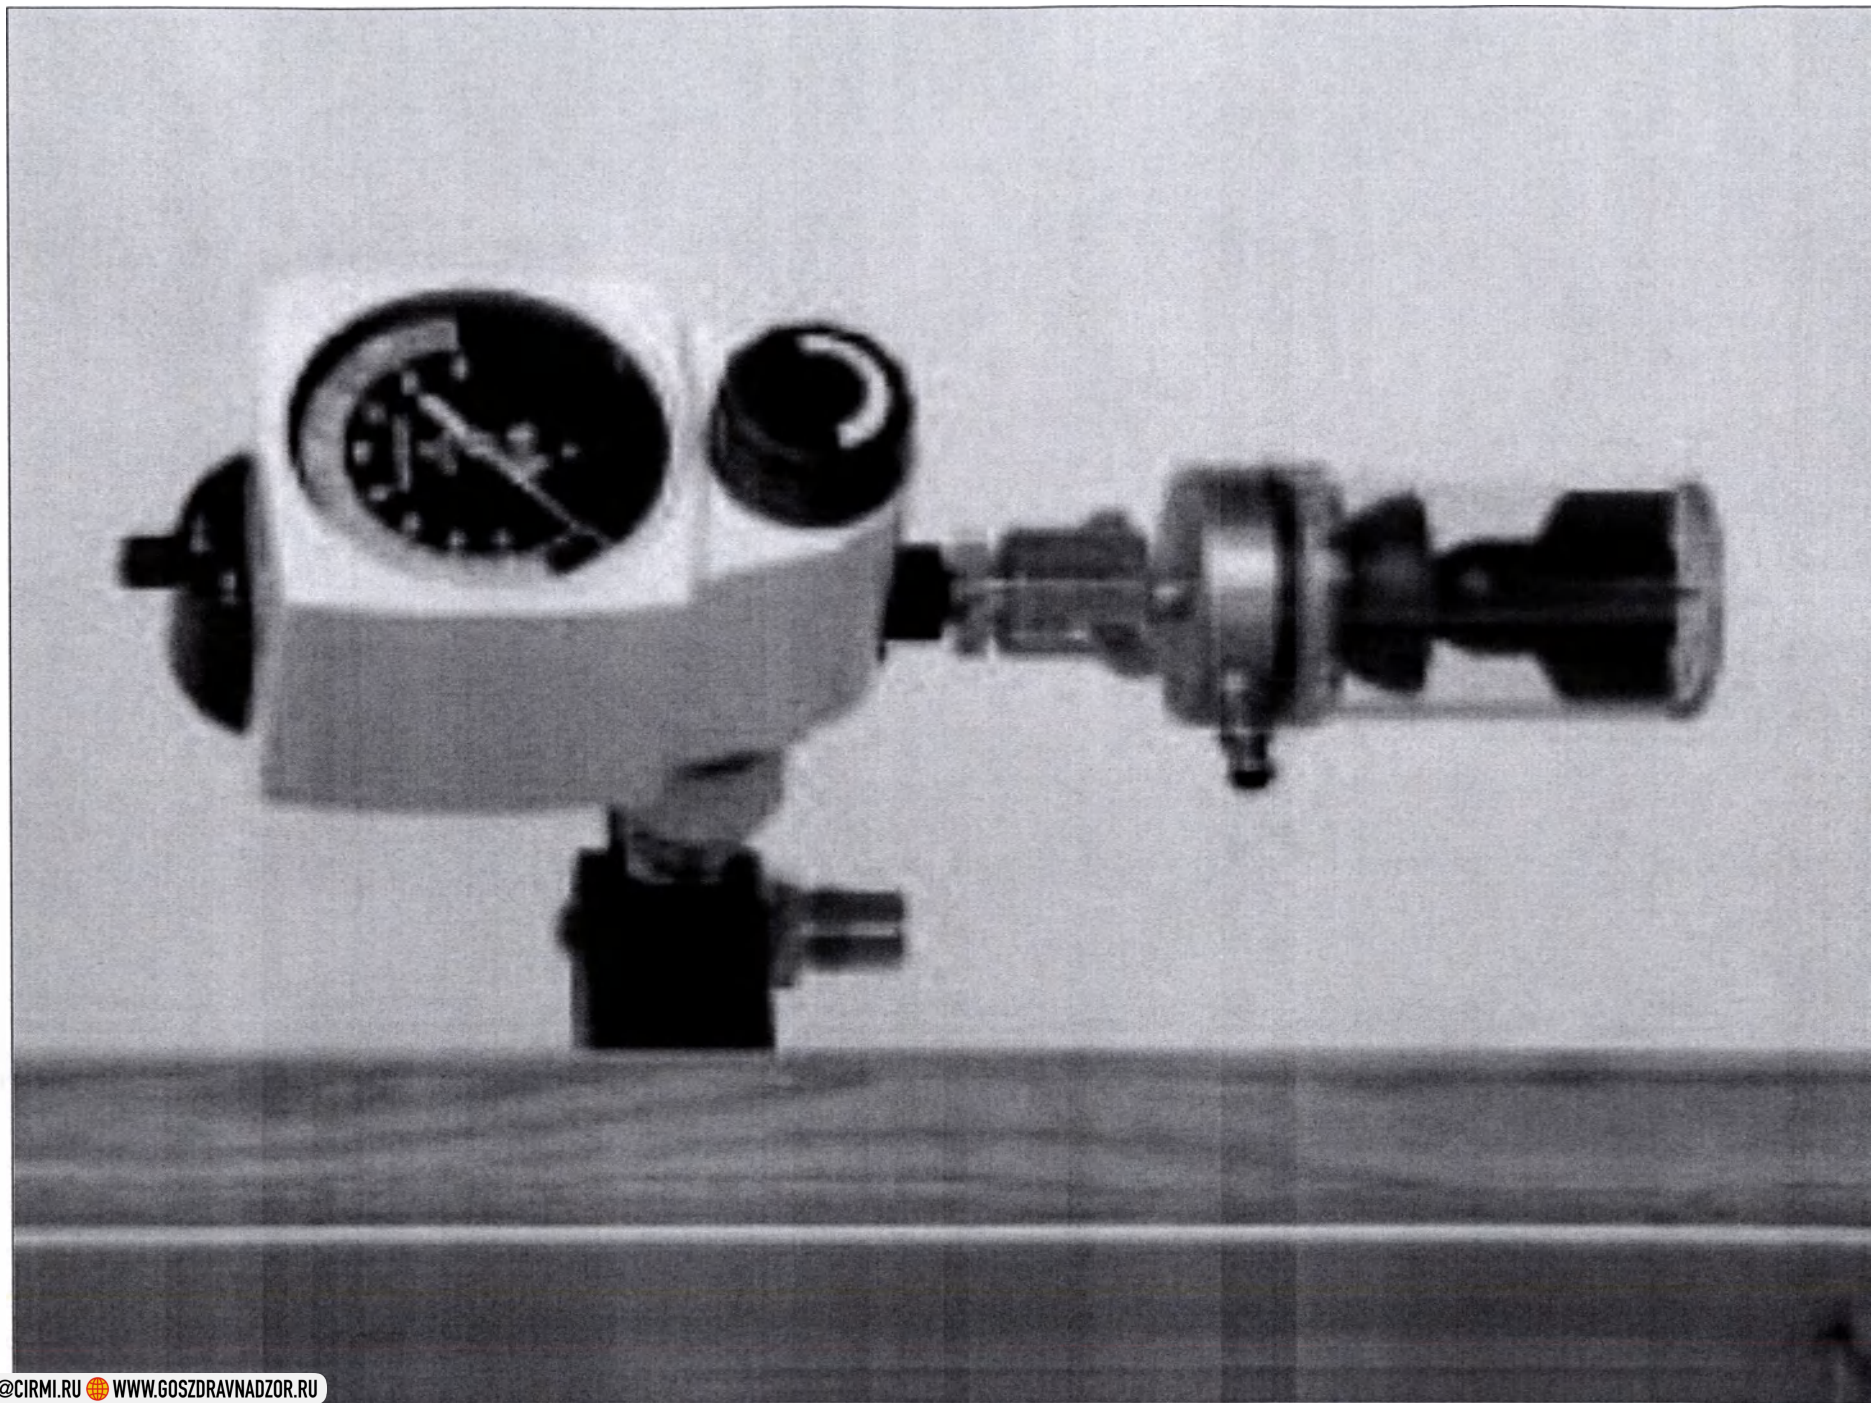


45. Емкости для аспираторов (не более 100 шт.).



46. Баллоны для кислорода и сжатого воздуха (не более 5 шт.).

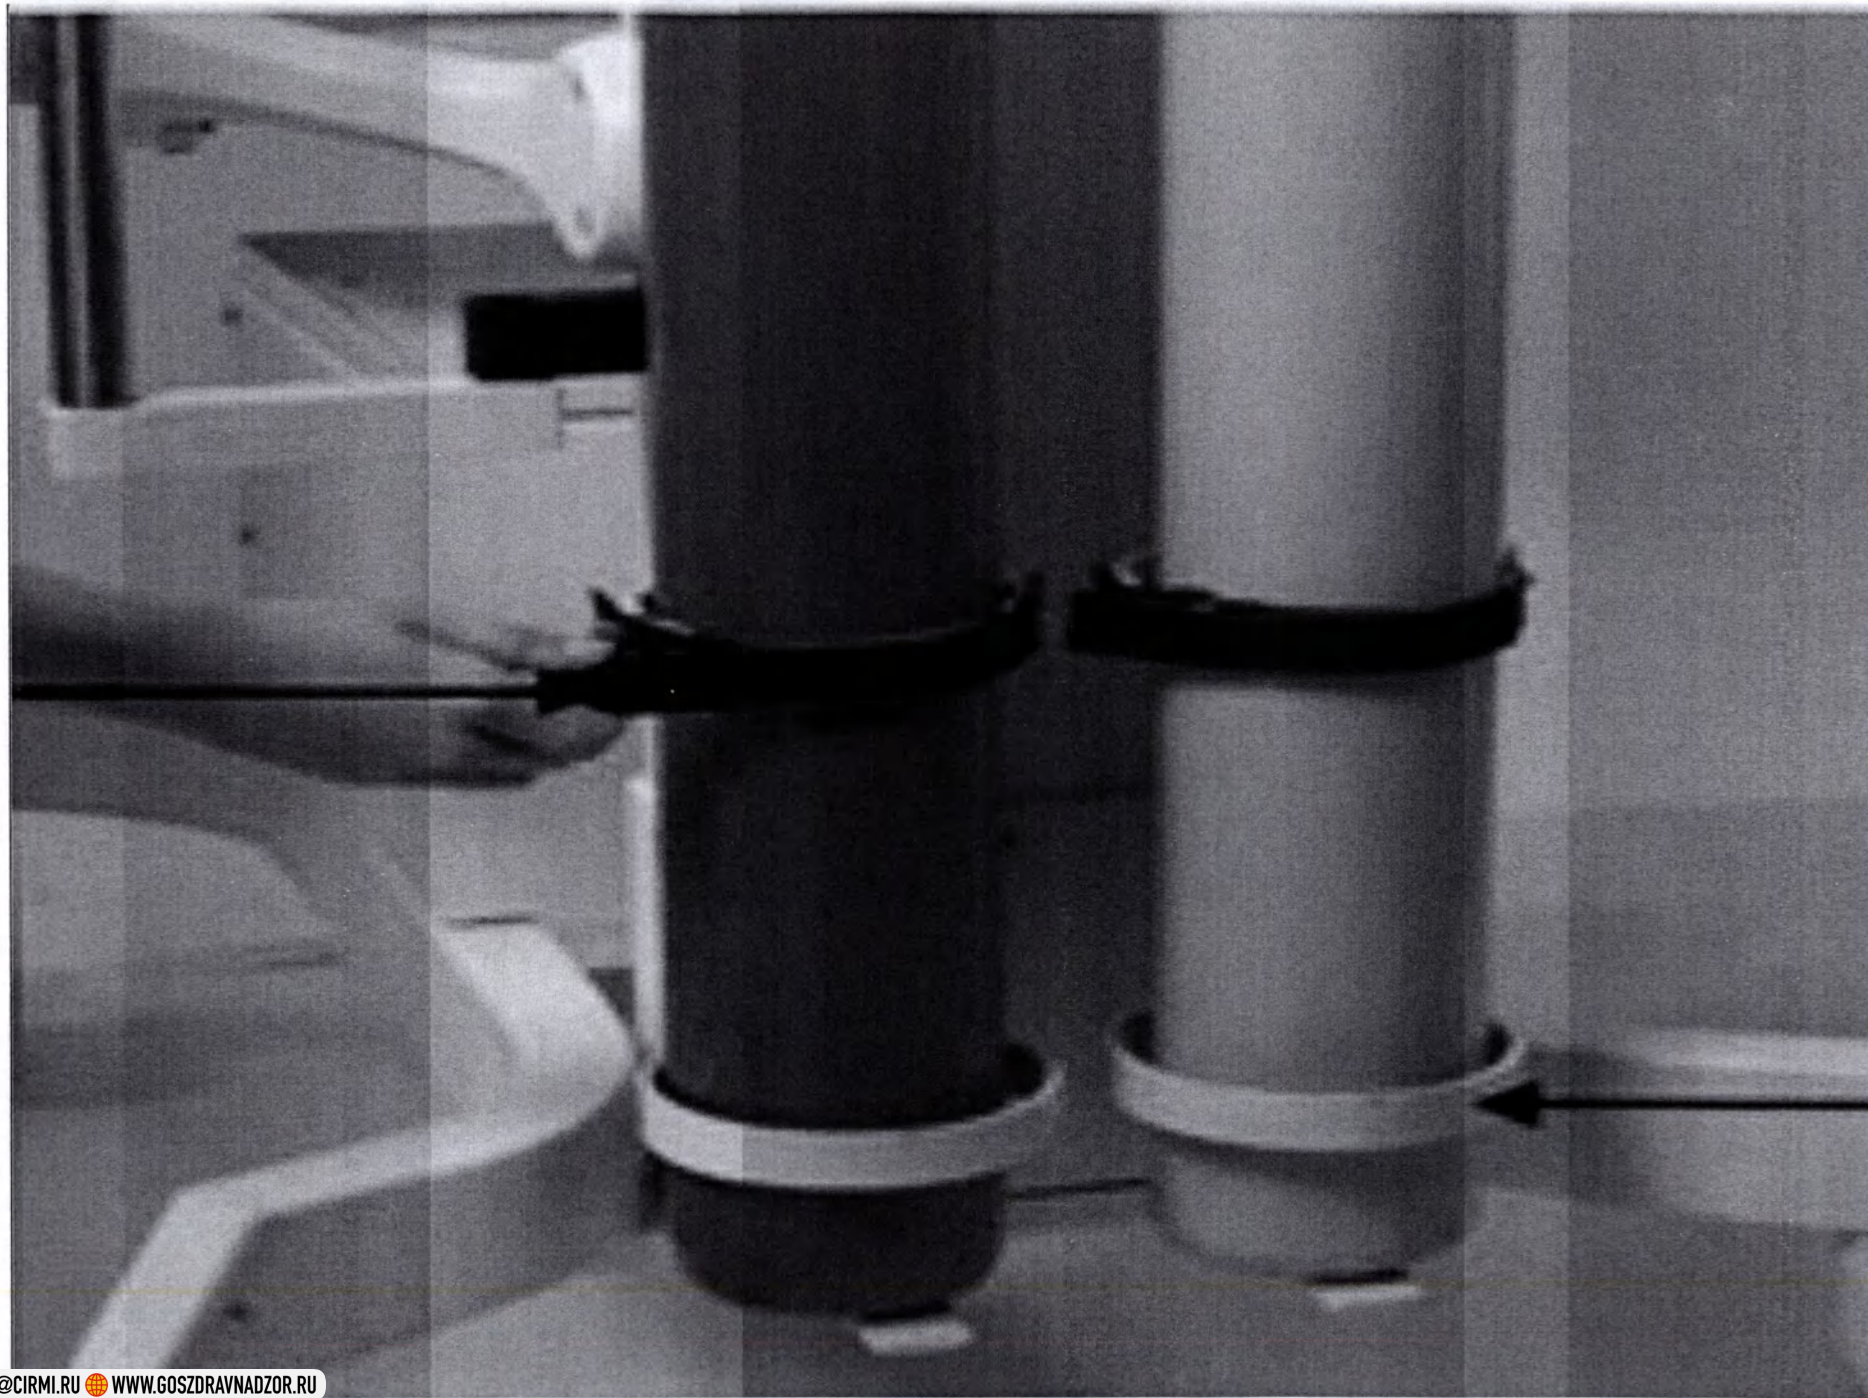


47. Смеситель Lullaby Resus Prime.

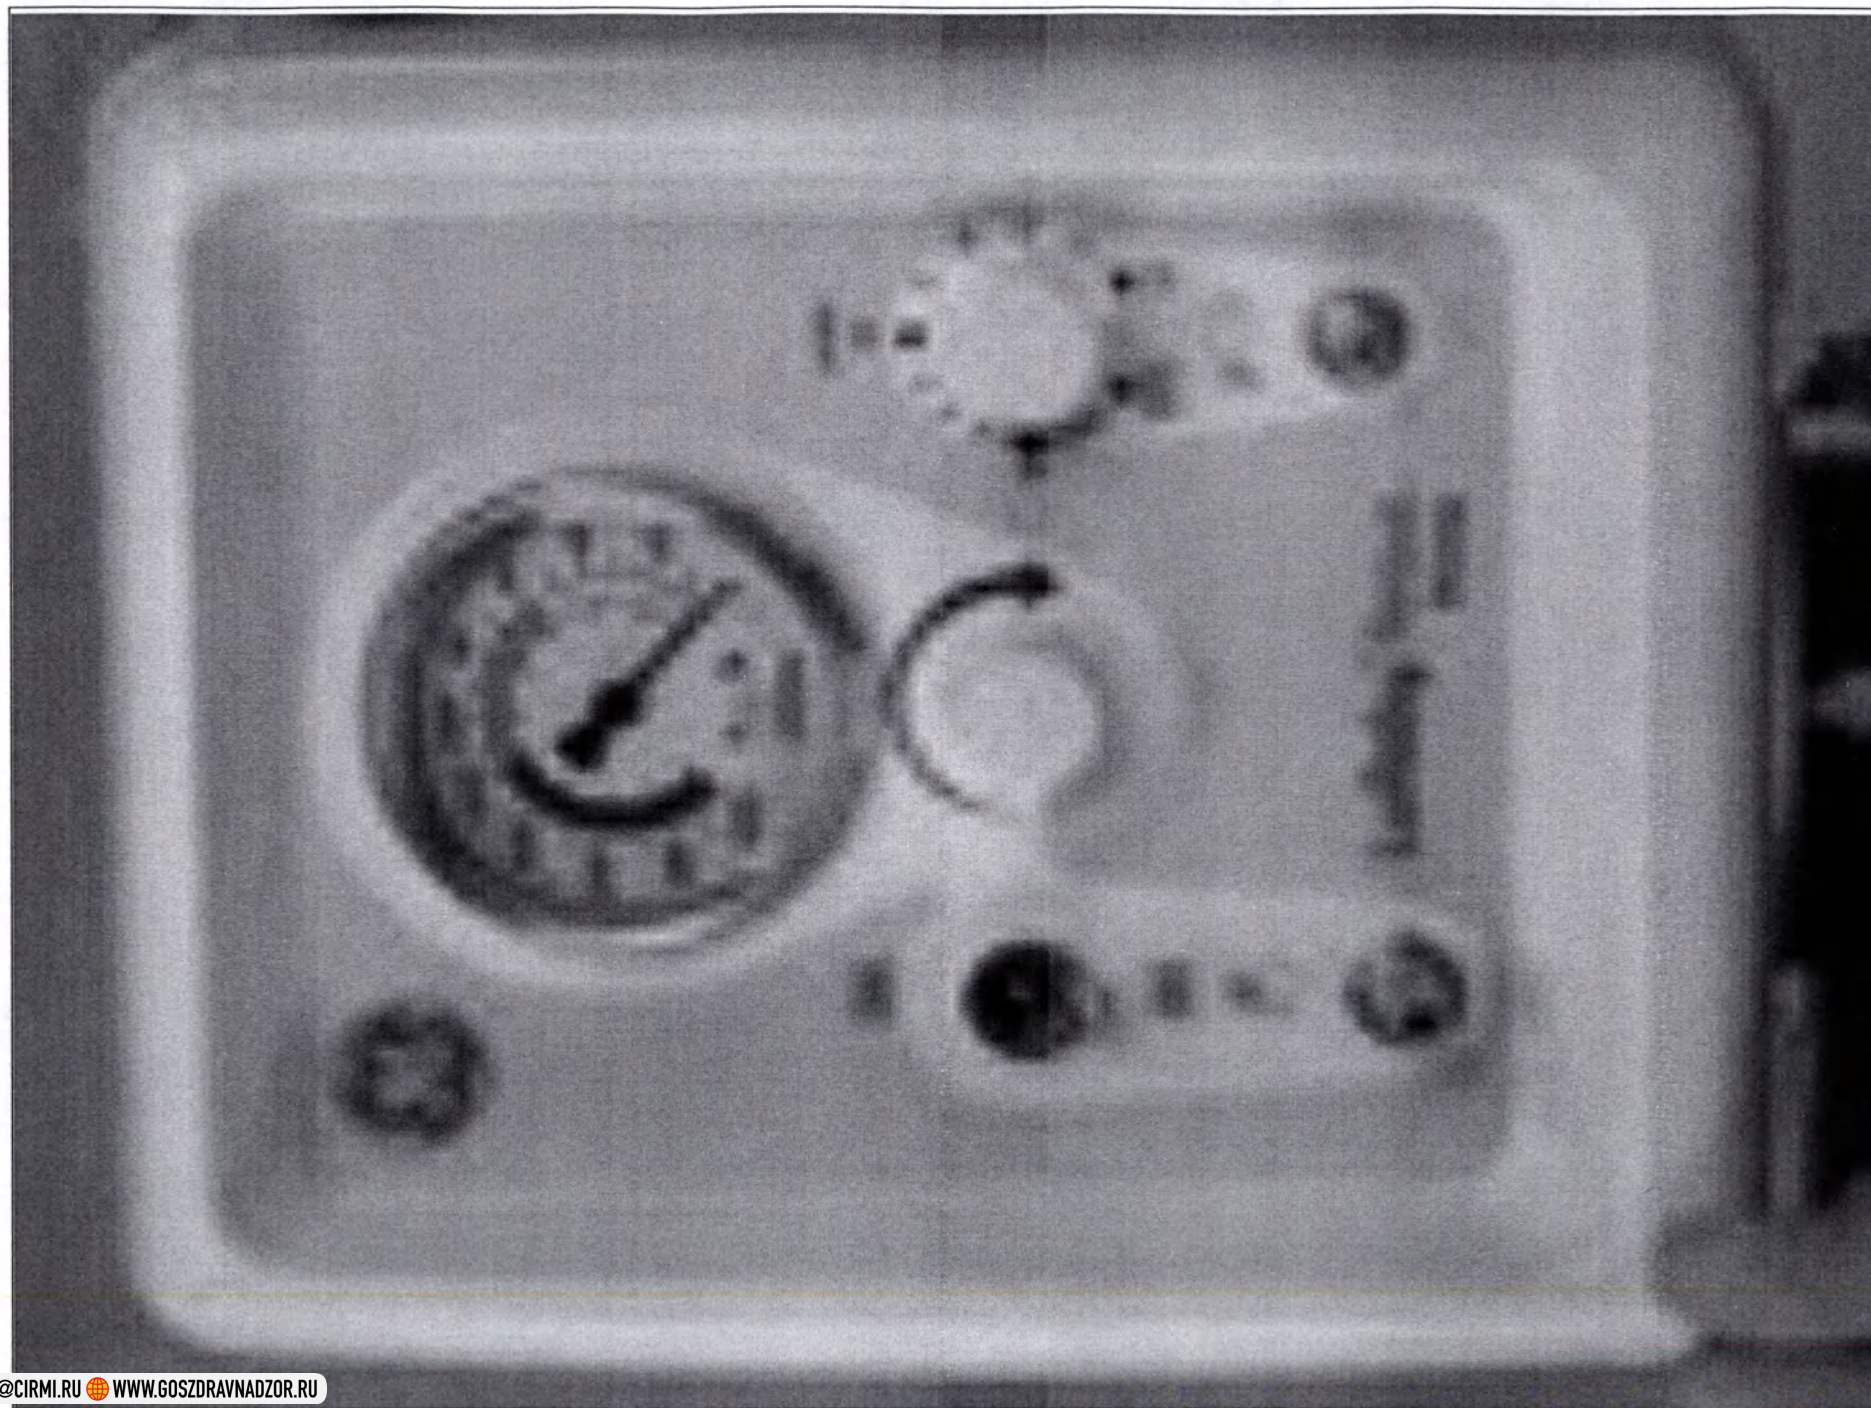


48. Манометры (не более 5 шт.).




49. Флоуметры (для подачи кислорода) (не более 5 шт.).

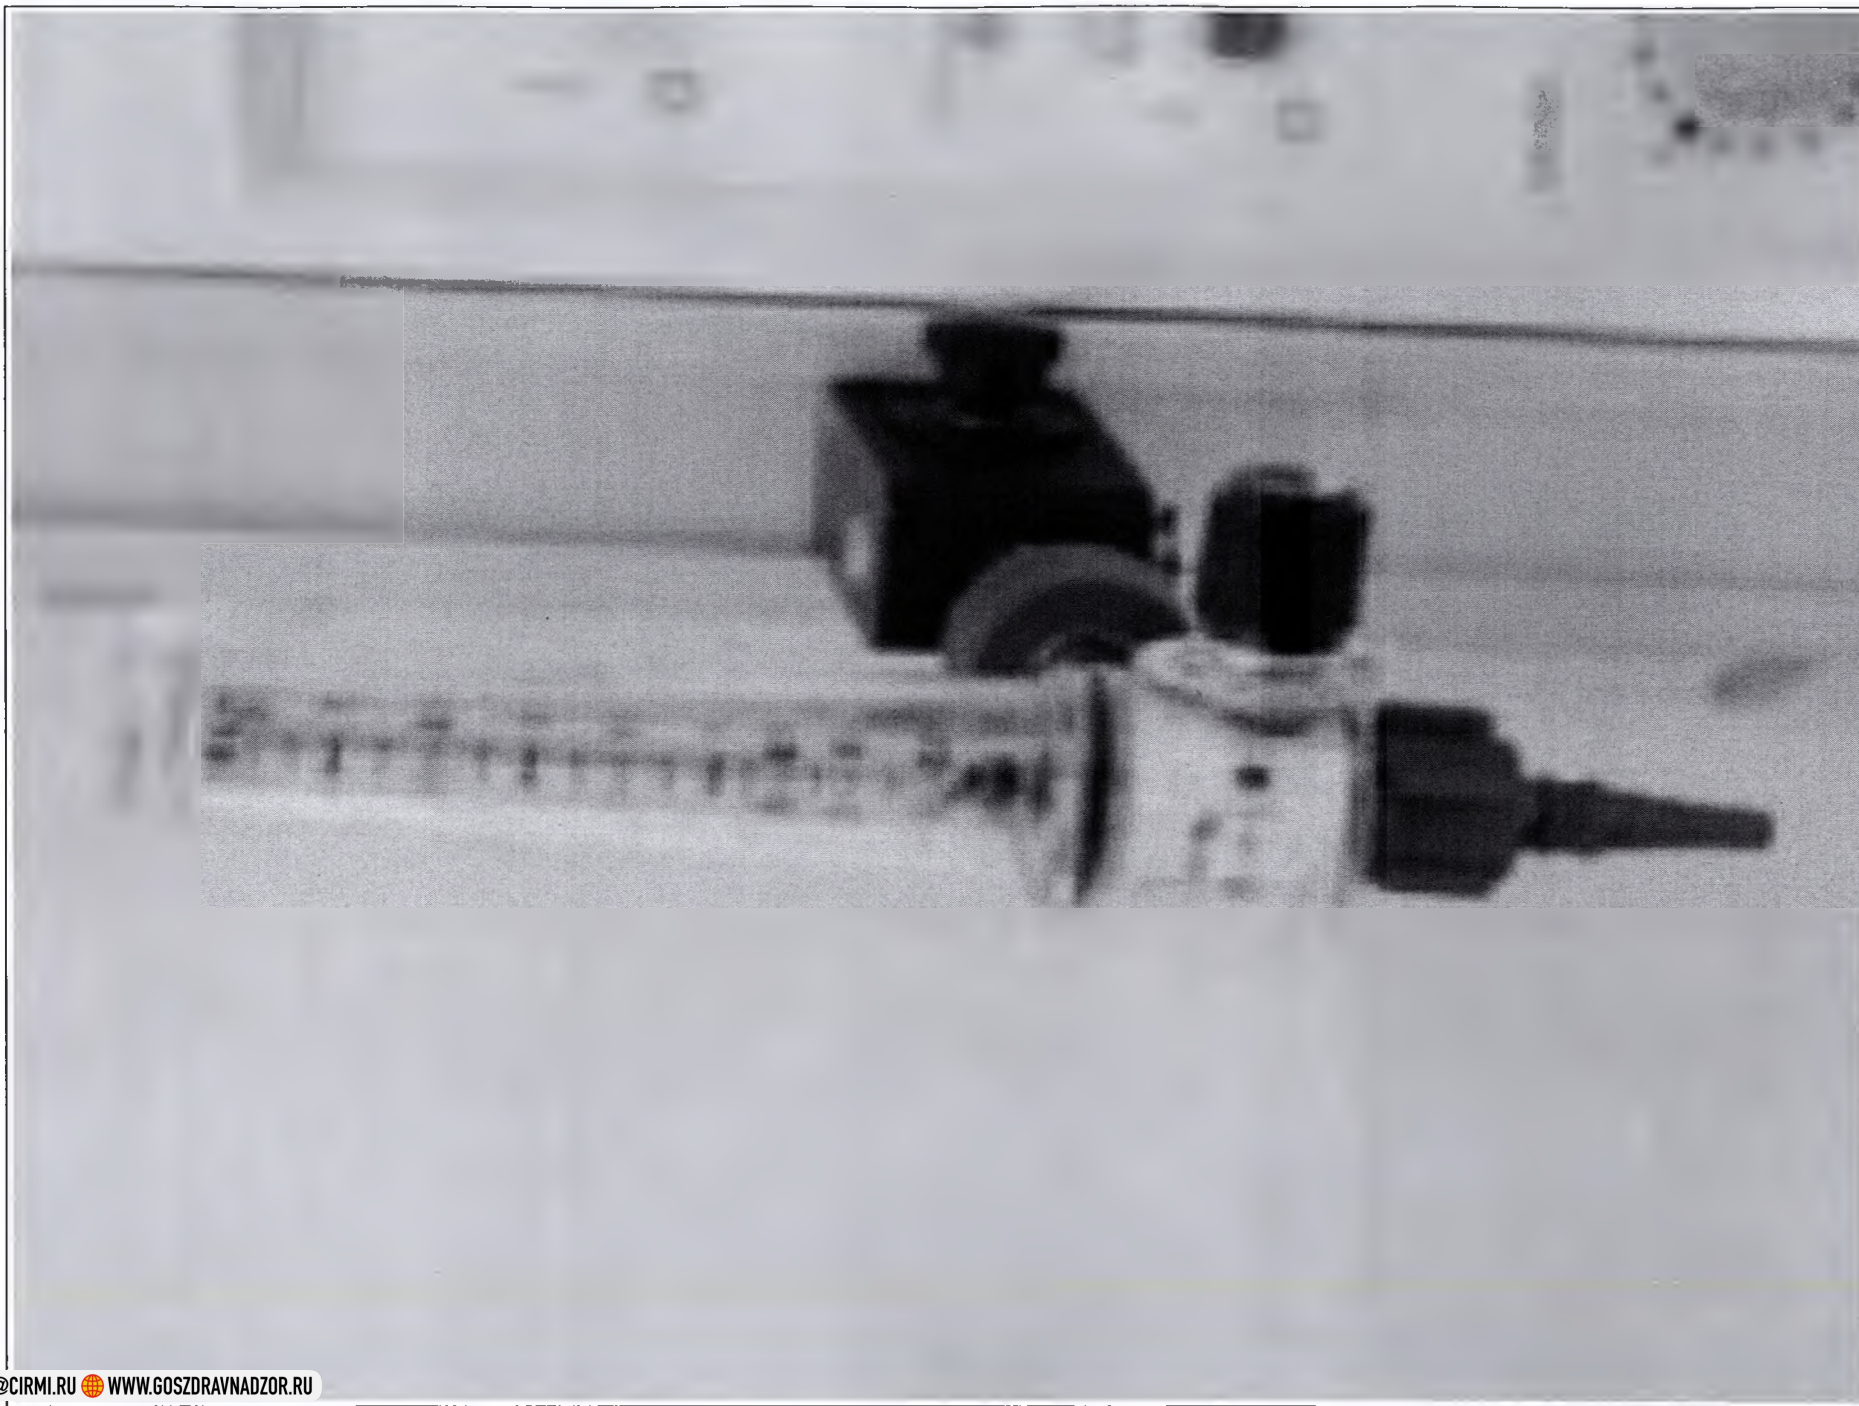

50. Газосмесительный блок Lullaby Resus Plus.

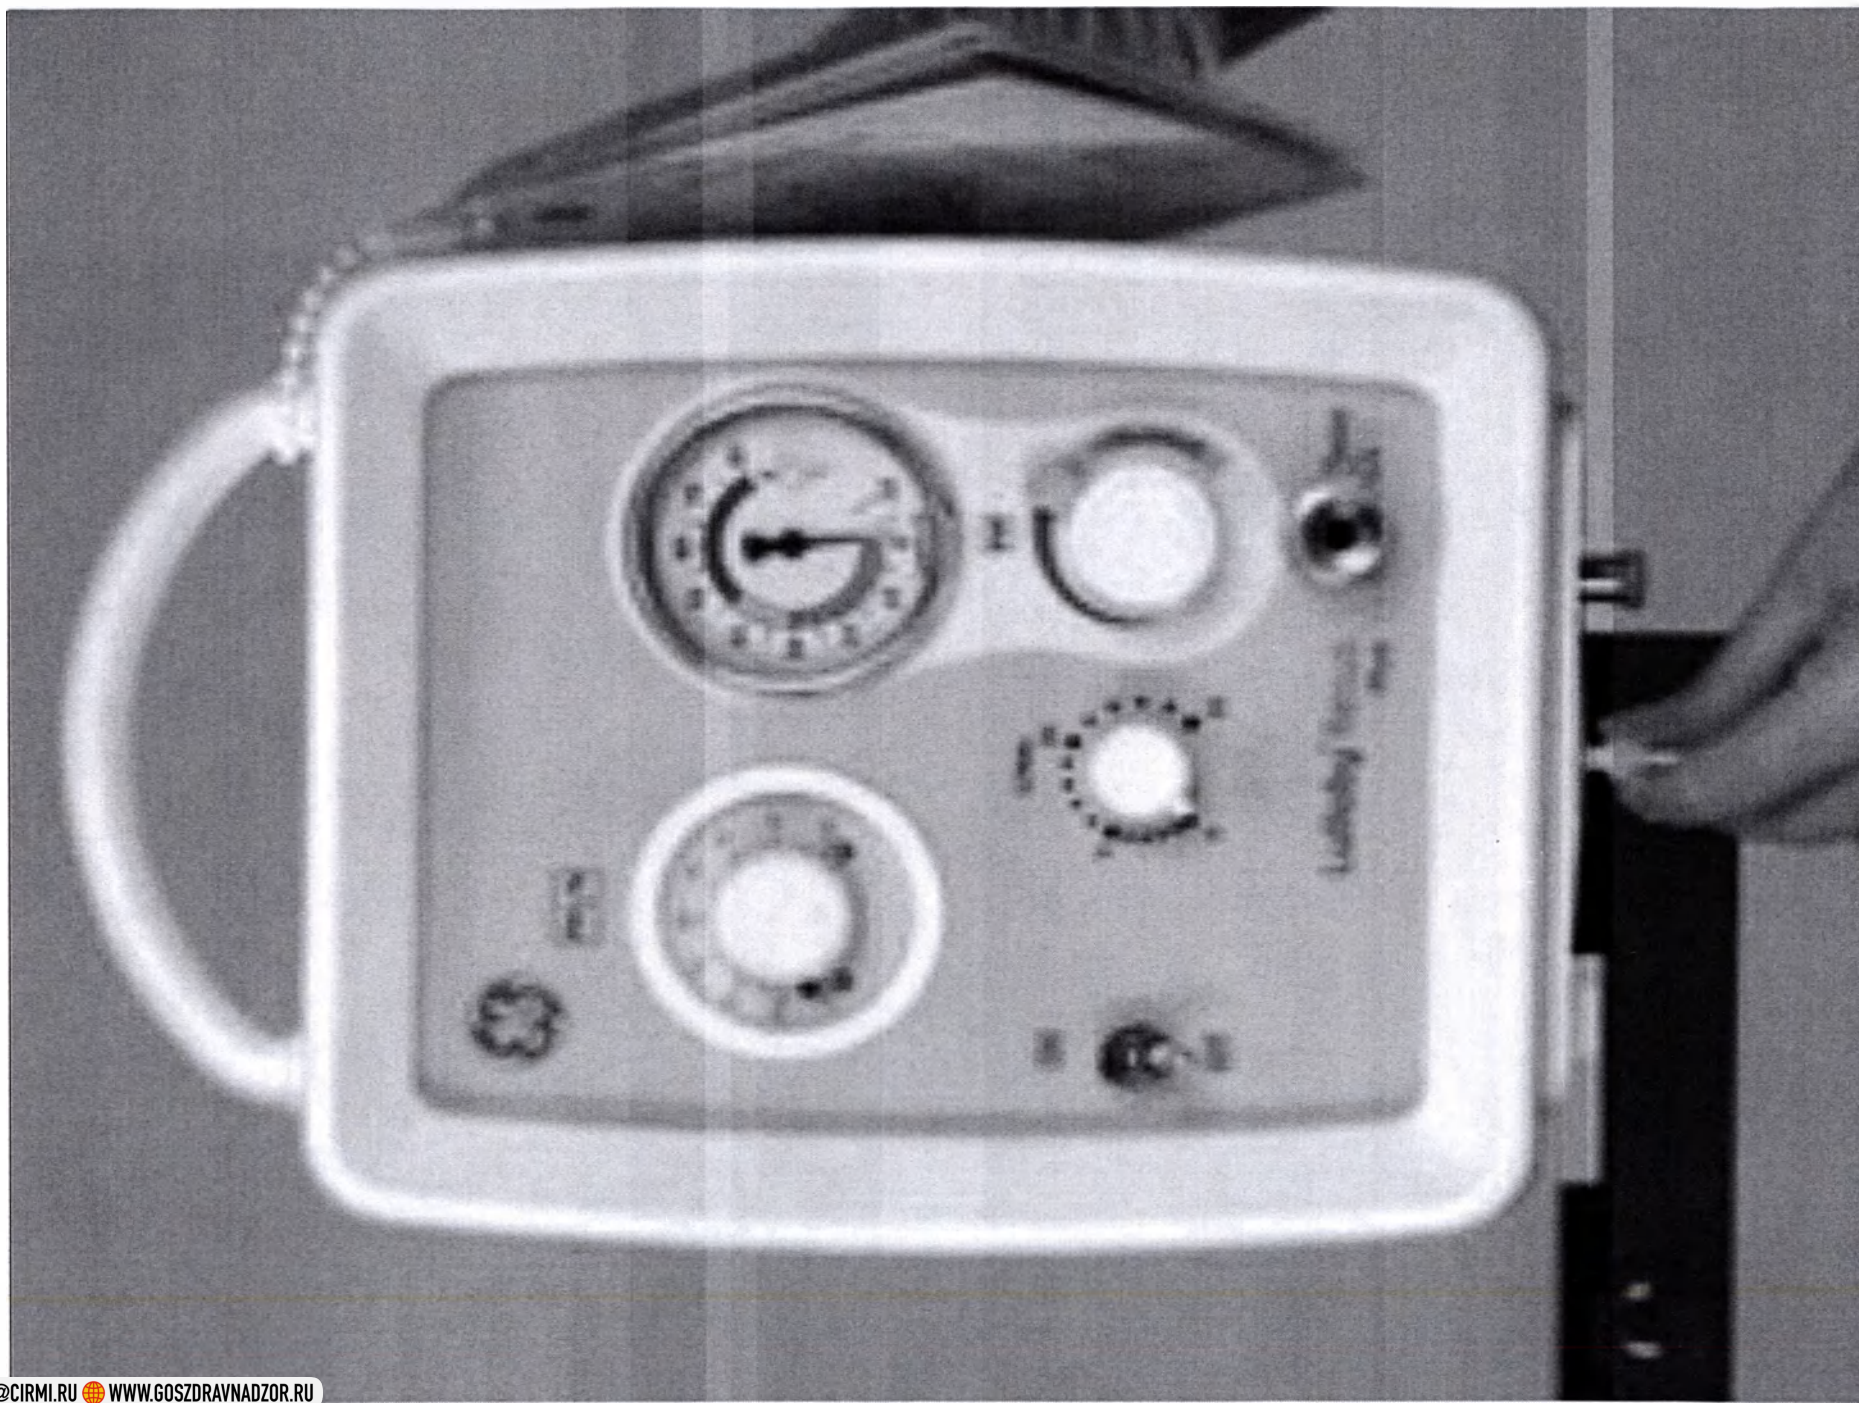

51. Линии подвода газов (не более 10 шт.).

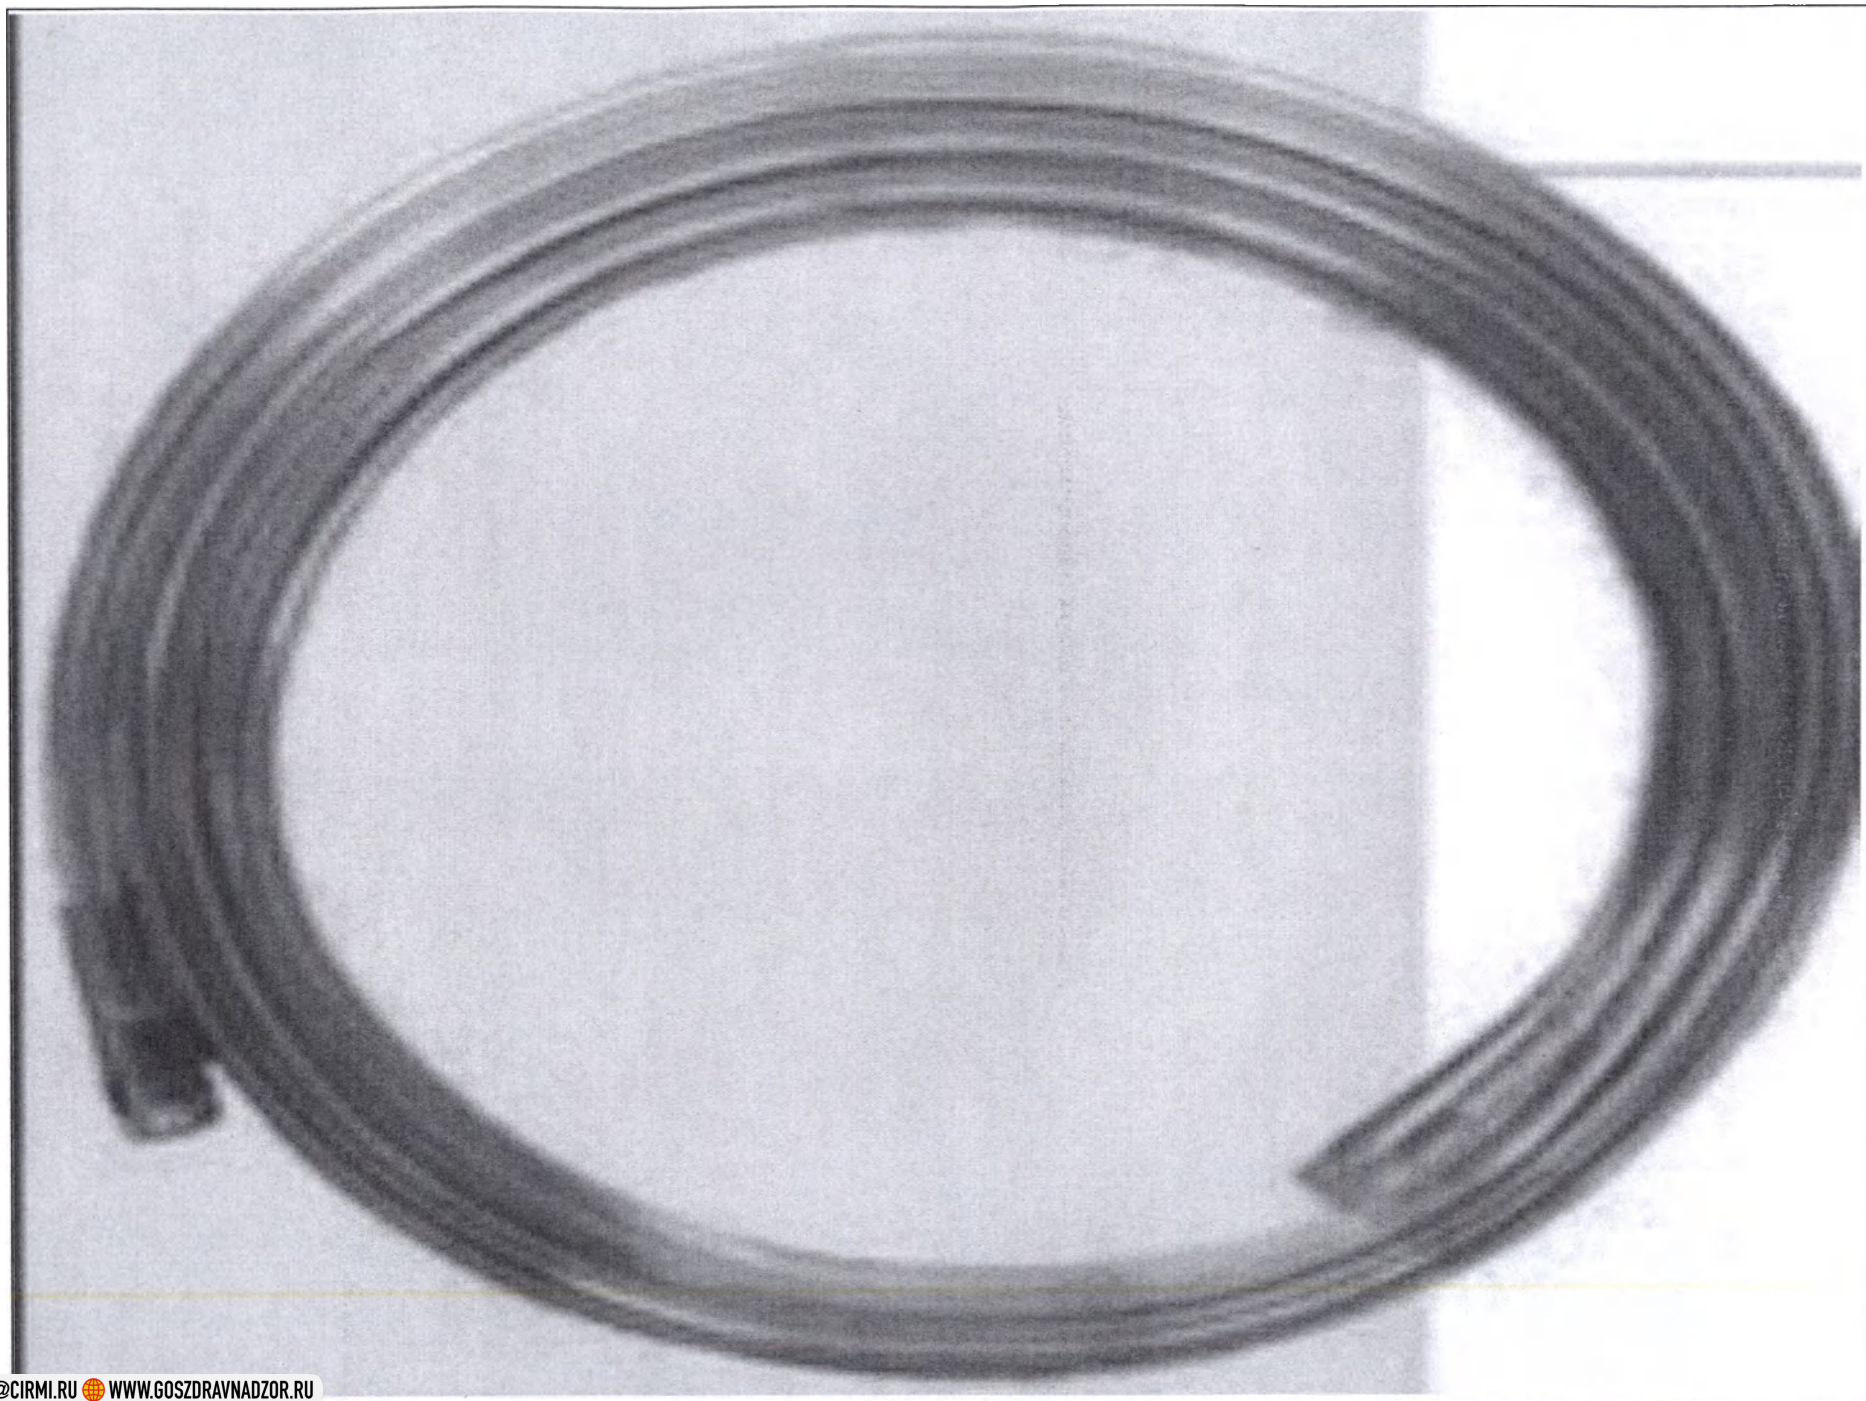


52. Лампа фототерапии.




53. Лампы экзаменационные (не более 10 шт.).




54. Лампы наблюдательные (не более 10 шт.).

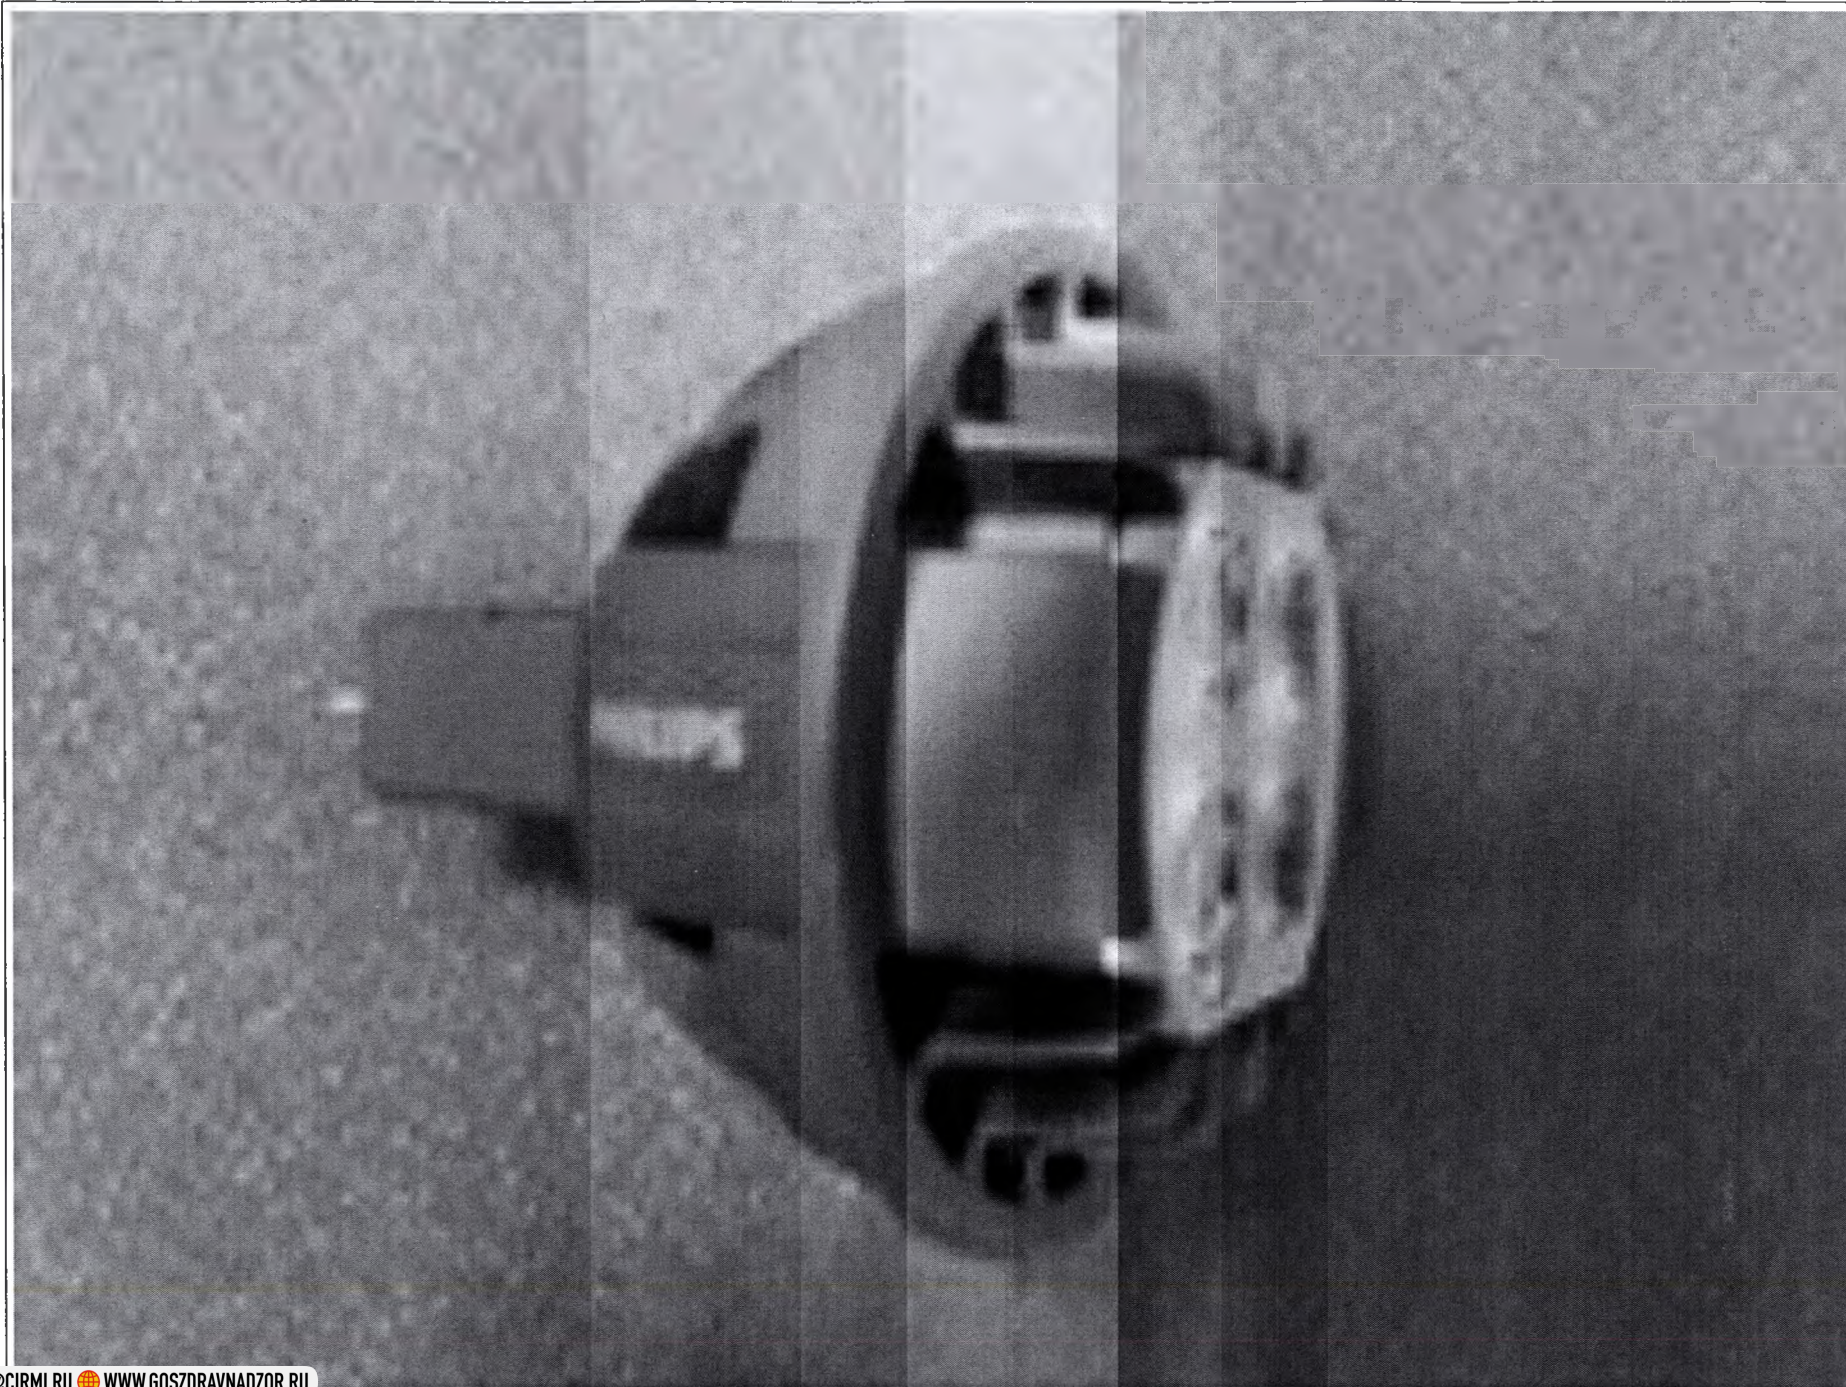


54. Лампы наблюдательные (не более 10 шт.).

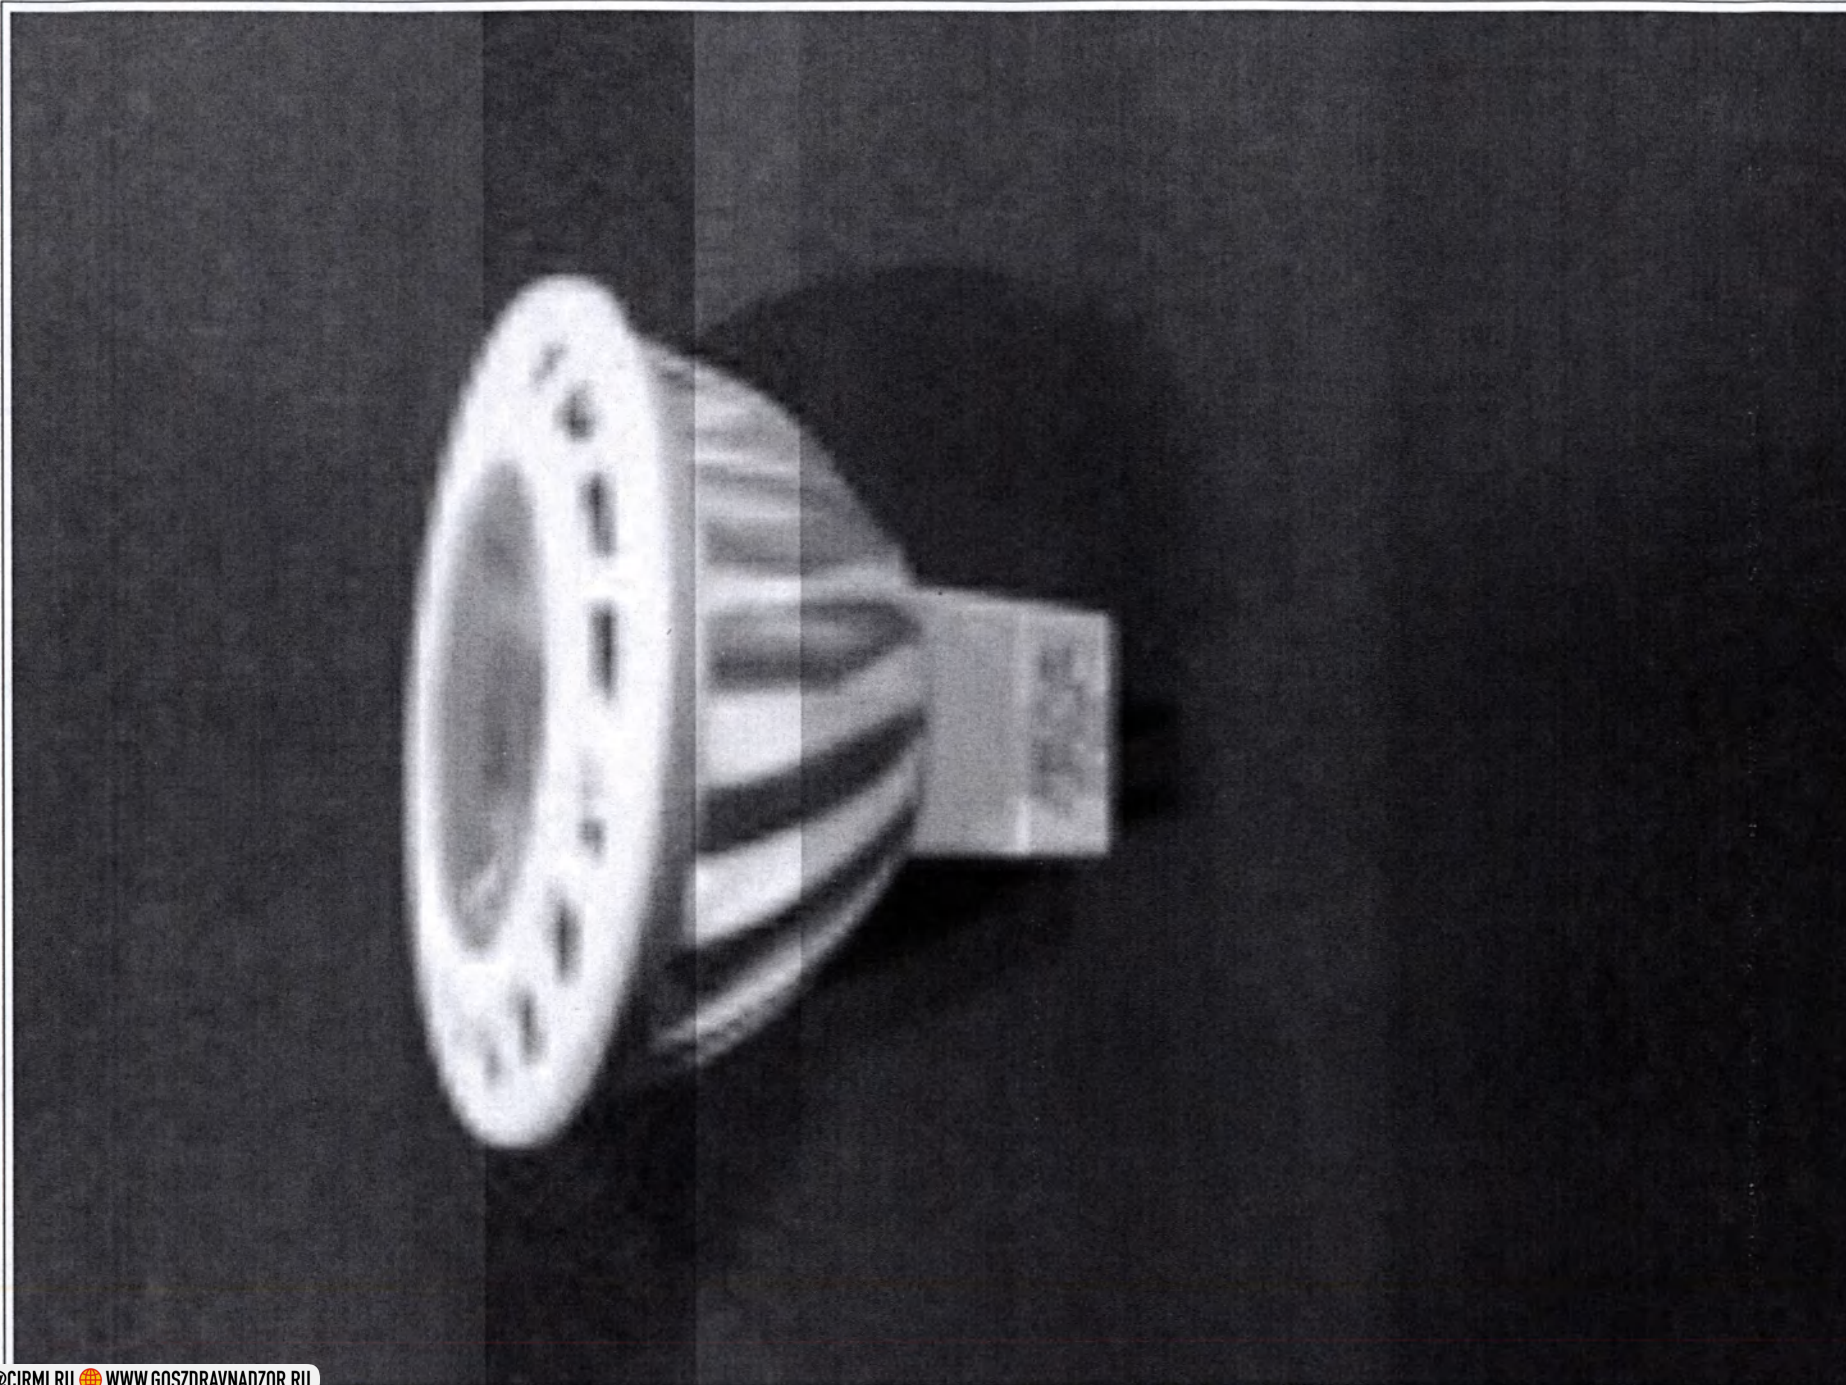


55. Лампы светодиодные (не более 10 шт.).

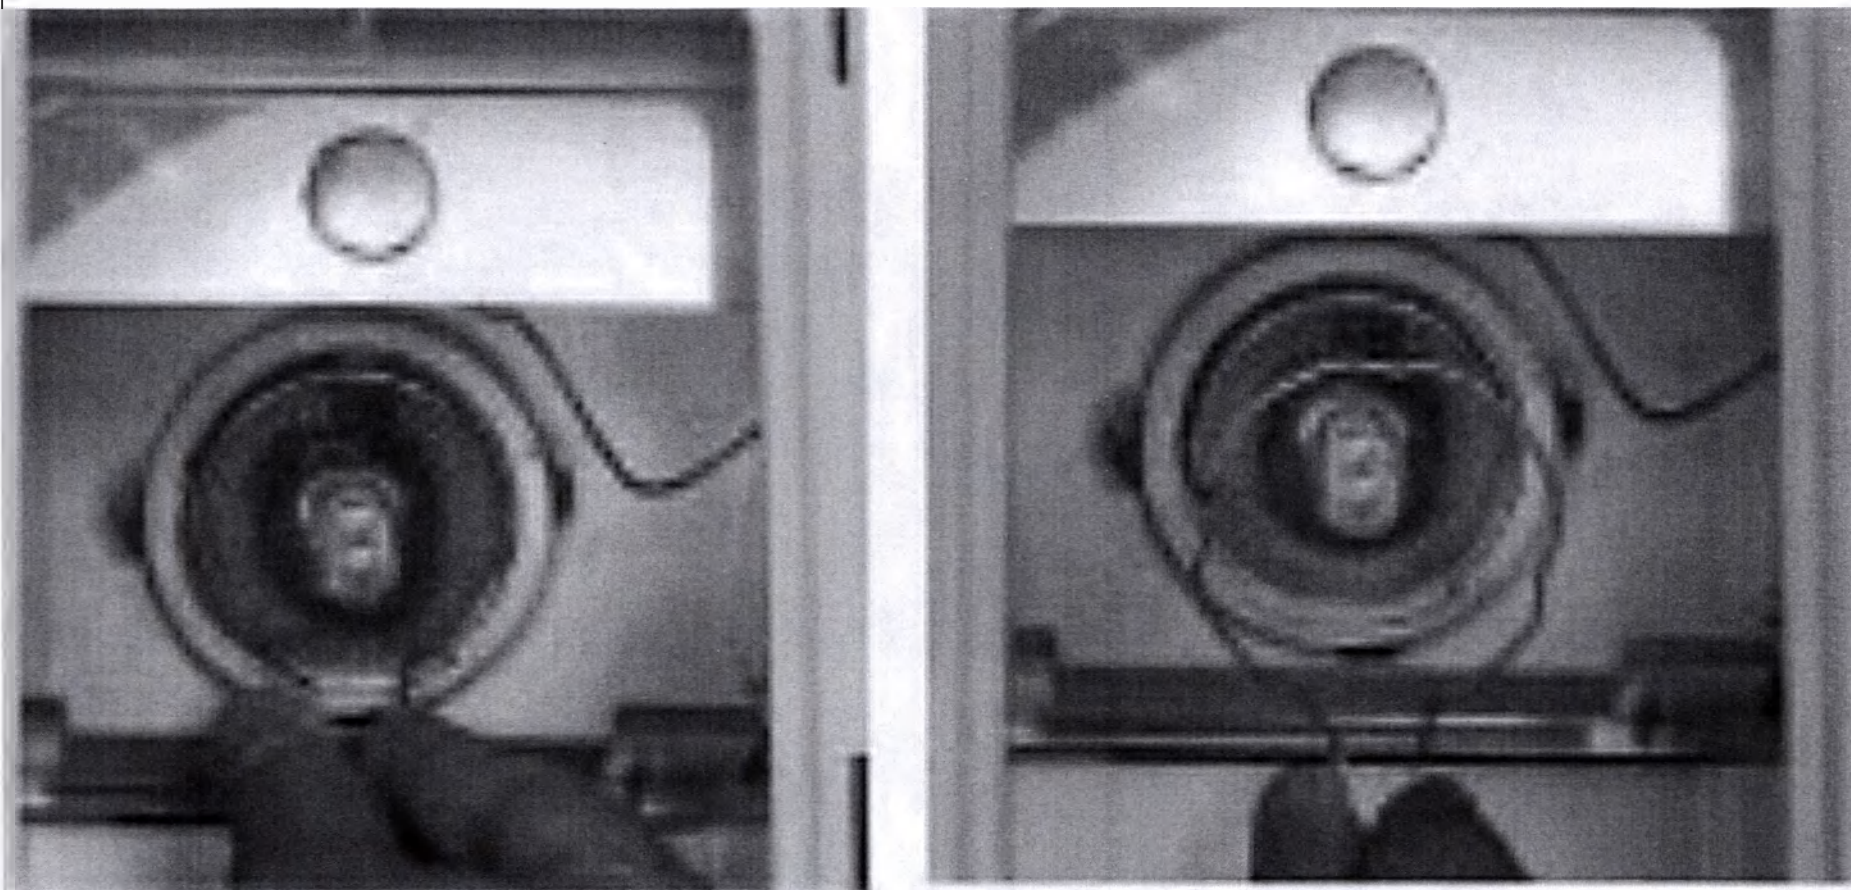


56. Предохранители (не более 5 шт.).

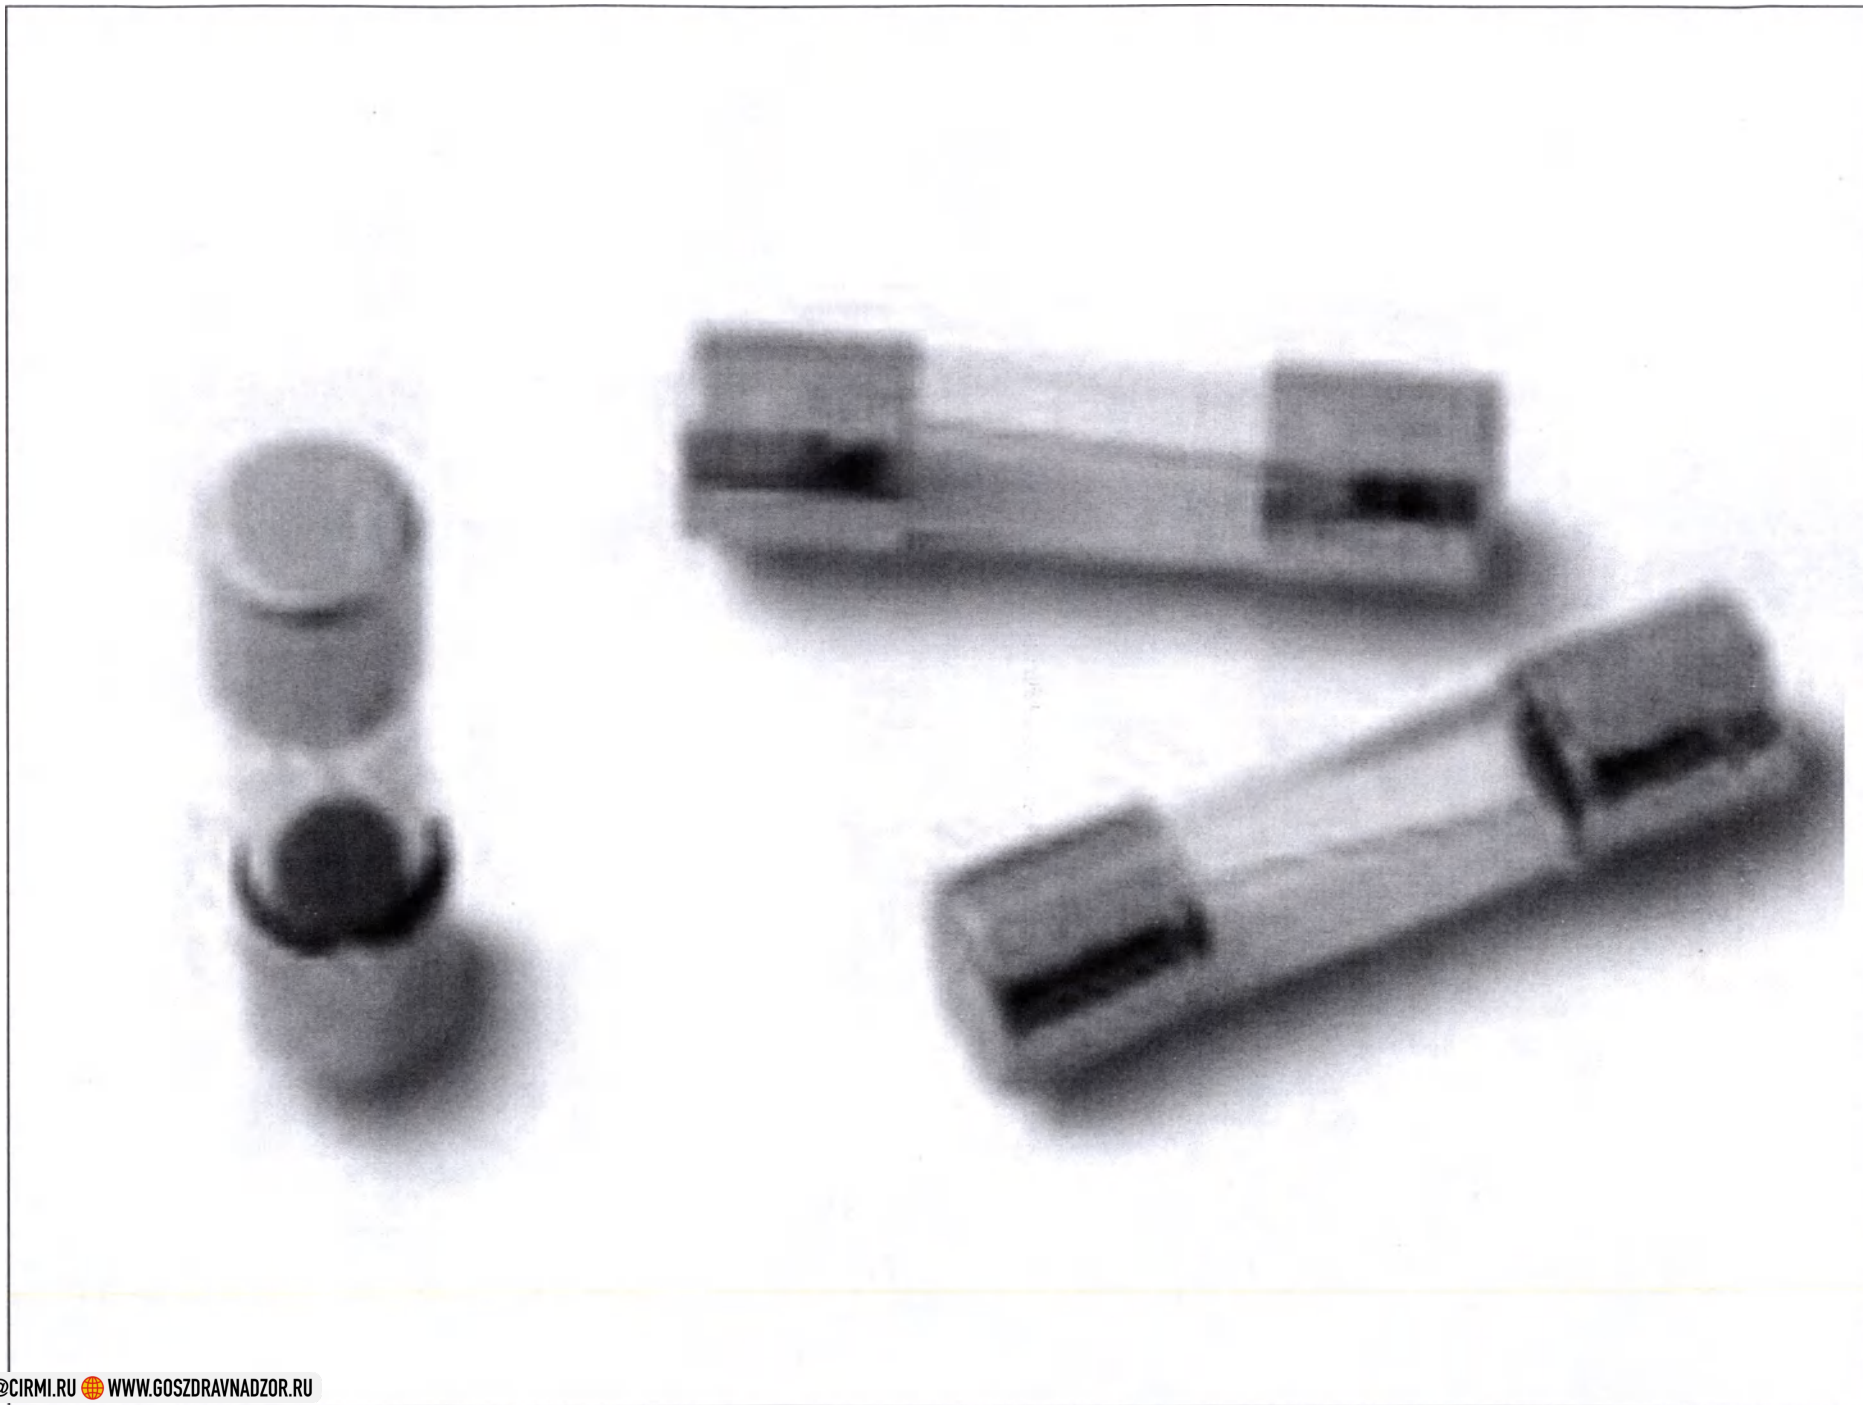

57. Крепежные зажимы (не более 5 шт.).

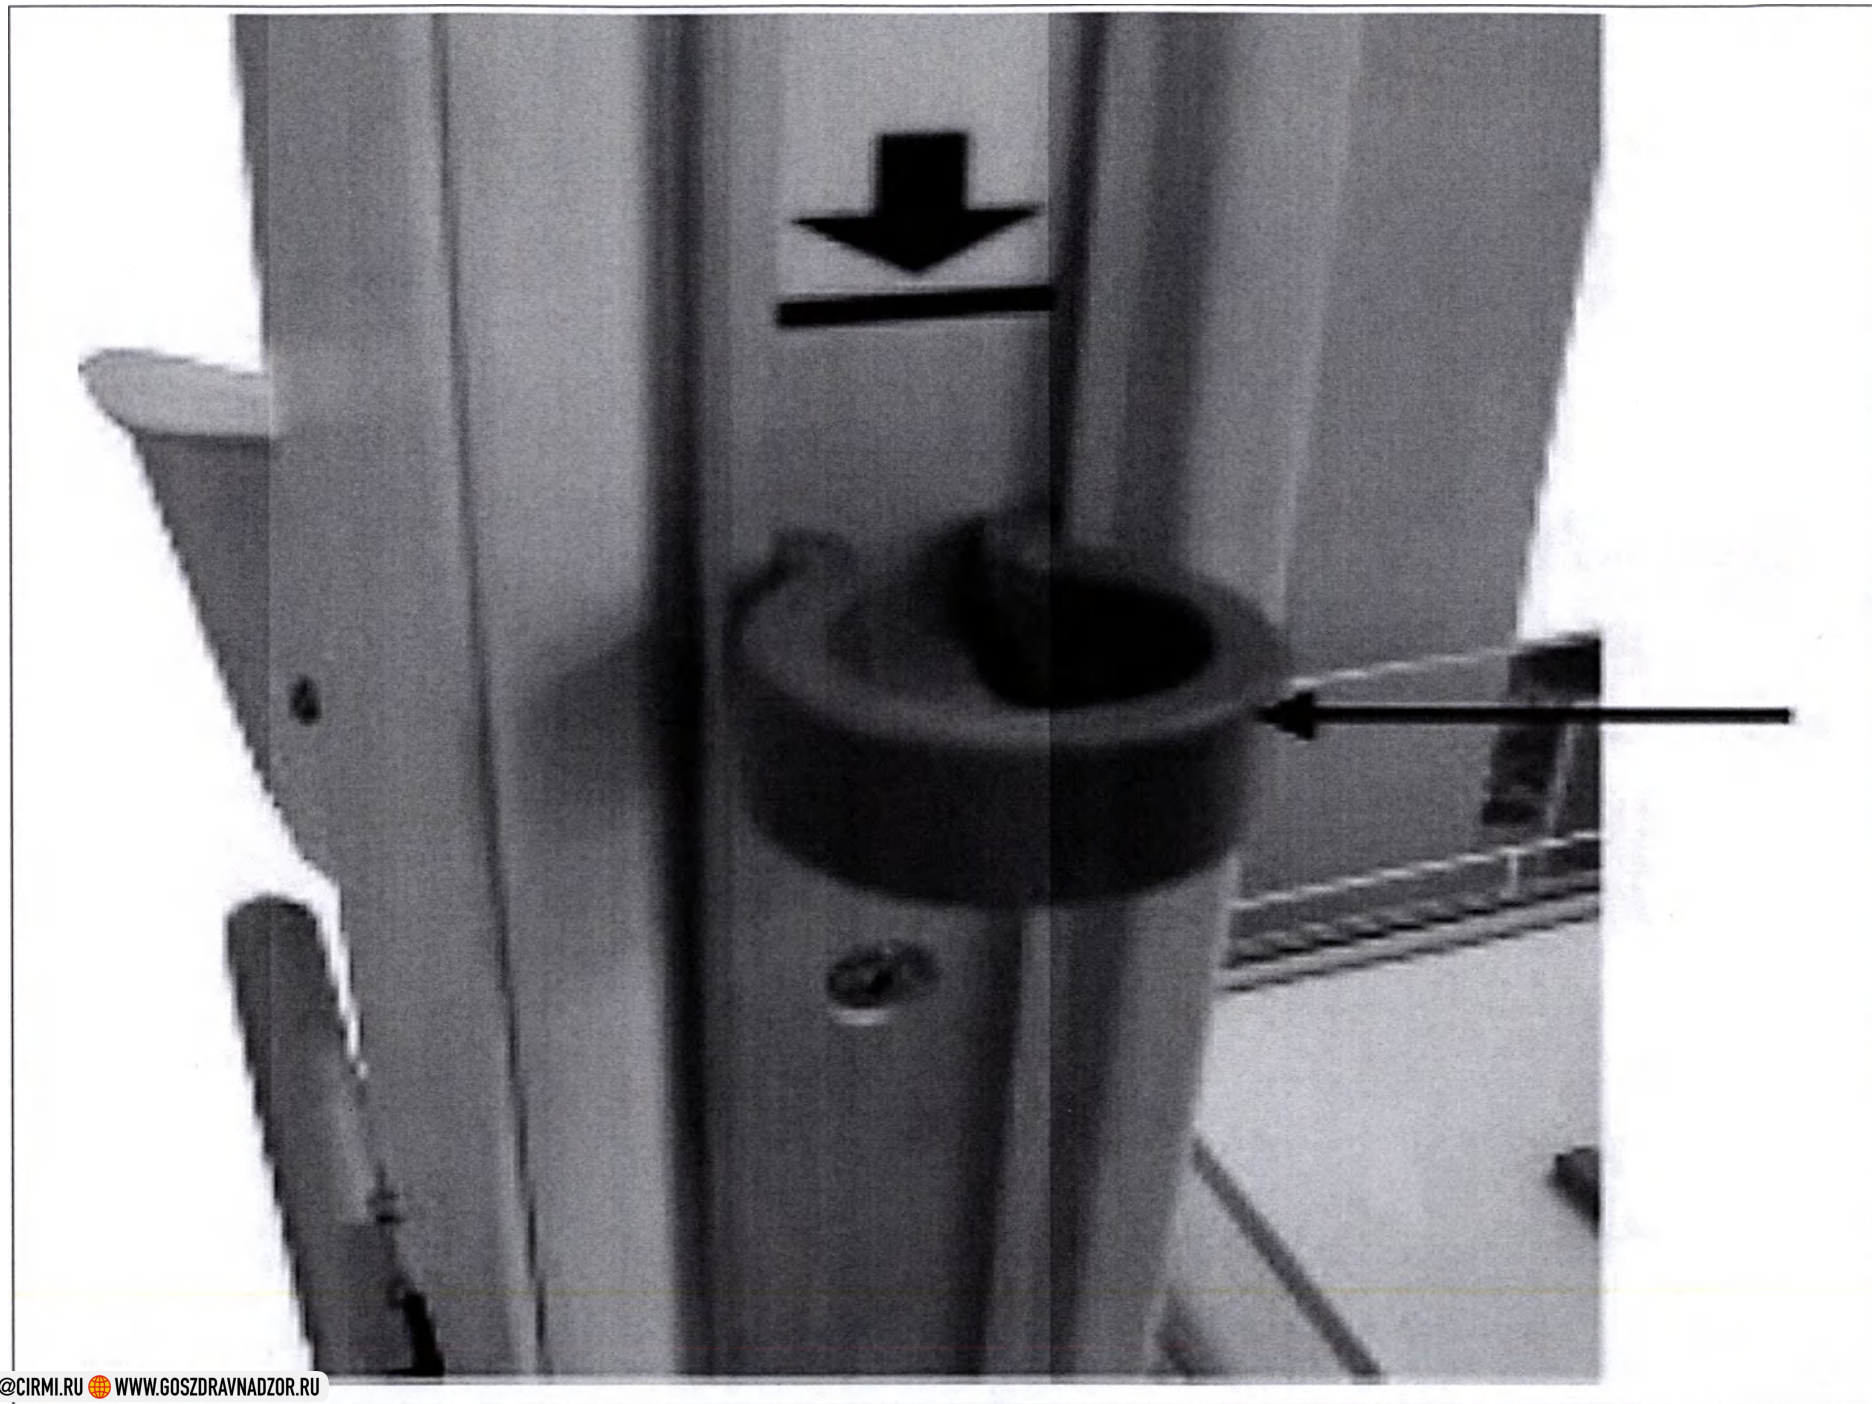


57. Крепежные зажимы (не более 5 шт.).

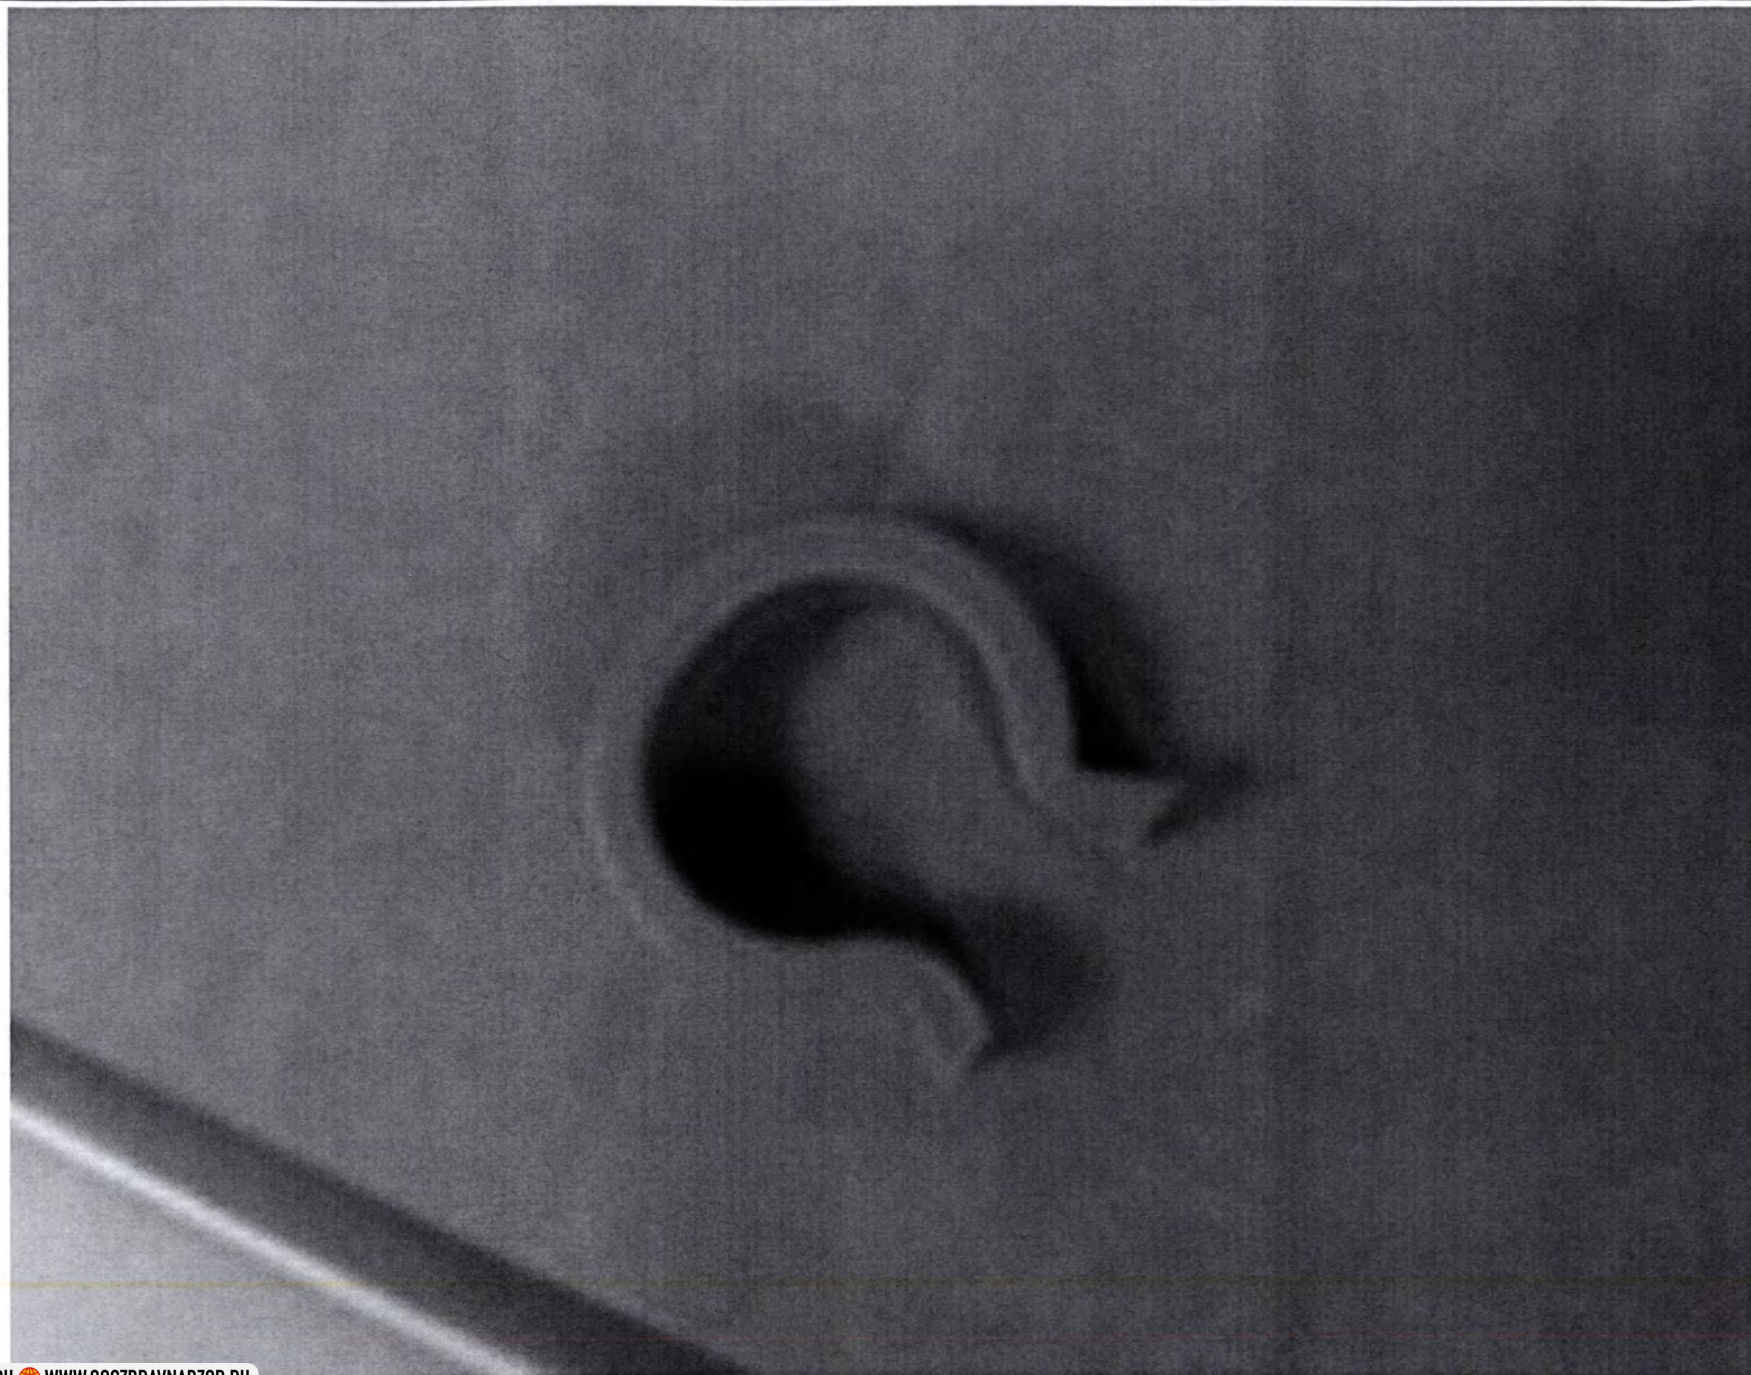


58. Фильтры воздушные (не более 5 шт.).




59. Фильтры бактериальные (не более 5 шт.).

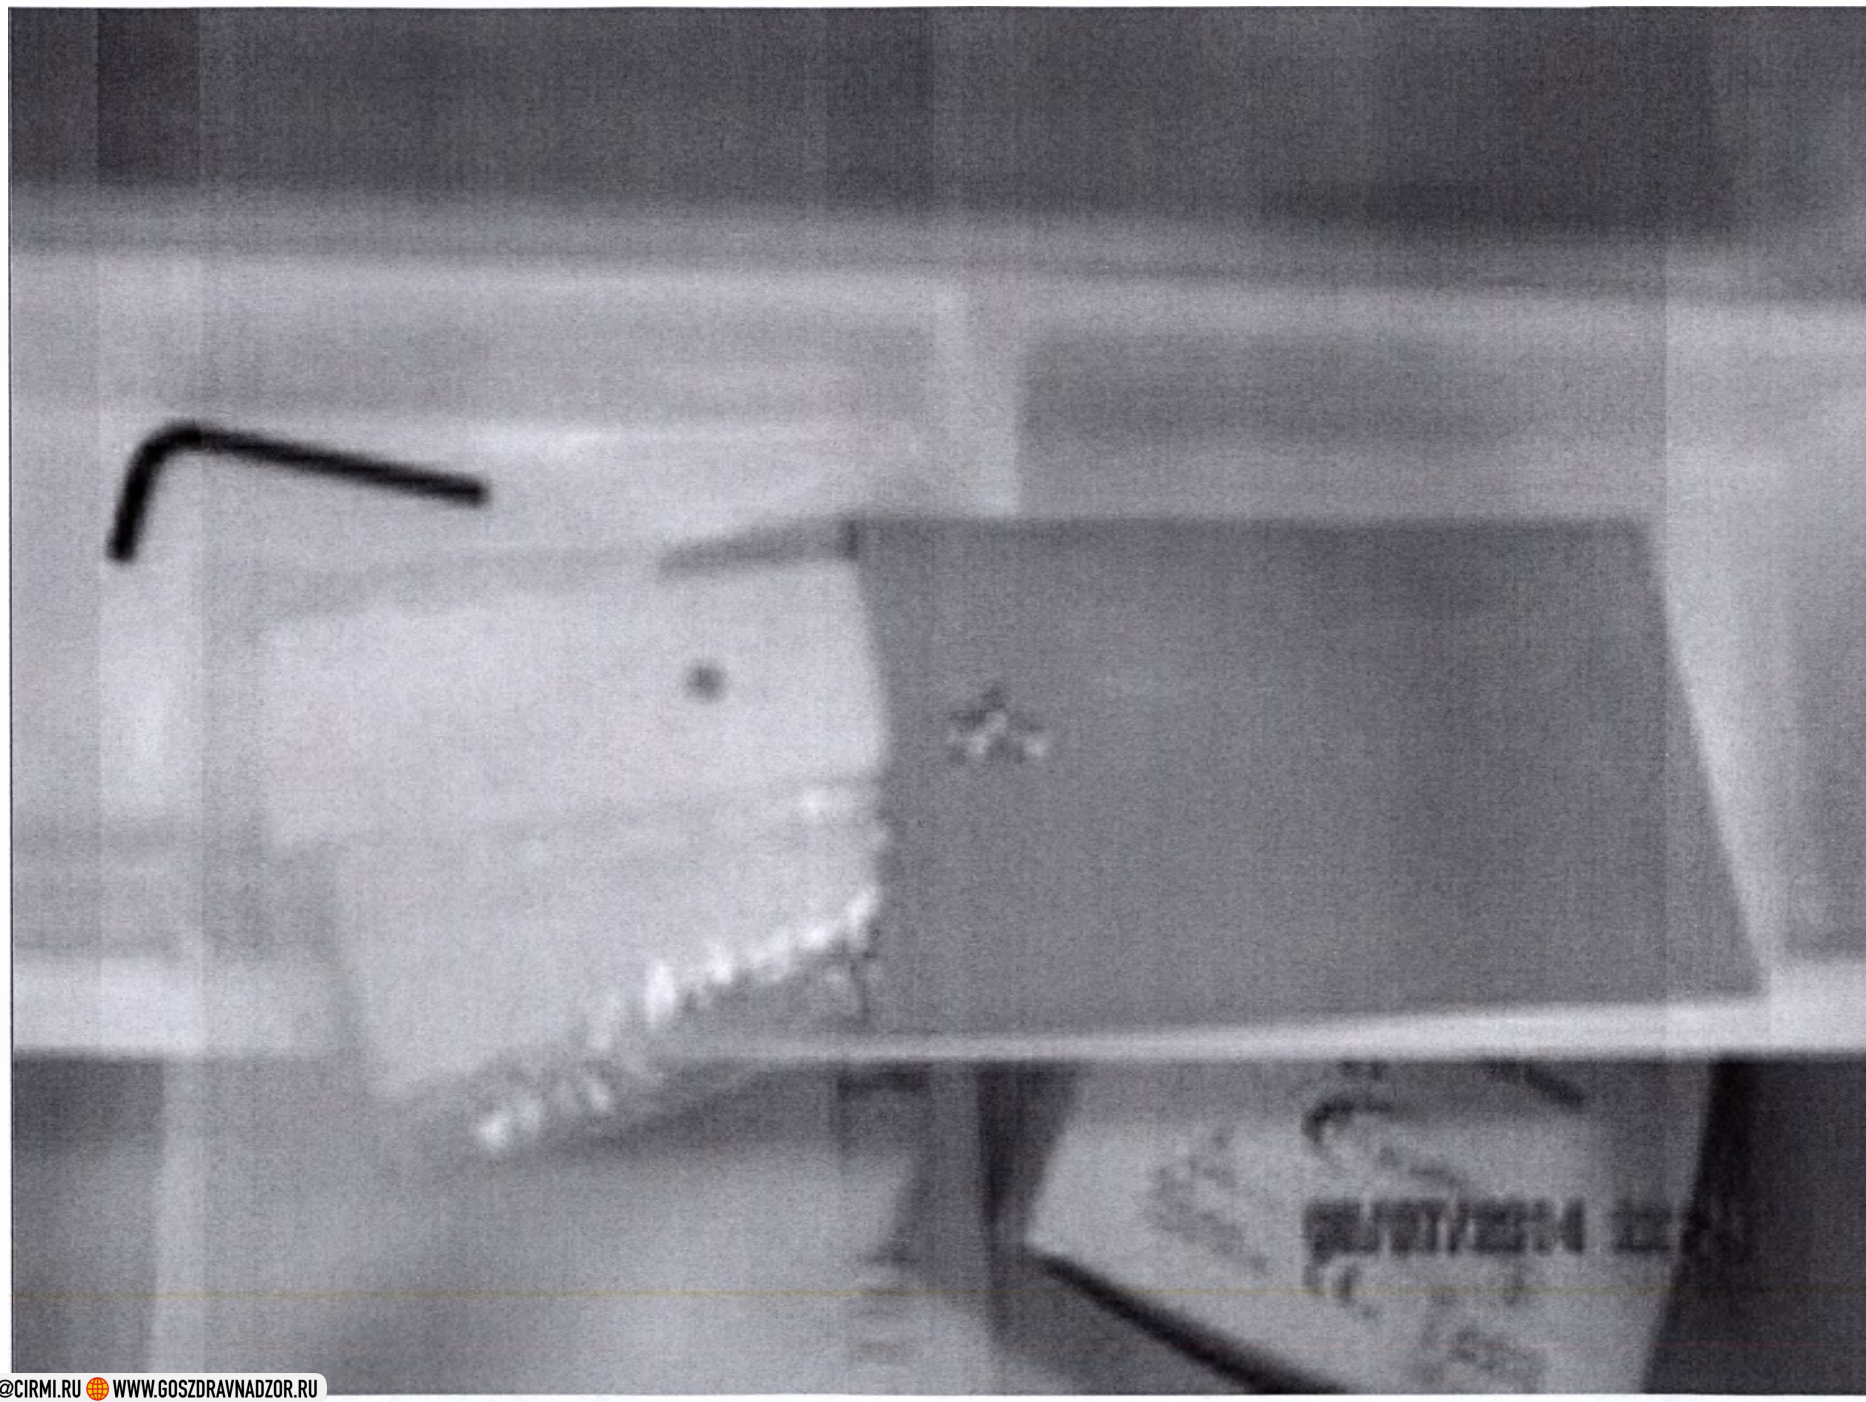

60. Фильтры вентиляторные (не более 5 шт.).

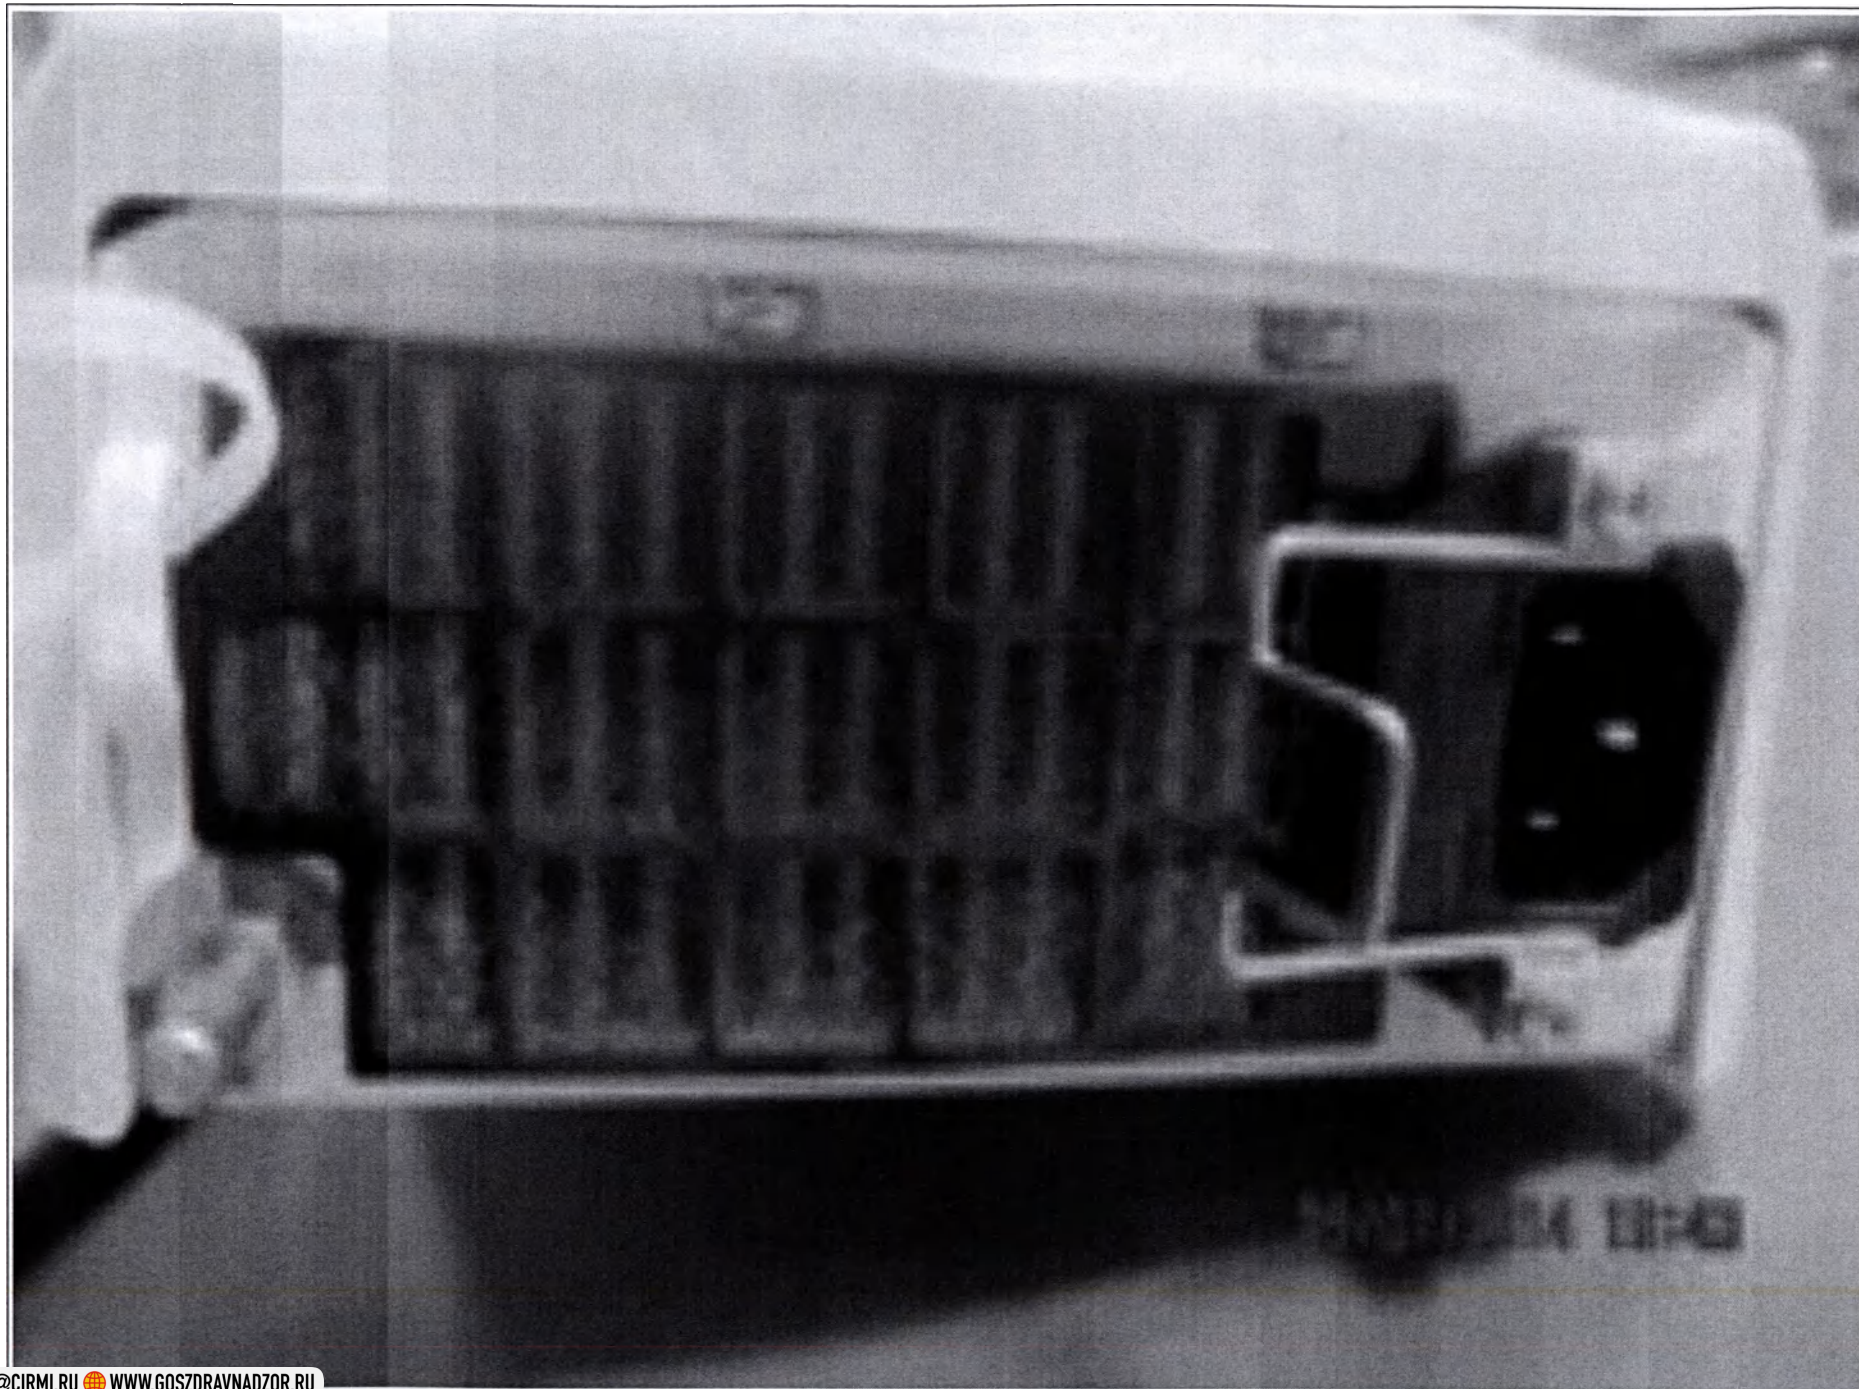

61. Корзина для хранения принадлежностей.

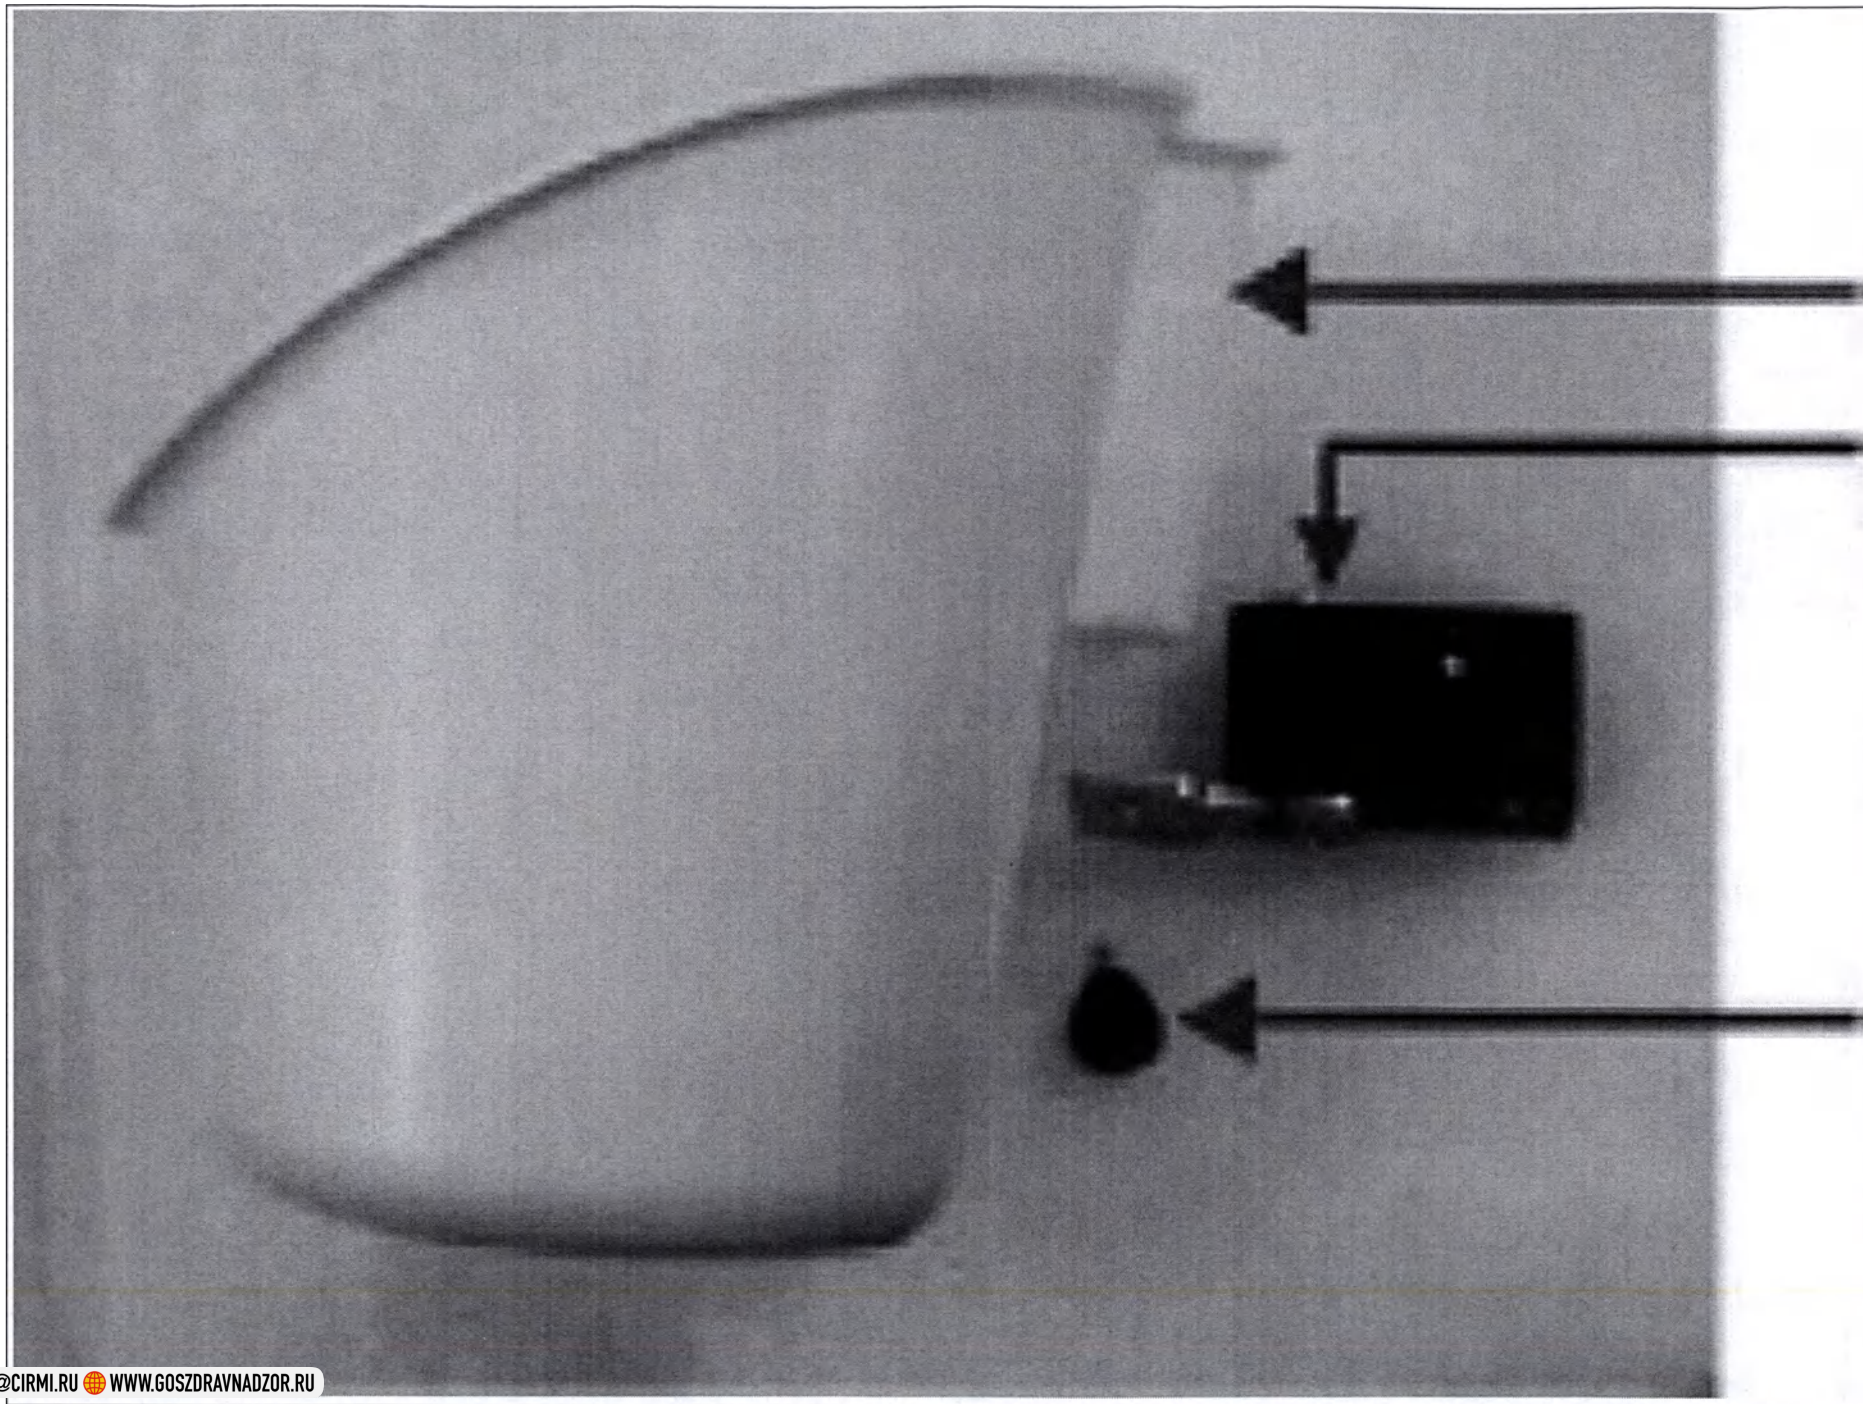

62. Крепеж для мешков дыхательных (не более 10 шт.).




63. Винт крепежный (не более 10 шт.).



GE Healthcare

Система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby™ Warmer

Руководство по эксплуатации
и техническому обслуживанию

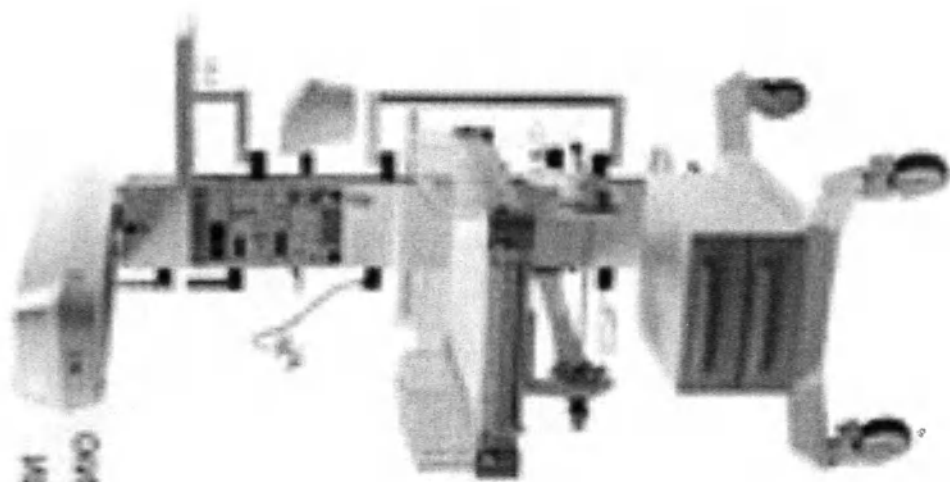

Система открытая реанимационная для
новорожденных Lullaby™ Warmer
Руководство по эксплуатации
и техническому обслуживанию
(на русском языке)
PWS2100-0011
1992.11

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 82
(восемьдесят два) листов
Руководитель отдела
регистрации и сертификации
России и СНГ
ООО "ДжиИ Хэлскеа"
Подпись: _____ Парахина С. Б.

