

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора Федерального
бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-
исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

В.В. Малеев

2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления провирусной ДНК вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией

«АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL»

по ТУ 9398-007-01897593-2012,


производства

Федерального бюджетного учреждения науки

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»,
Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А

2017

бор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 1 до вскрытия упаковки.

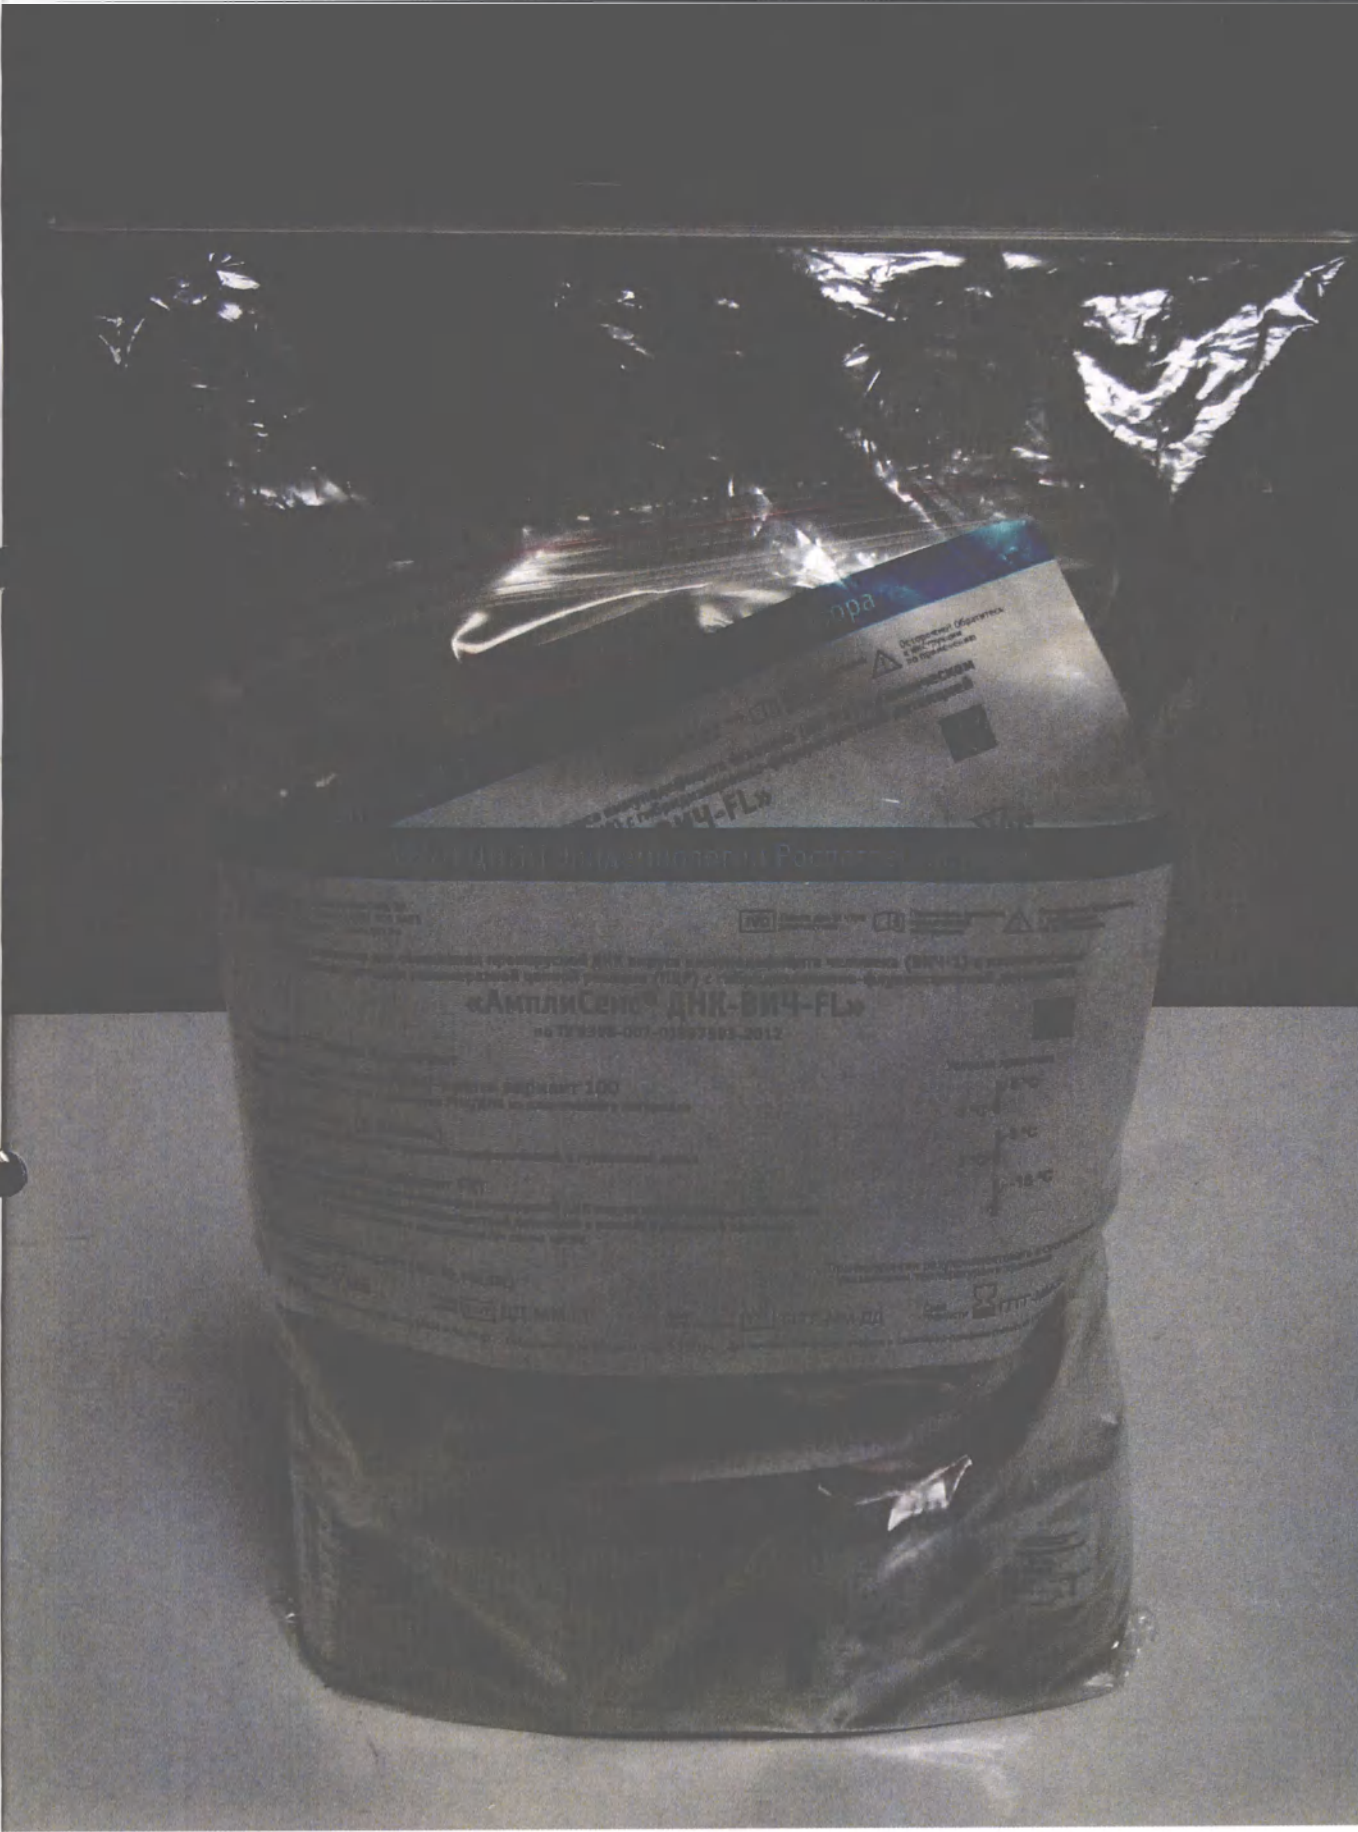

бор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 1 после вскрытия упаковки.



формы комплекта для 1 после вскрытия упаковки с
изанием реагентов.
мплект 1 из 2:

Раствор для отмывки 3 (1 флакон); 2. Раствор для отмывки 4 (1 флакон); 3. Раствор для
эципитации (1 флакон); 4. Раствор для лизиса (1 флакон); 5. РНК-буфер (8 пробирок);
емолитик (1 флакон).




лабор реактивов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 1 после вскрытия упаковки с
казанием реактивов.

Комплект 2 из 2:

1. ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ (8 пробирок); 2. ОТ-ПЦР-смесь-2-FEP/FRT (8 пробирок); 3. Полимераза
TaqF) (8 пробирок); 4. ТЕ-буфер (8 пробирок); 5. ПКО ДНК ВИЧ-1 и ДНК человека (2 пробирки).



Набор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 2 до вскрытия упаковки.

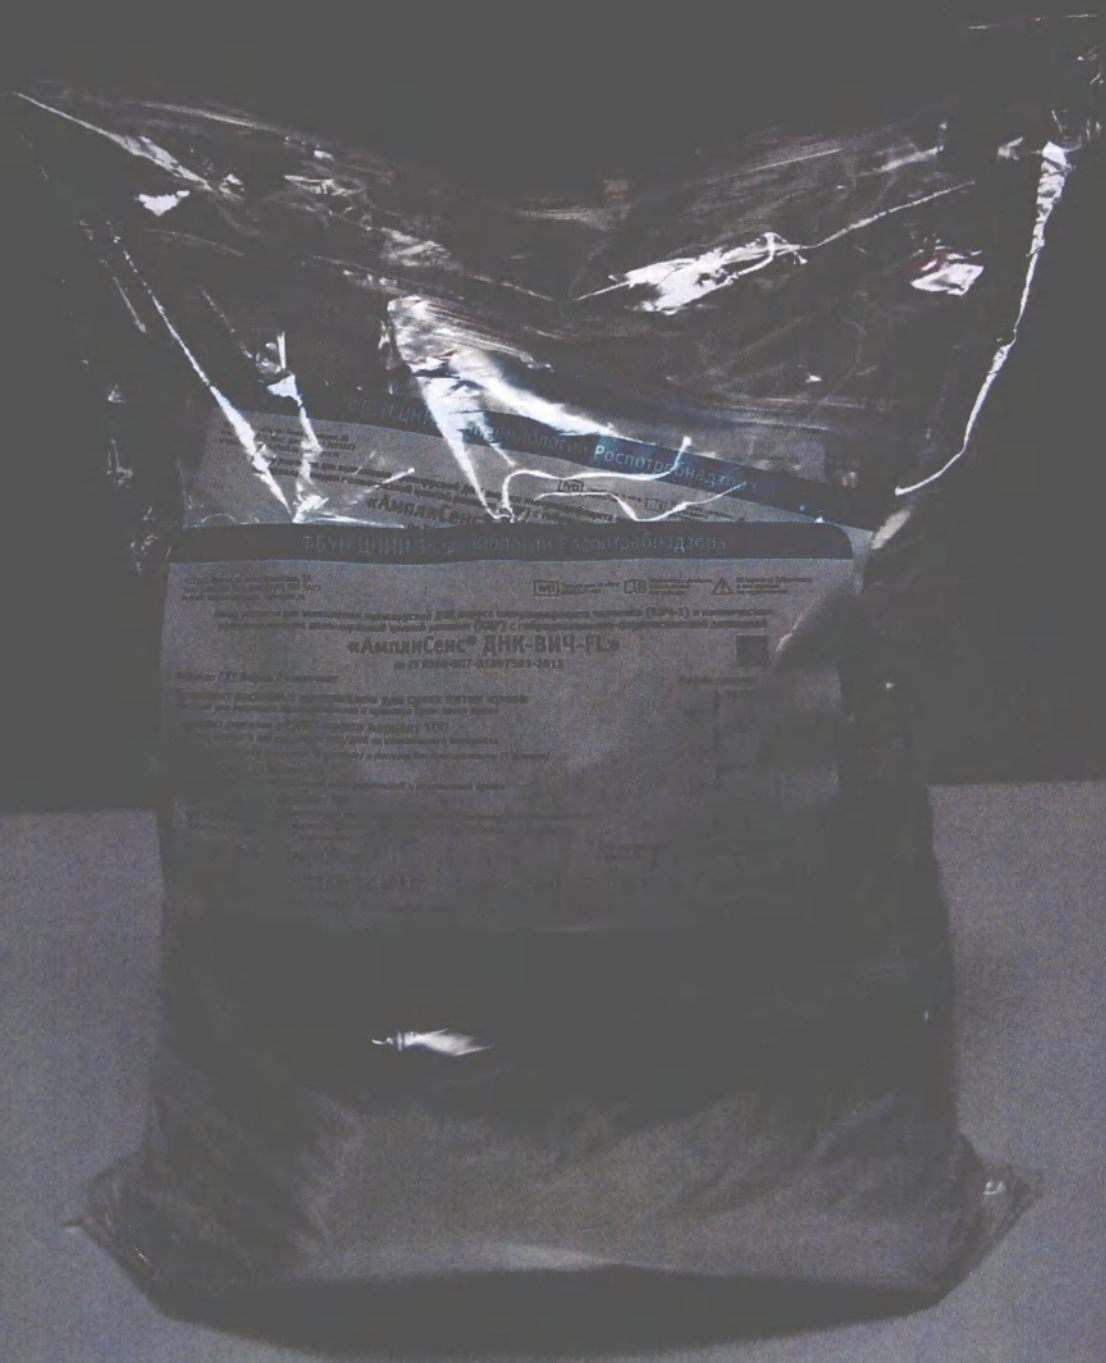




р реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 2 после вскрытия упаковки с
нием реагентов.

плект 1 из 3:

рточка для забора крови Whatman 903 (100 шт.); 2. Пакет Zip-Lock (100 шт.);

сушитель (100 шт.).

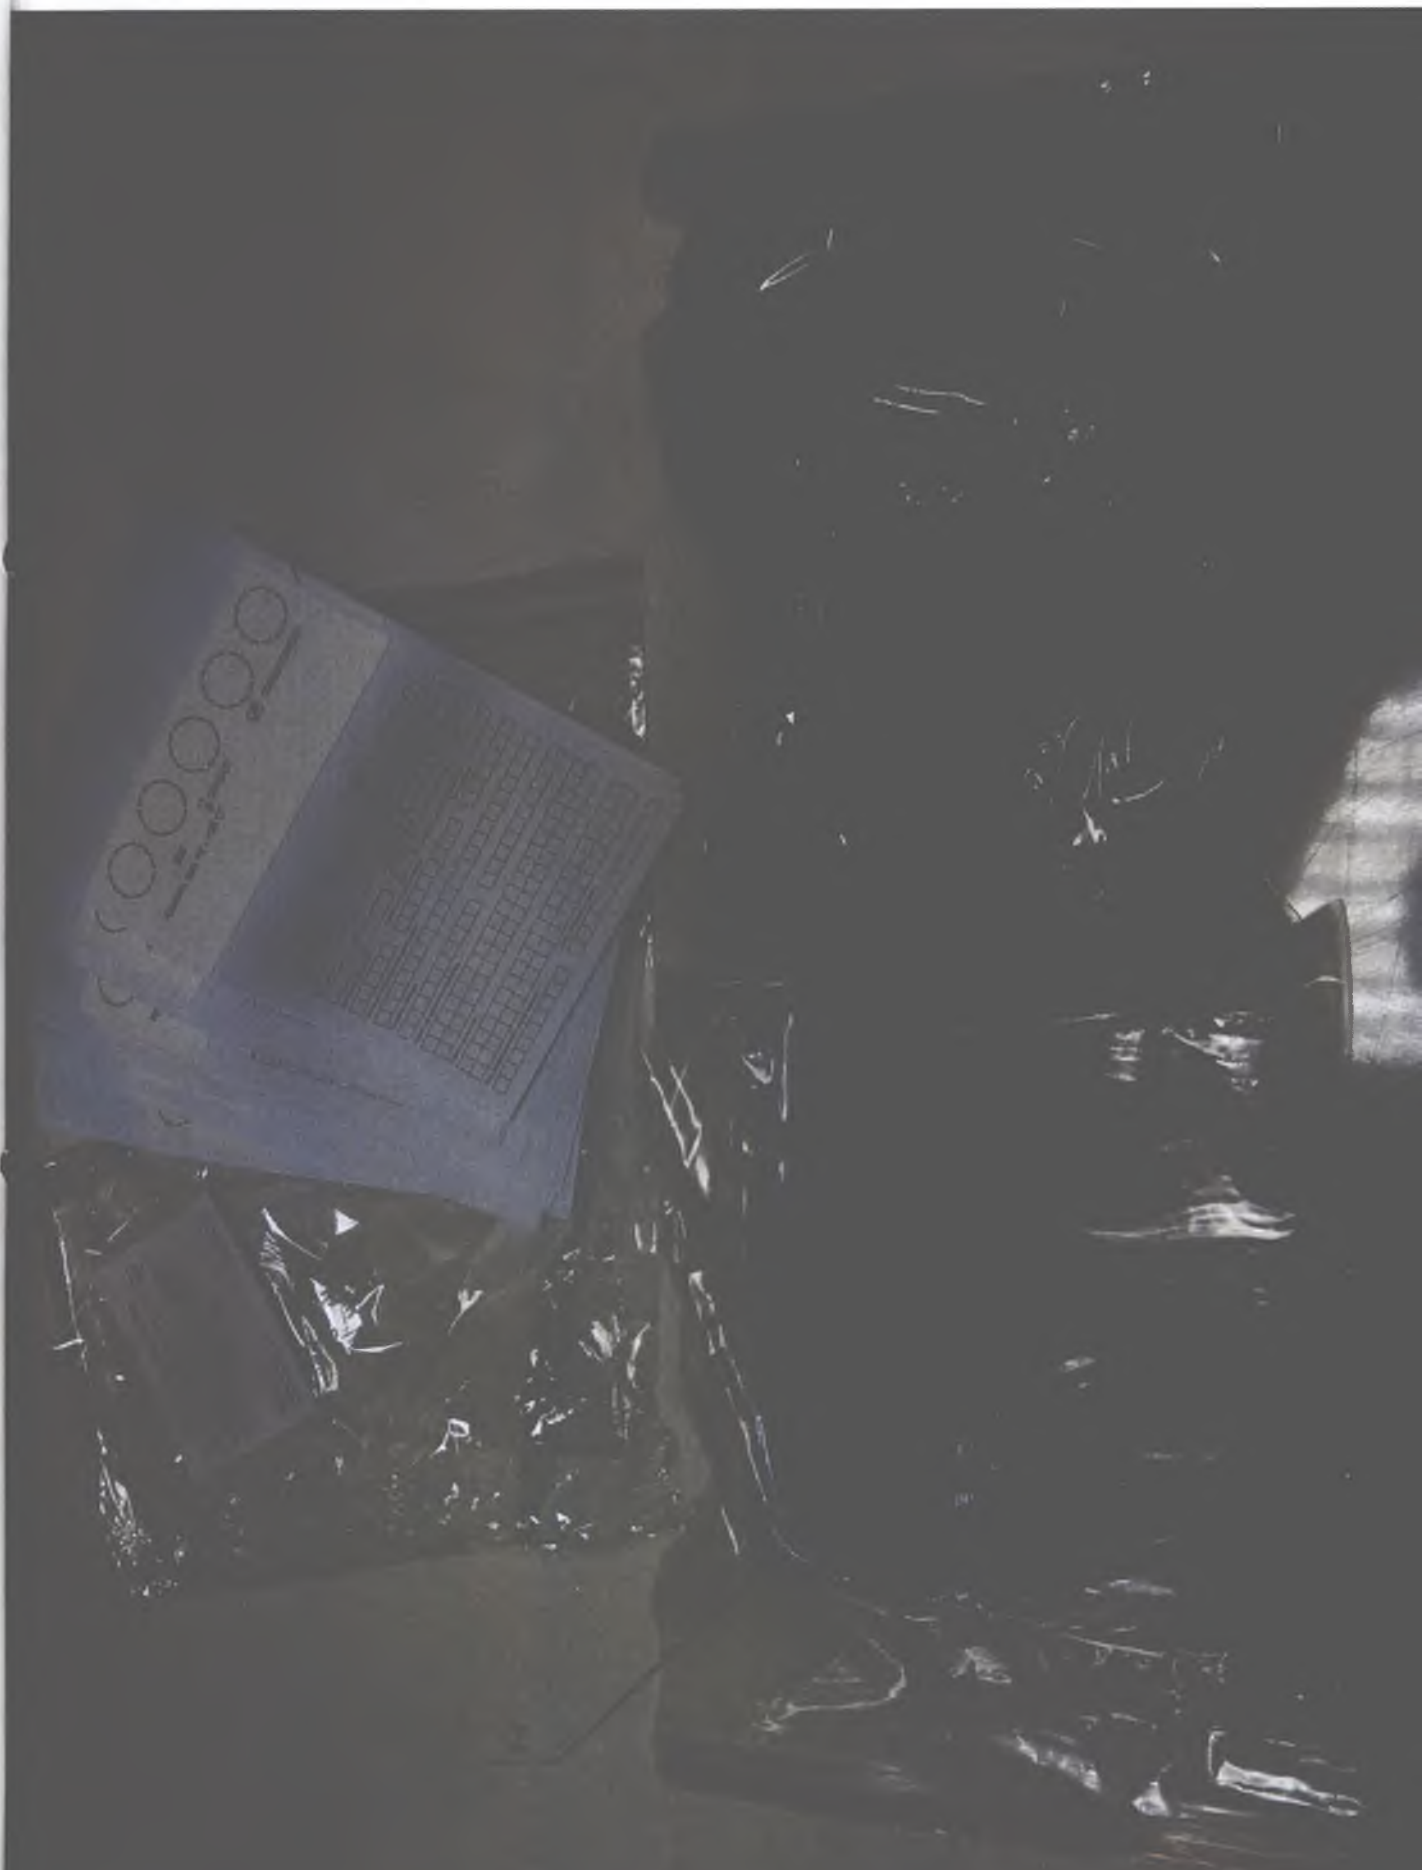

Набор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 2 после вскрытия упаковки с указанием реагентов.

Комплект 2 из 3:

1. Гемолитик (1 флакон);
2. Раствор для отмывки 3 (1 флакон);
3. Раствор для отмывки 4 (1 флакон);
4. Раствор для преципитации (2 флакона);
5. Раствор для лизиса (3 флакона);
6. РНК-буфер (8 пробирок).



Набор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 2 после вскрытия упаковки с указанием реагентов.

Комплект 3 из 3:

1. Полимераза (TaqF) (8 пробирок); 2. ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ (8 пробирок); 3. ОТ-ПЦР-смесь-2-FRT/FRT (8 пробирок); 4. ТЕ-буфер (8 пробирок); 5. ПКО ДНК ВИЧ-1 и ДНК человека (2 пробирки).



бор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 3 после вскрытия упаковки с
ранием реагентов.

комплект 1 из 2:

ЖКО (1 пробирка); 2. ТЕ-буфер (2 пробирки); 3. Сорбент универсальный (2 пробирки); 4.
олитик (2 пробирки); 5. Лизирующий раствор (1 пробирка); 6. Раствор для отмывки 1 (1
бирка); 7. Раствор для отмывки 2 (1 пробирка).



реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 3 после вскрытия упаковки с

нием реагентов.

ект 2 из 2:

буфер (8 пробирок); 2. Полимераза (TaqF) (8 пробирок); 3. ПКО ДНК ВИЧ-1 и ДНК человека (8 пробирок); 4. ОТ-ПЦР-смесь-2-FEP/FRT (8 пробирок); 5. ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ (8 пробирок).

Набор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 4 до вскрытия упаковки:
ПЦР-комплект» вариант FRT, «РИБО-преп» вариант 100, «Гемолитик». Упаковка 1 из 2;
ПЦР-комплект» вариант FRT, «РИБО-преп» вариант 100, «Гемолитик». Упаковка 2 из 2.



Набор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплекта 4 после вскрытия упаковки с указанием реагентов.

«ПЦР-комплект» вариант FRT, «РИБО-преп» вариант 100, «Гемолитик».

Упаковка 1 из 2.

1. Раствор для преципитации (2 пробирки); 2. РНК-буфер (16 пробирок); 3. Раствор для отмывки 4 (2 пробирки); 4. Раствор для лизиса (2 пробирки); 5. Гемолитик (2 пробирки); 6. Раствор для отмывки 3 (2 пробирки).

«ПЦР-комплект» вариант FRT, «РИБО-преп» вариант 100, «Гемолитик».

Упаковка 2 из 2.


7. ПКО-ДНК-ВИЧ-1 и ДНК-человека (4 пробирки); 8. ОТ-ПЦР-смесь-2-FER/FRT (16 пробирок); 9. Полимераза (TaqF) (16 пробирок); 10. ТЕ-буфер (16 пробирок); 11. ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ (16 пробирок).



ор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 4 после вскрытия упаковки с
ванием реагентов.

ковка 1 из 2.


раствор для преципитации (2 пробирки); 2. РНК-буфер (16 пробирок); 3. Раствор для отмывки 4
пробирки); 4. Раствор для лизиса (2 пробирки); 5. Гемолитик (2 пробирки); 6. Раствор для отмывки
пробирки).

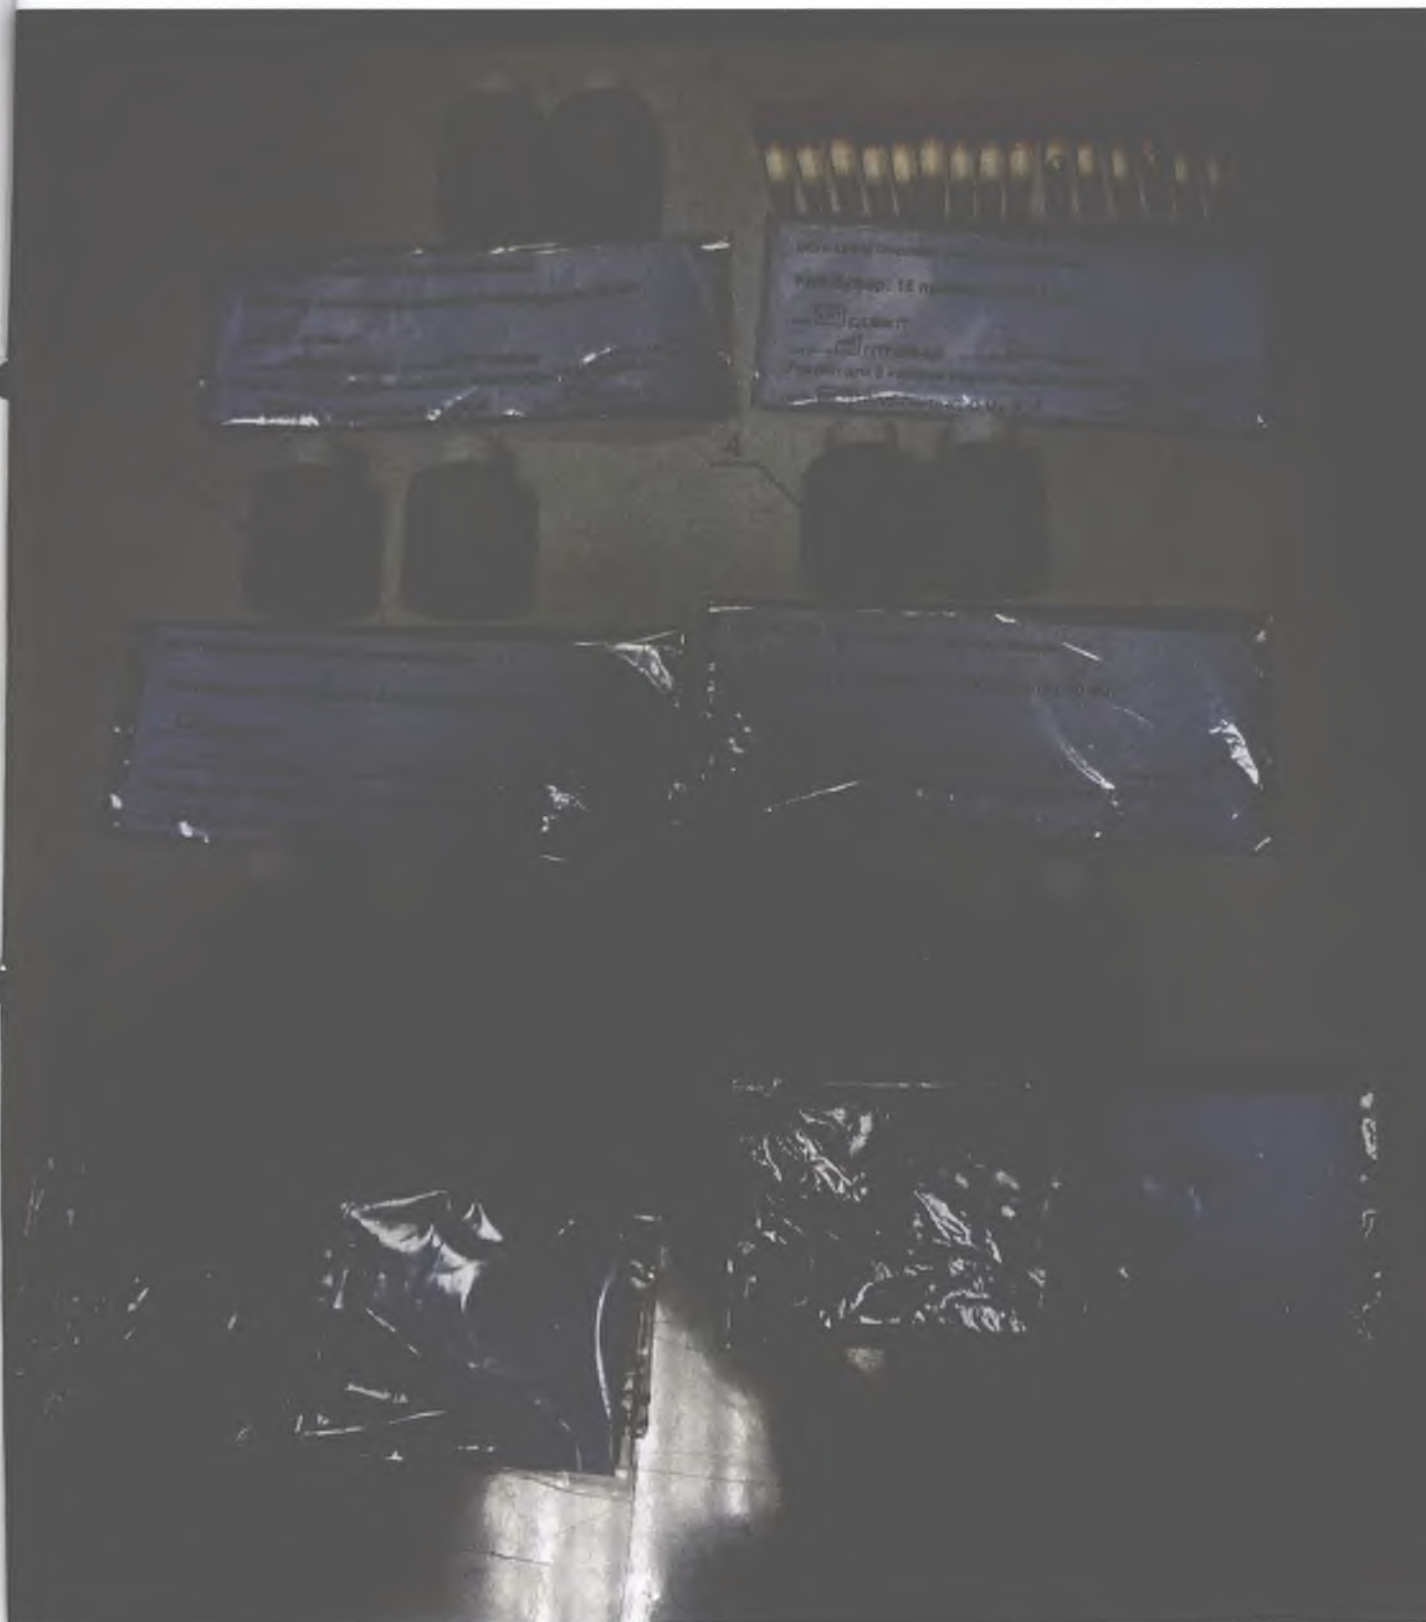

ор реагентов АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL формы комплектации 4 после вскрытия упаковки с указанием
ентов.

ковка 2 из 2.

КО-ДНК-ВИЧ-1 и ДНК-человека (4 пробирки); 2. ОТ-ПЦР-смесь-2-FER/FRT (16 пробирок); 3. Полимераза
pF) (16 пробирок); 4. ТЕ-буфер (16 пробирок); 5. ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ (16 пробирок).

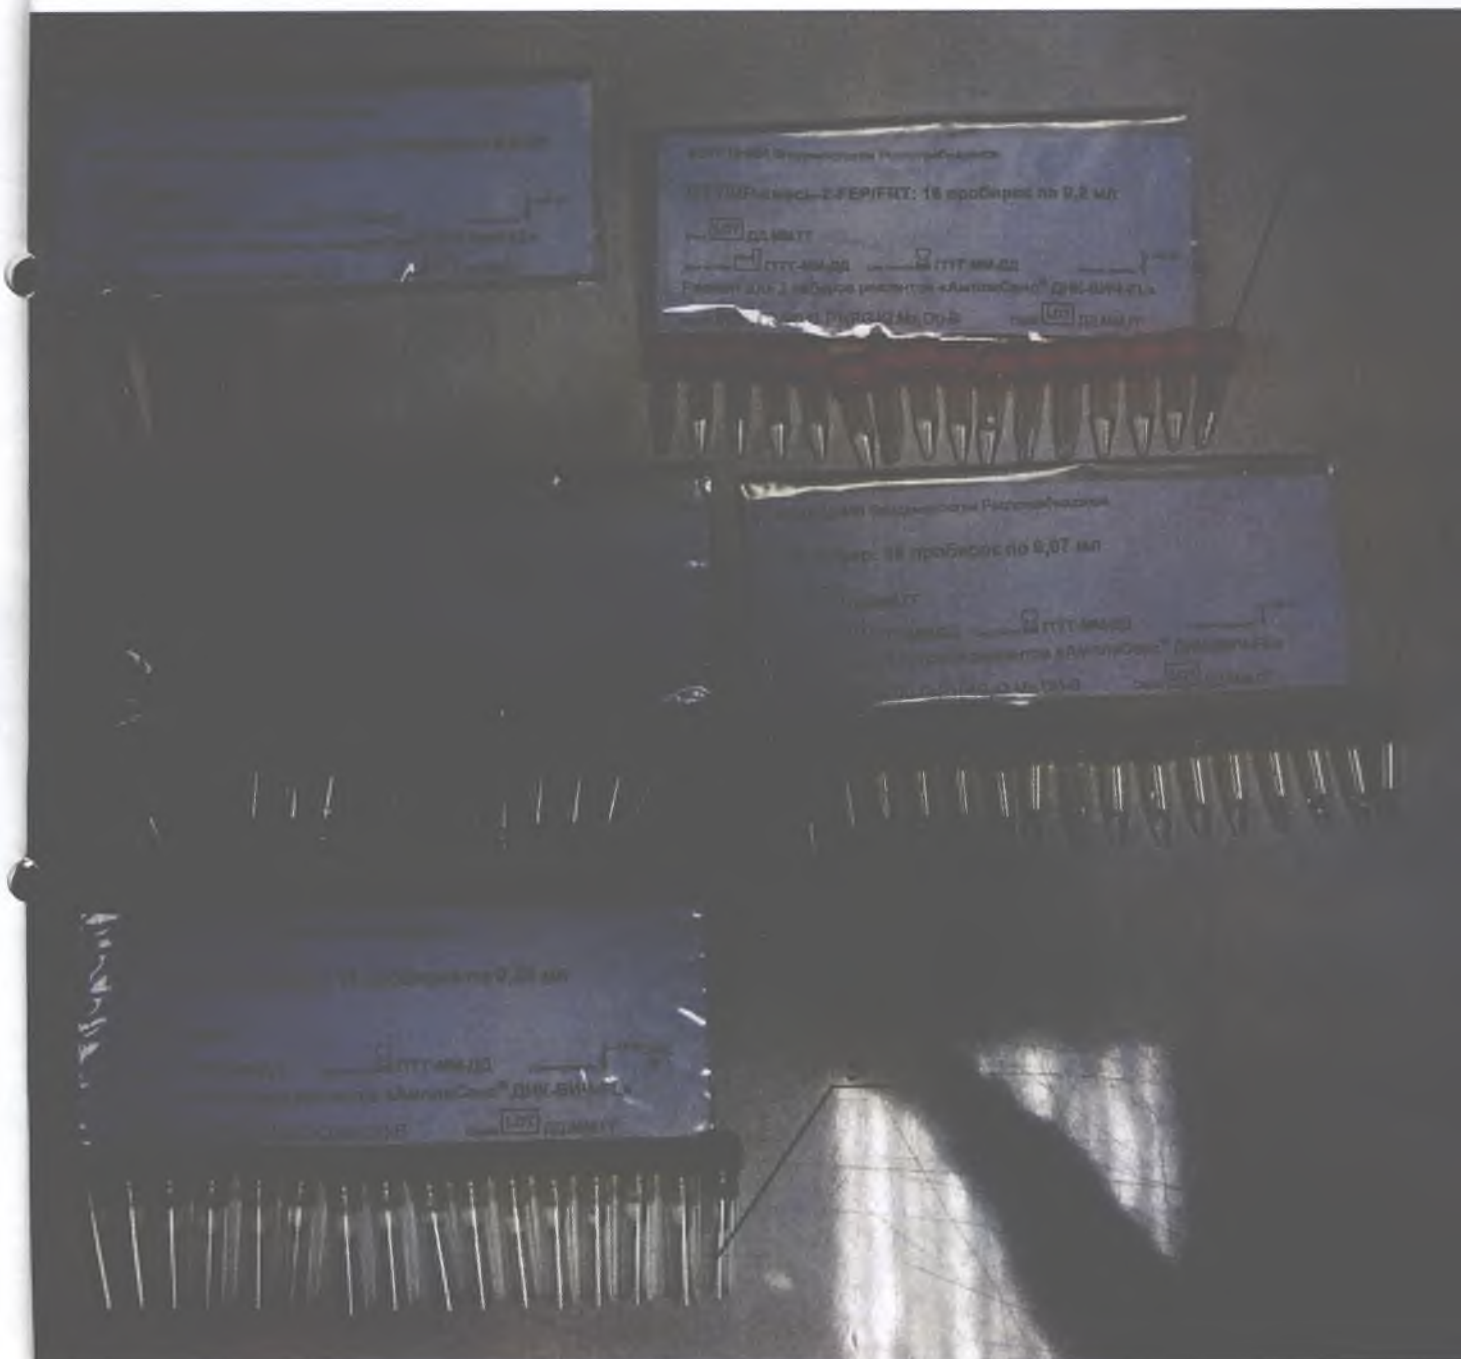

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 18 лист 06

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

 В.В.Малеев

