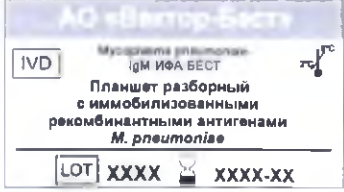











«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусайнов
«03» _____ 2015 г.
ОГРН 102540434755, Юр. адрес: г. Челябинск, Челябинская область, Р.п. № _____

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М
к *Mycoplasma pneumoniae* (*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора "Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ"

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	
Положительный контрольный образец (К ⁺)	
Отрицательный контрольный образец (К ⁻)	
Конъюгат или конъюгат, концентрат	 
Раствор для разведения конъюгата (РК) (при комплектации набора конъюгатом, концентратом)	
Раствор для разведения сыворооток (РС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	
Ванночки для реагентов	

2. Образцы этикеток на коробке набора "Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ"

2.1. Верхняя этикетка.

или

XXXX

**набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к Mycoplasma pneumoniae**

Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ

состав:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
7. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
9. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
10. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
12. Ванночки для реагентов	2 шт.

REF

D-XXXX


**набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к Mycoplasma pneumoniae**

Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ

состав:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
13. Ванночки для реагентов	2 шт.

2.2. Боковая этикетка №1.

REF	D-XXXX		96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-047-23548172-2018				XXXX-XX-XX	
ПУ №				XXXX-XX-XX	
Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ					
IVD					XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют					


2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www. vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев


«03» _____ 2019 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов.
Директор по технологиям и качеству
АО "Вектор-Бест"

" 3 " _____ 2017 г. Масяго А.В.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусайнов

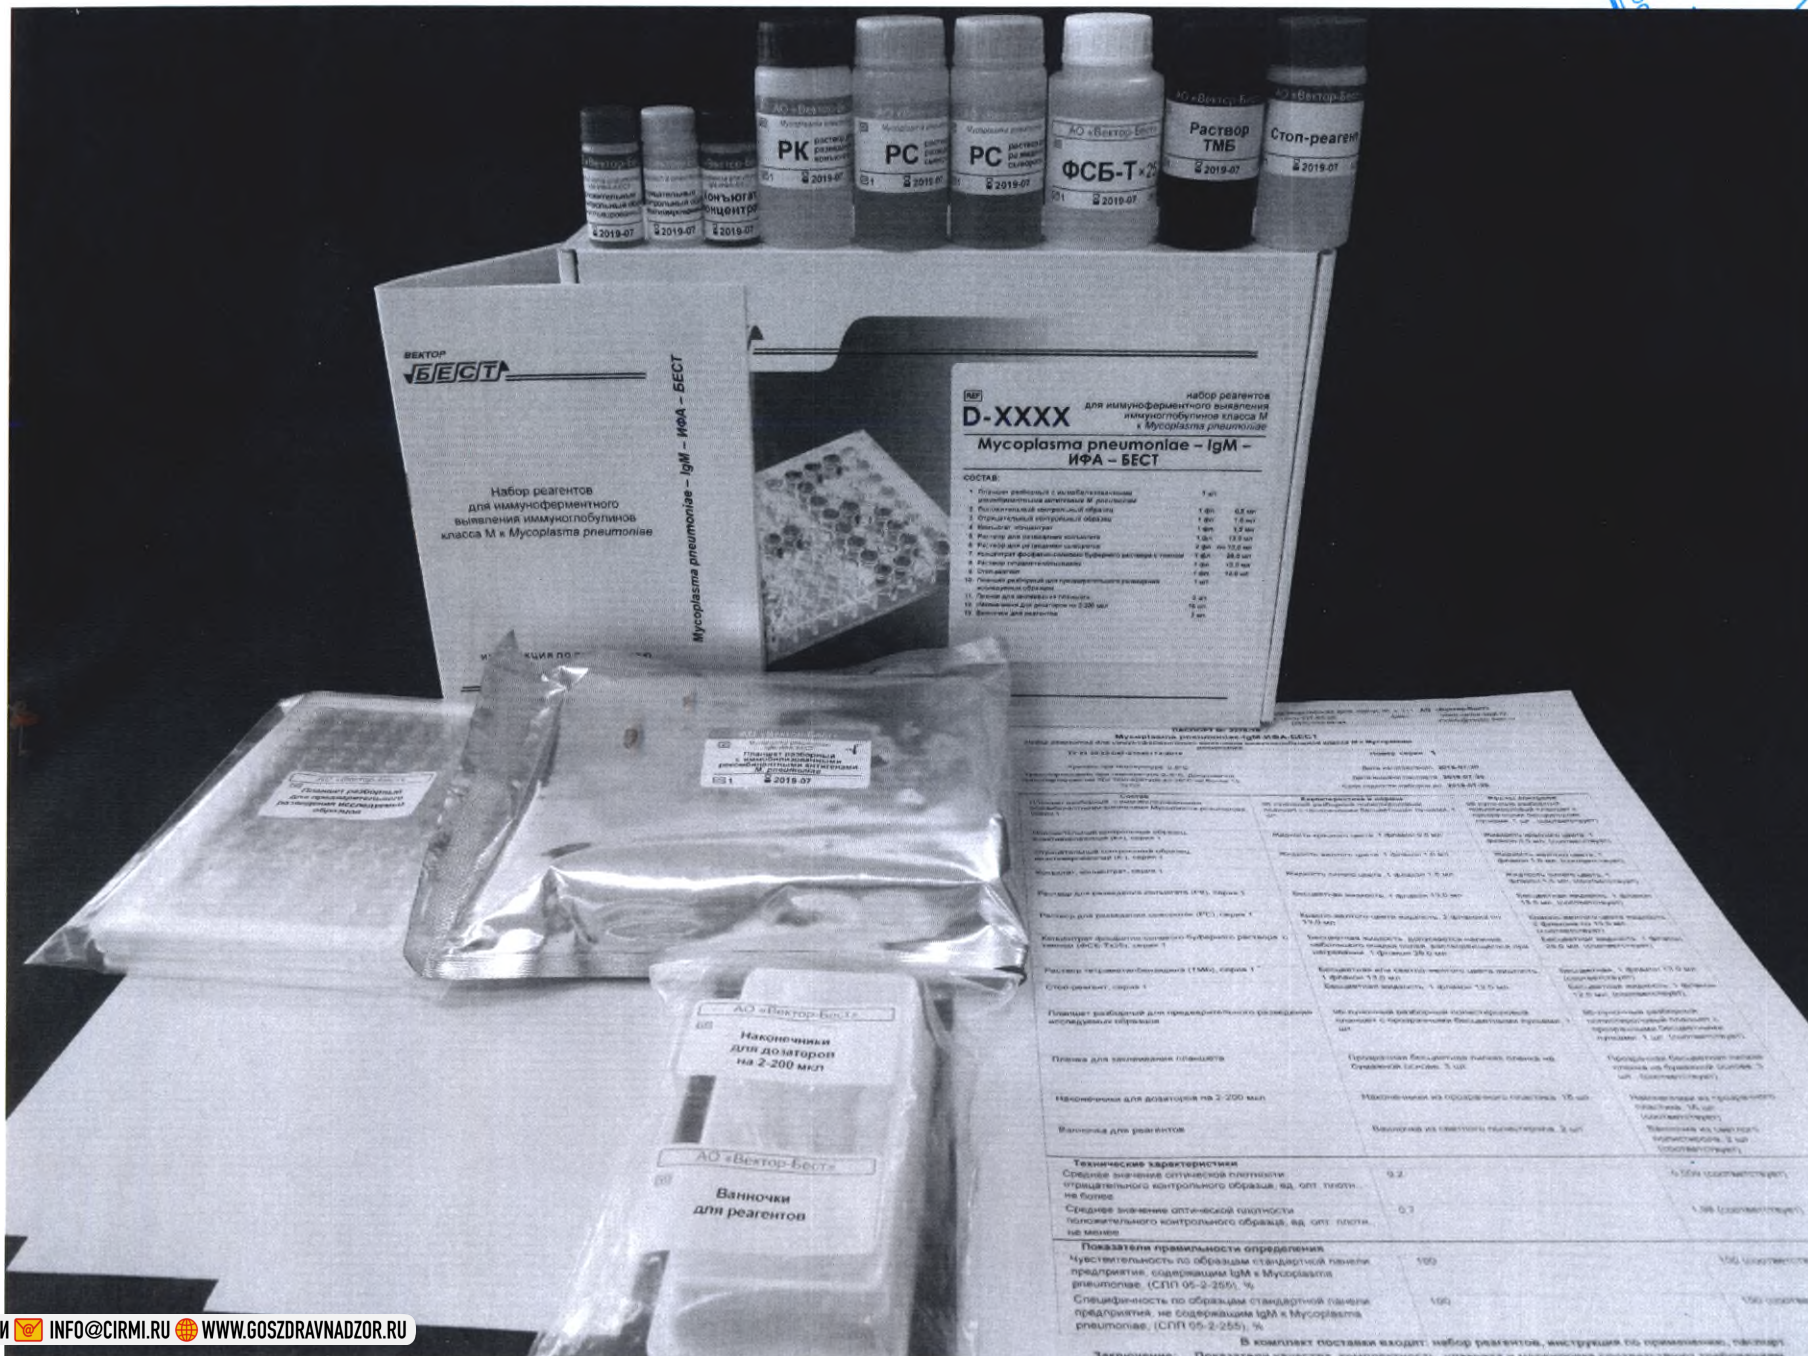


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусайнов
“д” 66 2019 г.

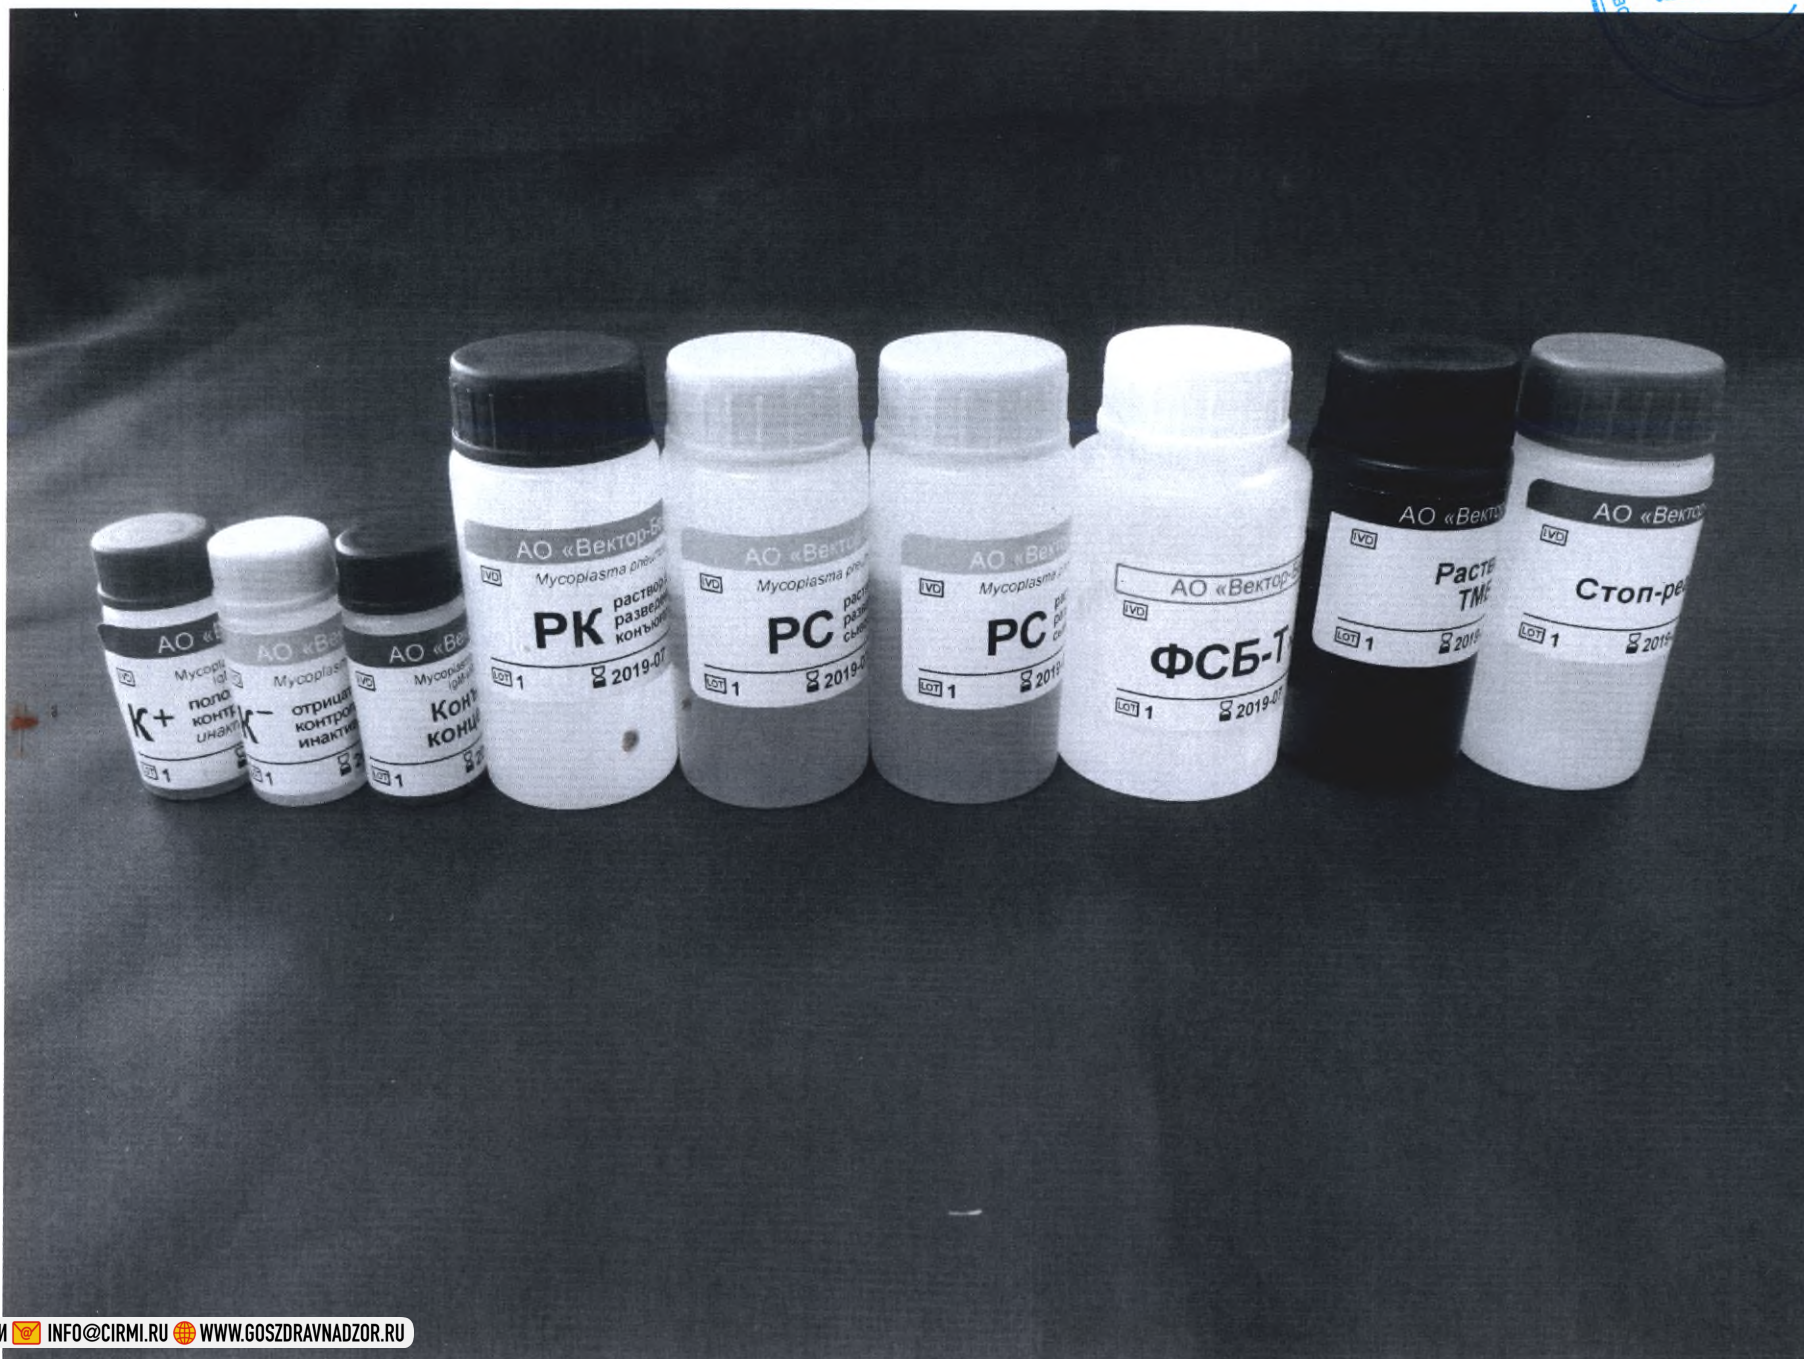


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов

“04”

2019

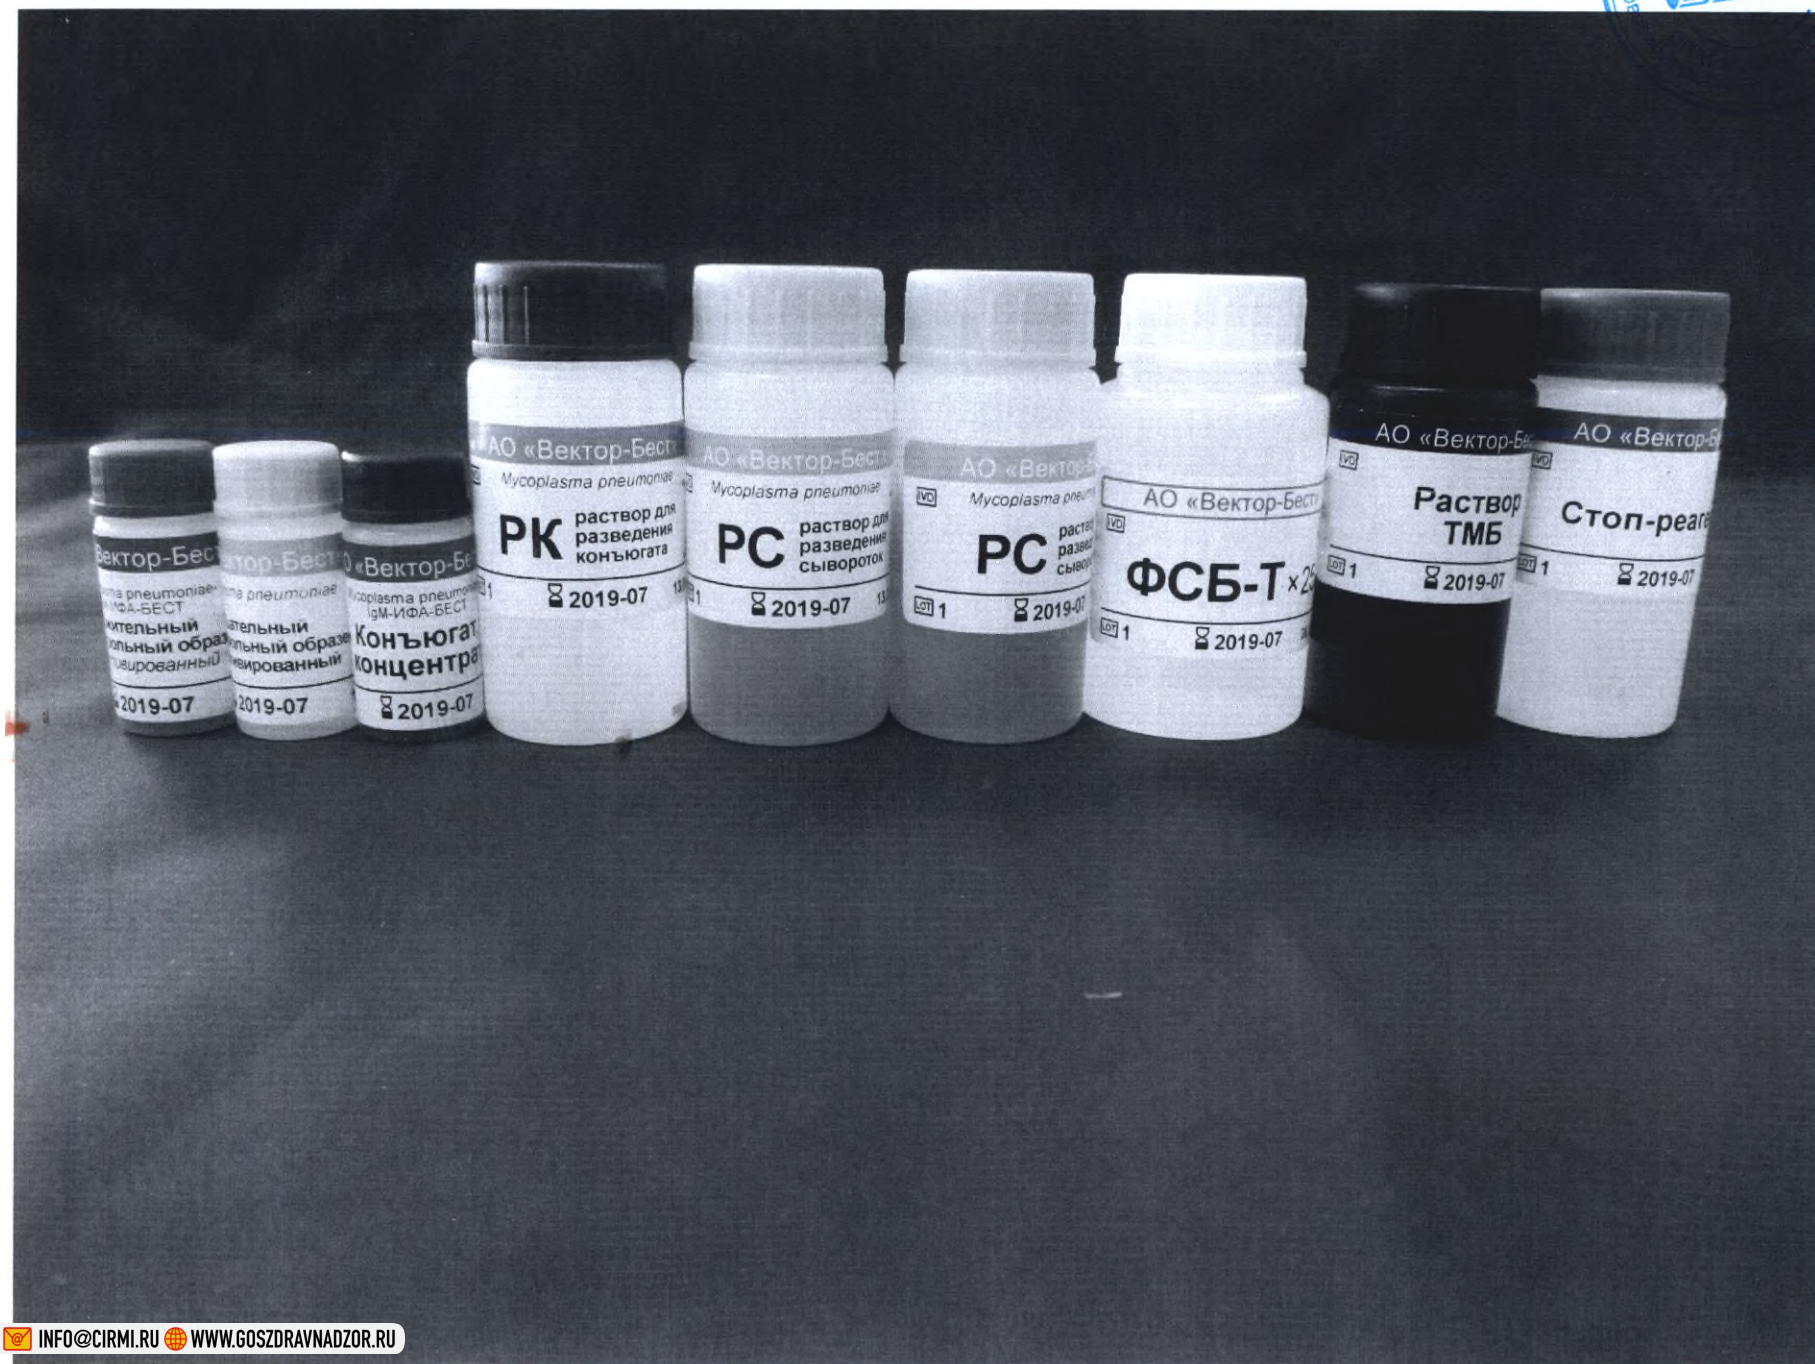


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусанов


2019 г.

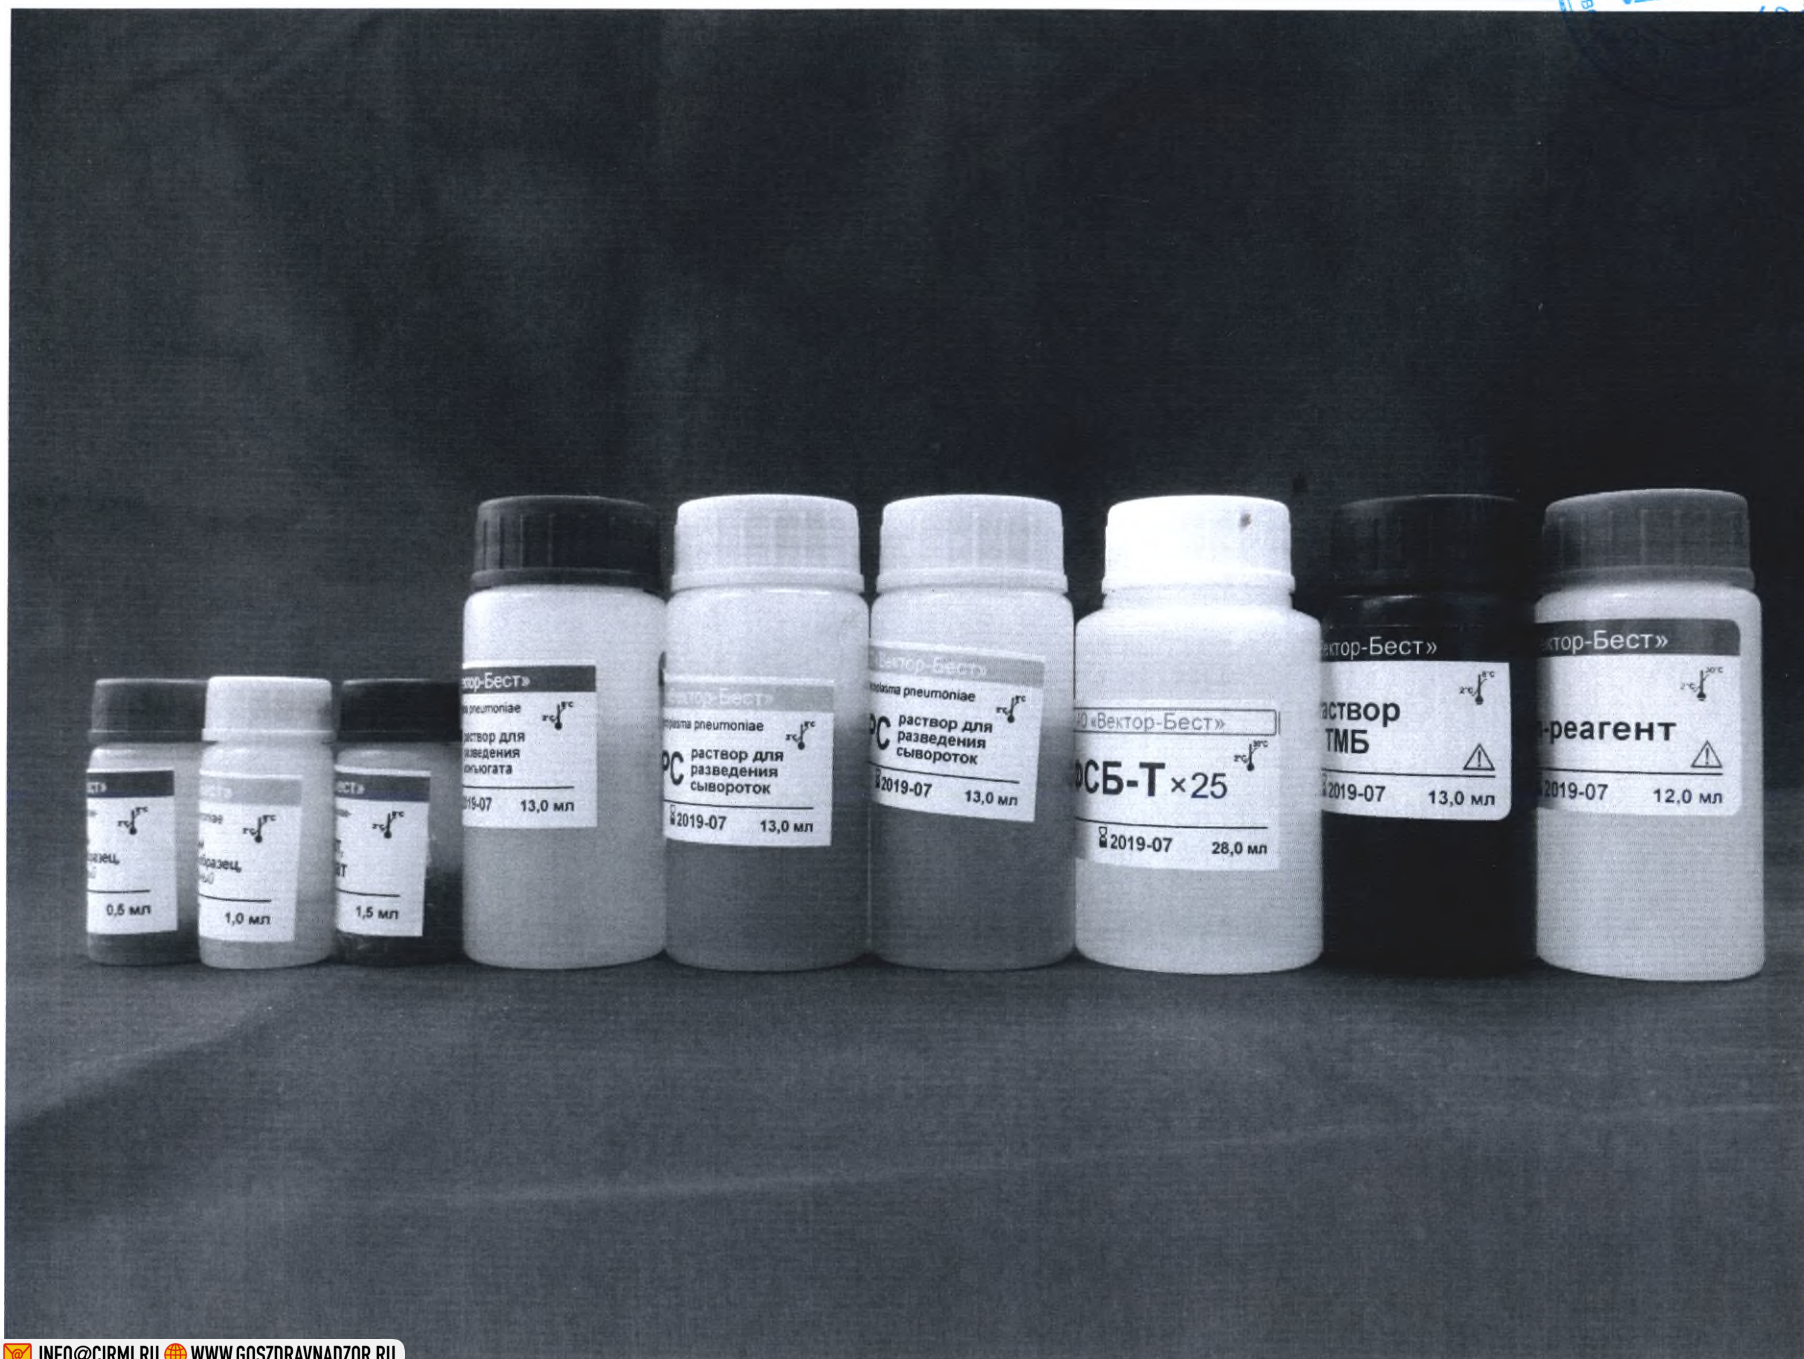

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №5
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

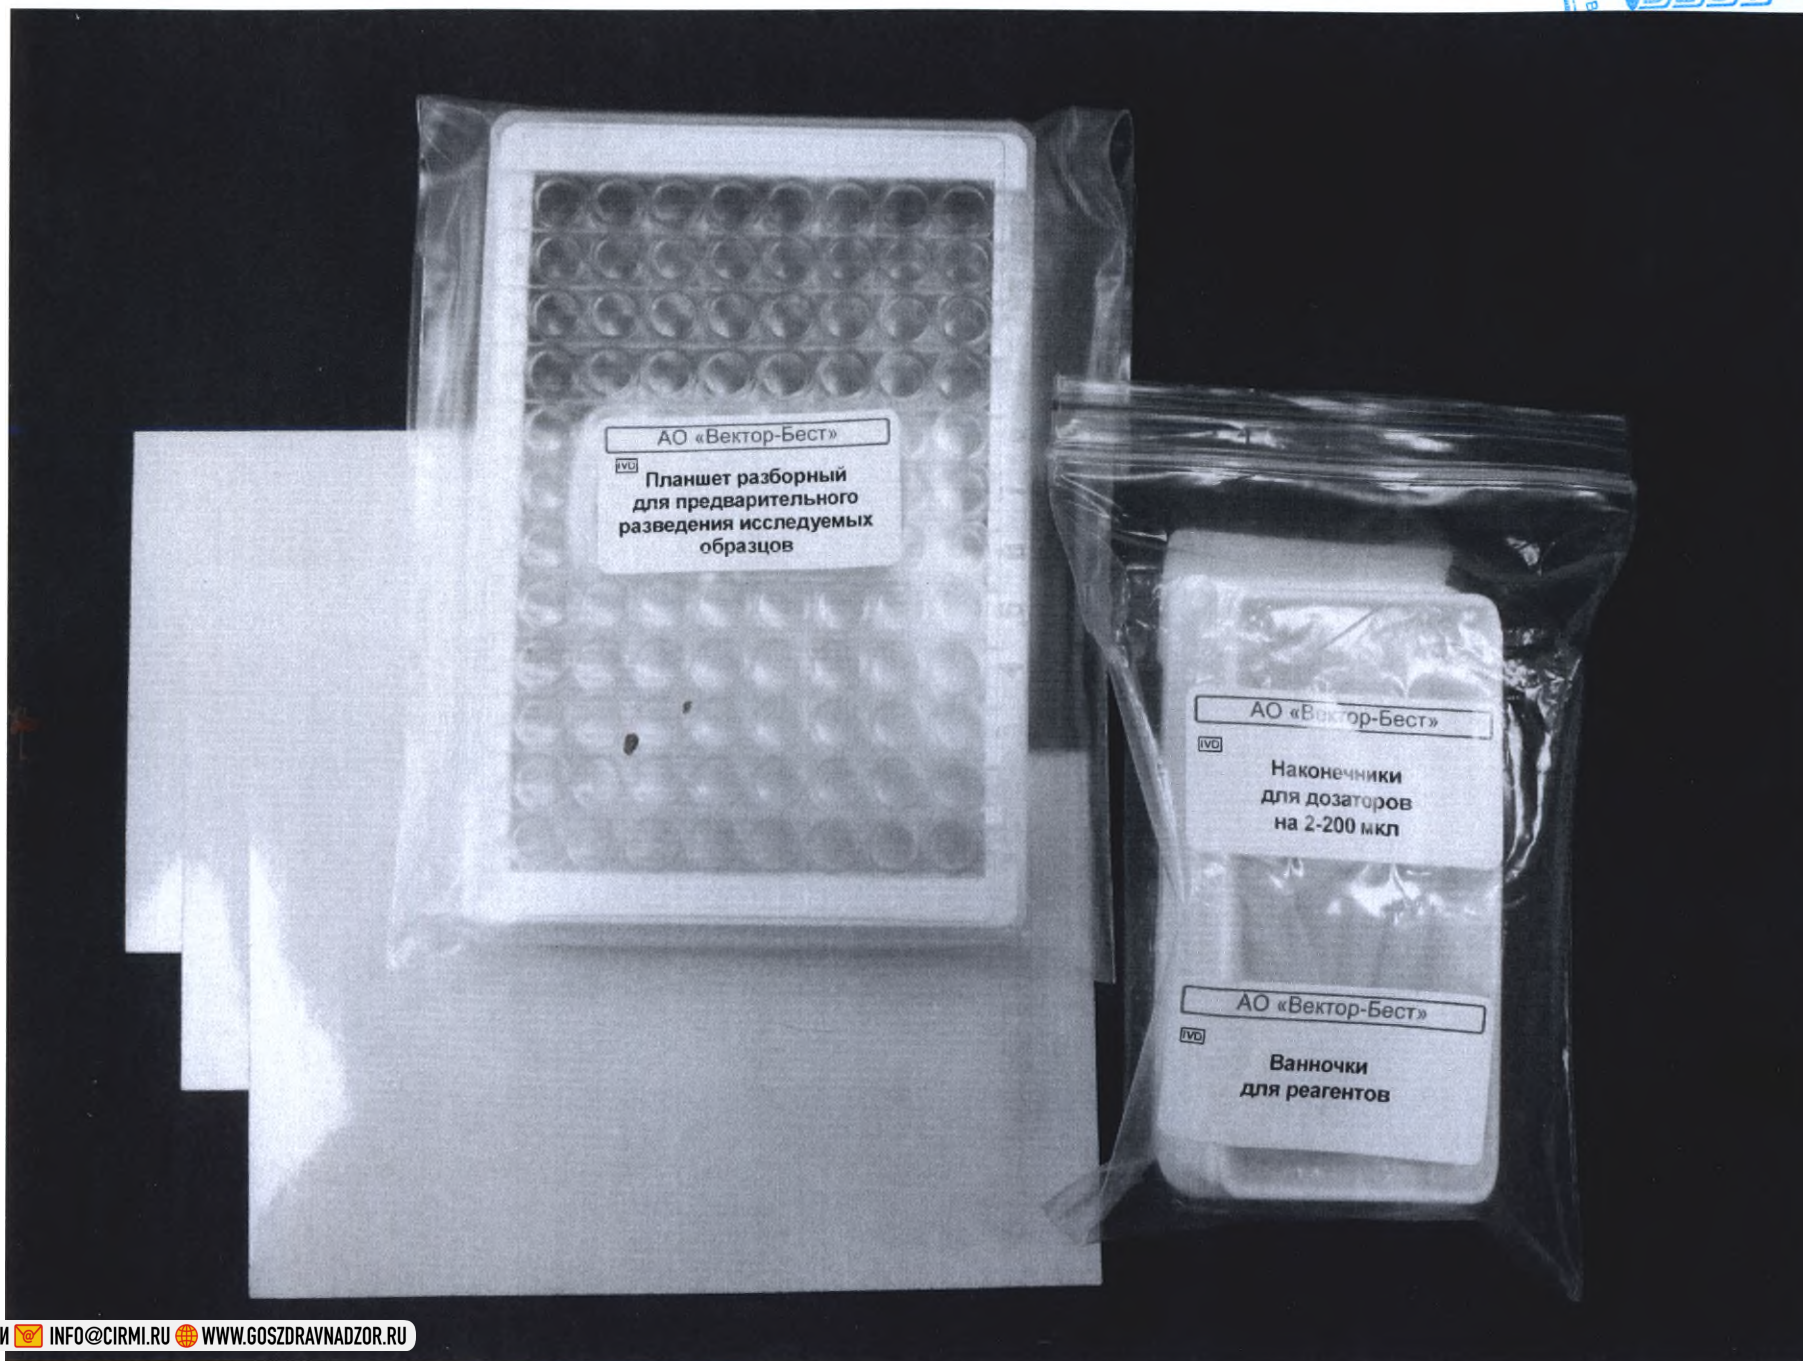



ВЕКТОР
БЕСТ

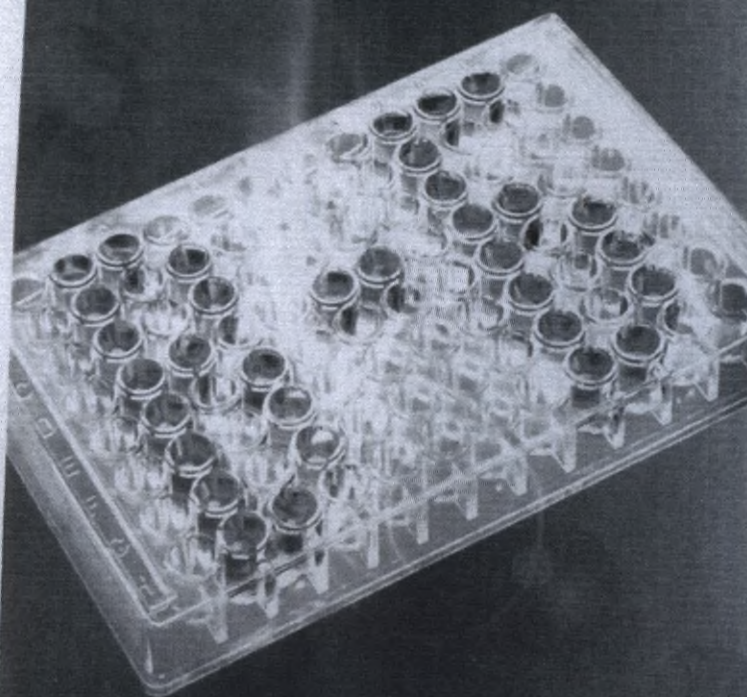

REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к *Mycoplasma pneumoniae*

**Mycoplasma pneumoniae – IgM –
ИФА – БЕСТ**

СОСТАВ:


1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
13. Ванночки для реагентов	2 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ" №2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М. Полусаинов
"01" 2019 г. 



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ"
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусайнов
 "04" . 05 . 2019 г.

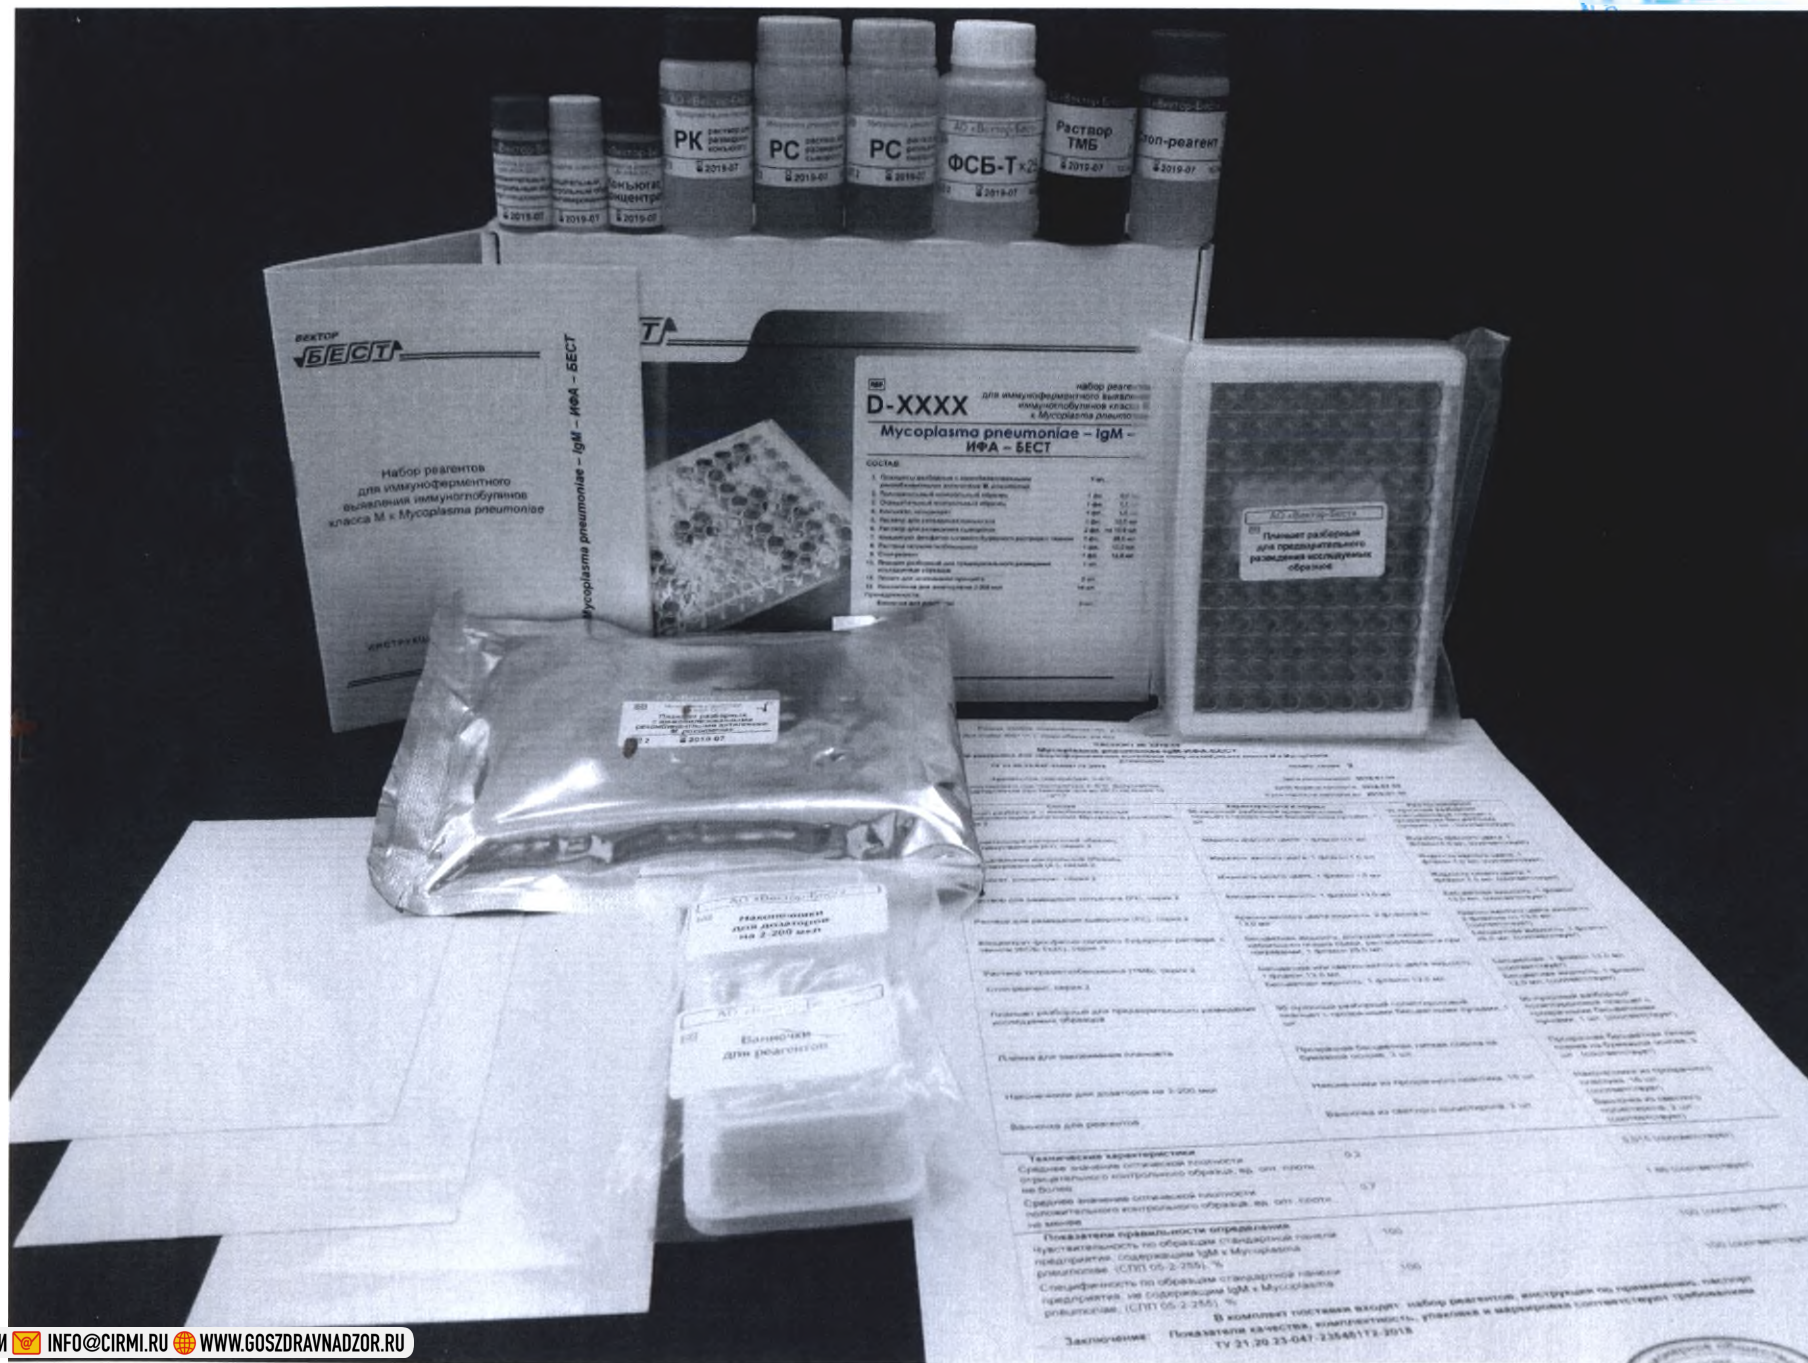


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов

2019 г.

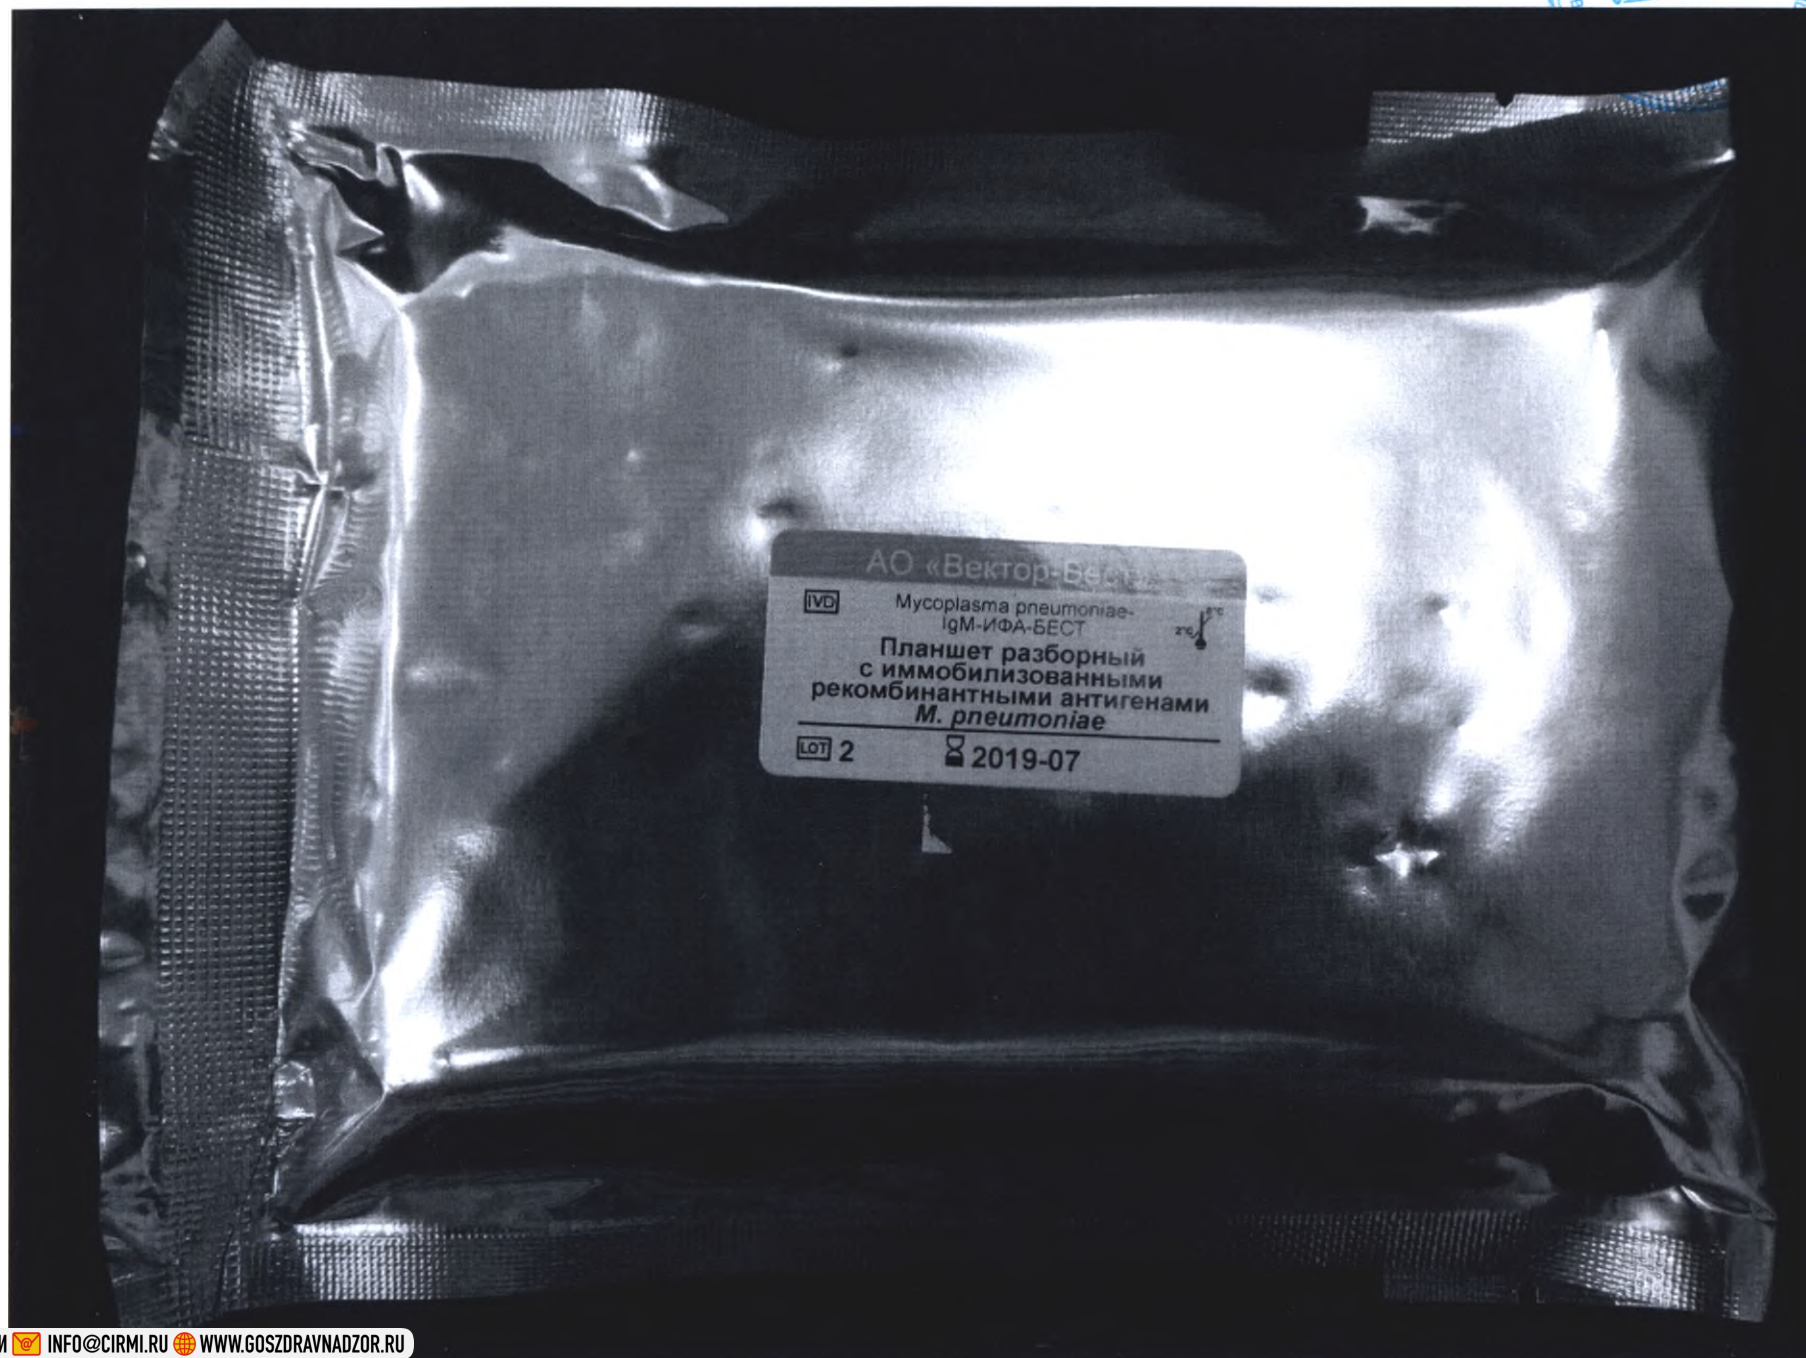


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов

2019 г.

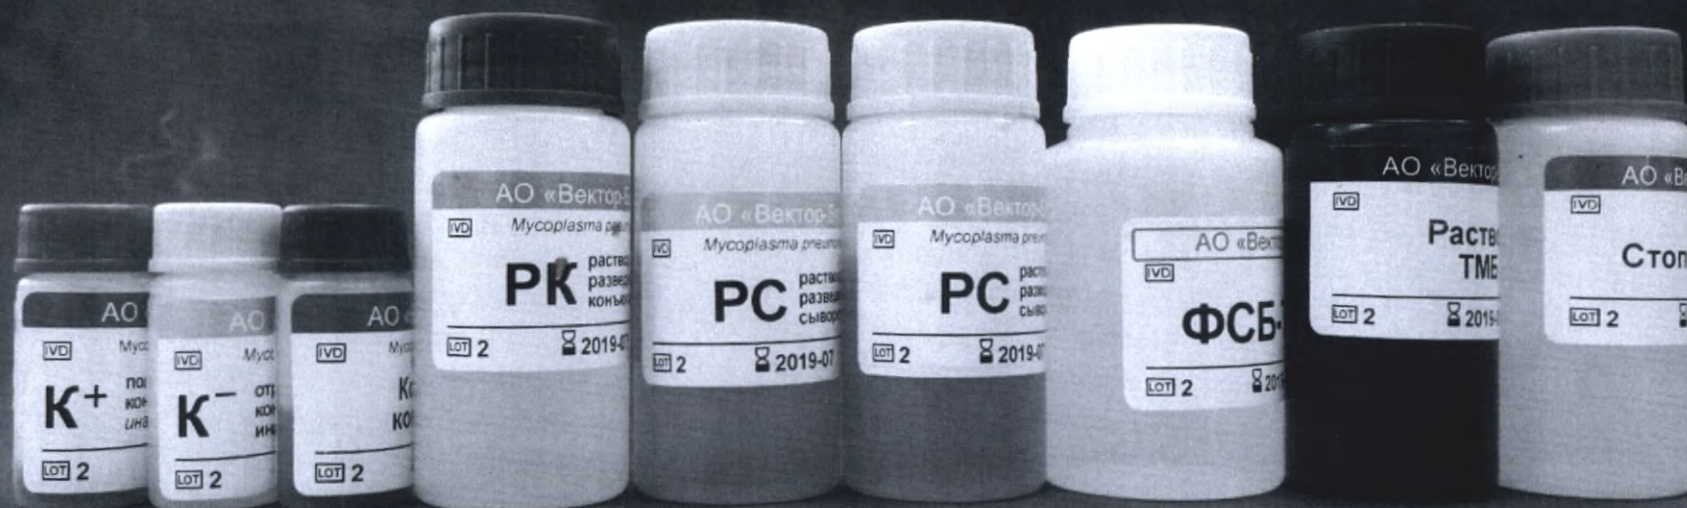

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №3
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.

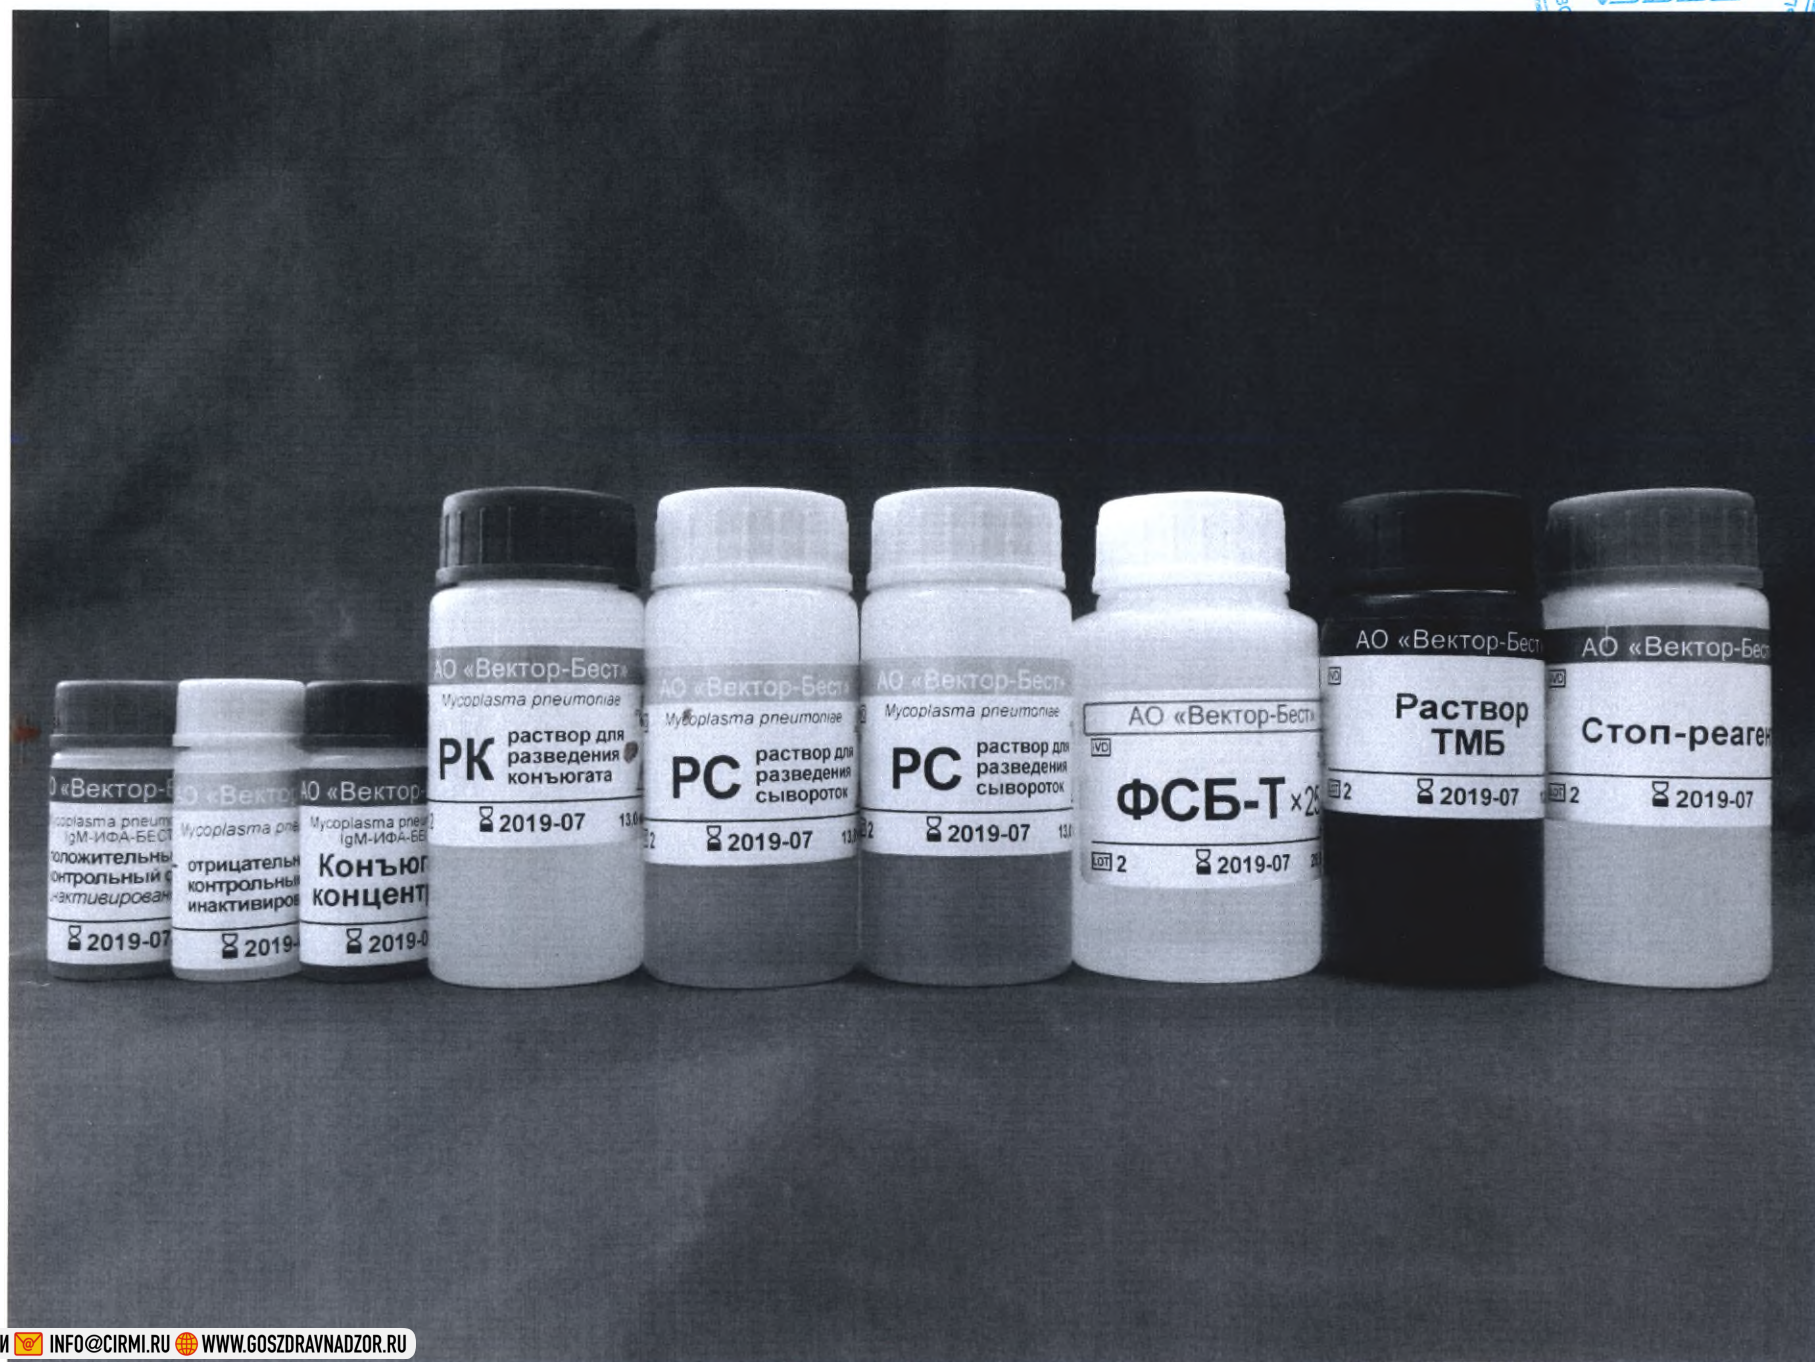

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №4
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

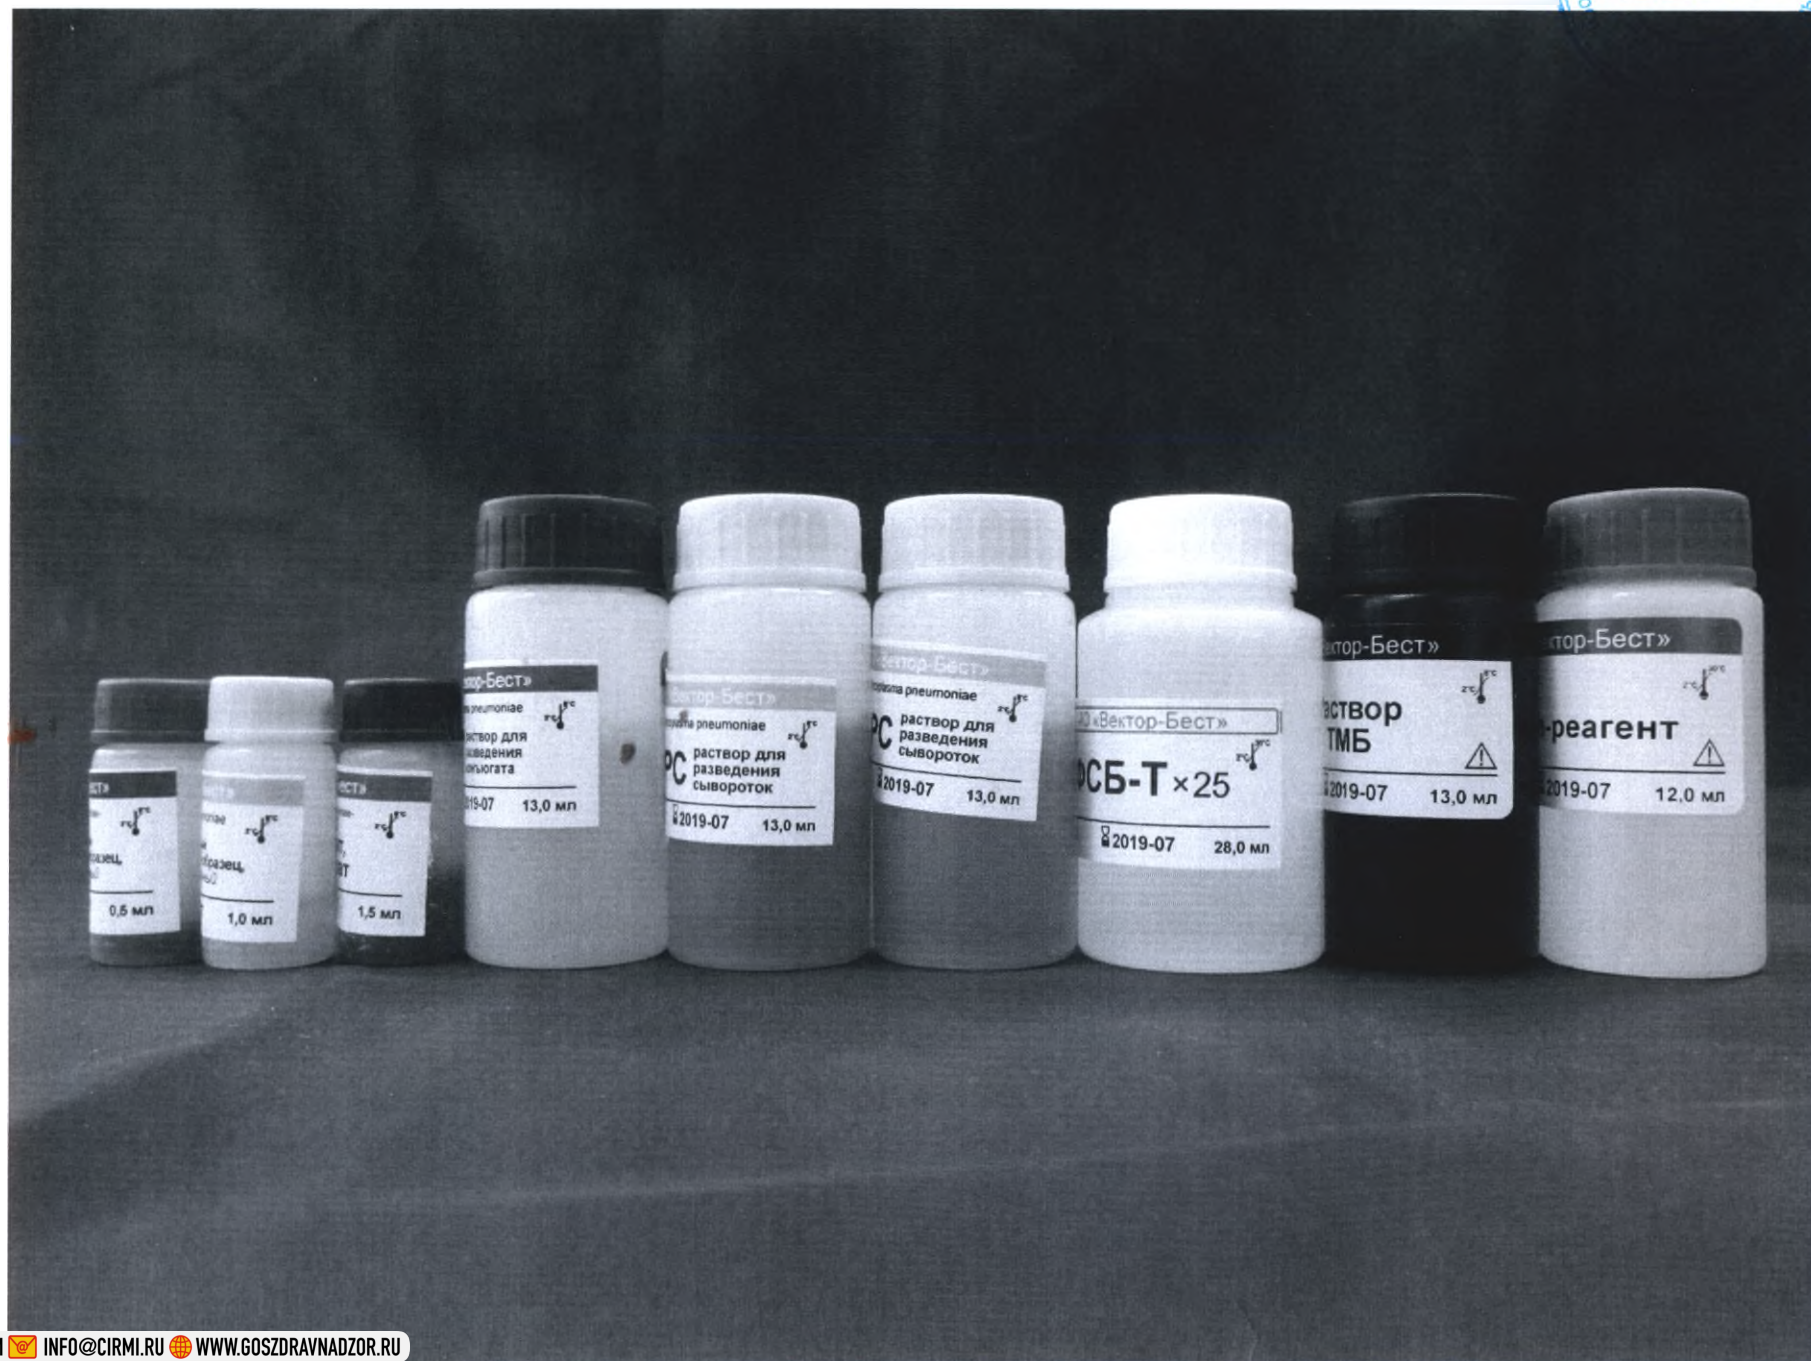


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусайнов
“01” _____ 2019 г.

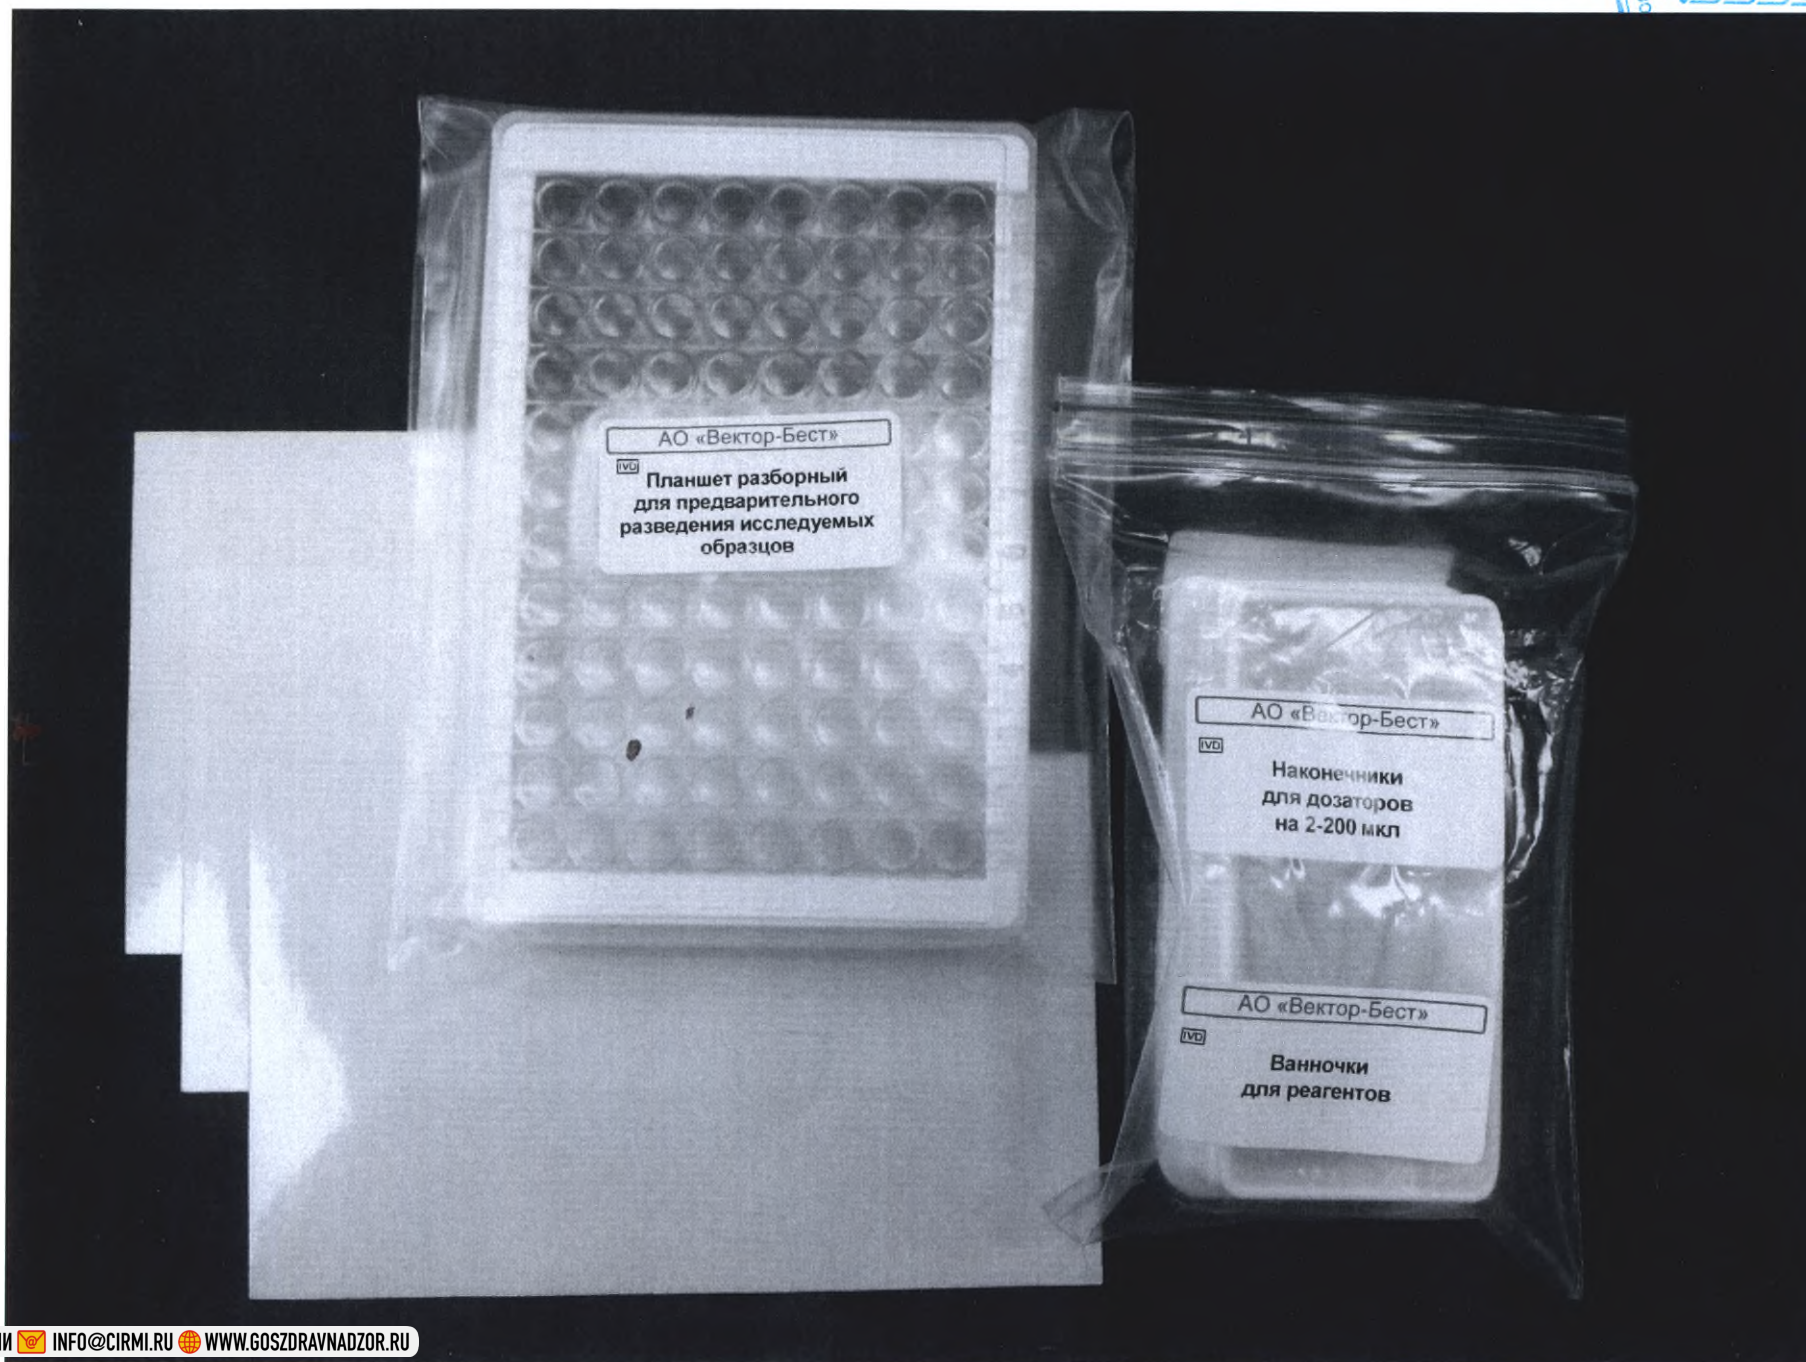



ВЕКТОР
БЕСТ

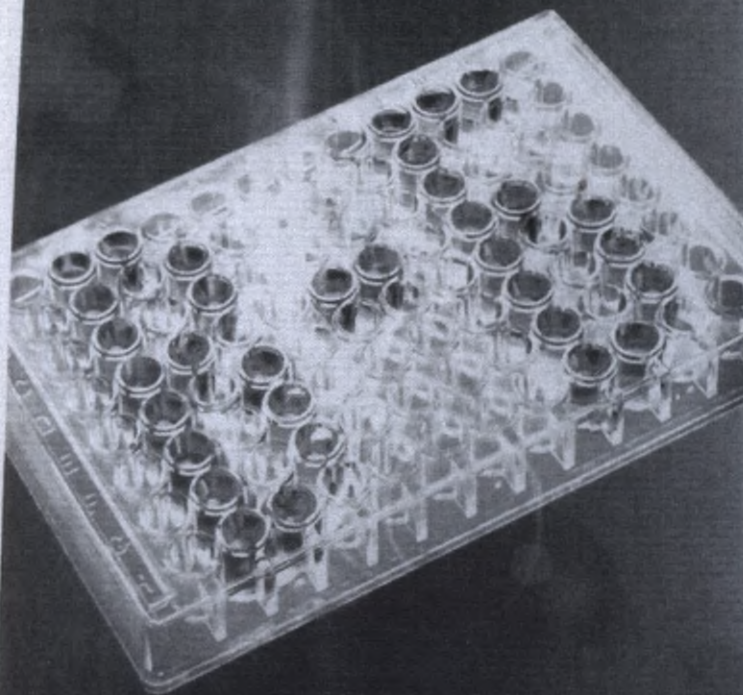

REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к *Mycoplasma pneumoniae*

***Mycoplasma pneumoniae* – IgM –
ИФА – БЕСТ**


СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
13. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №2
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

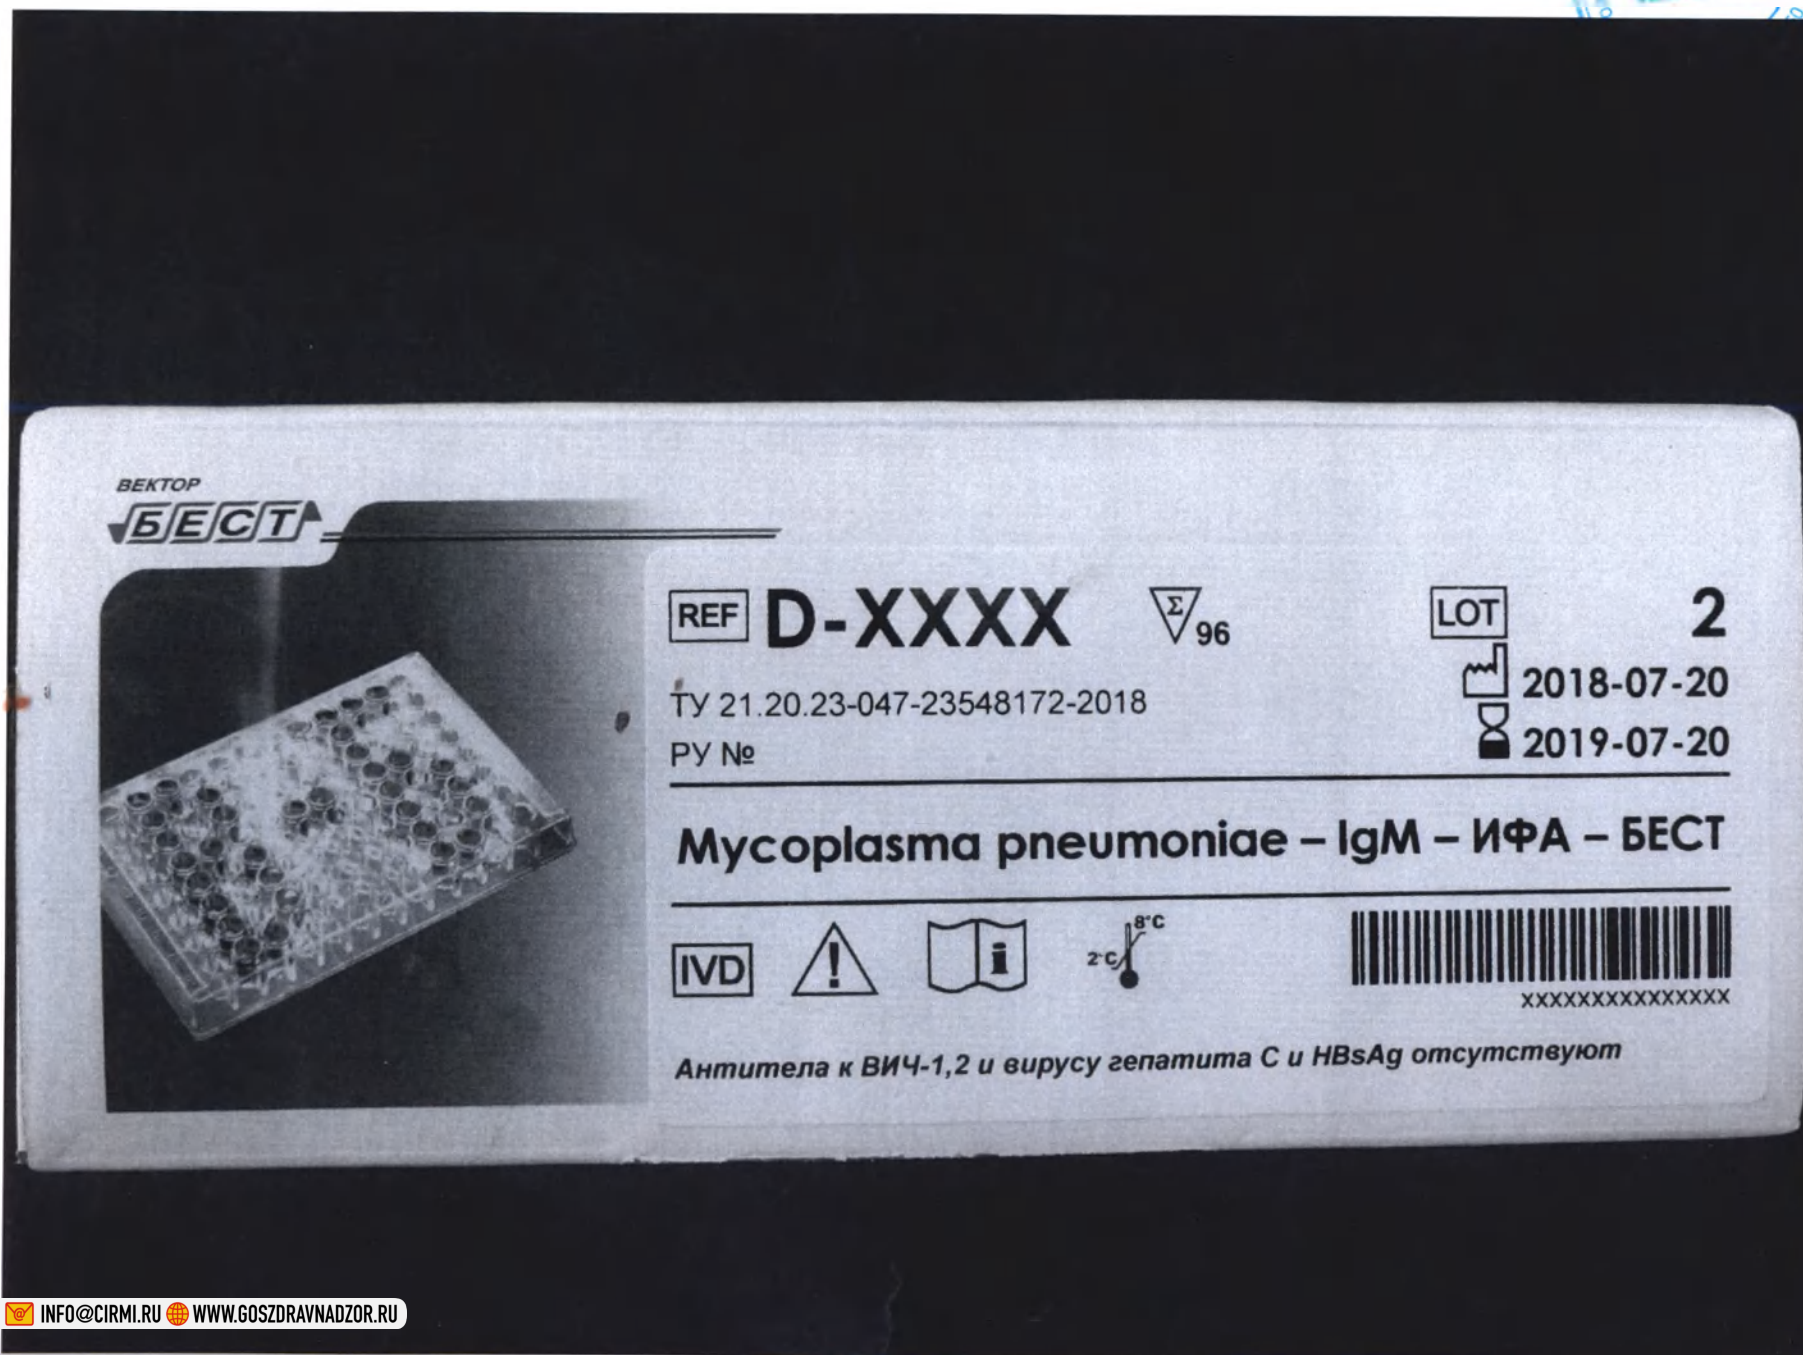


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “01” 2019 г.

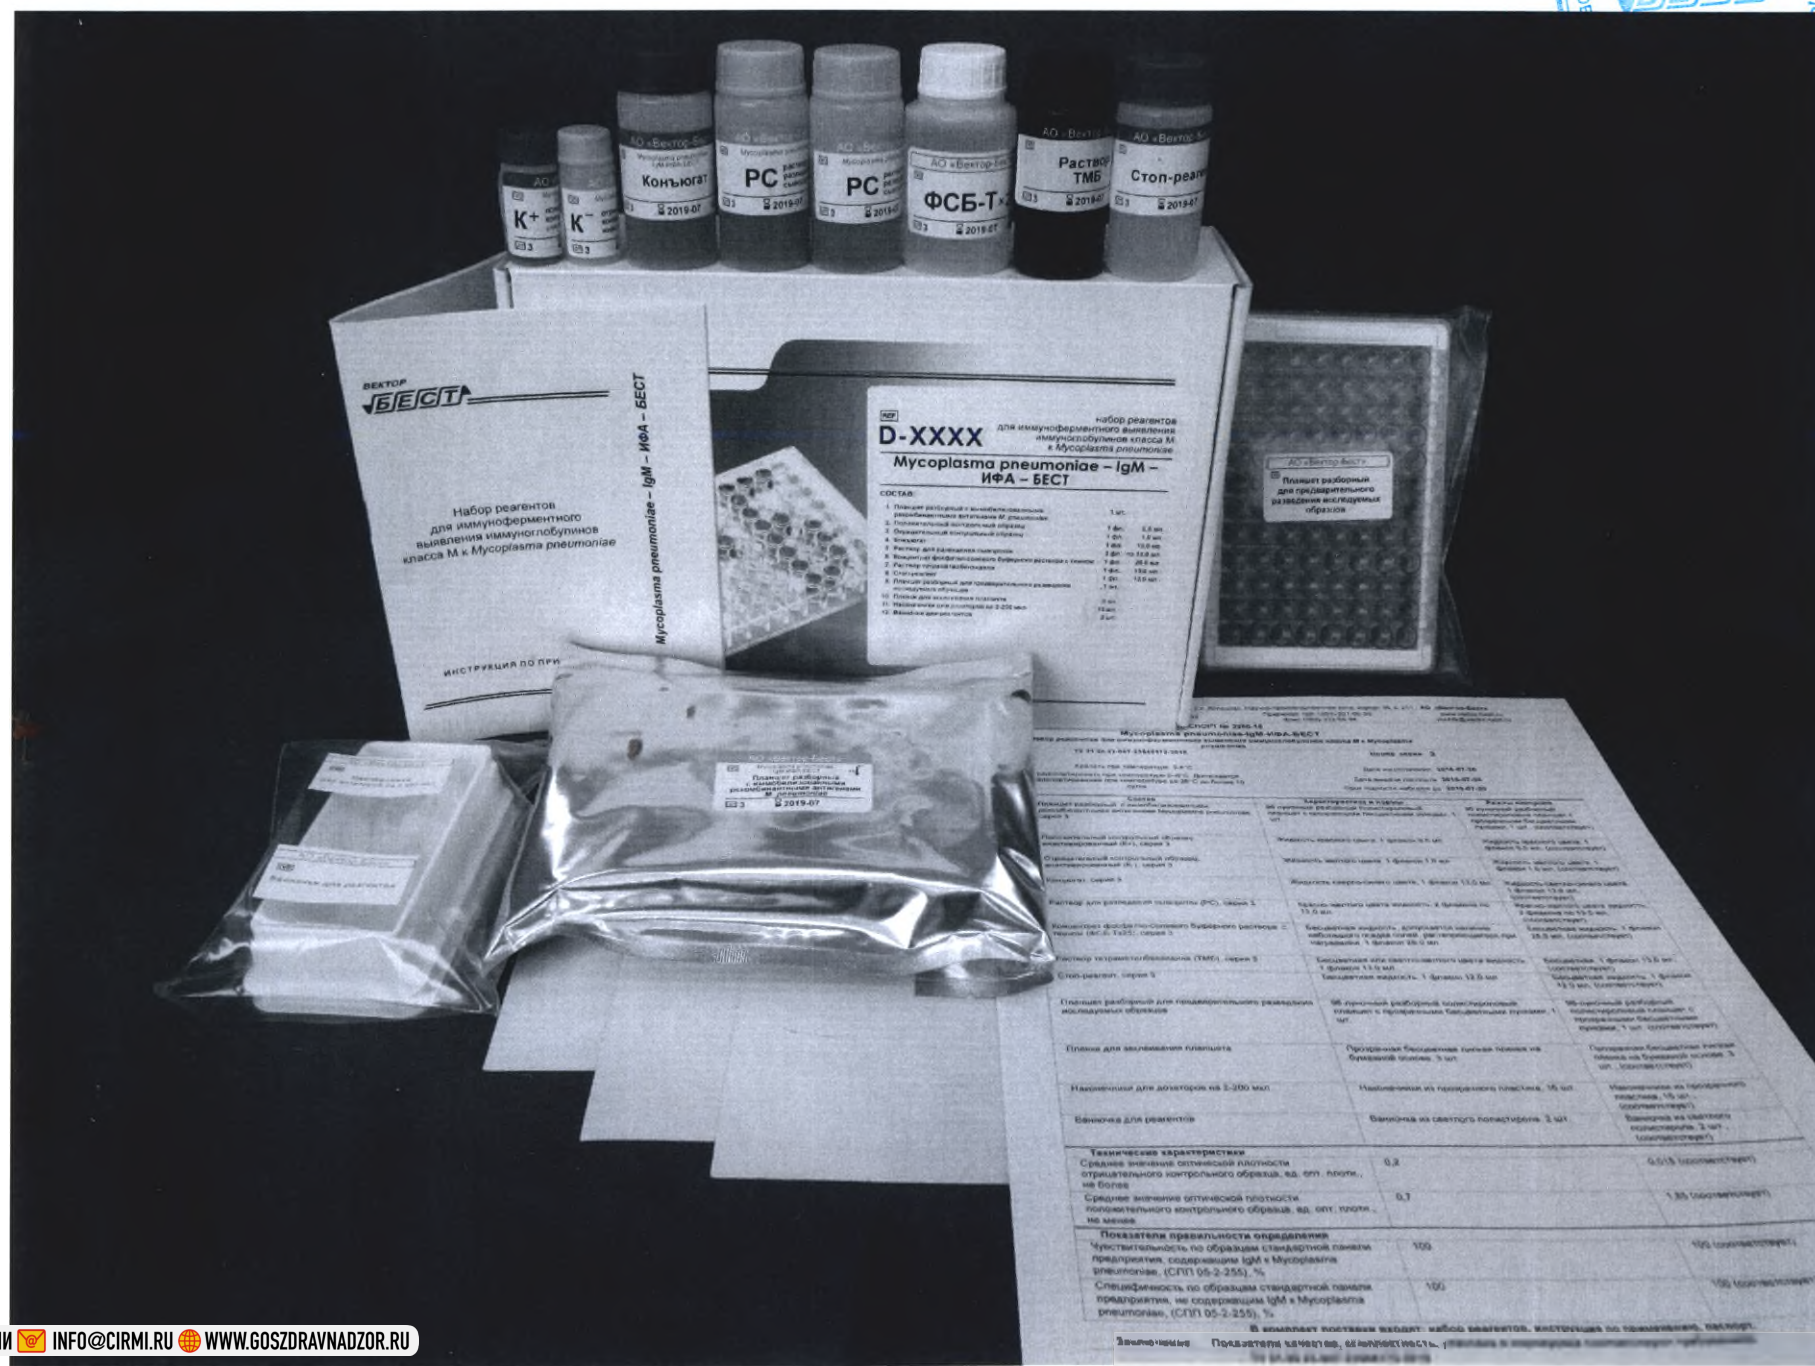


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов

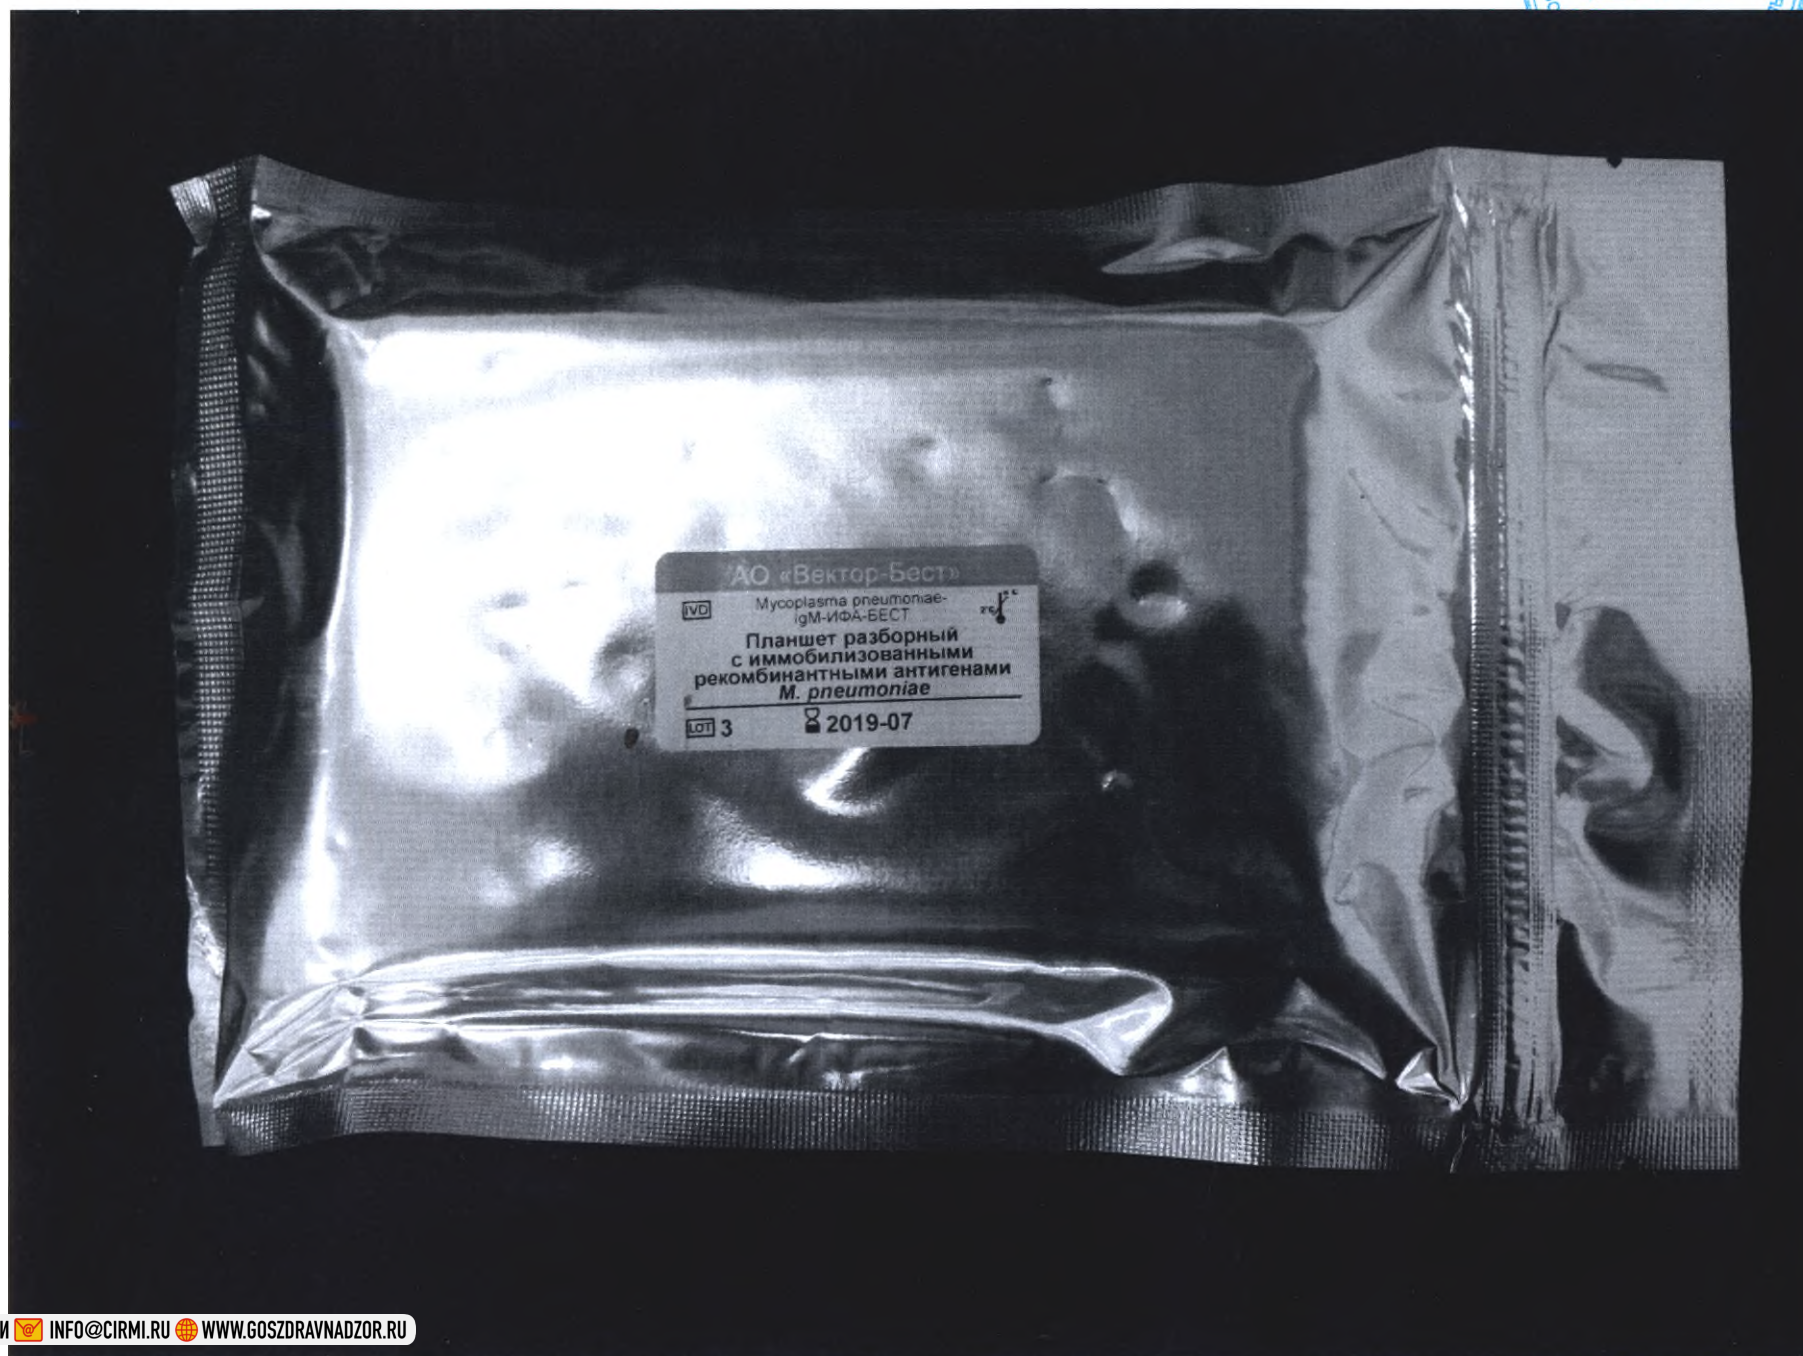


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.

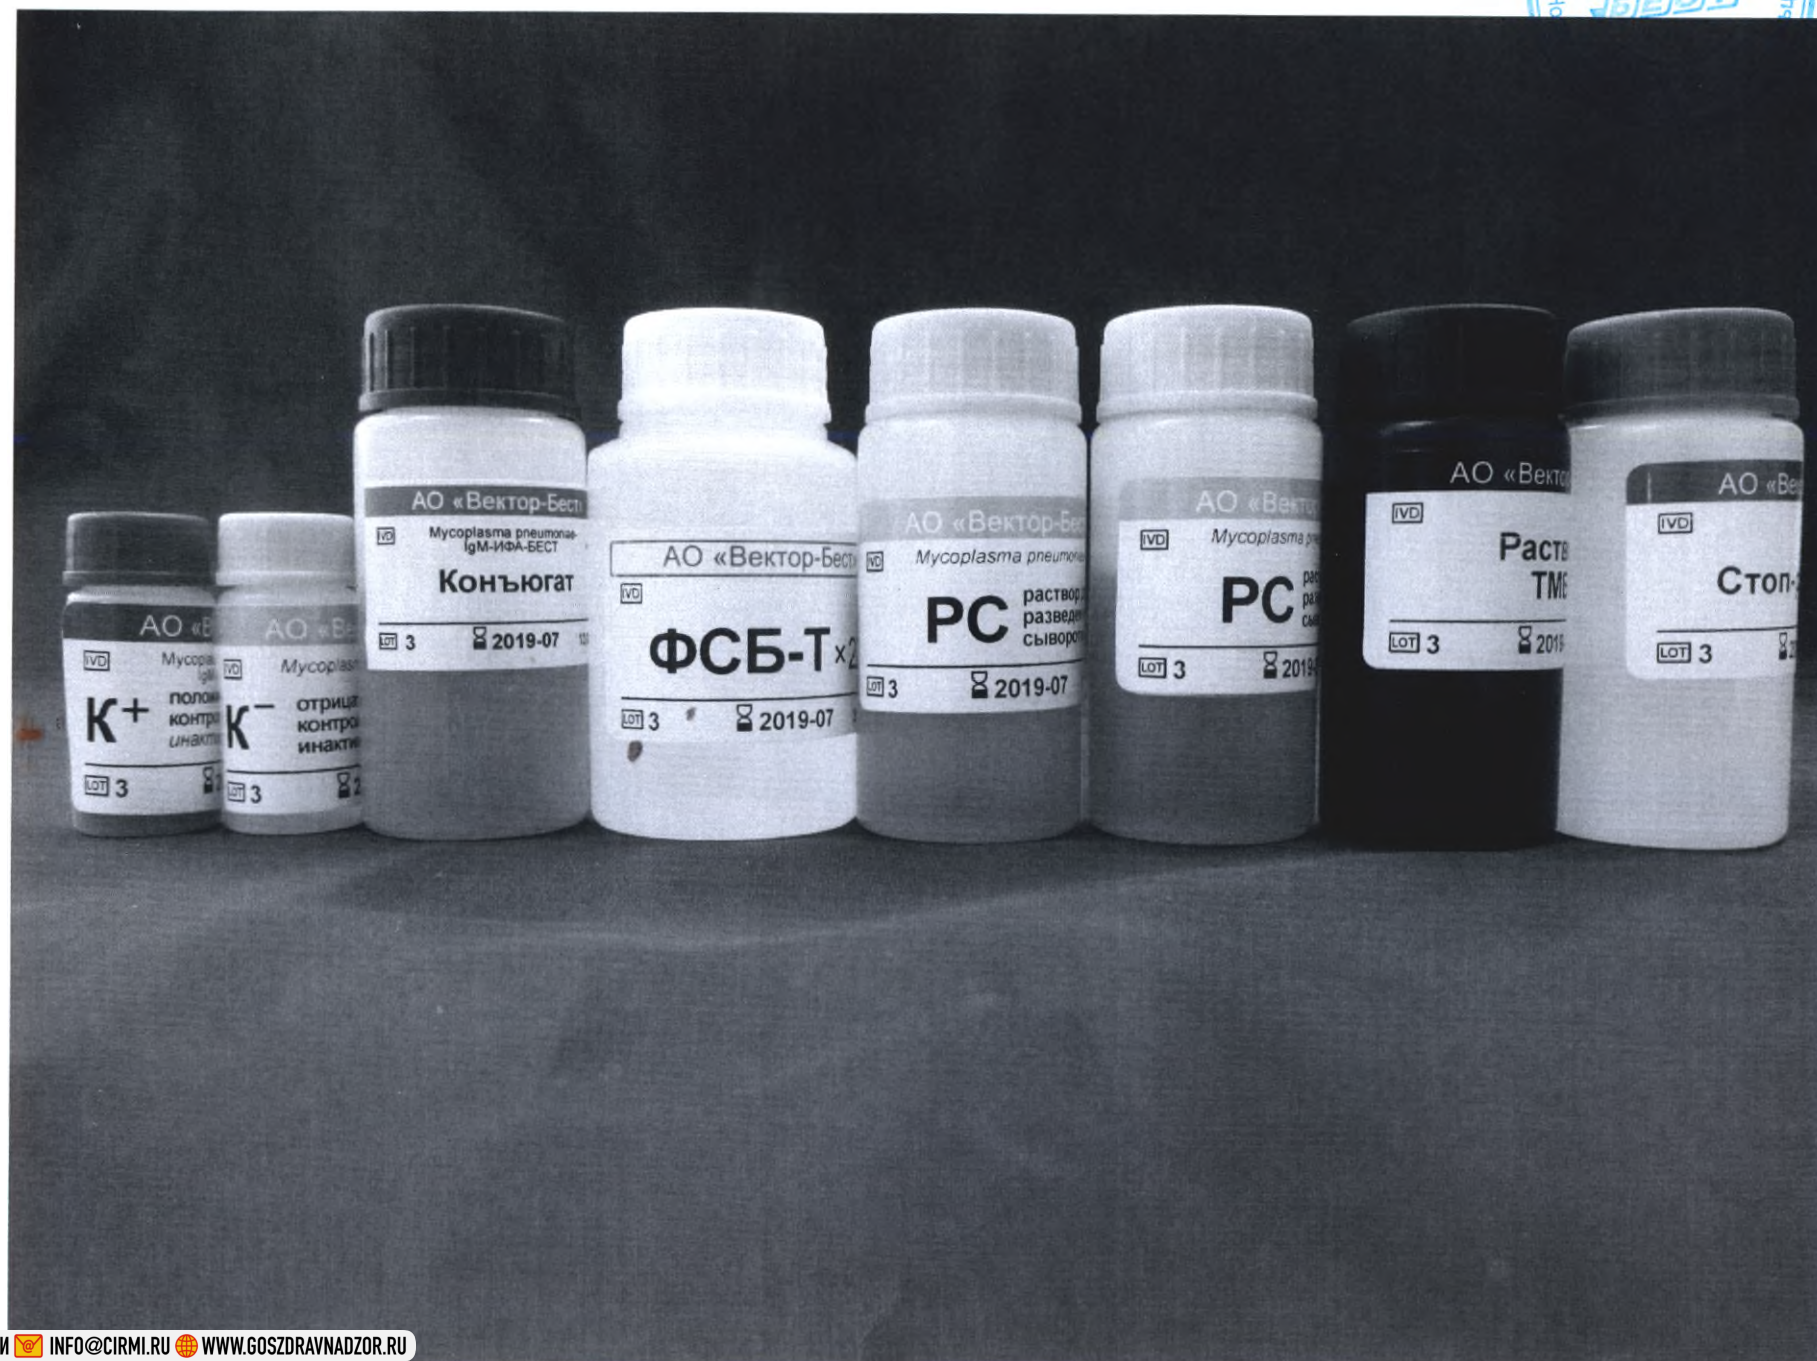


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“07” 06 2019 г.

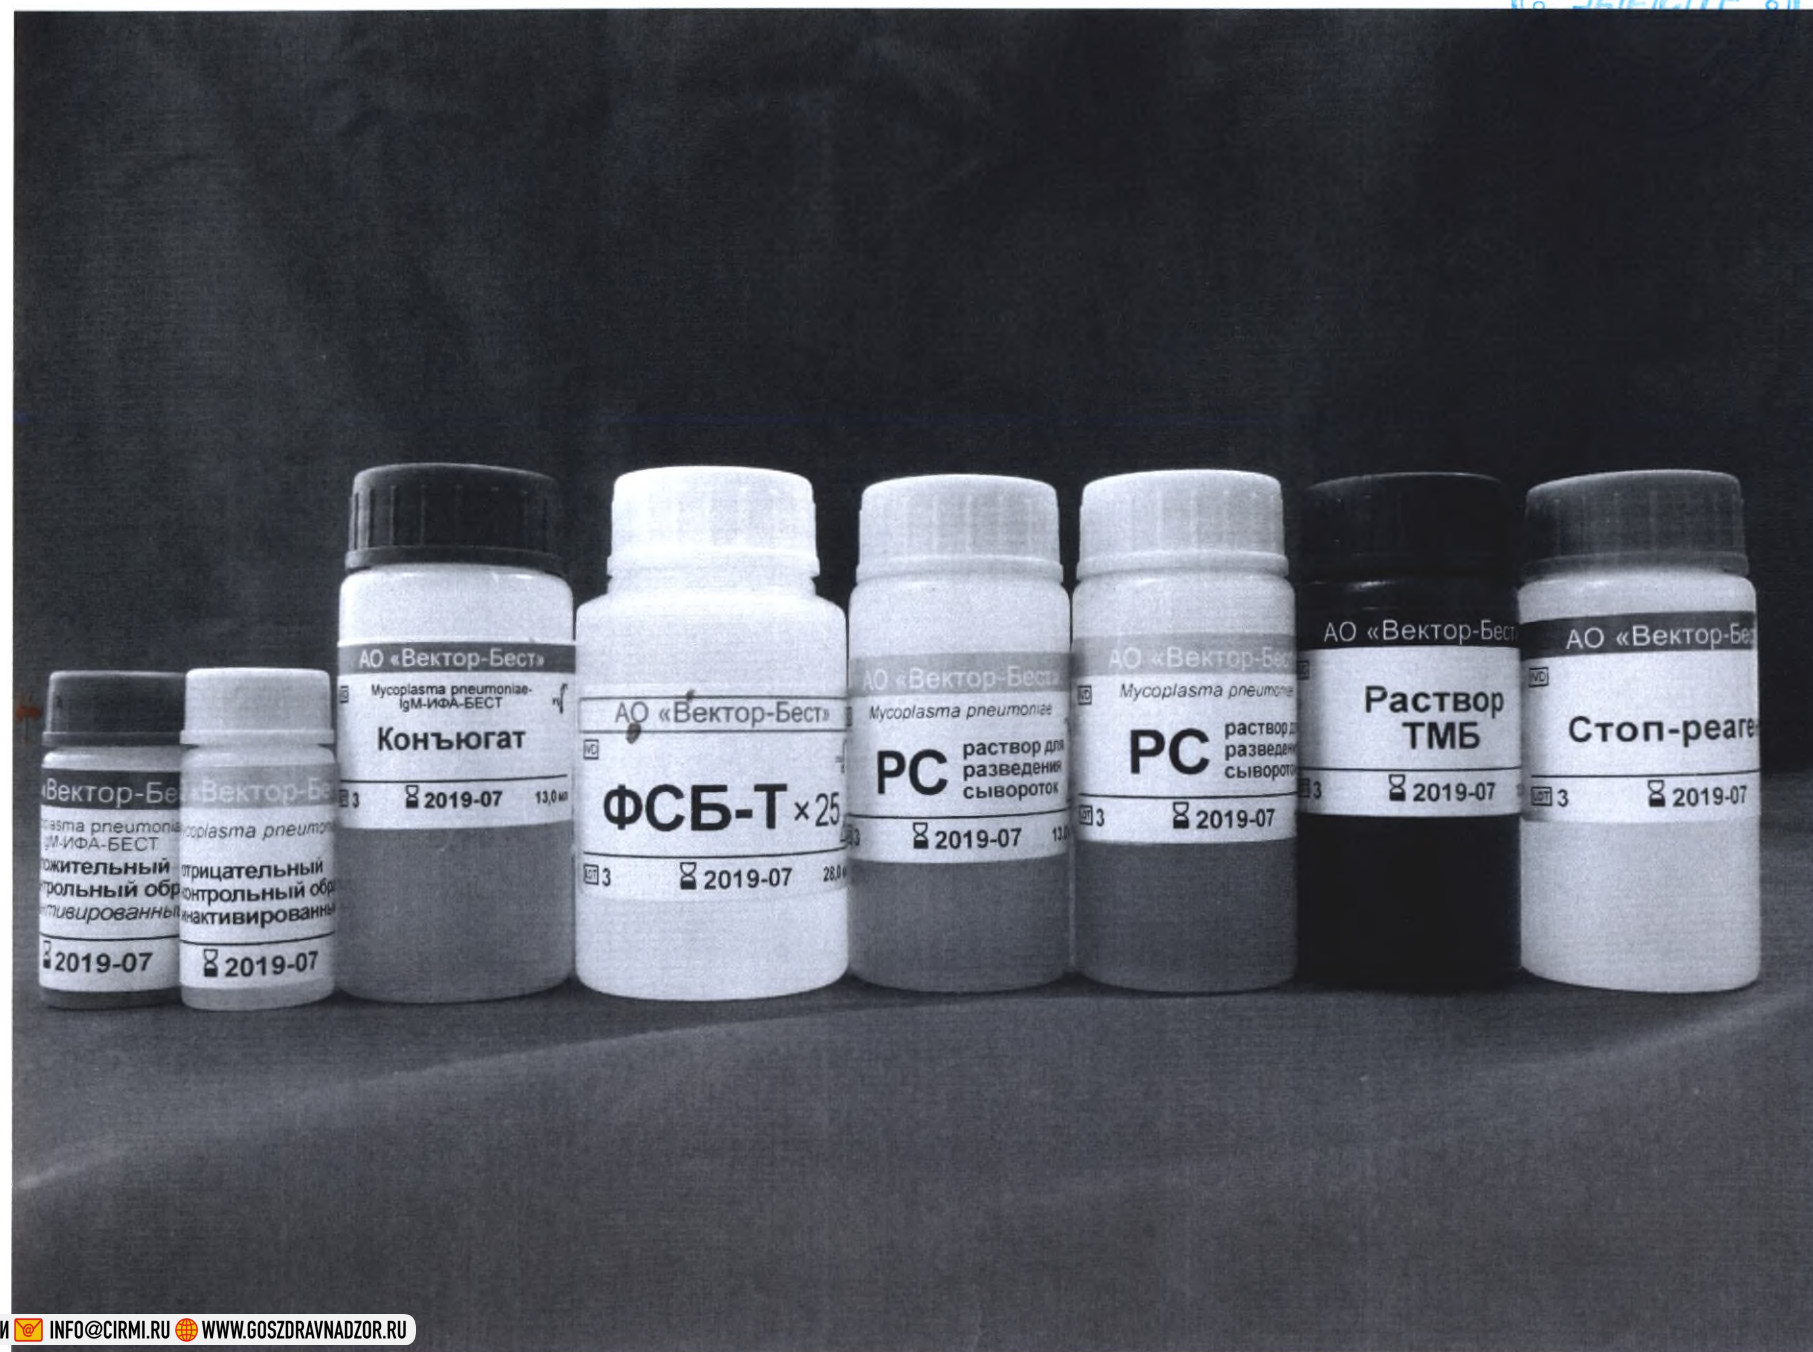



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
2019 г.

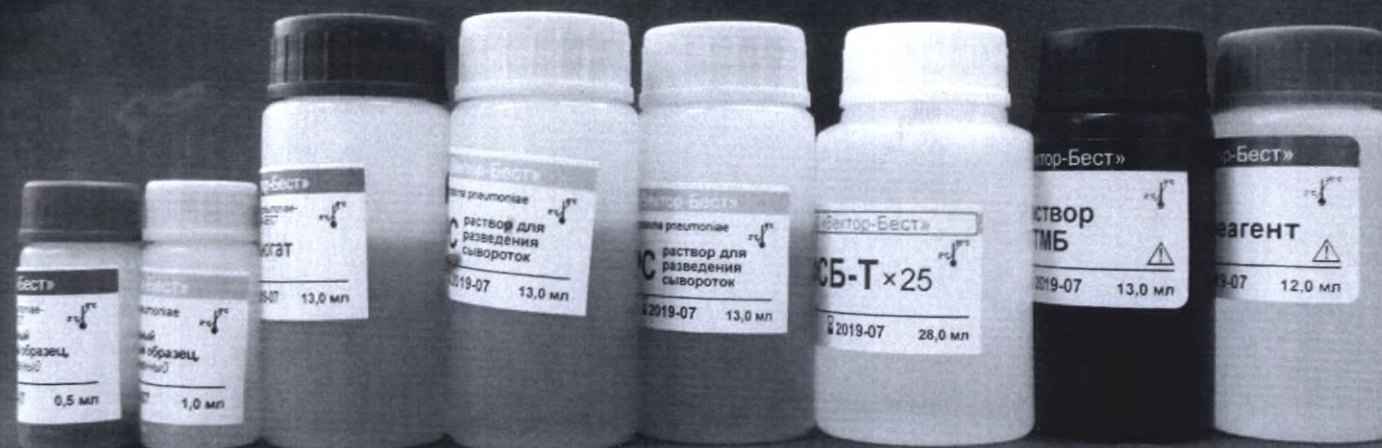


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“ ” 2019 г.

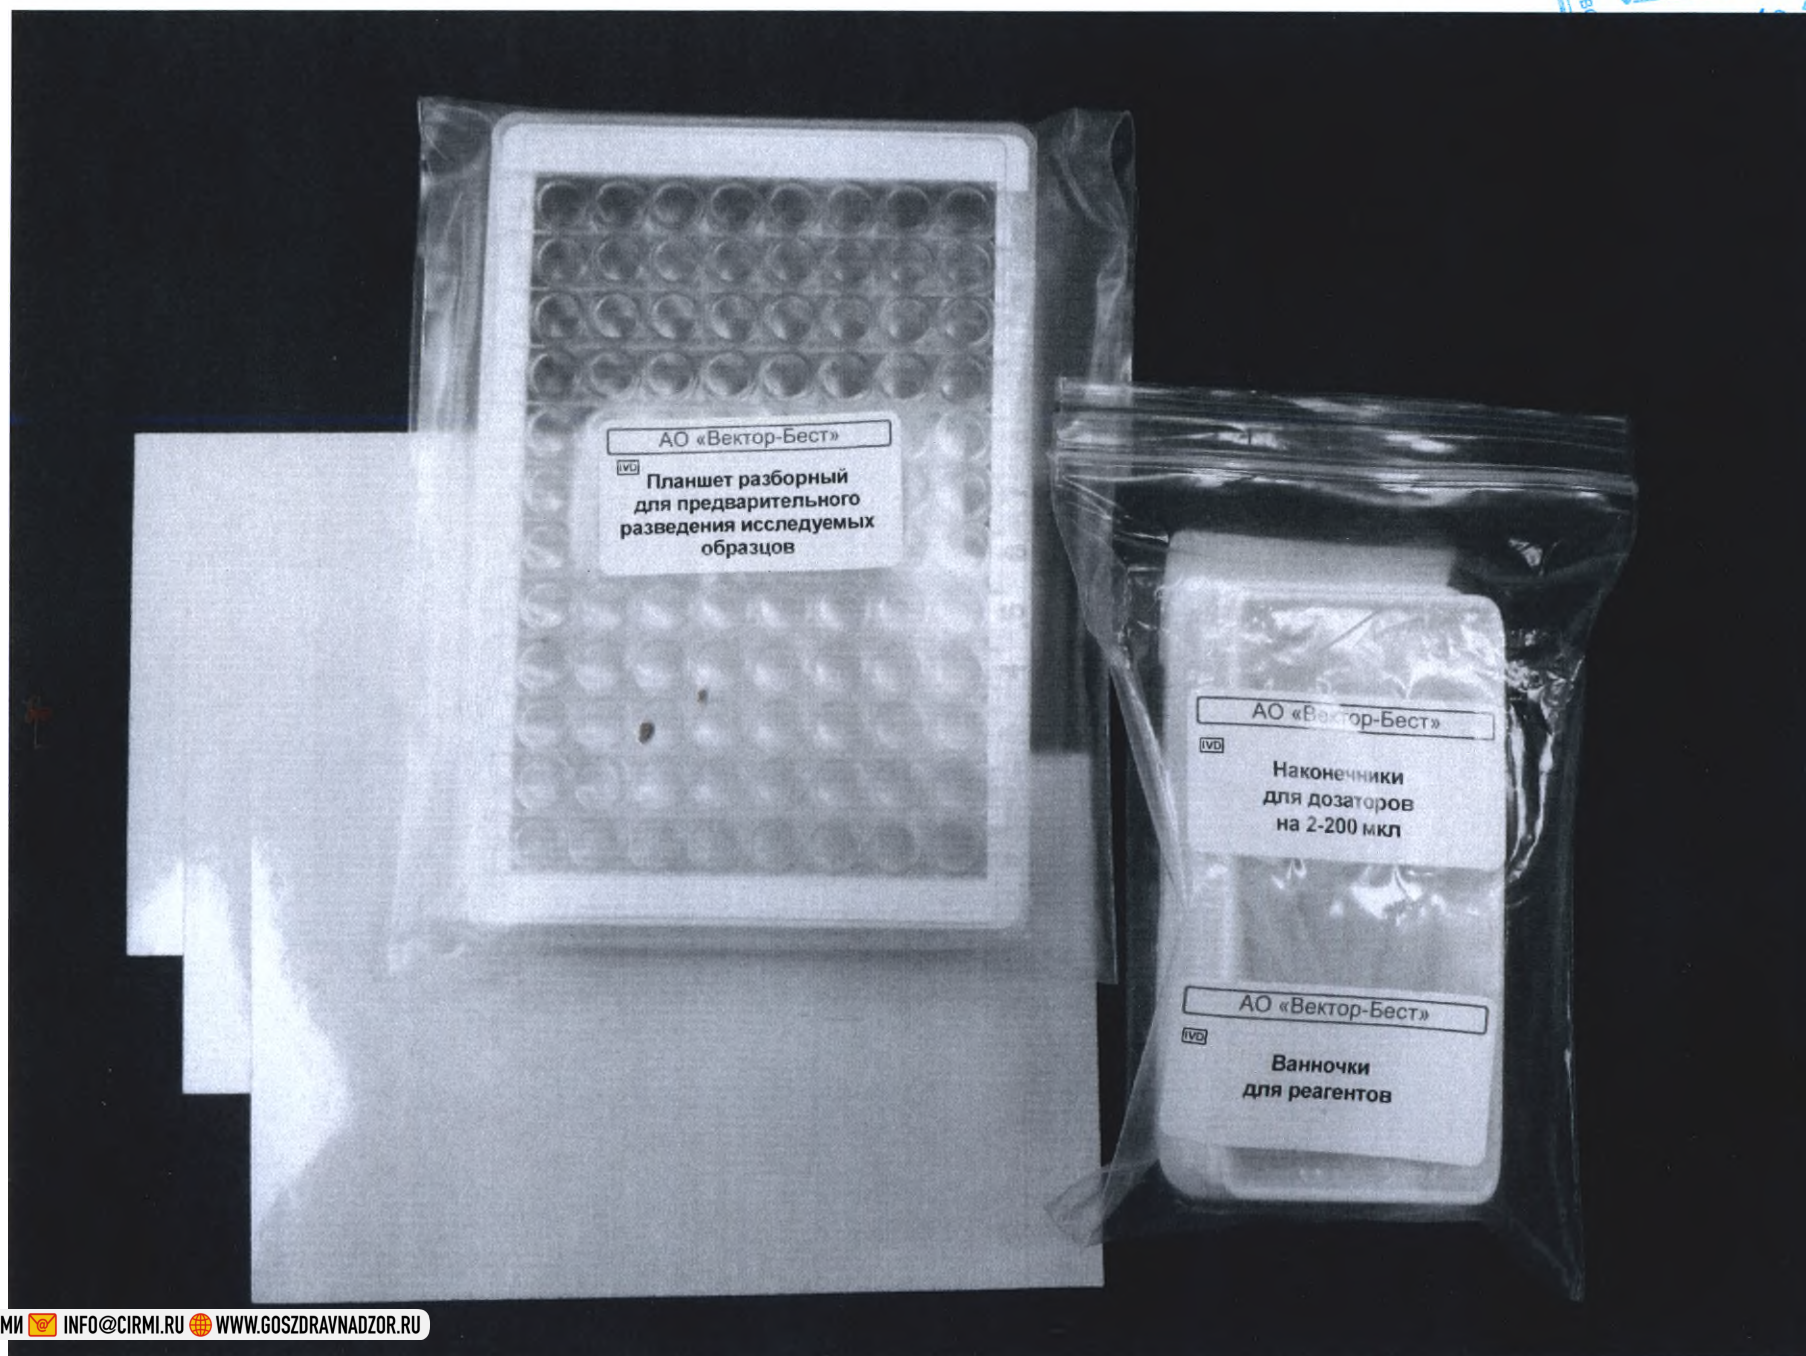

ВЕКТОР
БЕСТ

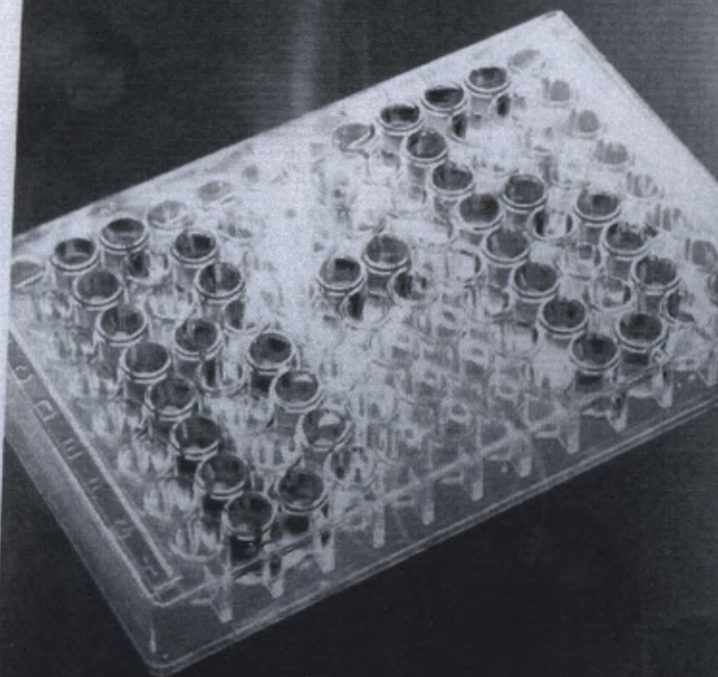

REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к *Mycoplasma pneumoniae*

**Mycoplasma pneumoniae – IgM –
ИФА – БЕСТ**



СОСТАВ:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i> | 1 шт. |
| 2. Положительный контрольный образец | 1 фл. 0,5 мл |
| 3. Отрицательный контрольный образец | 1 фл. 1,0 мл |
| 4. Конъюгат | 1 фл. 13,0 мл |
| 5. Раствор для разведения сывороток | 2 фл. по 13,0 мл |
| 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. 28,0 мл |
| 7. Раствор тетраметилбензидина | 1 фл. 13,0 мл |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. 12,0 мл |
| 9. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов | 1 шт. |
| 10. Пленки для заклеивания планшета | 3 шт. |
| 11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл | 16 шт. |
| 12. Ванночки для реагентов | 2 шт. |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ" №2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2019 г.

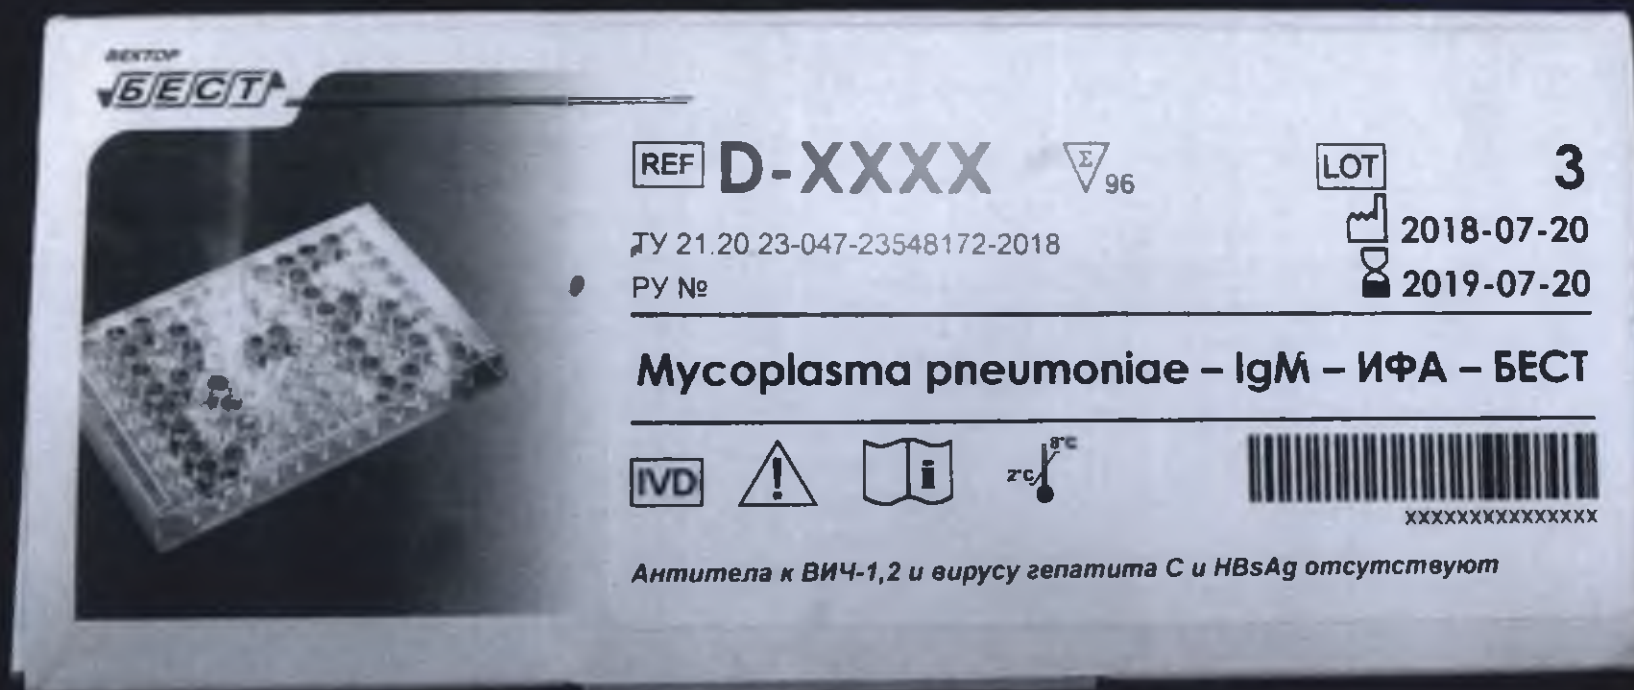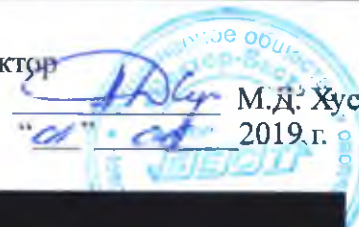


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хуҗаинов

2019 г.

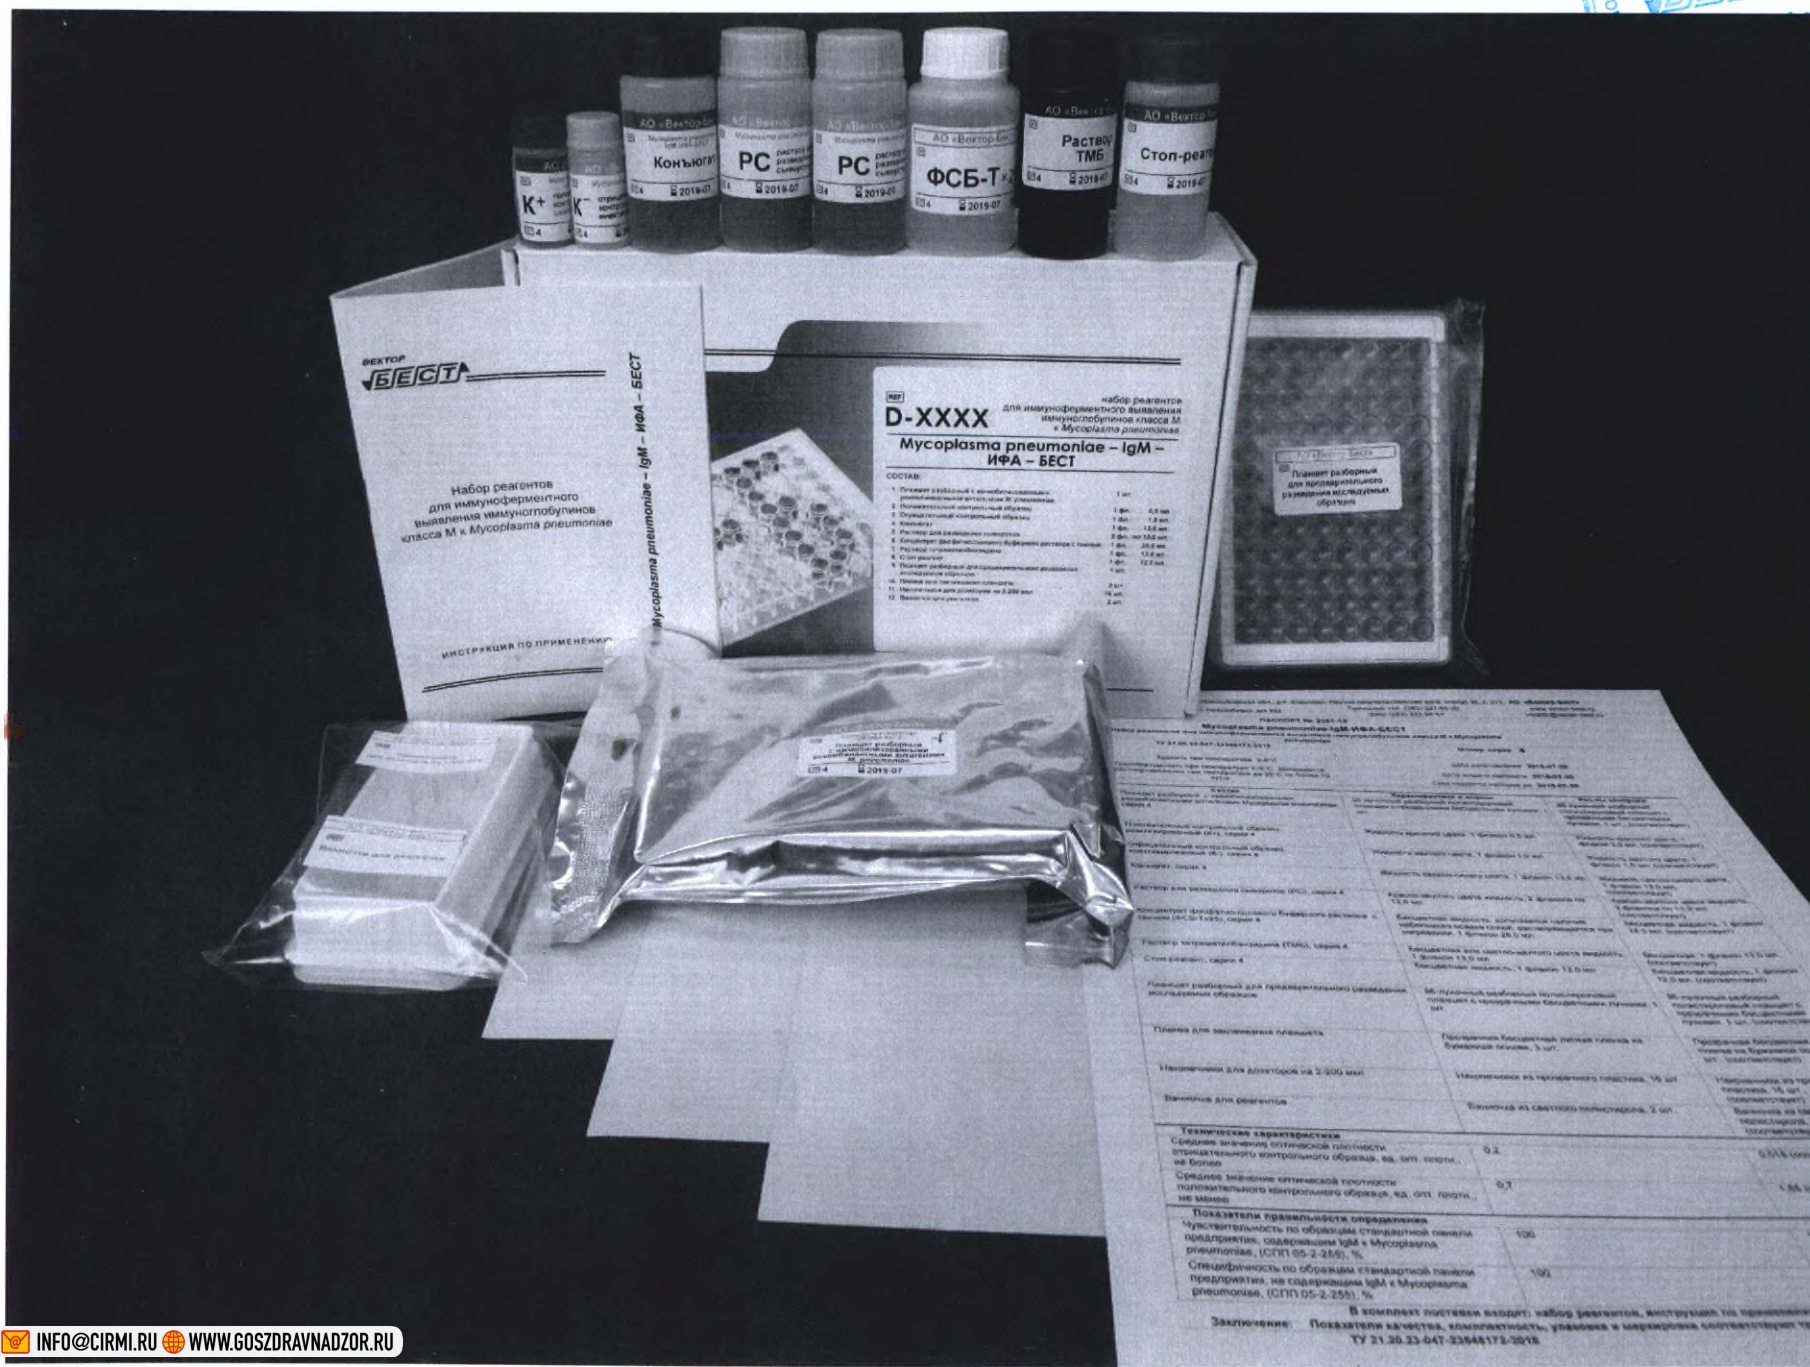

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
“04” 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №2
серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“*off*”  2019 г.

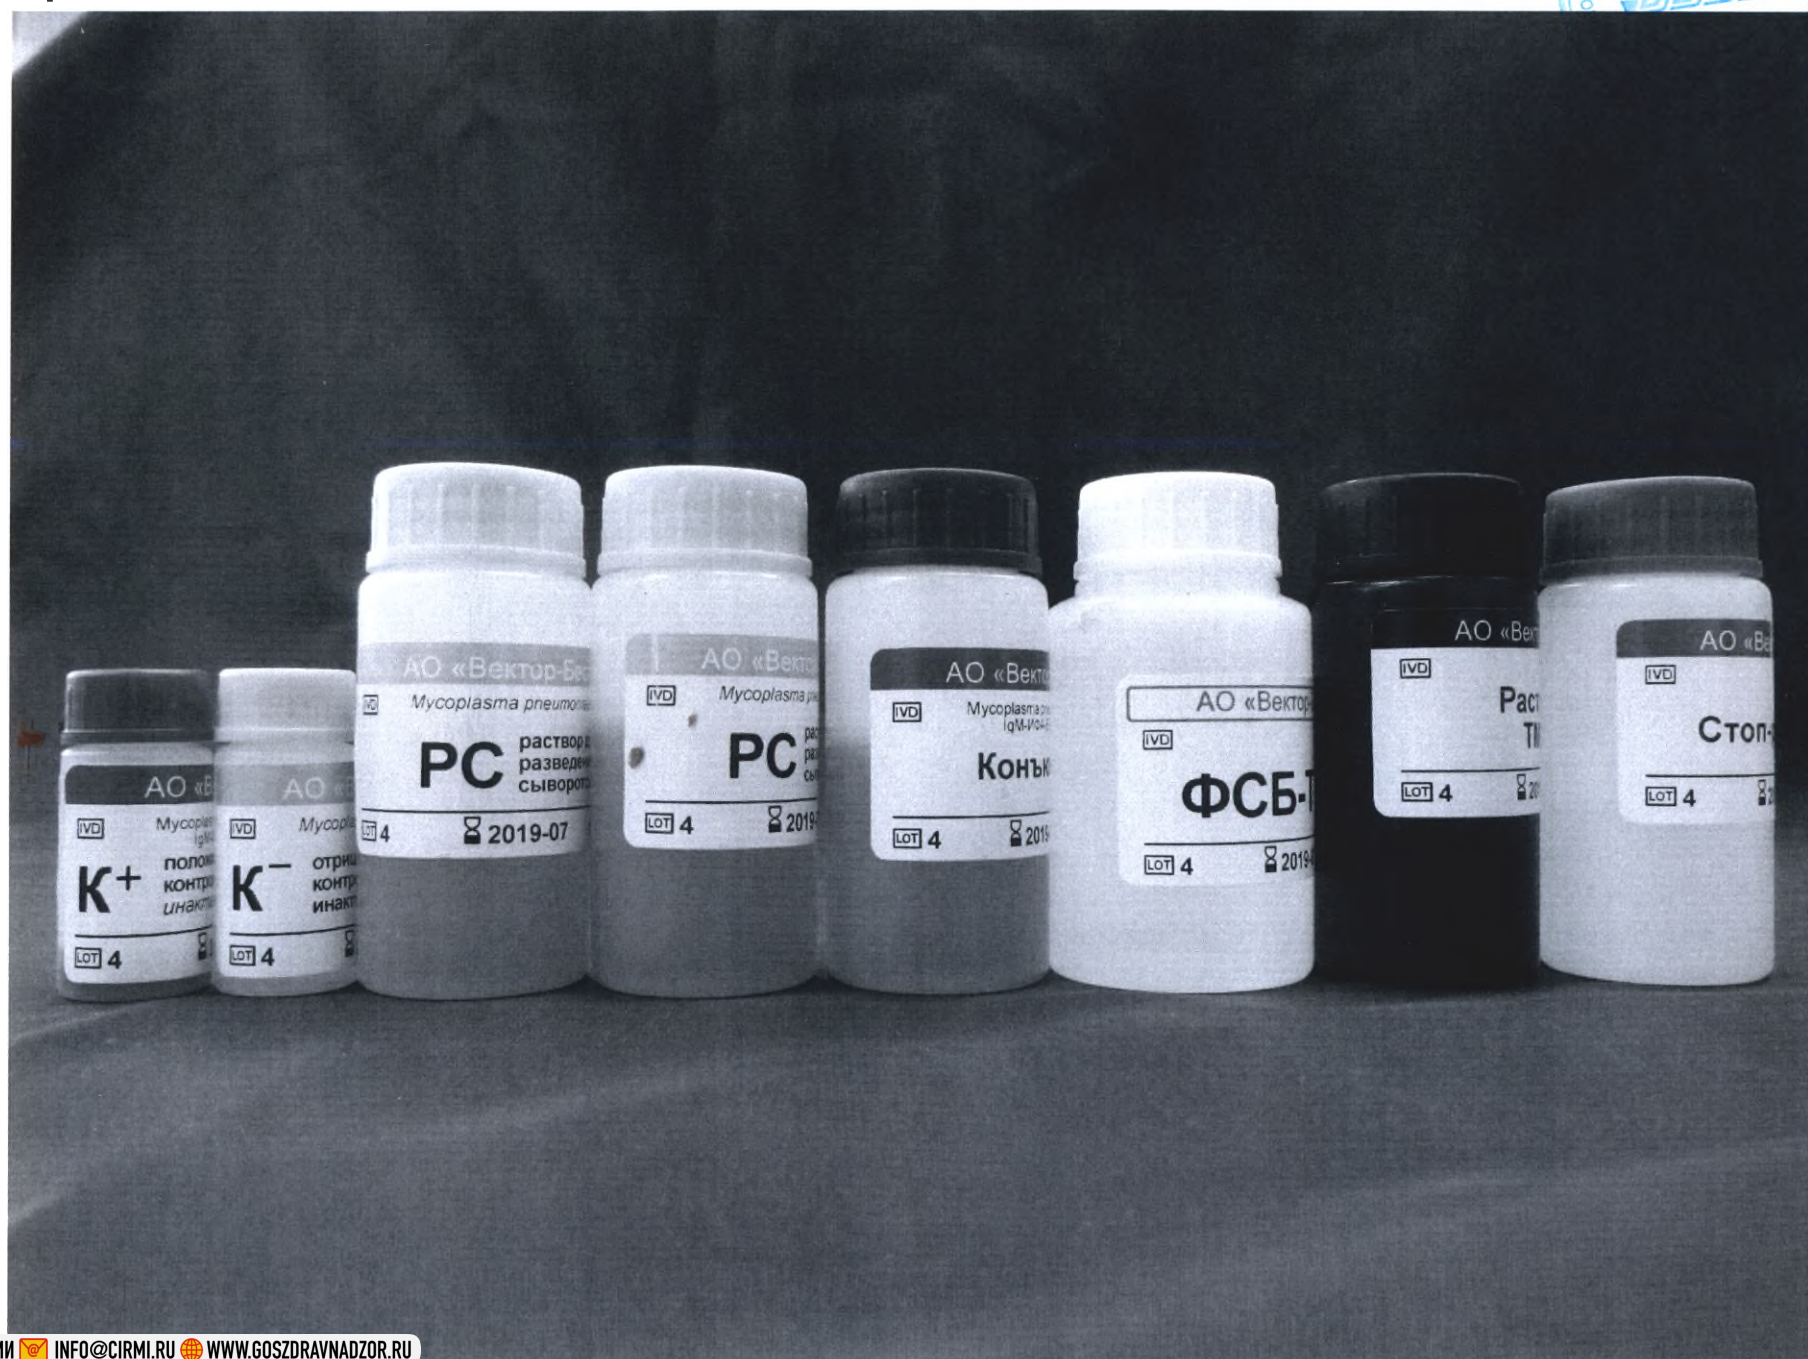

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №3
серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

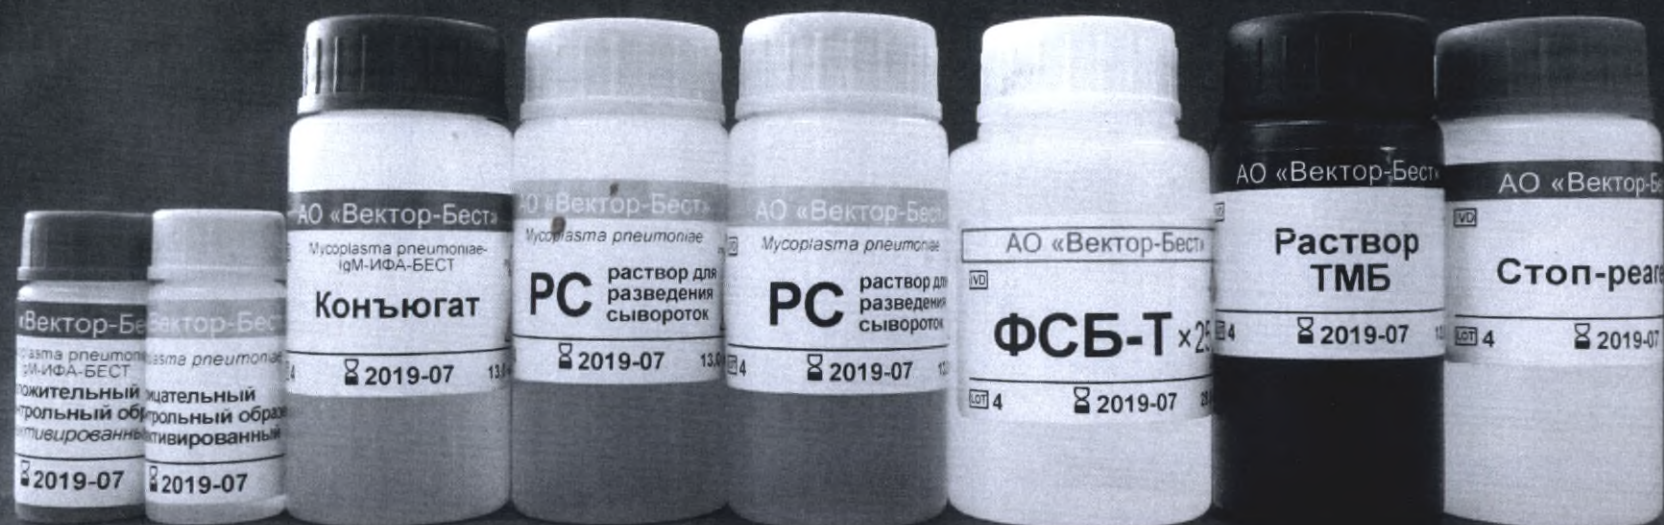


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №4
серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“___” _____ 2019 г.

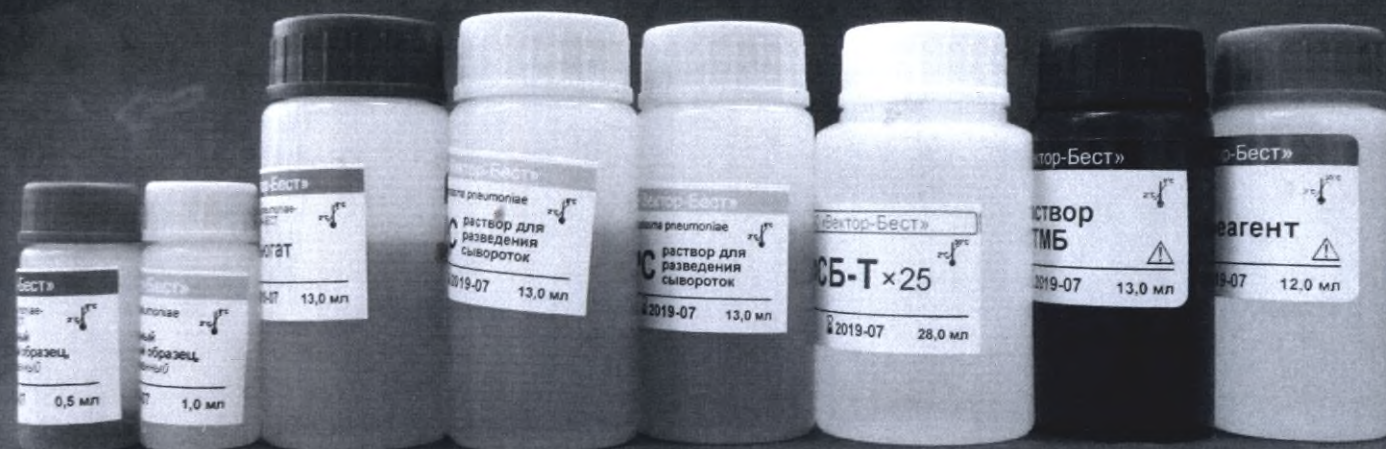


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgM-ИФА-БЕСТ” №5
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“04” 06 2019 г.

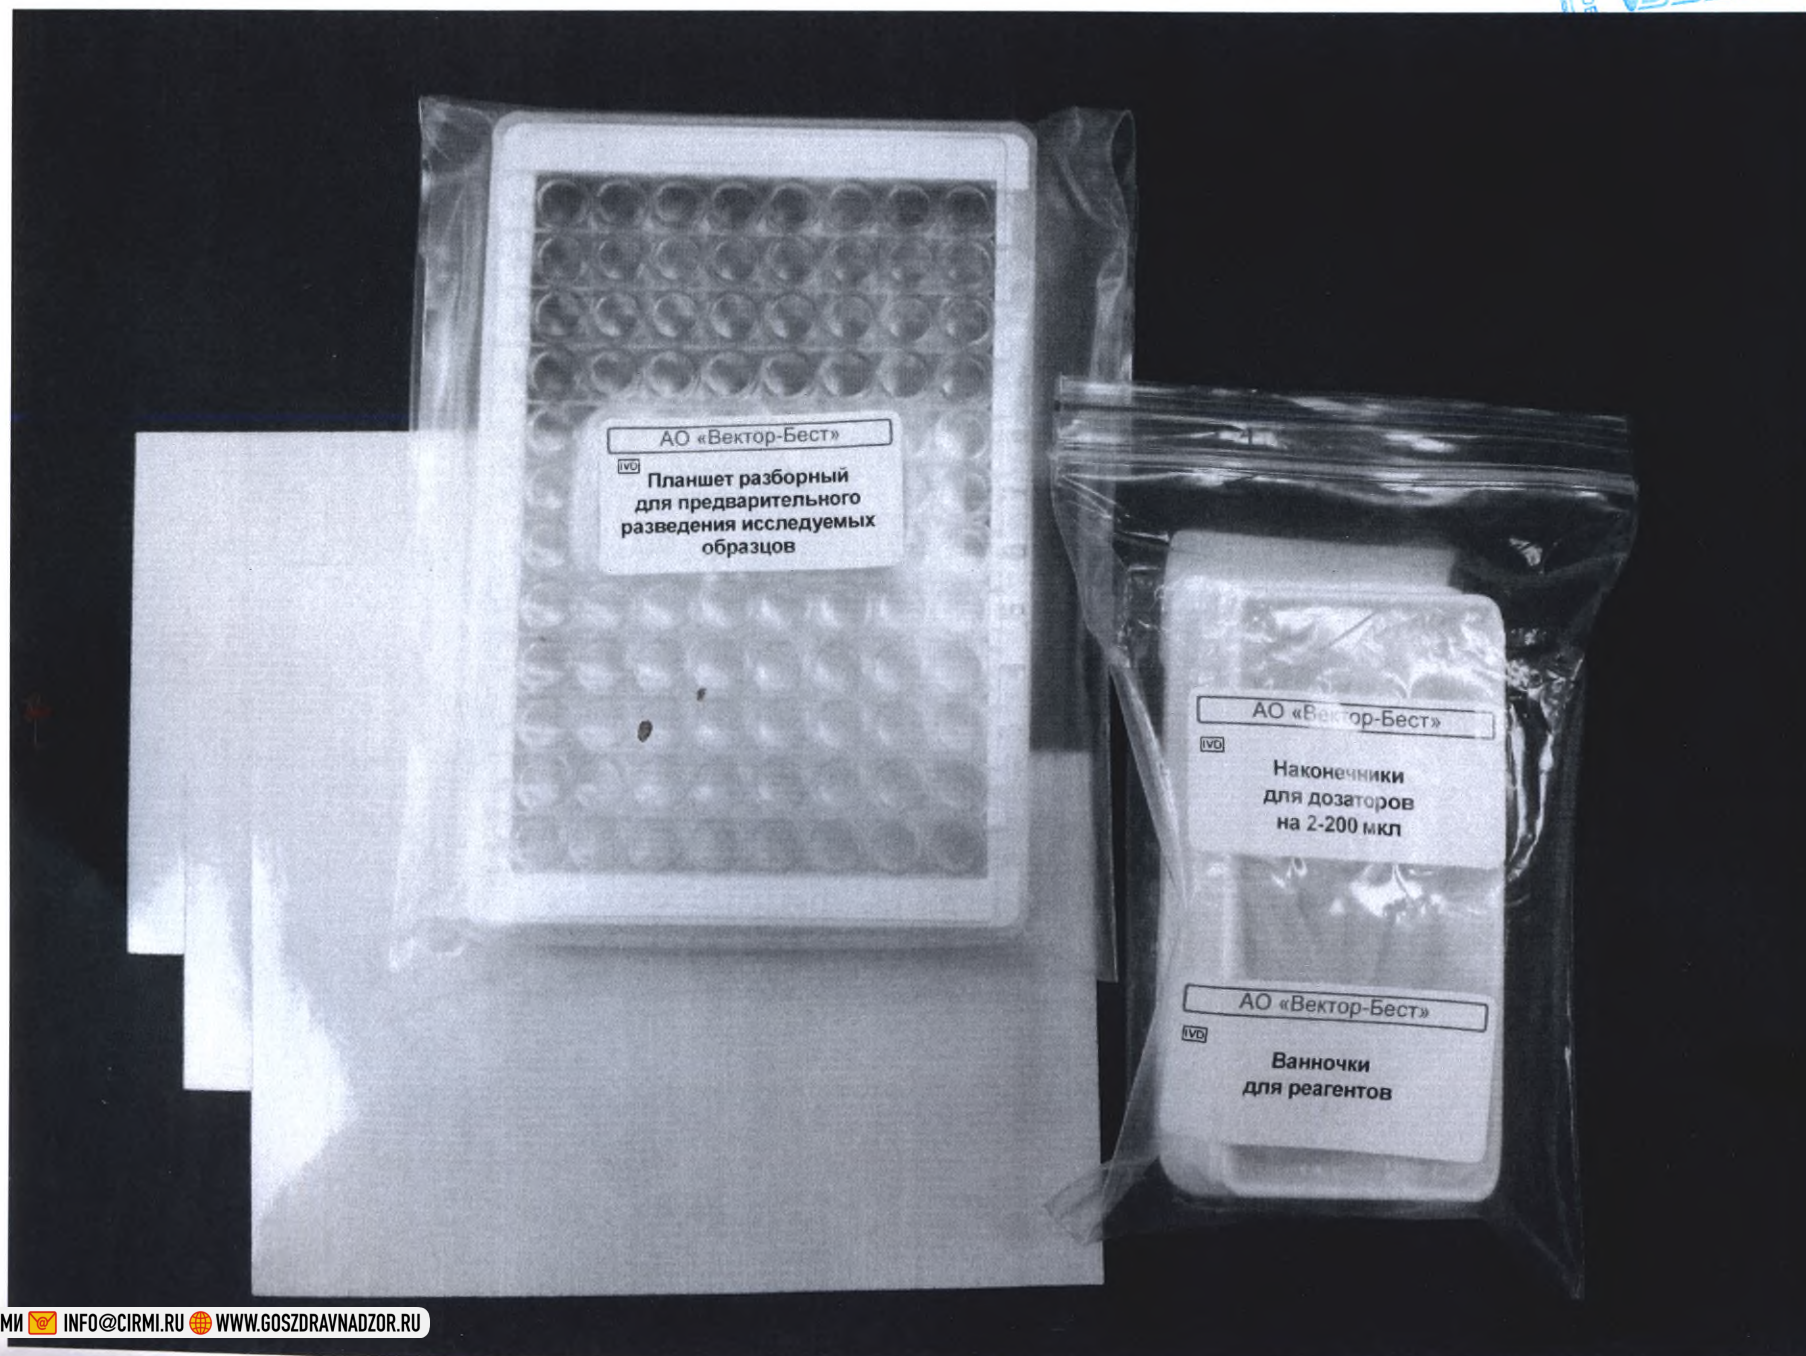

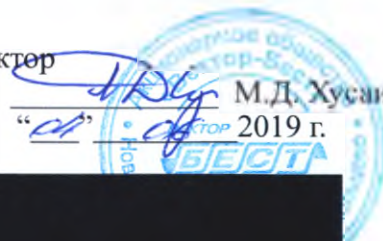

ВЕКТОР
БЕСТ

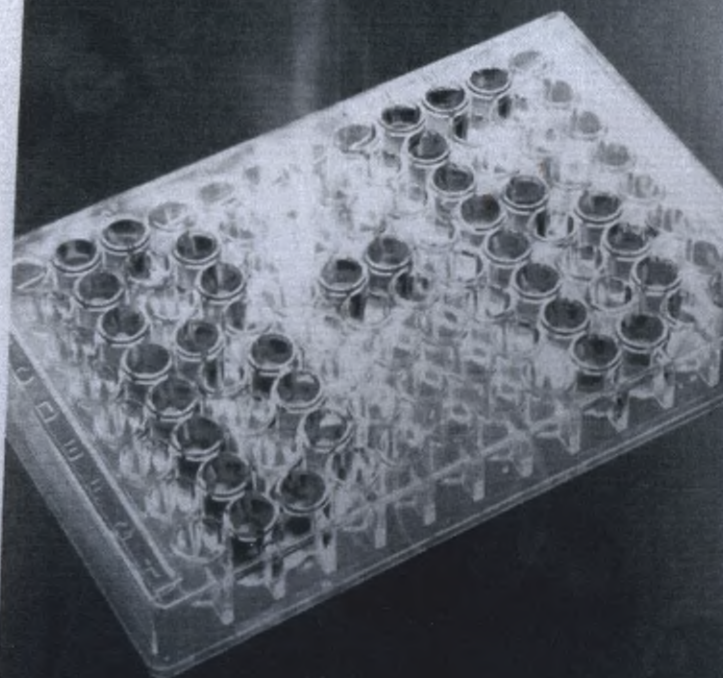

REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к *Mycoplasma pneumoniae*

**Mycoplasma pneumoniae – IgM –
ИФА – БЕСТ**

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
7. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
9. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
10. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
12. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ" №2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов

2019 г.

