


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ”
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____


М.Д. Хусайнов

“04” 06/06/2019

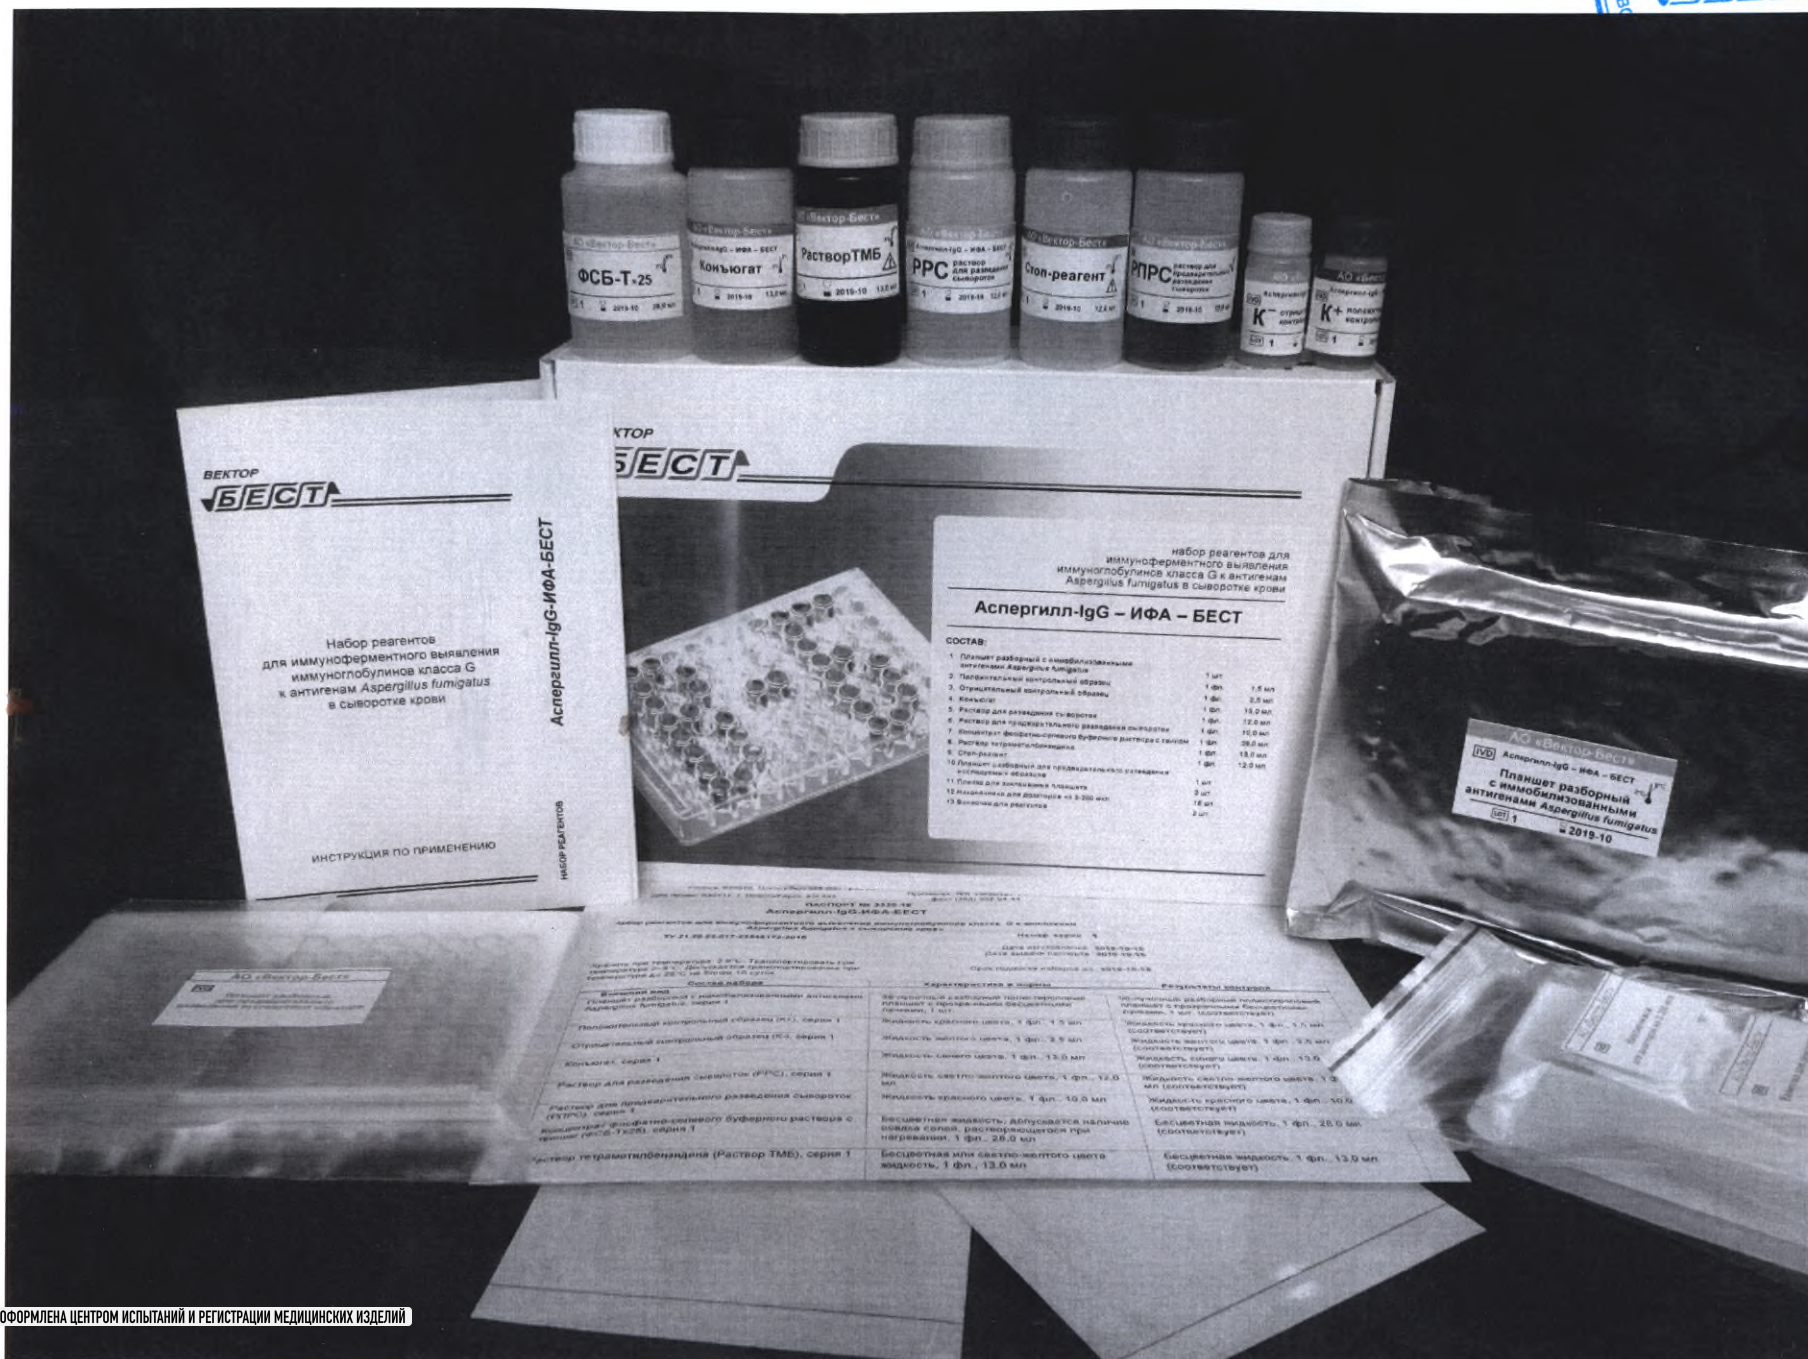


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”



М.Д. Хусаинов
2019 г.

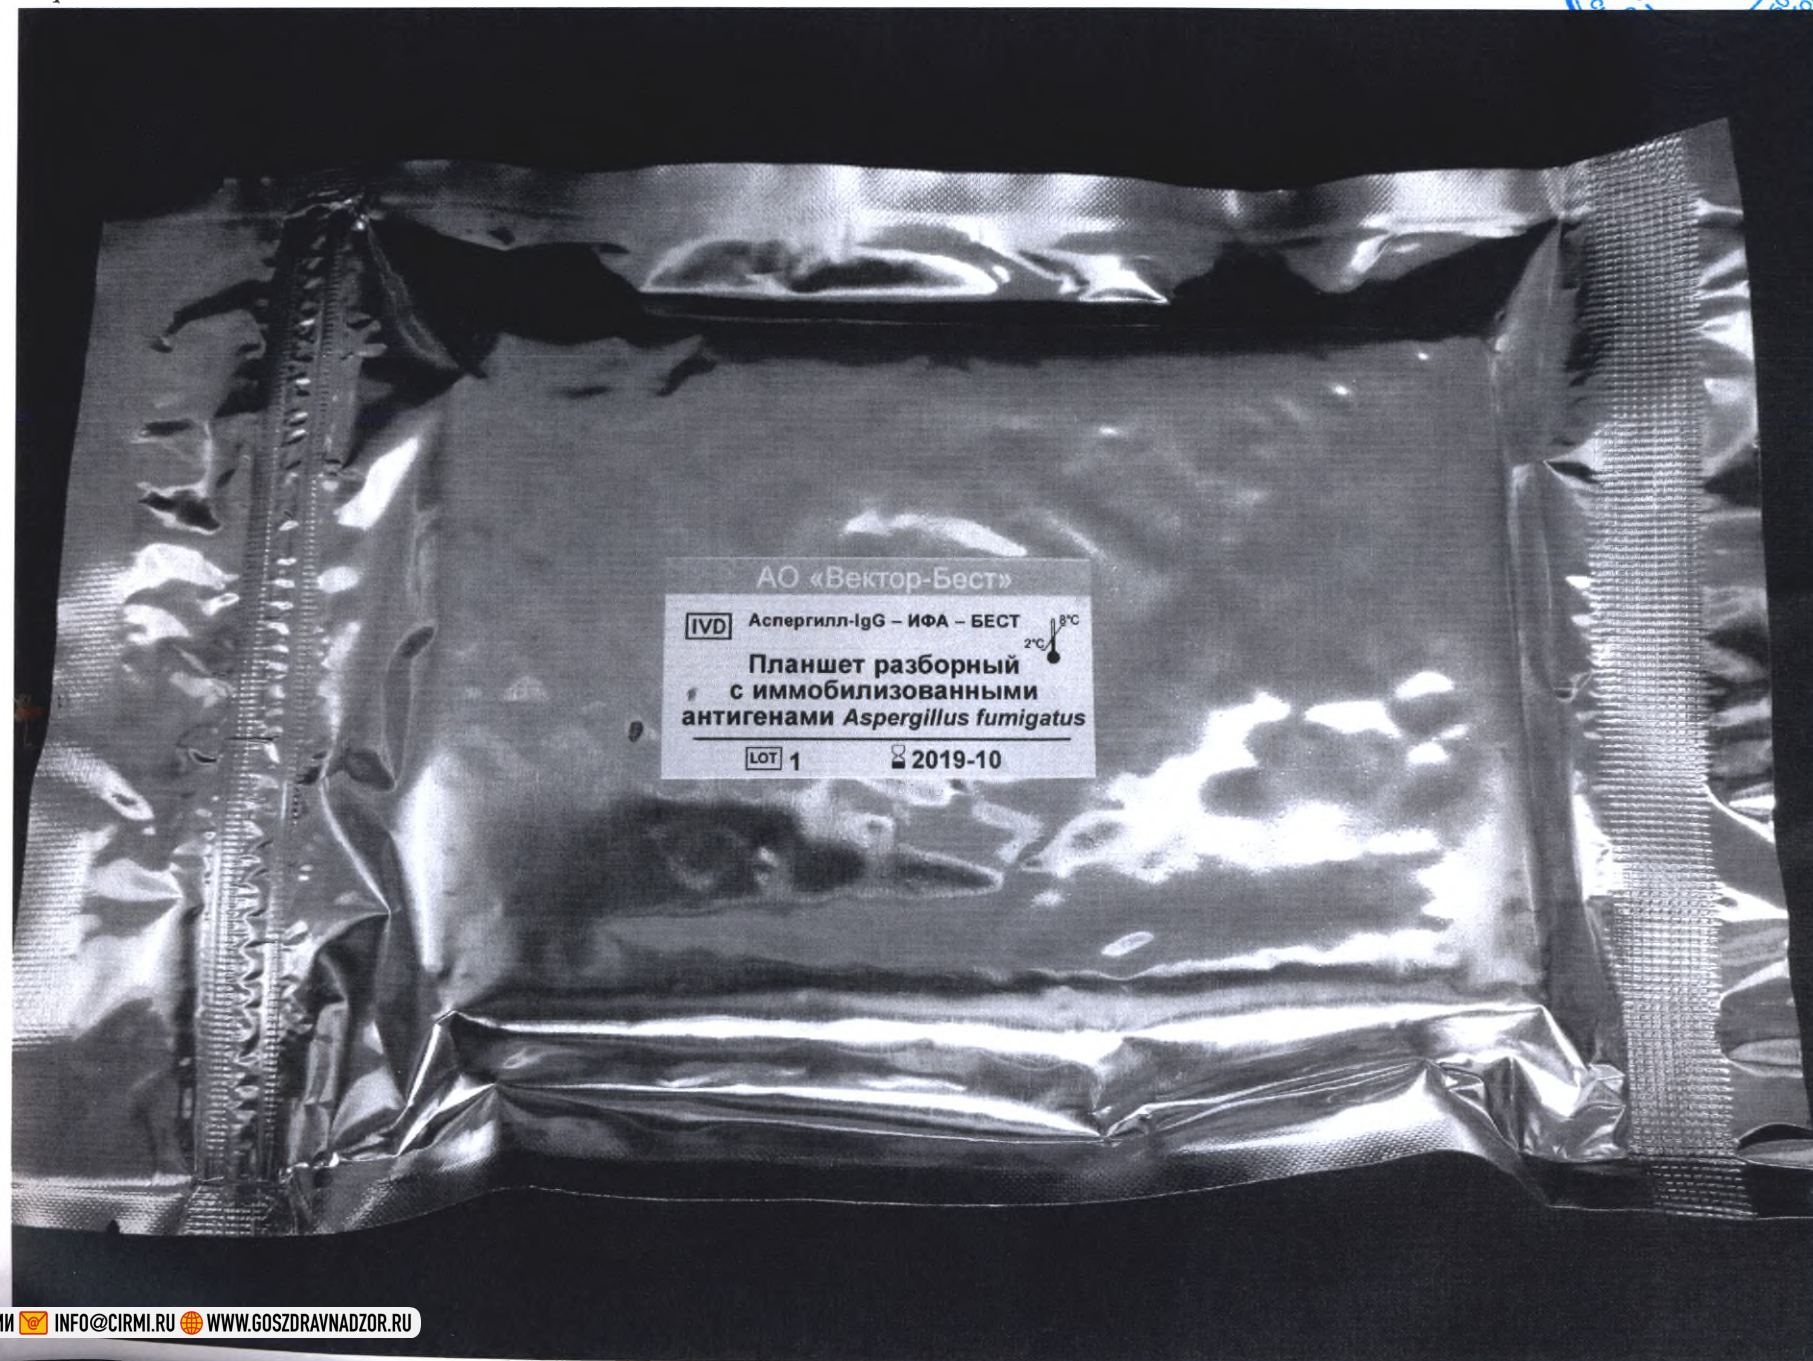


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусанов

“04”

2019 г.

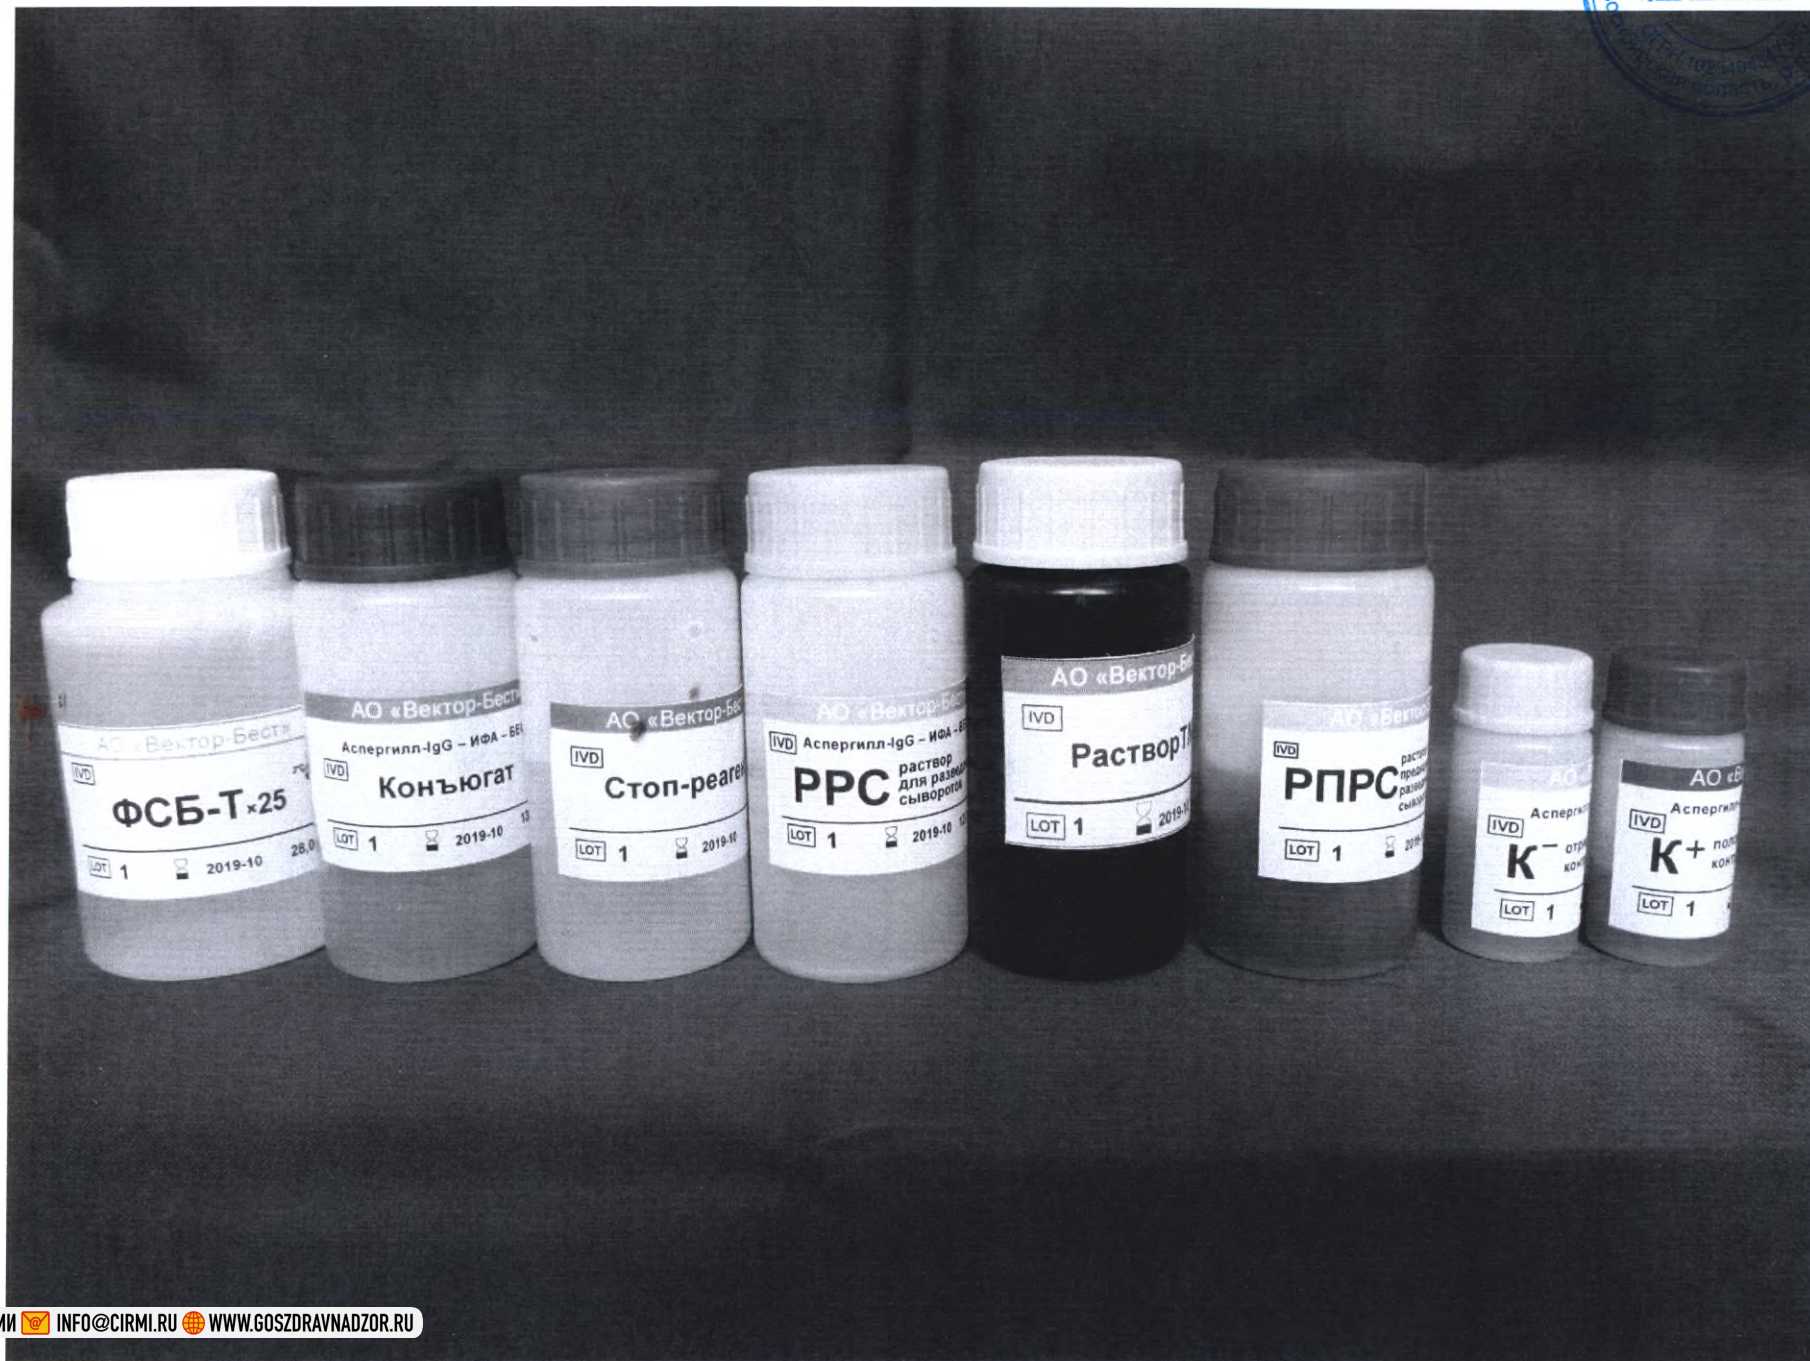


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М. Д. Хусаинов



2019 г.

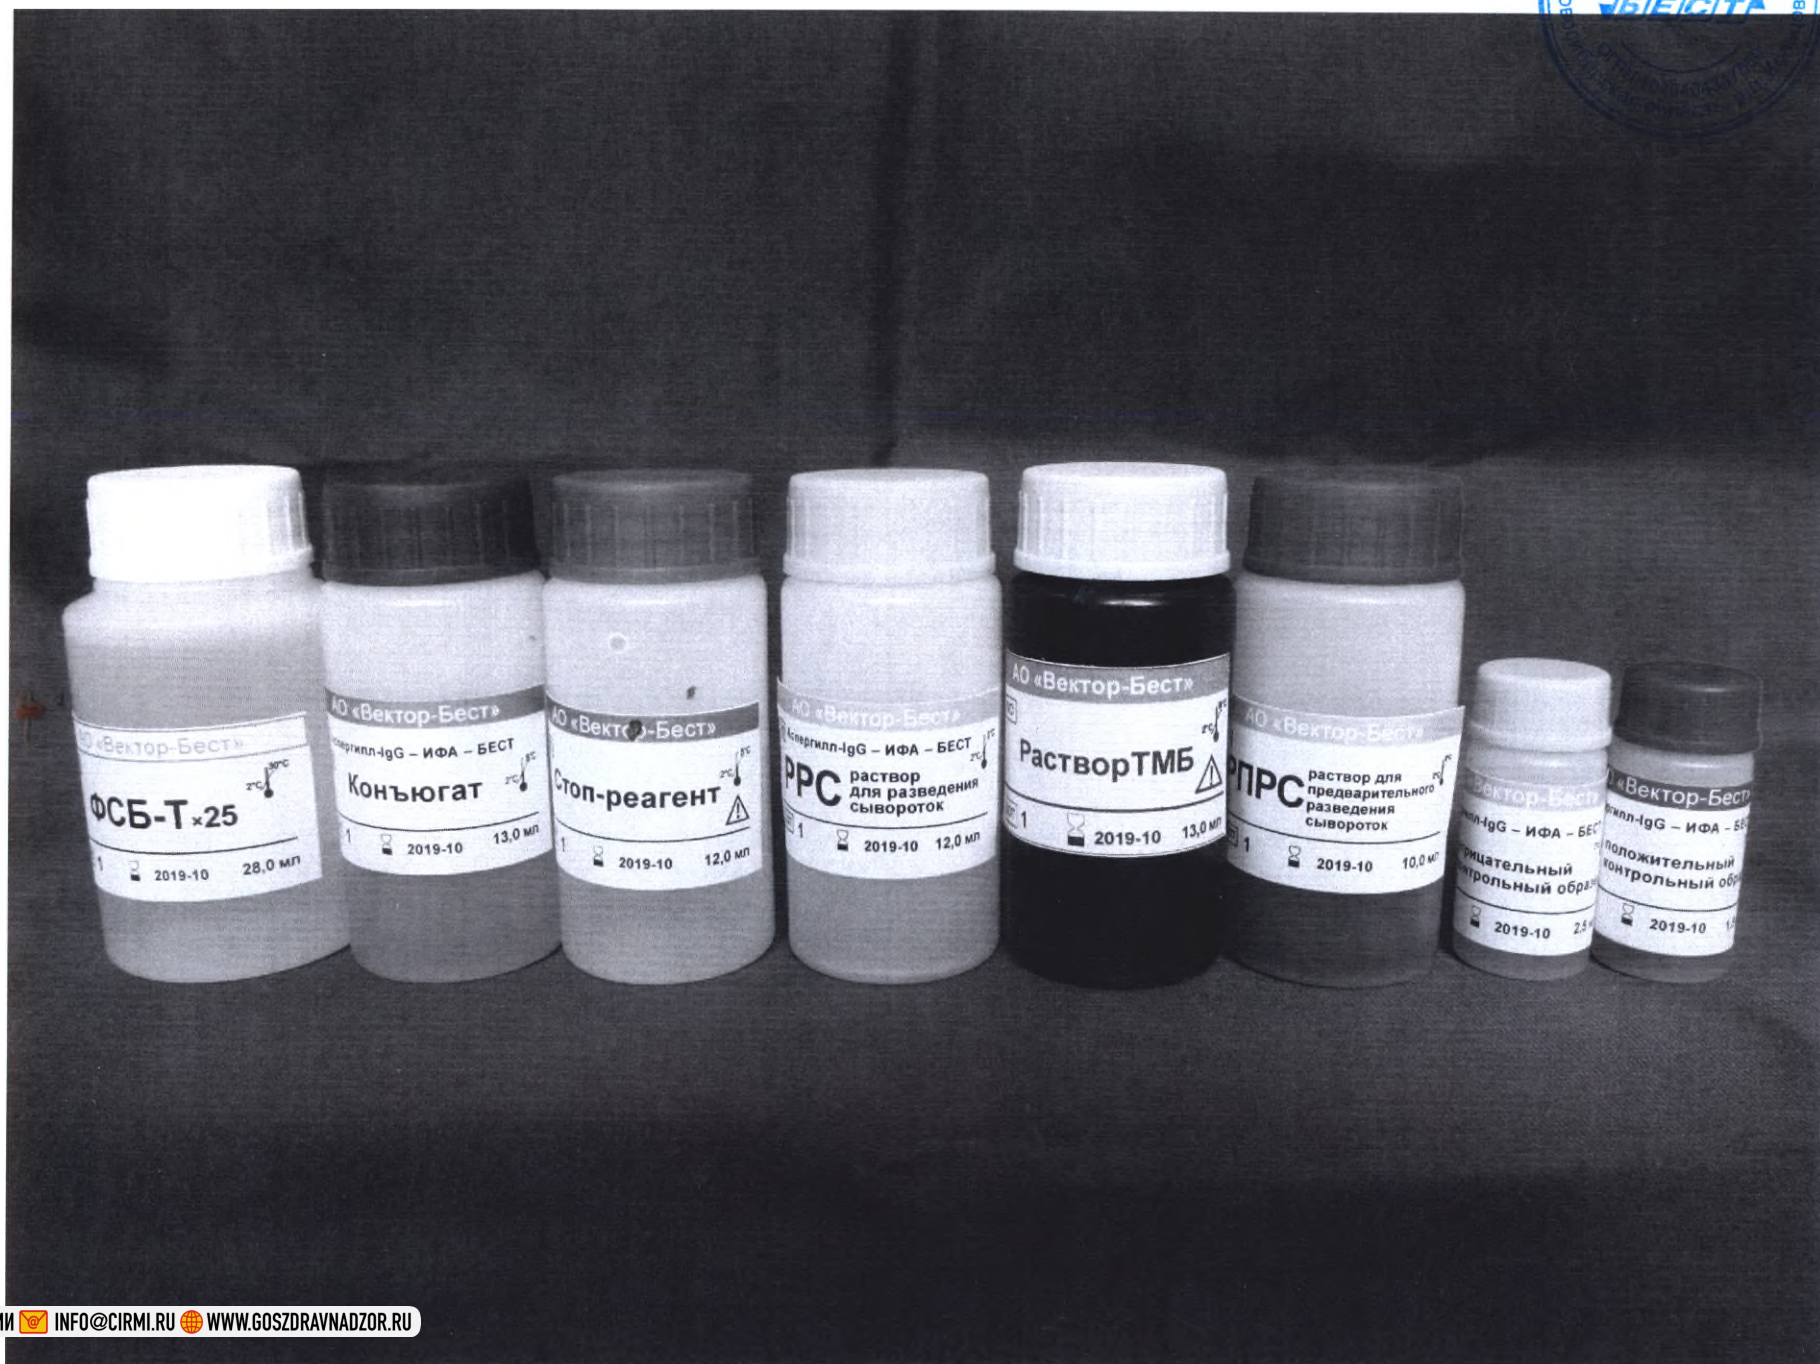

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

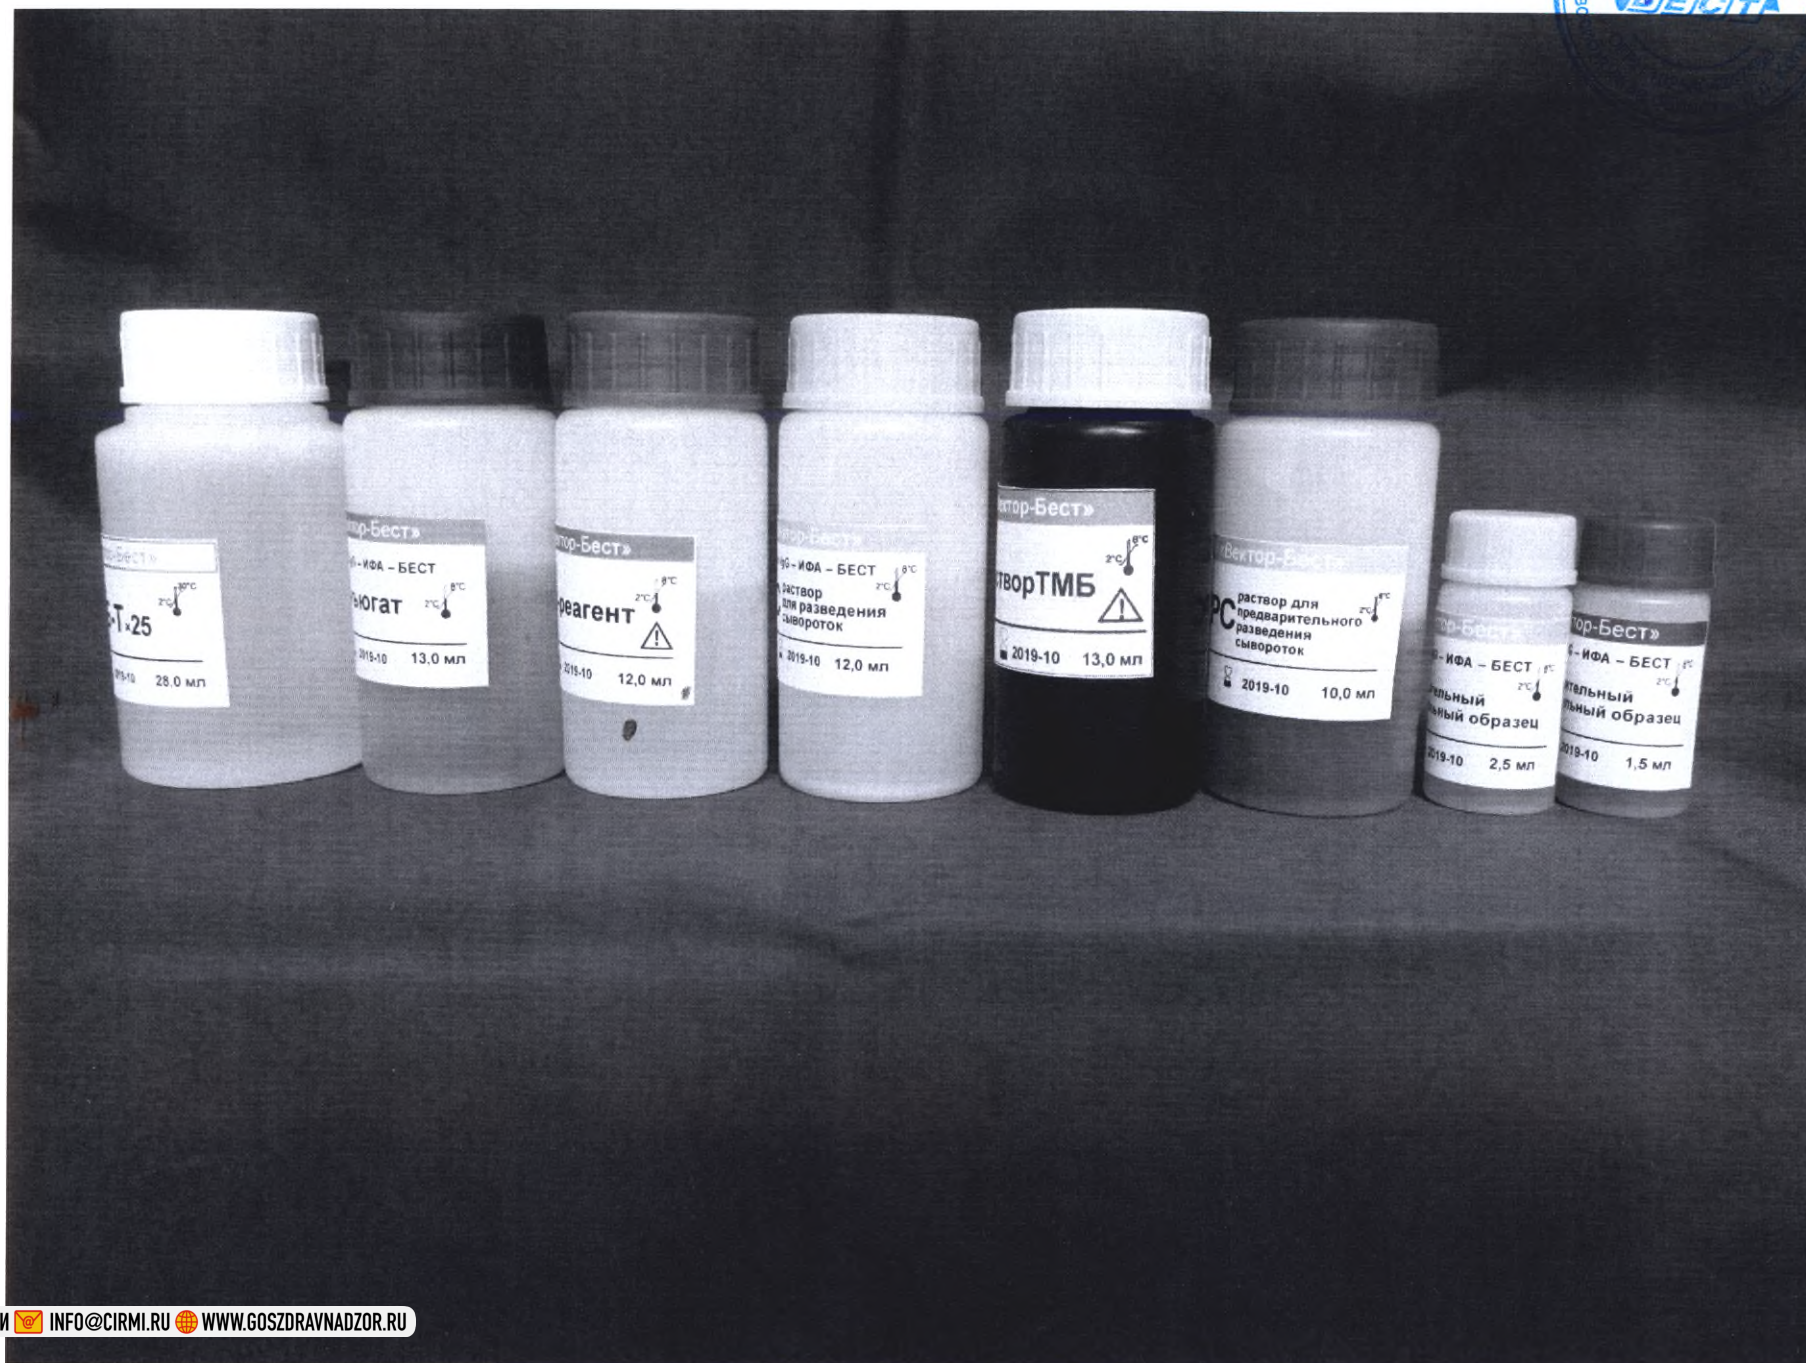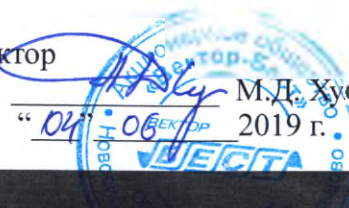


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов



“ 04.06.2019 ”

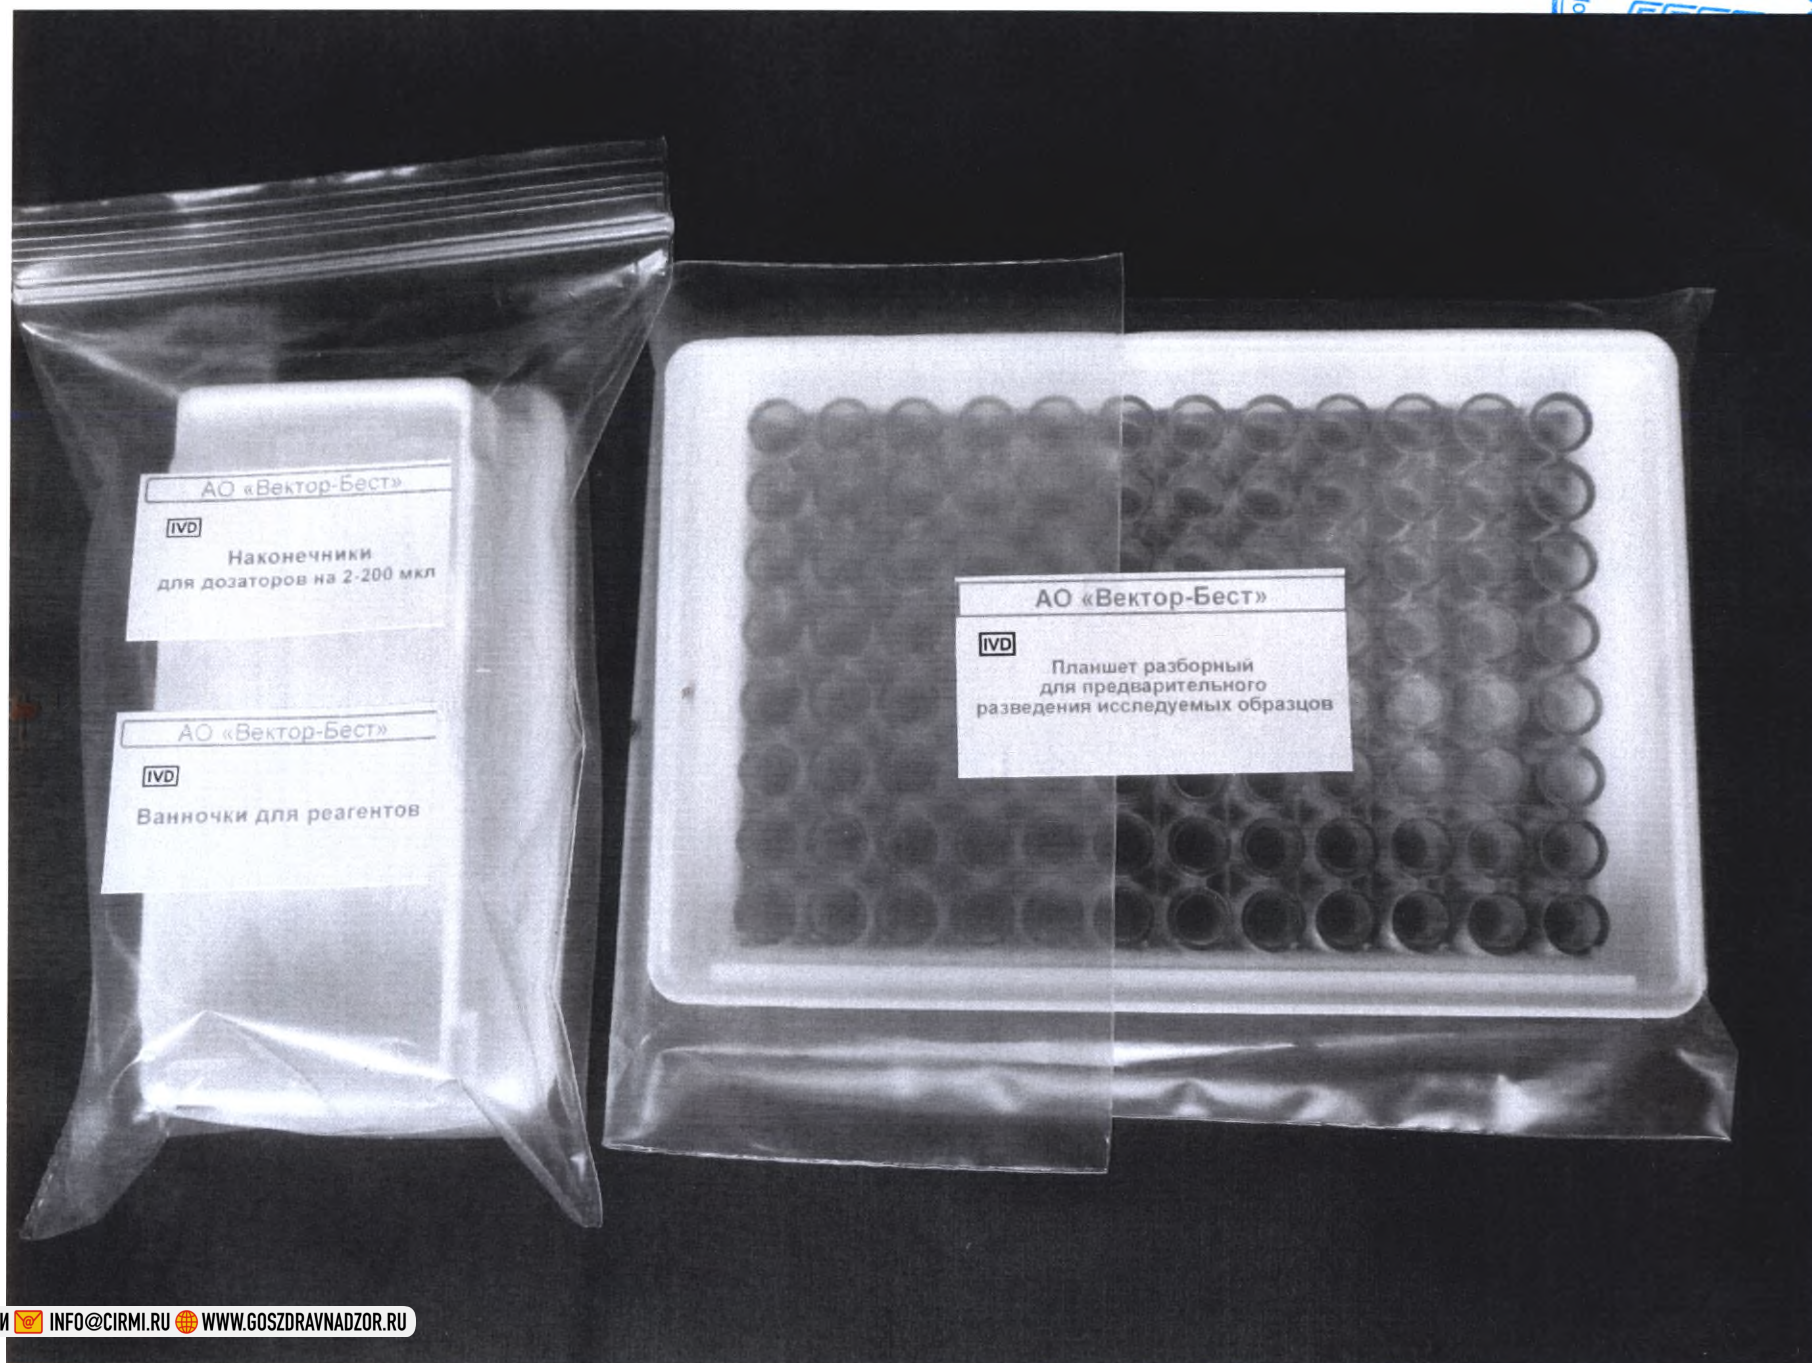

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

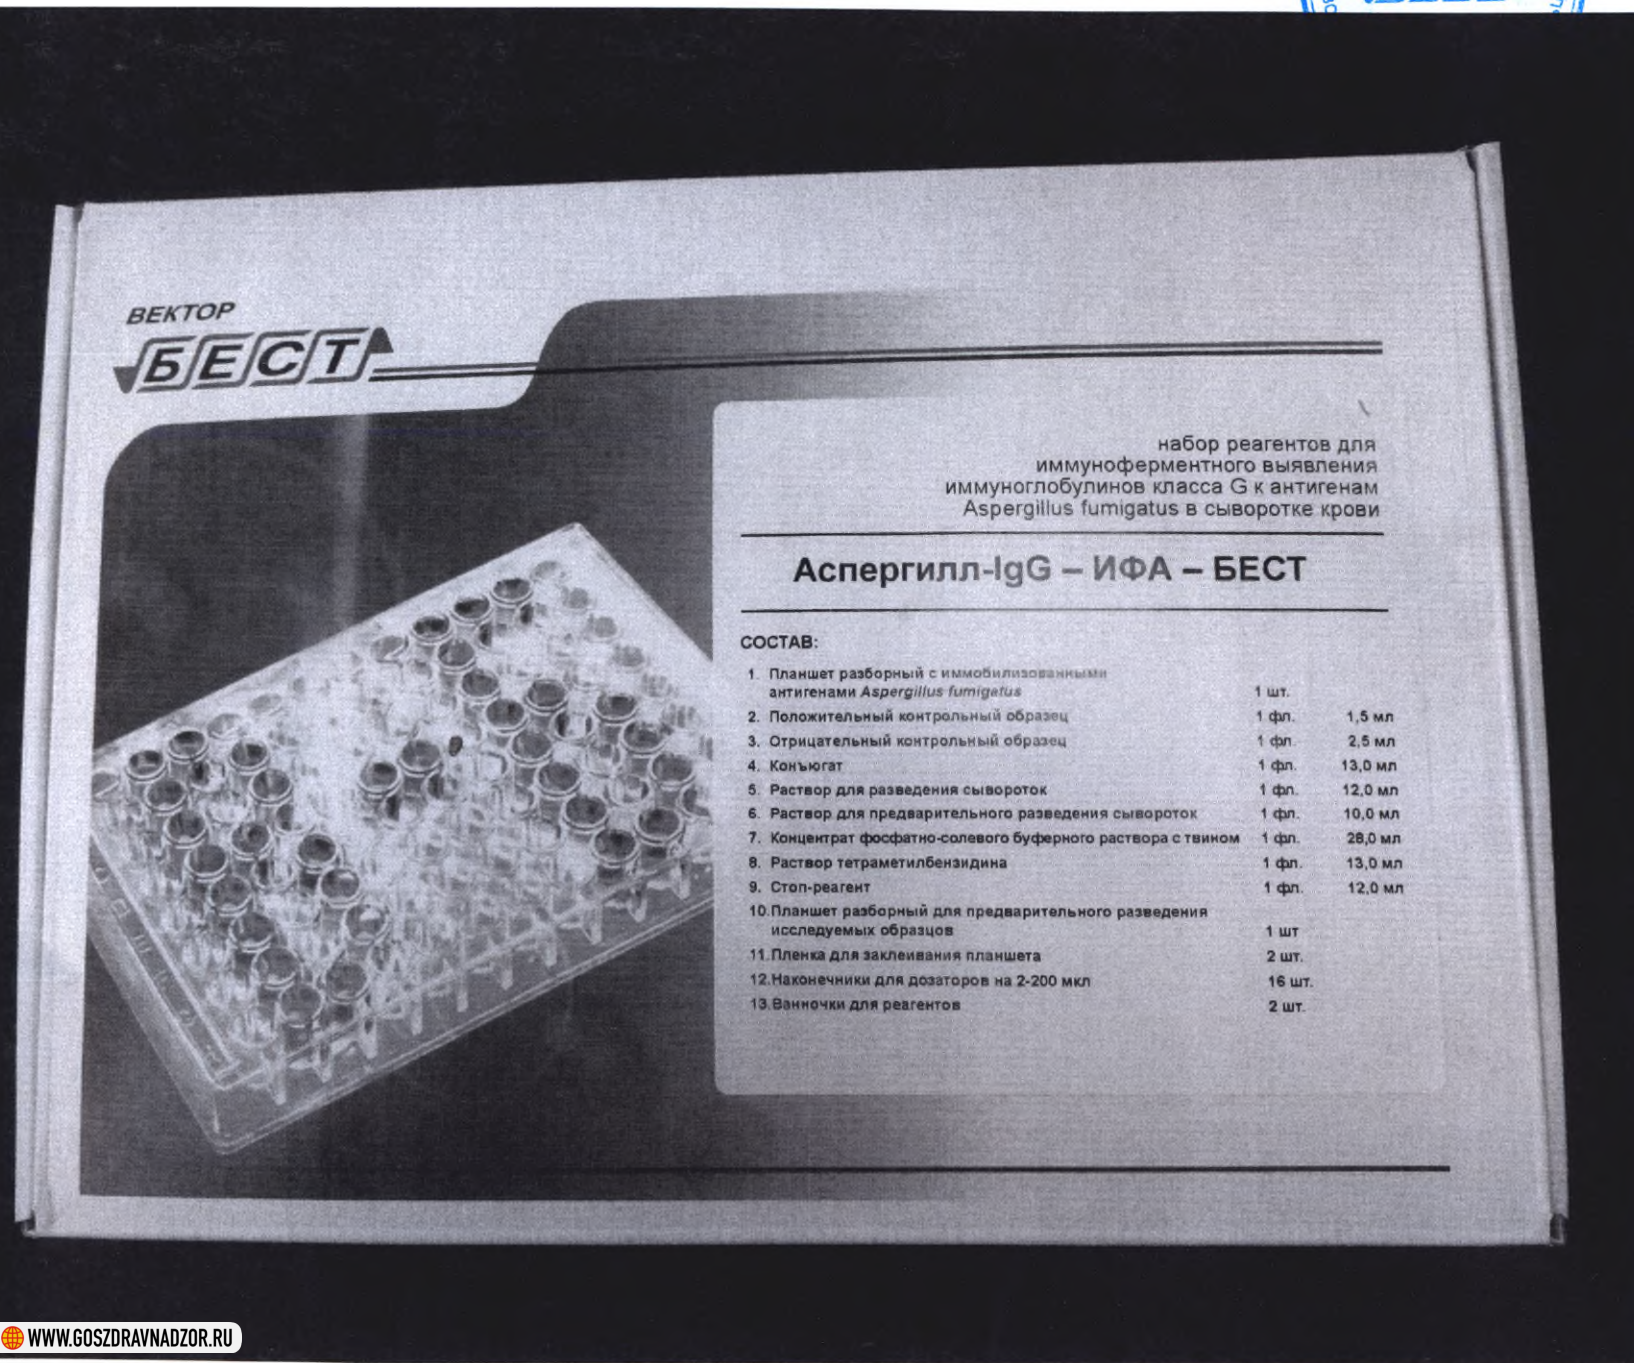

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам
Aspergillus fumigatus в сыворотке крови

Аспергилл-IgG – ИФА – БЕСТ


СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Aspergillus fumigatus</i>	1 шт.	
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	2,5 мл
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаннов
“04” 06 2019 г.

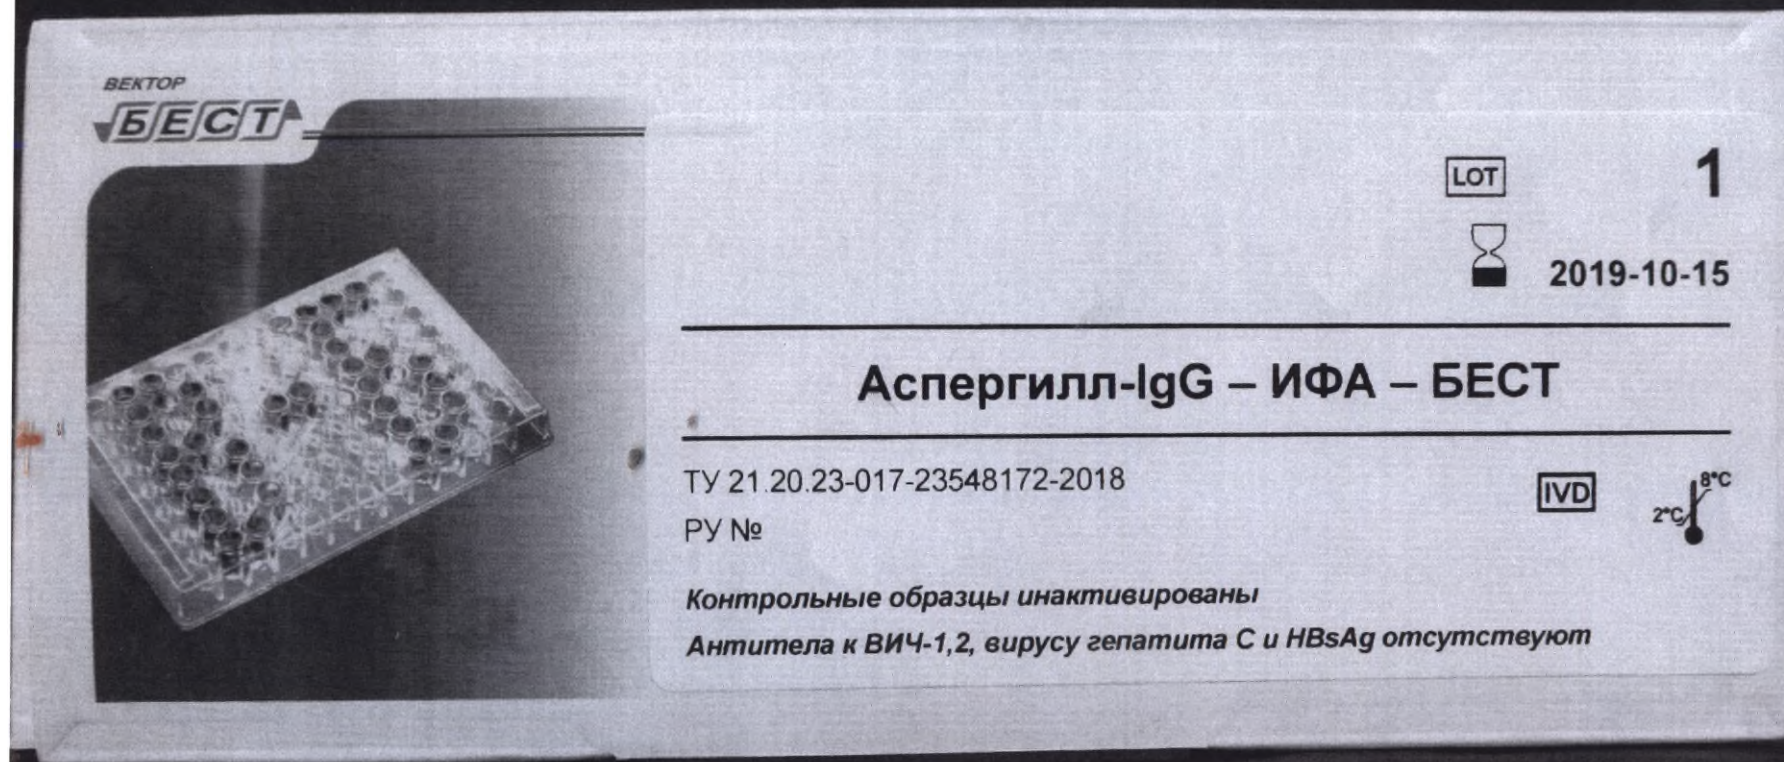



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “04” 06/2019 г.

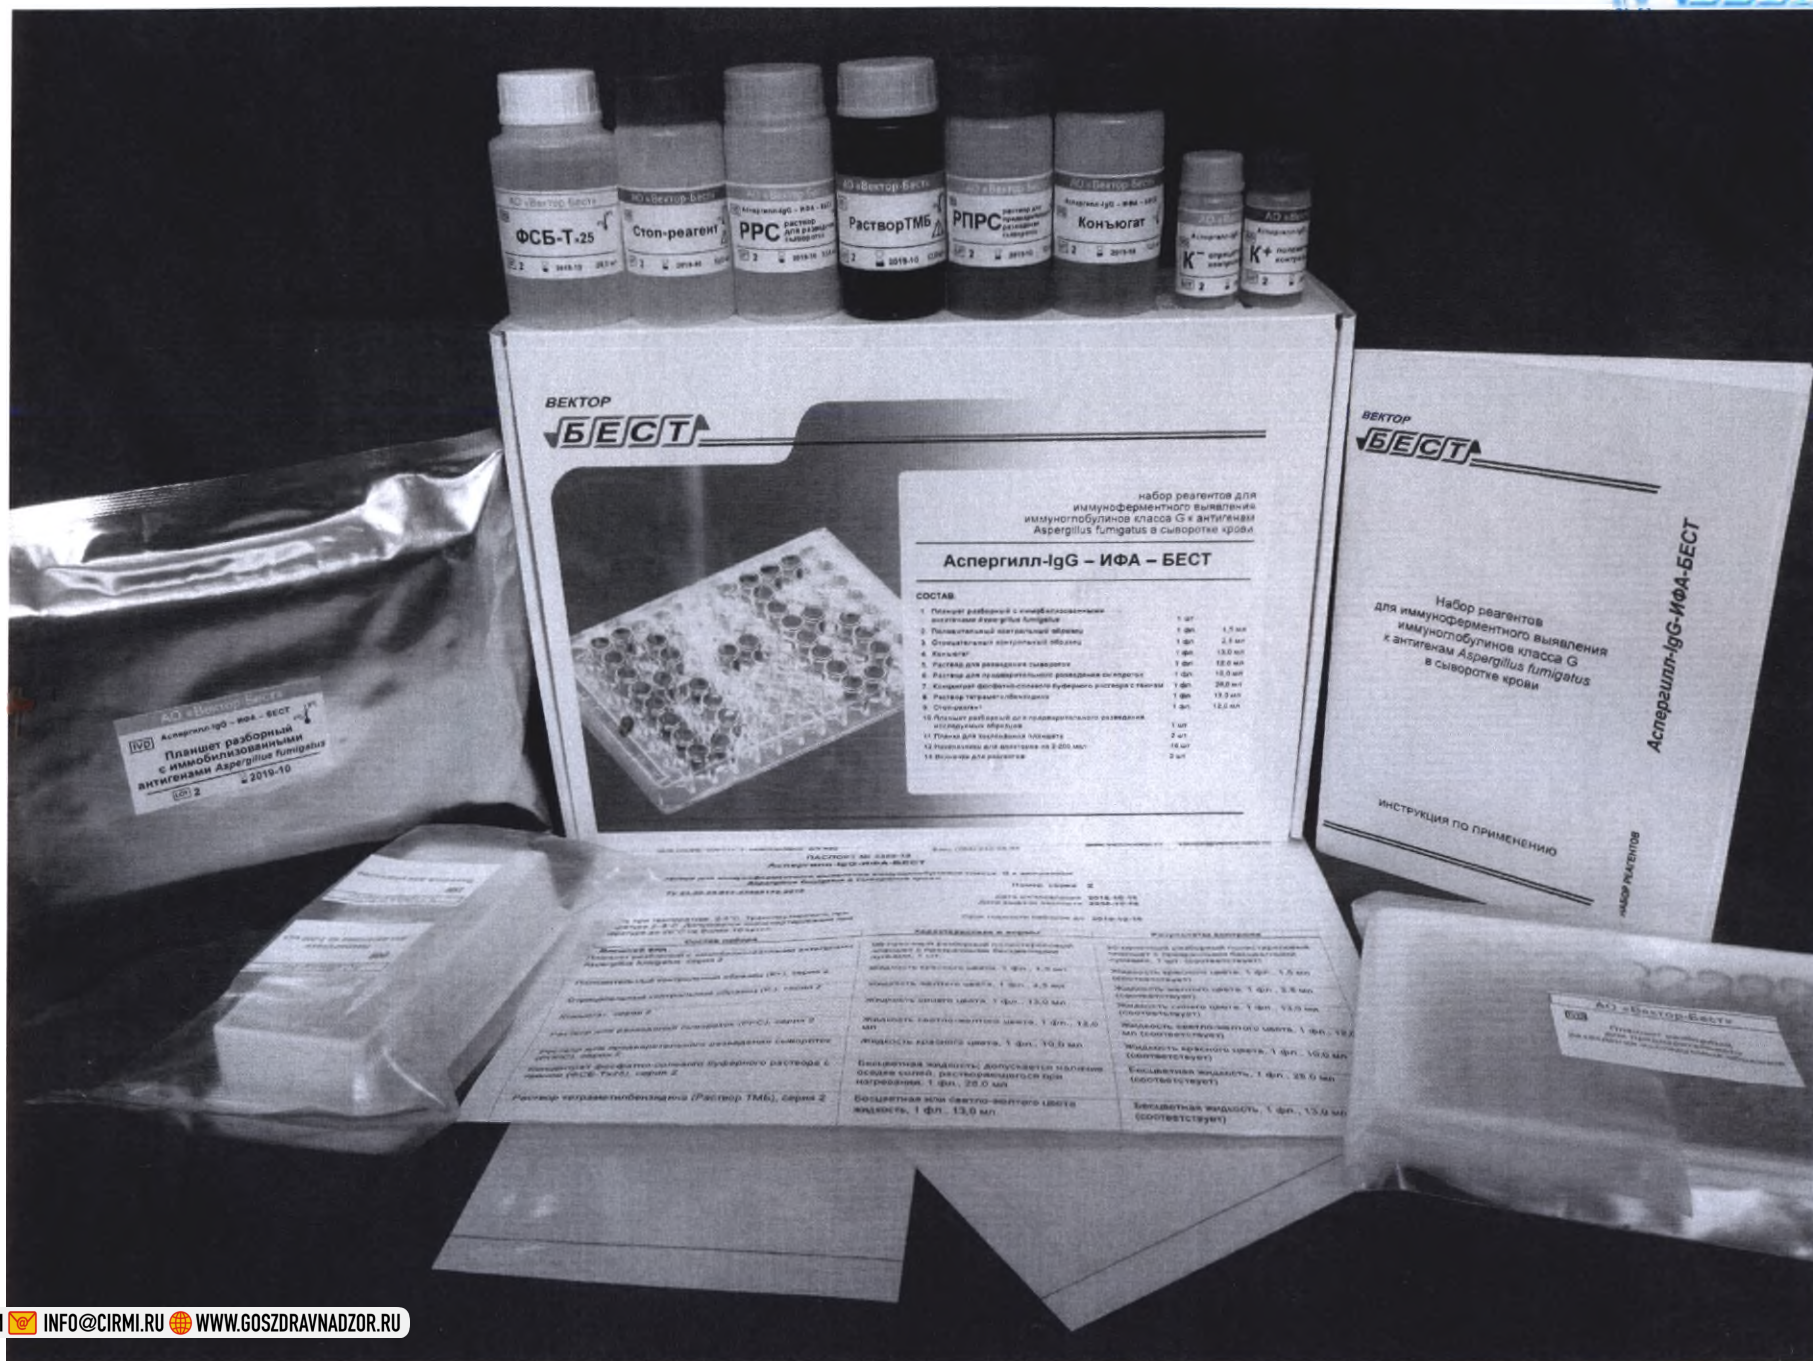

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“04” 06 2019 г.

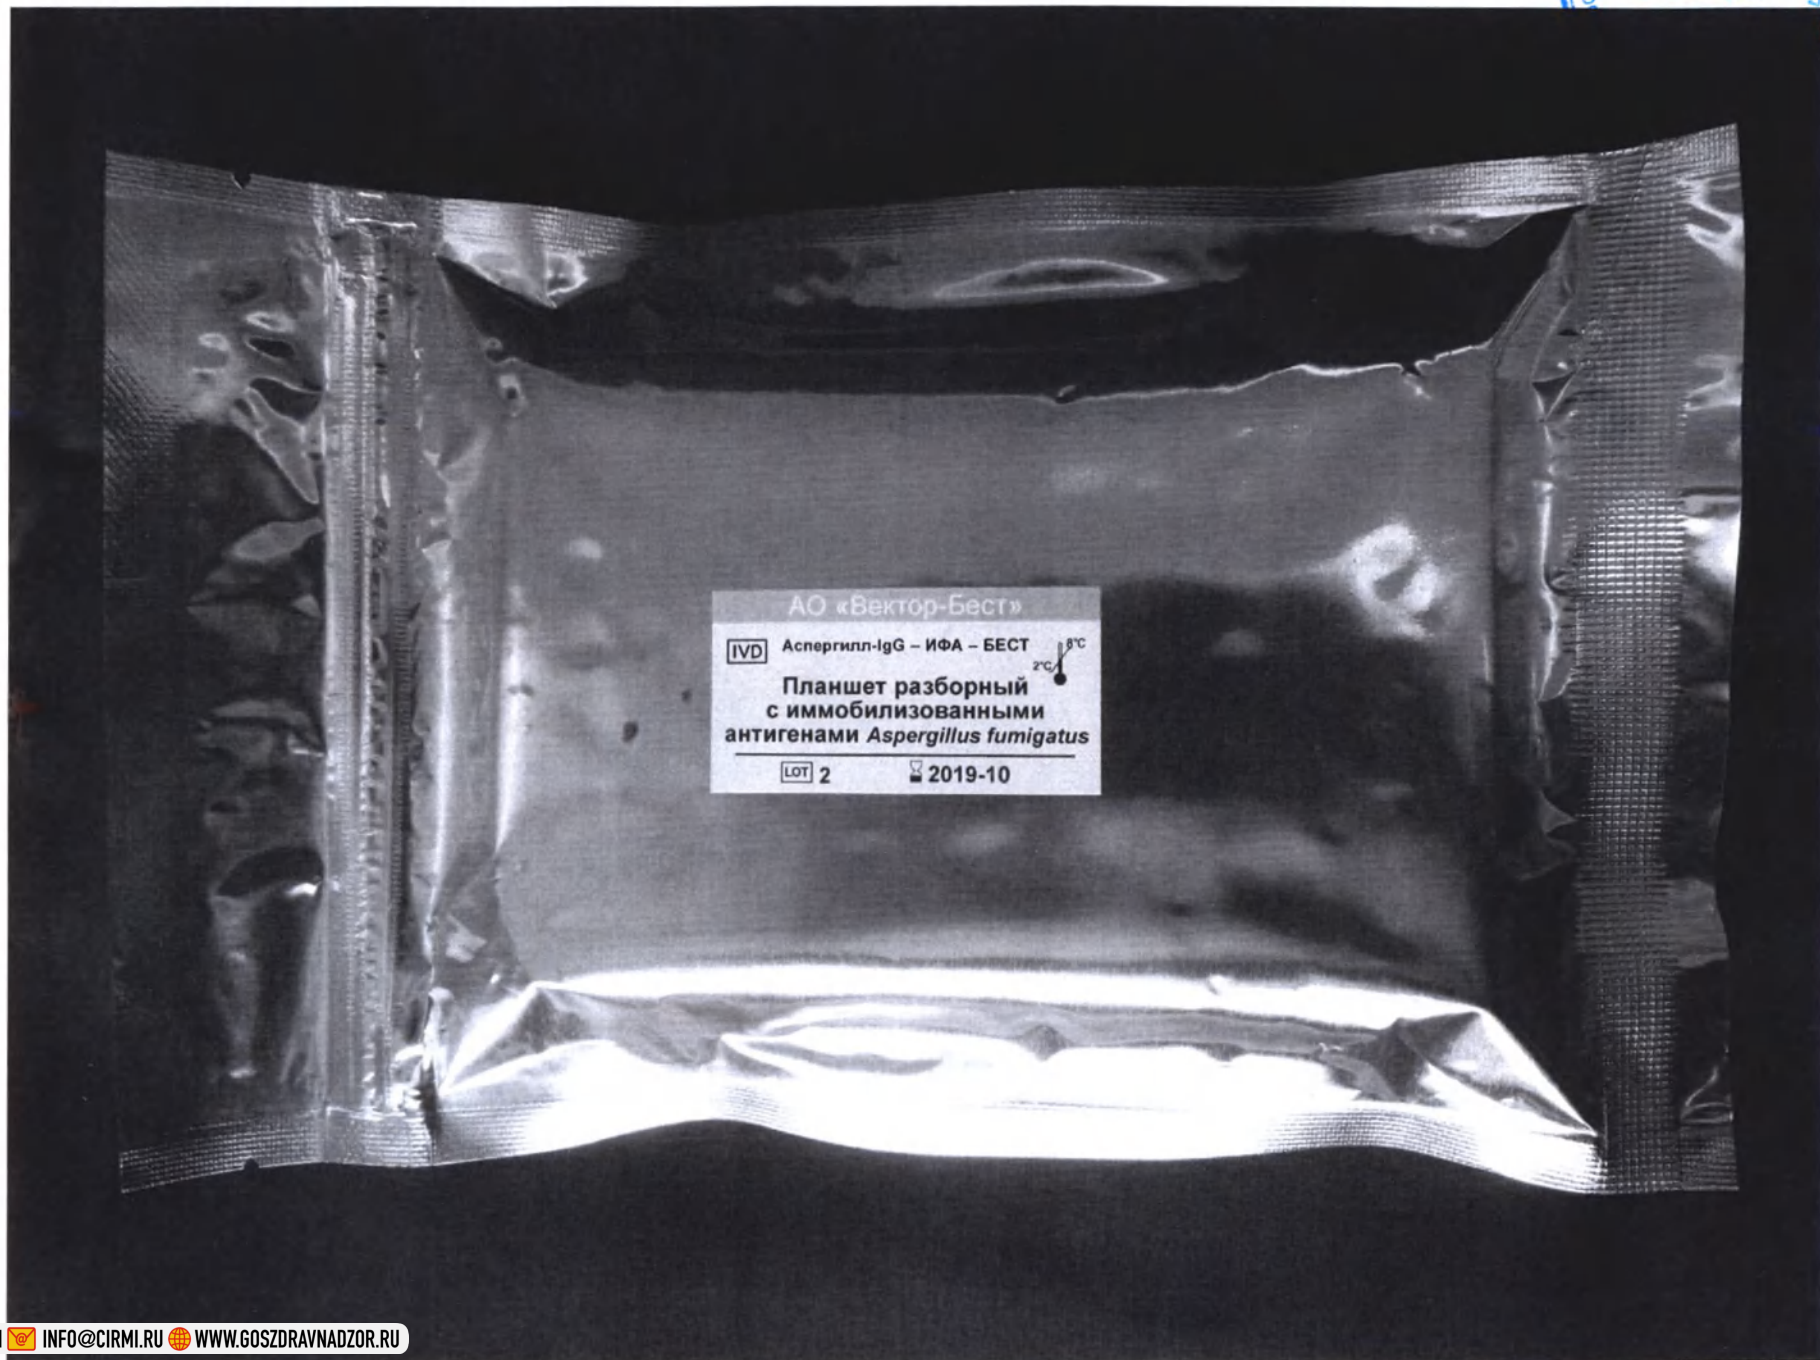
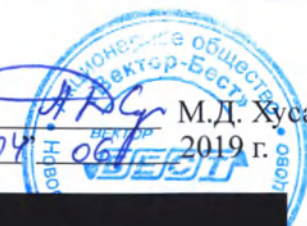


АО «Вектор-Бест»
IVD Аспергилл-IgG – ИФА – БЕСТ 8°C
Планшет разборный
с иммобилизованными
антигенами *Aspergillus fumigatus*
LOT 2 2019-10

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов
2019 г.

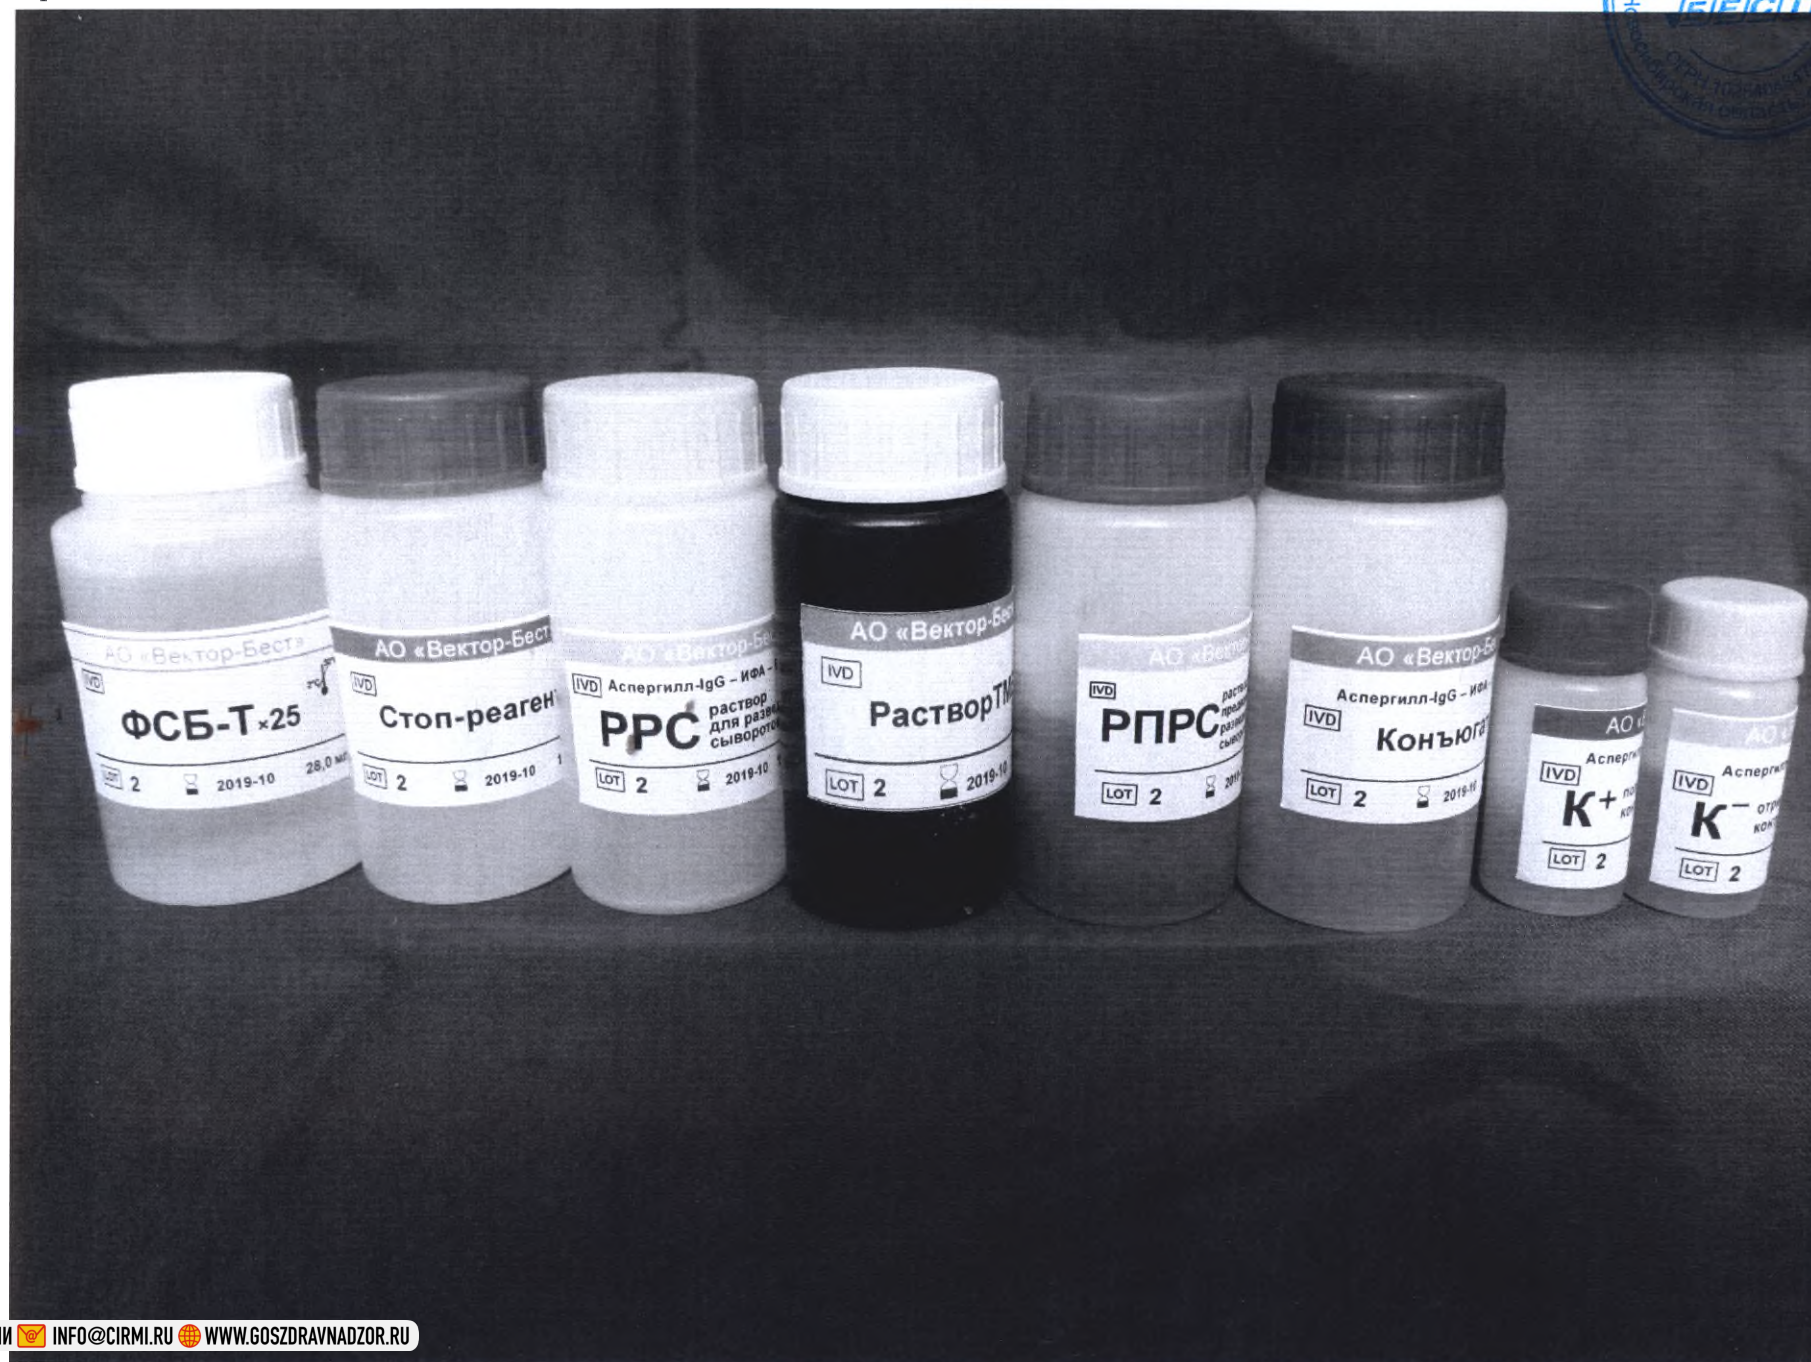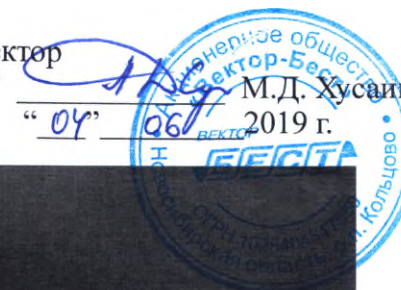


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.


“04” 06

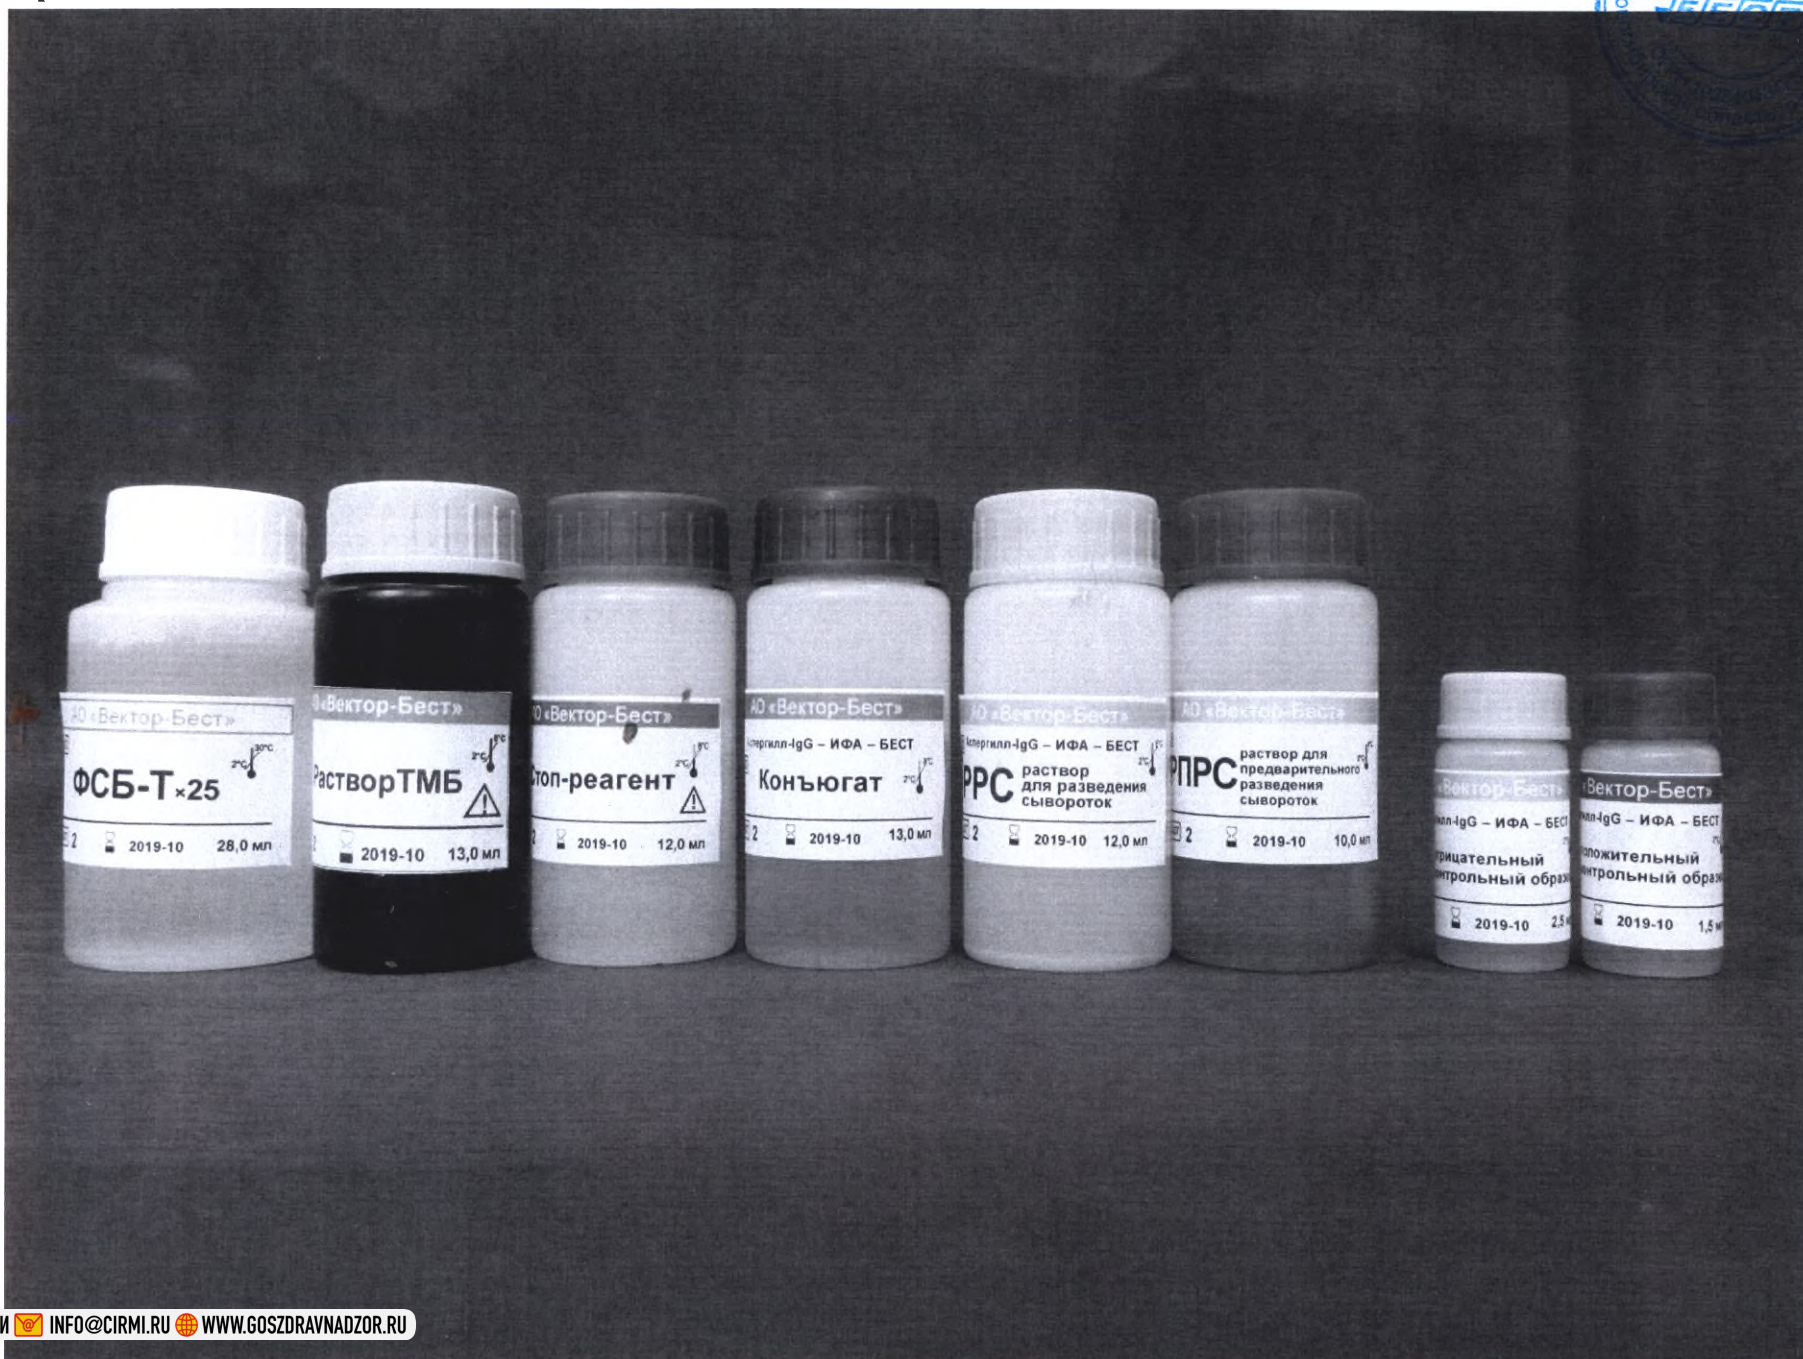

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
“04” 06.11.2019 г.

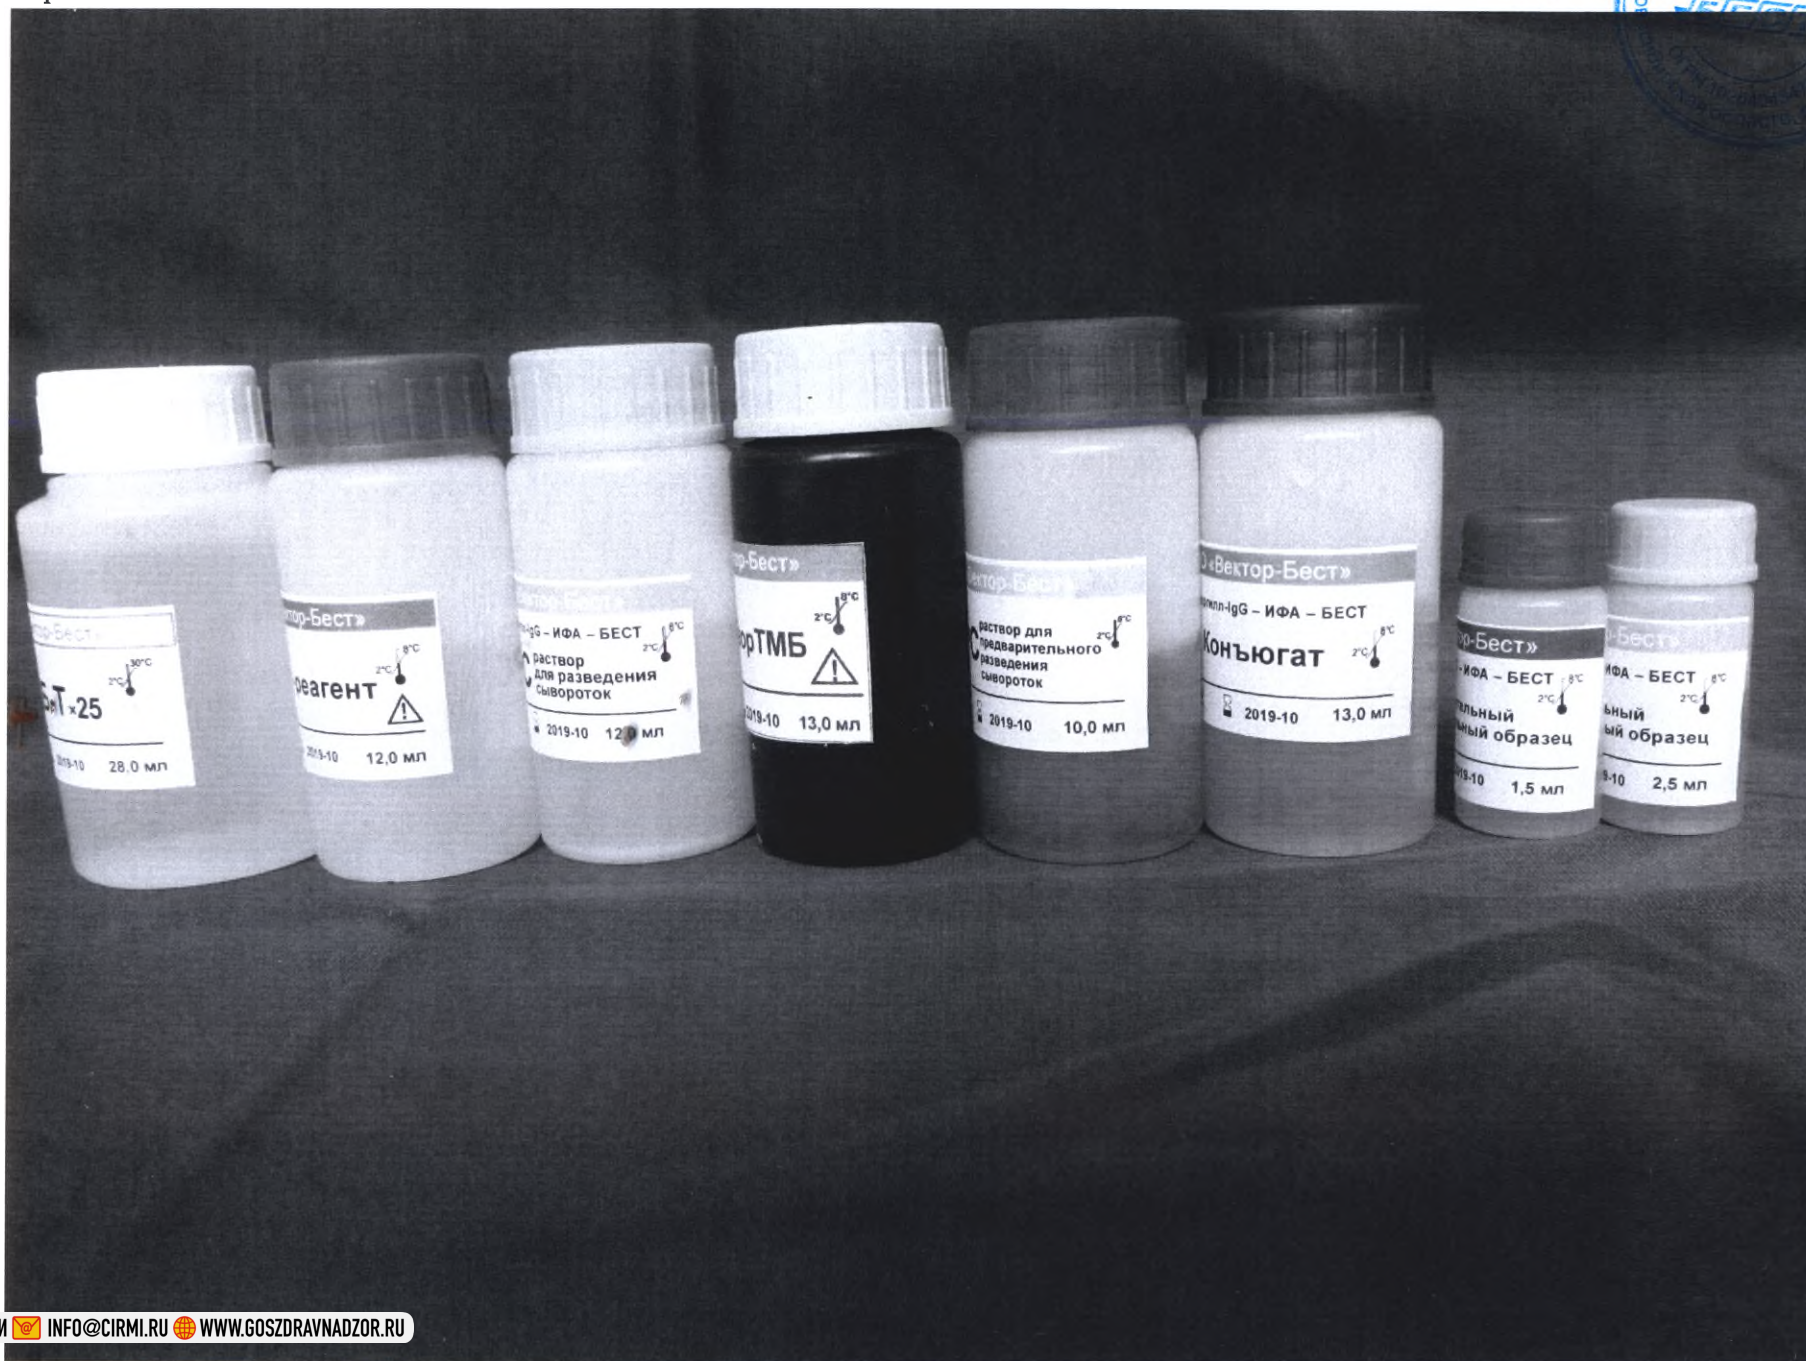



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.

“04”

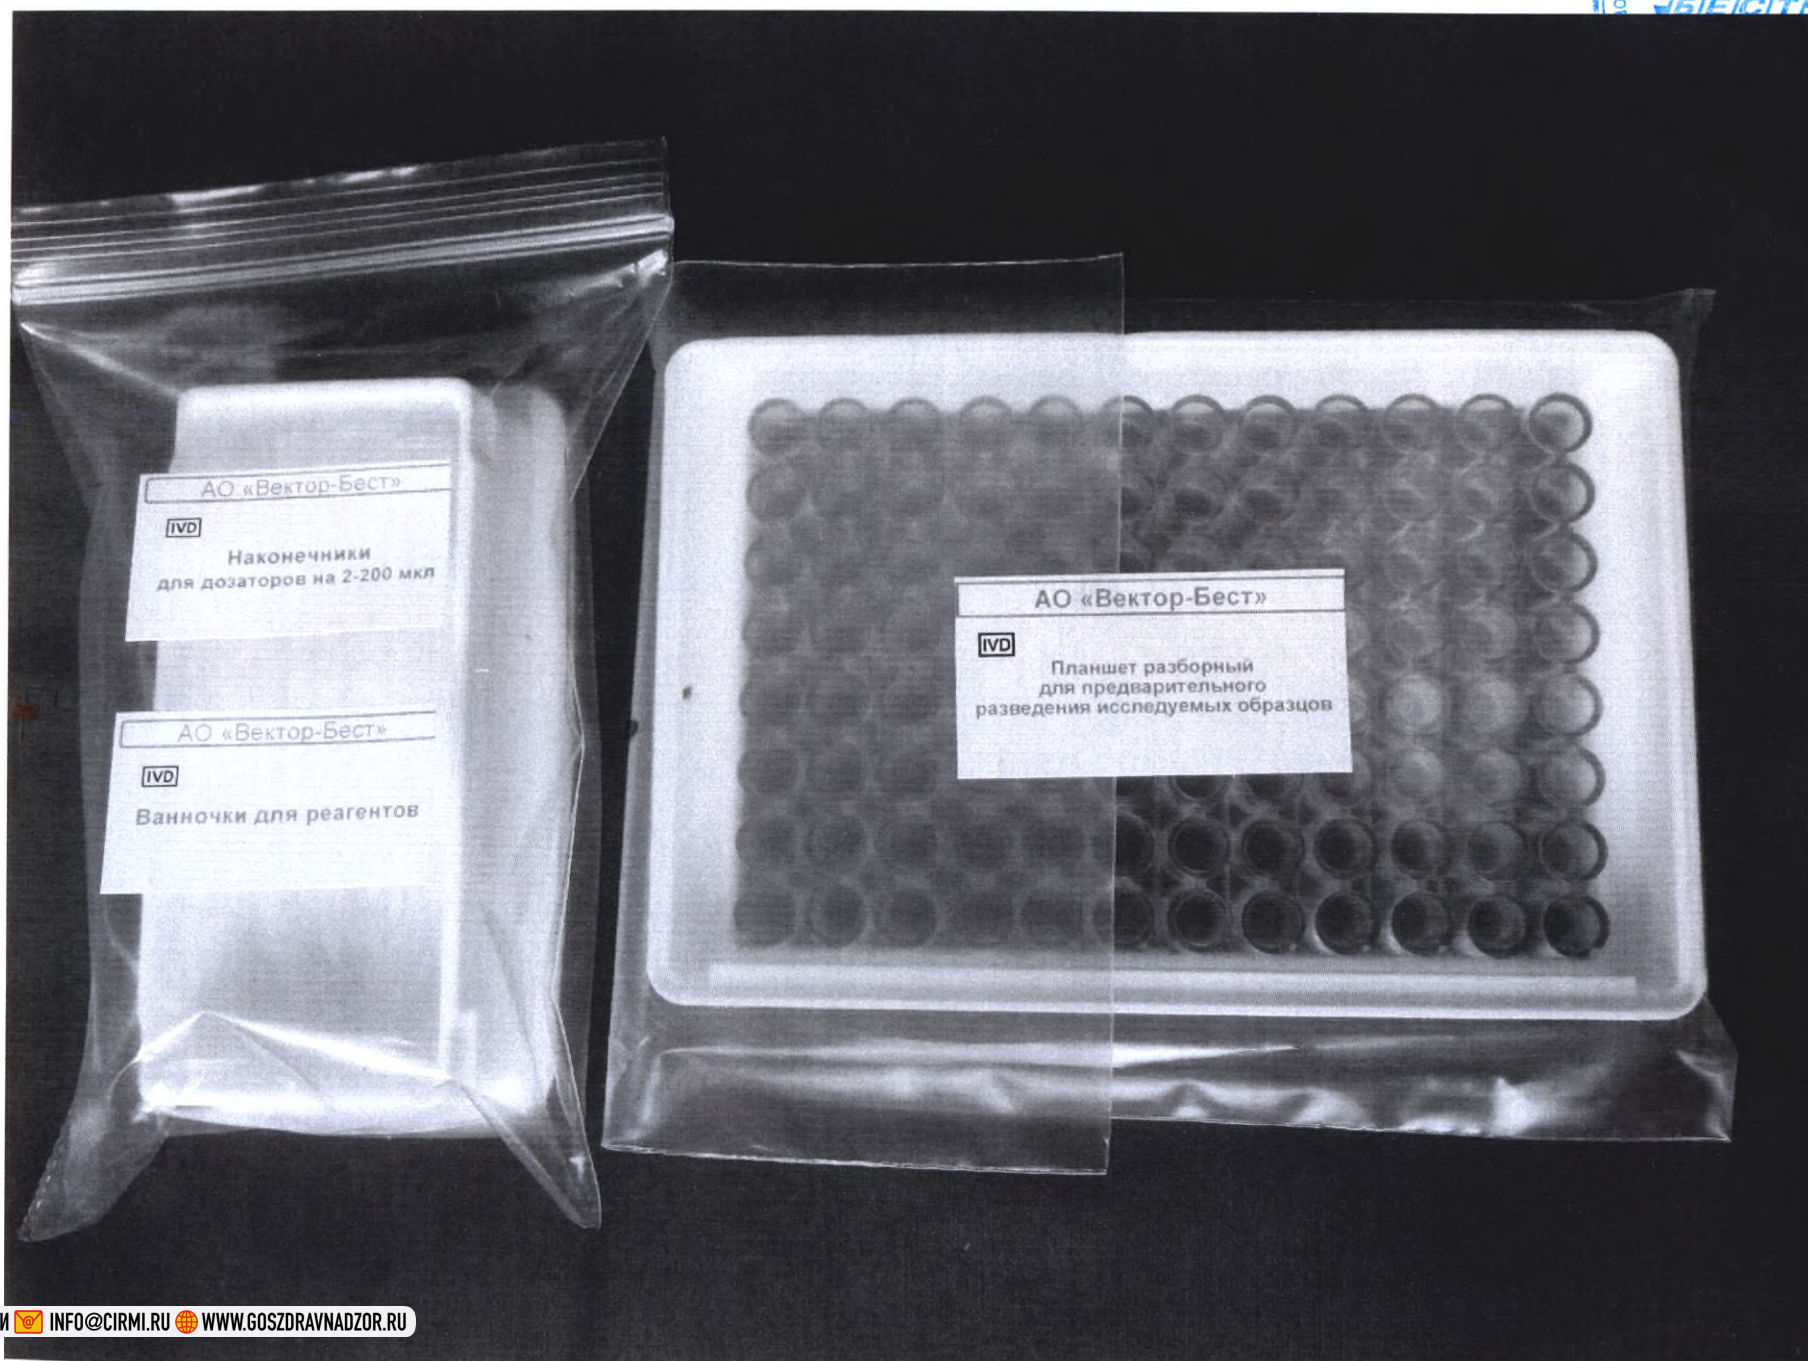

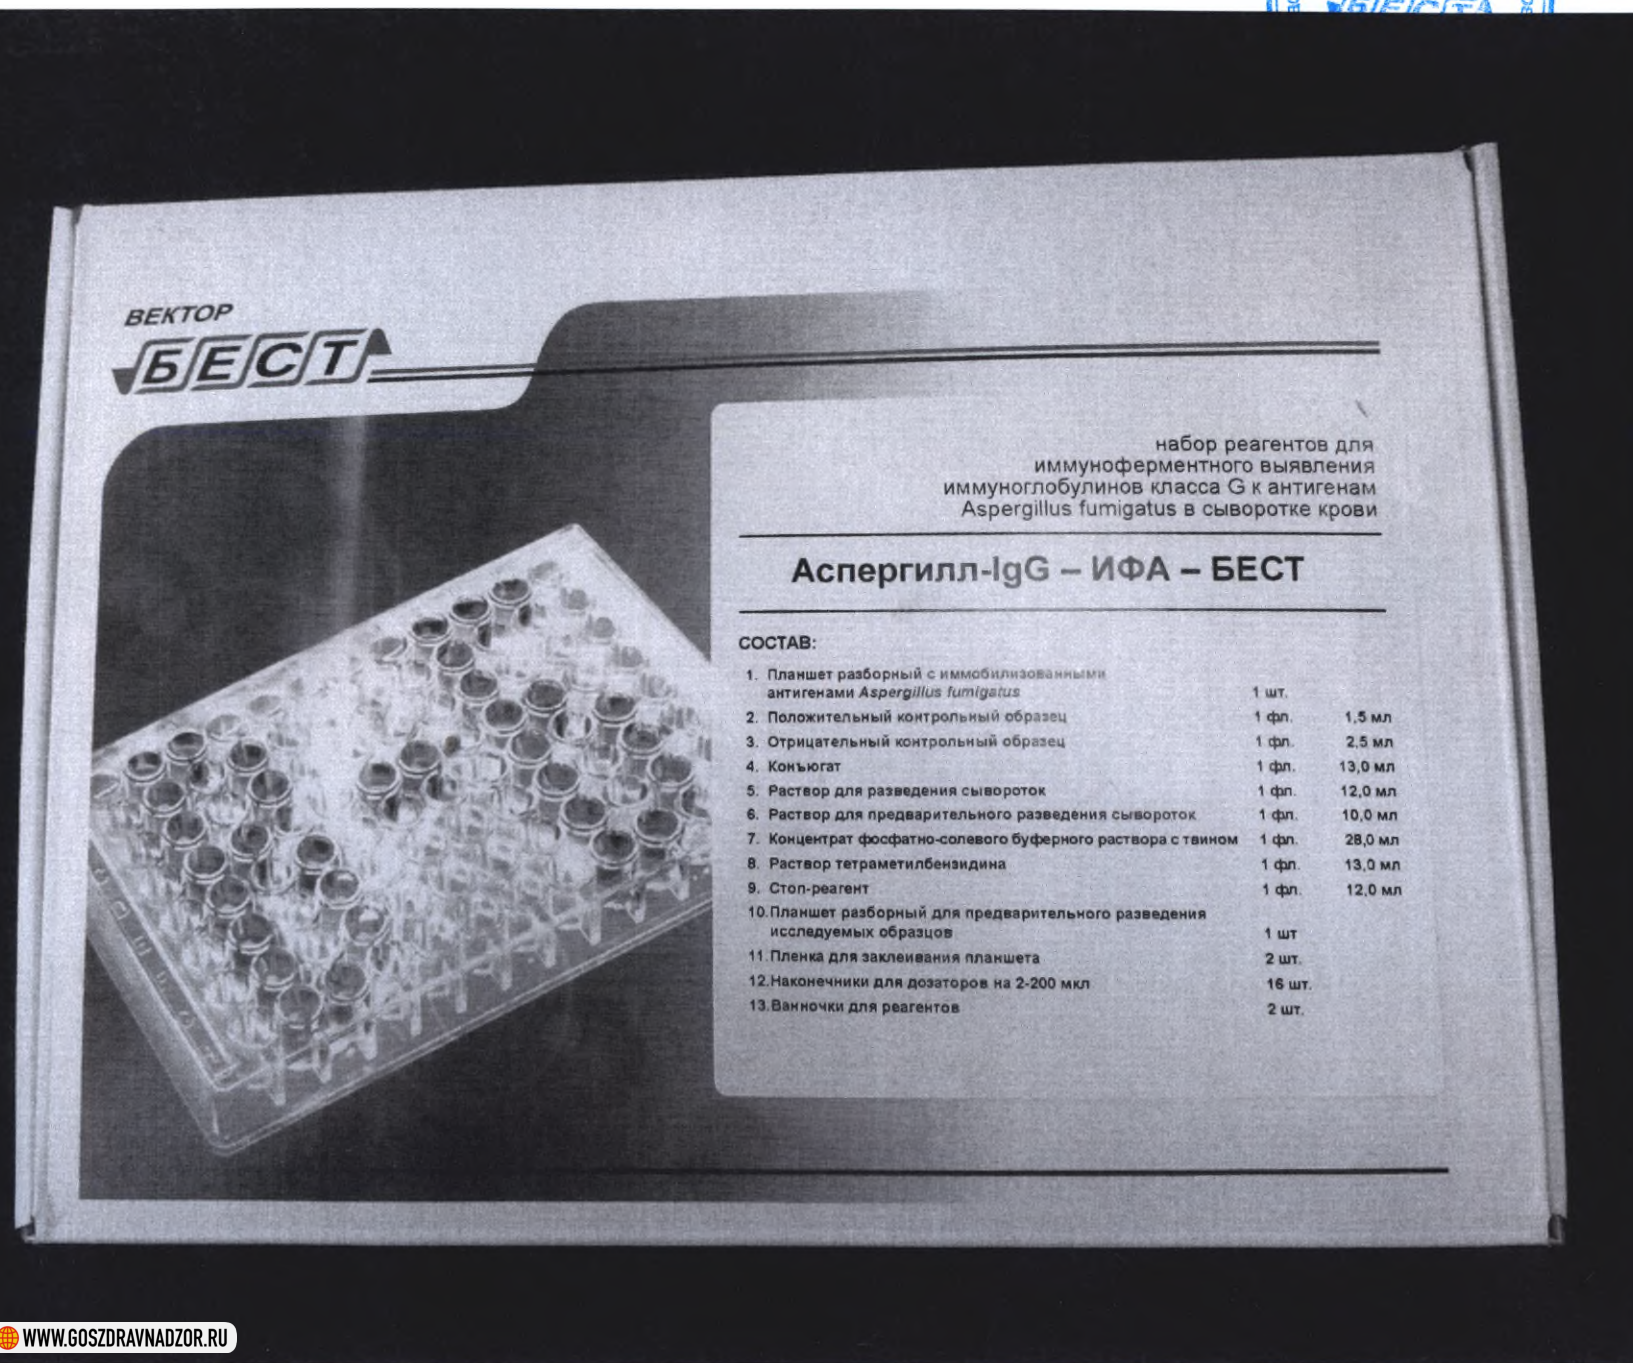

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов

“04” 08 / 2019 г.

