





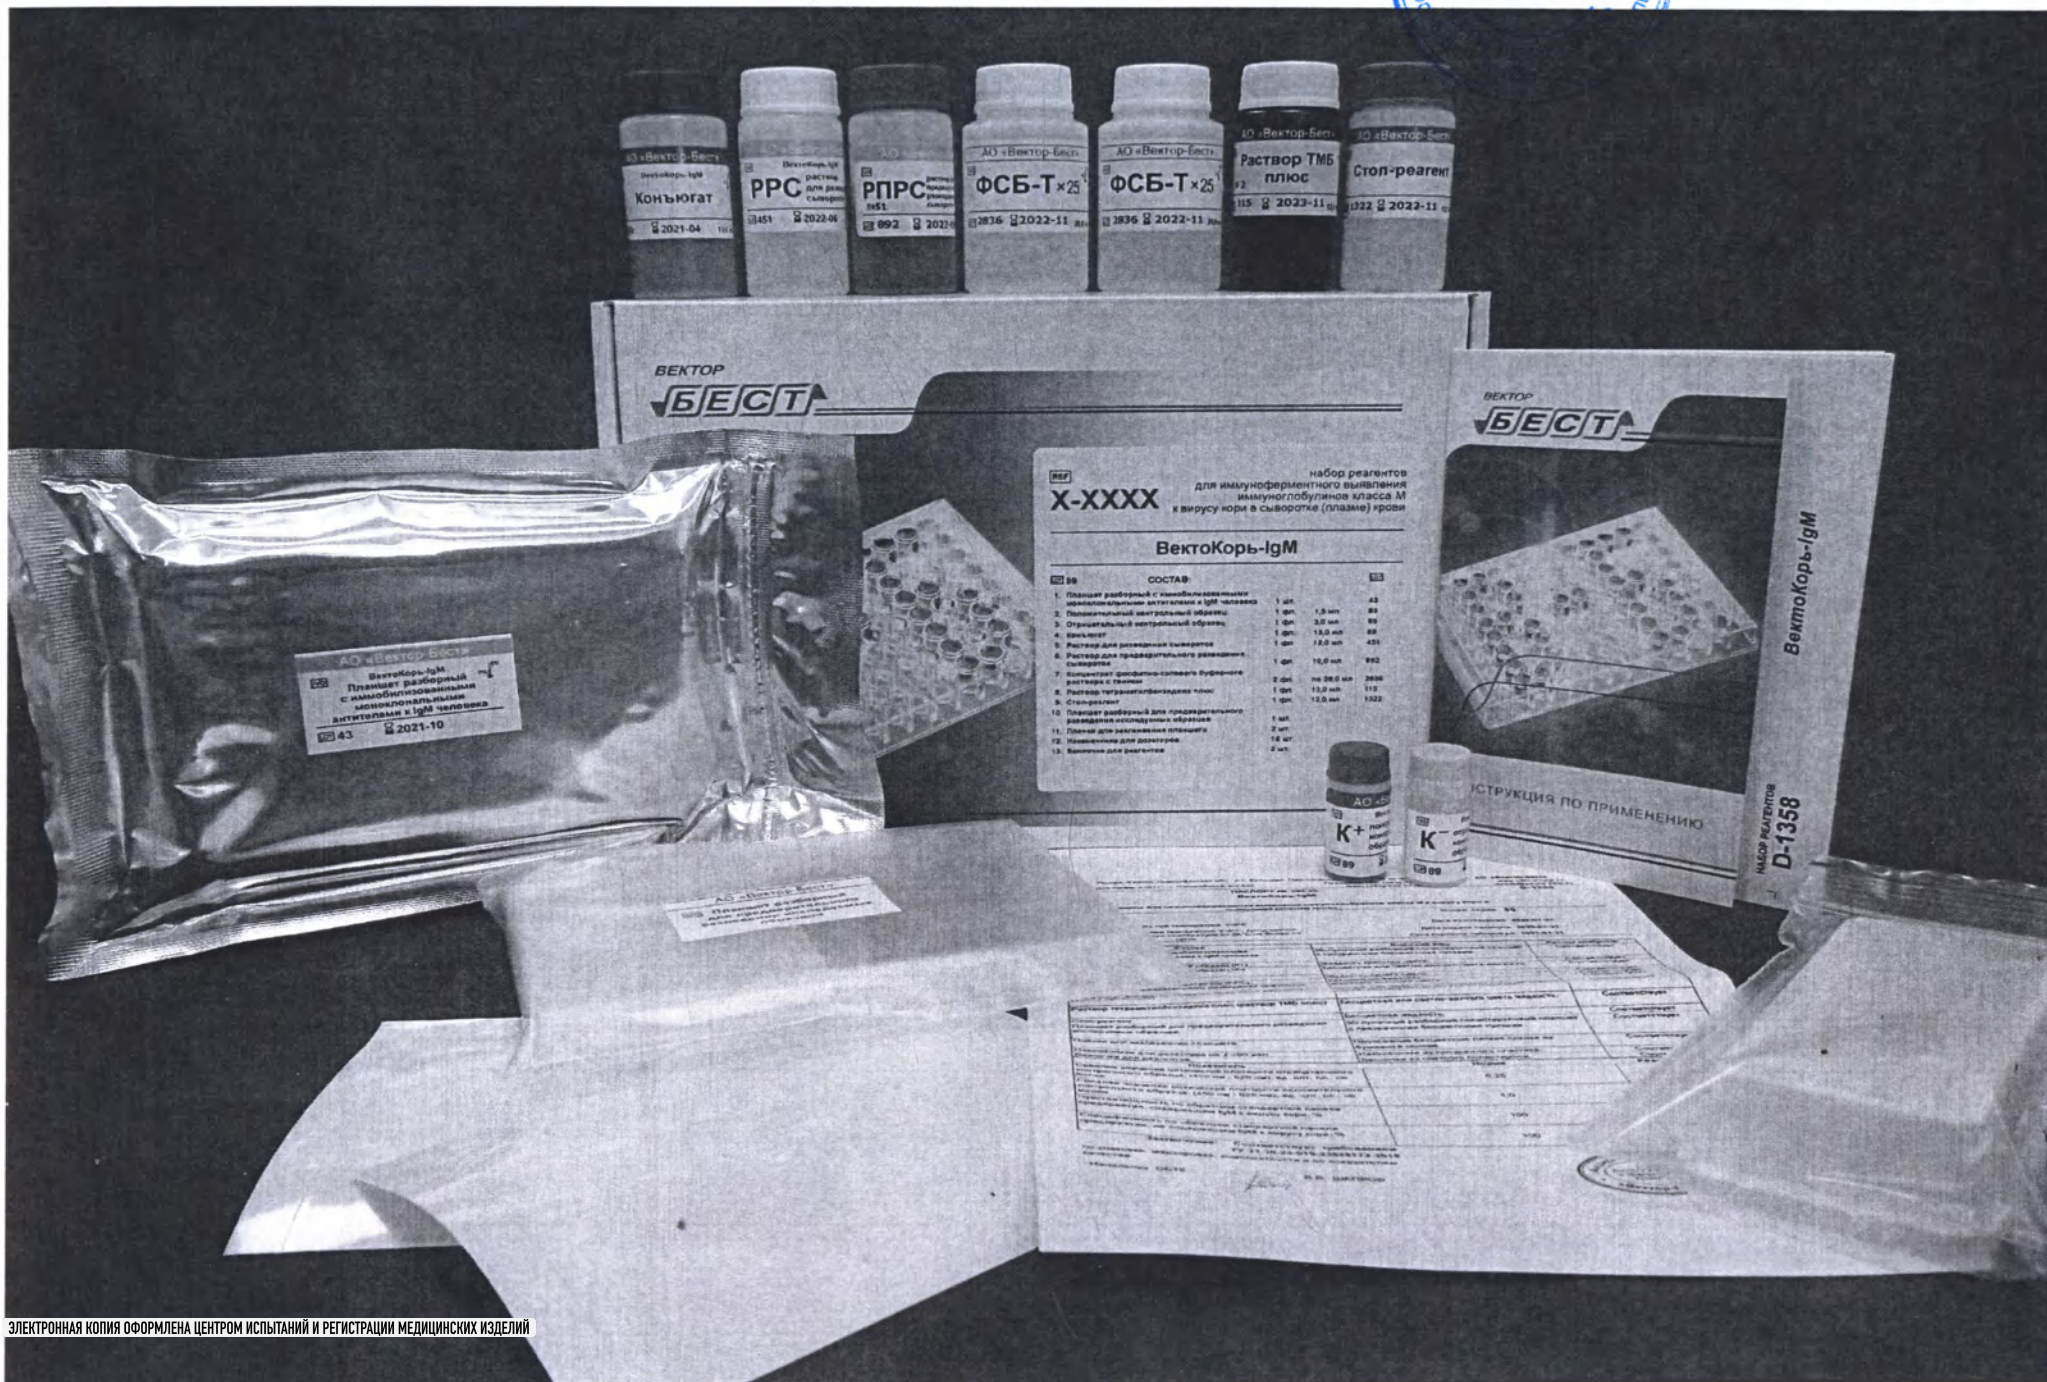

ВЕКТОР

БЕСТ

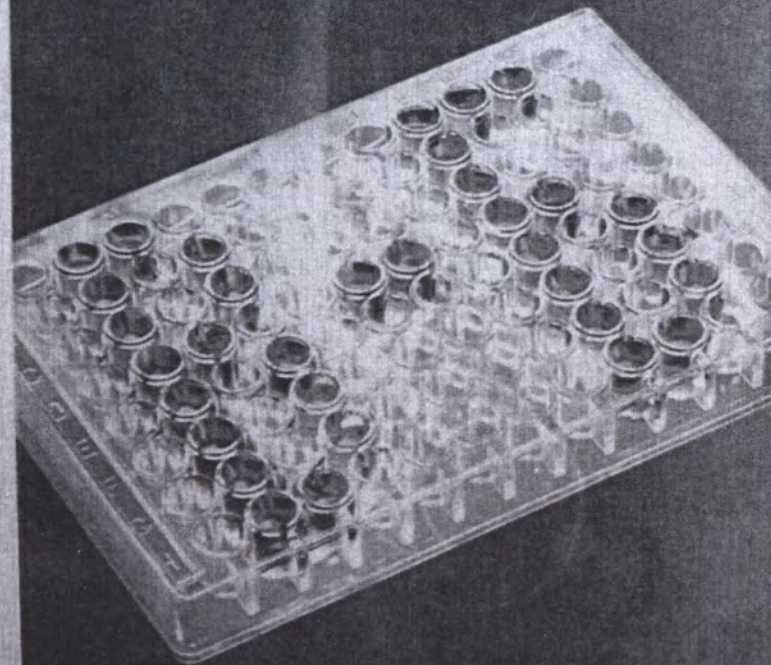

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови

ВектоКорь-IgM

LOT 89

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		43
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	89
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	3,0 мл	89
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	89
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	451
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	892
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2836
8. Раствор тетраметилбензида плюс	1 фл.	13,0 мл	115
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1322
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		



БЕКТОР

БЕСТ



REF **X-XXXX**

Σ 12x8

LOT

89

ТУ 21.20.23-019-23548172-2018

ПУ № РЗН 2019/8635 от 18.07.2019



2020-01-31



2021-01-31

ВектоКорь-IgM

iVD



13583101210008900008

Контрольные образцы инаktivированы

Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

