


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 1


Генеральный директор М.Д. Хусайнов
 АО “Вектор-Бест” “04” 06/2019 г.

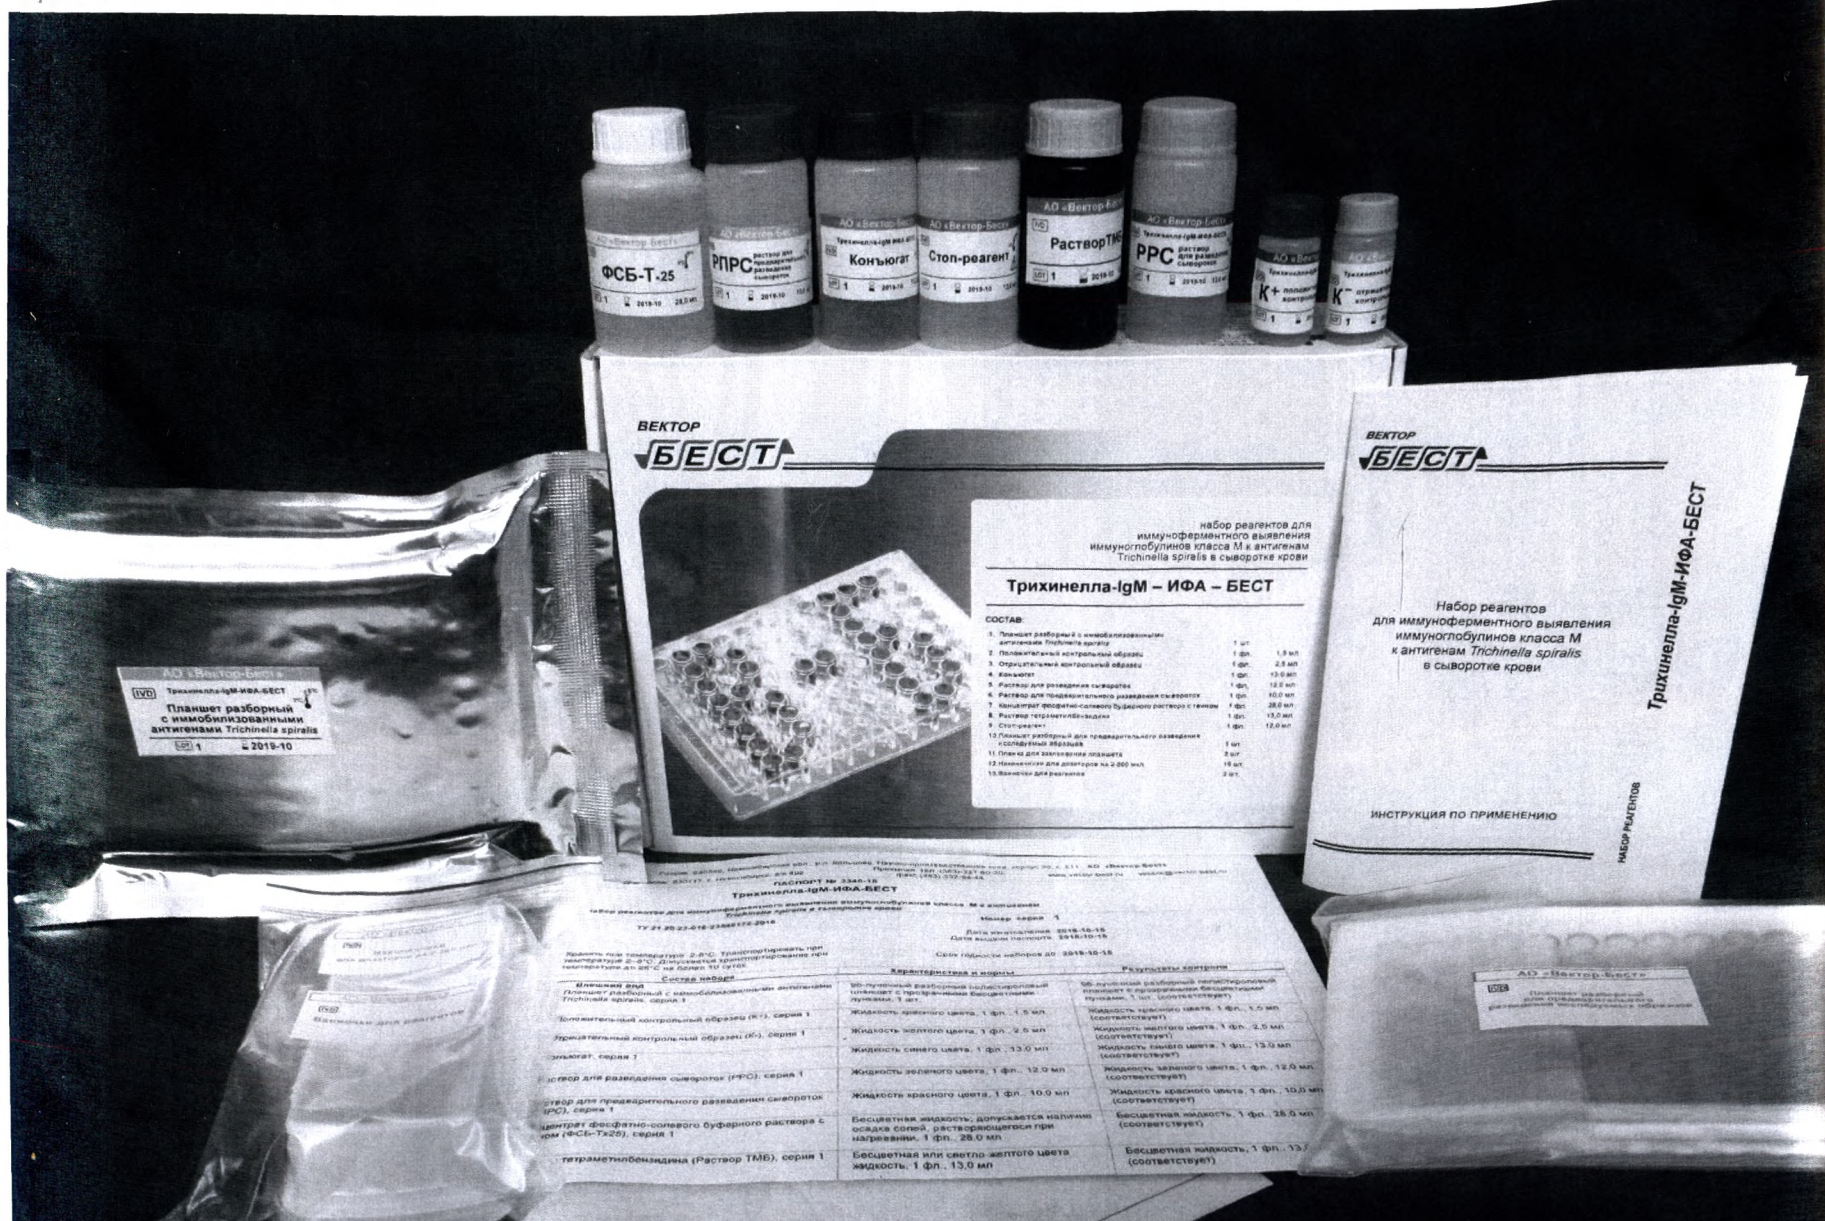

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов
“07 06” 2019 г.

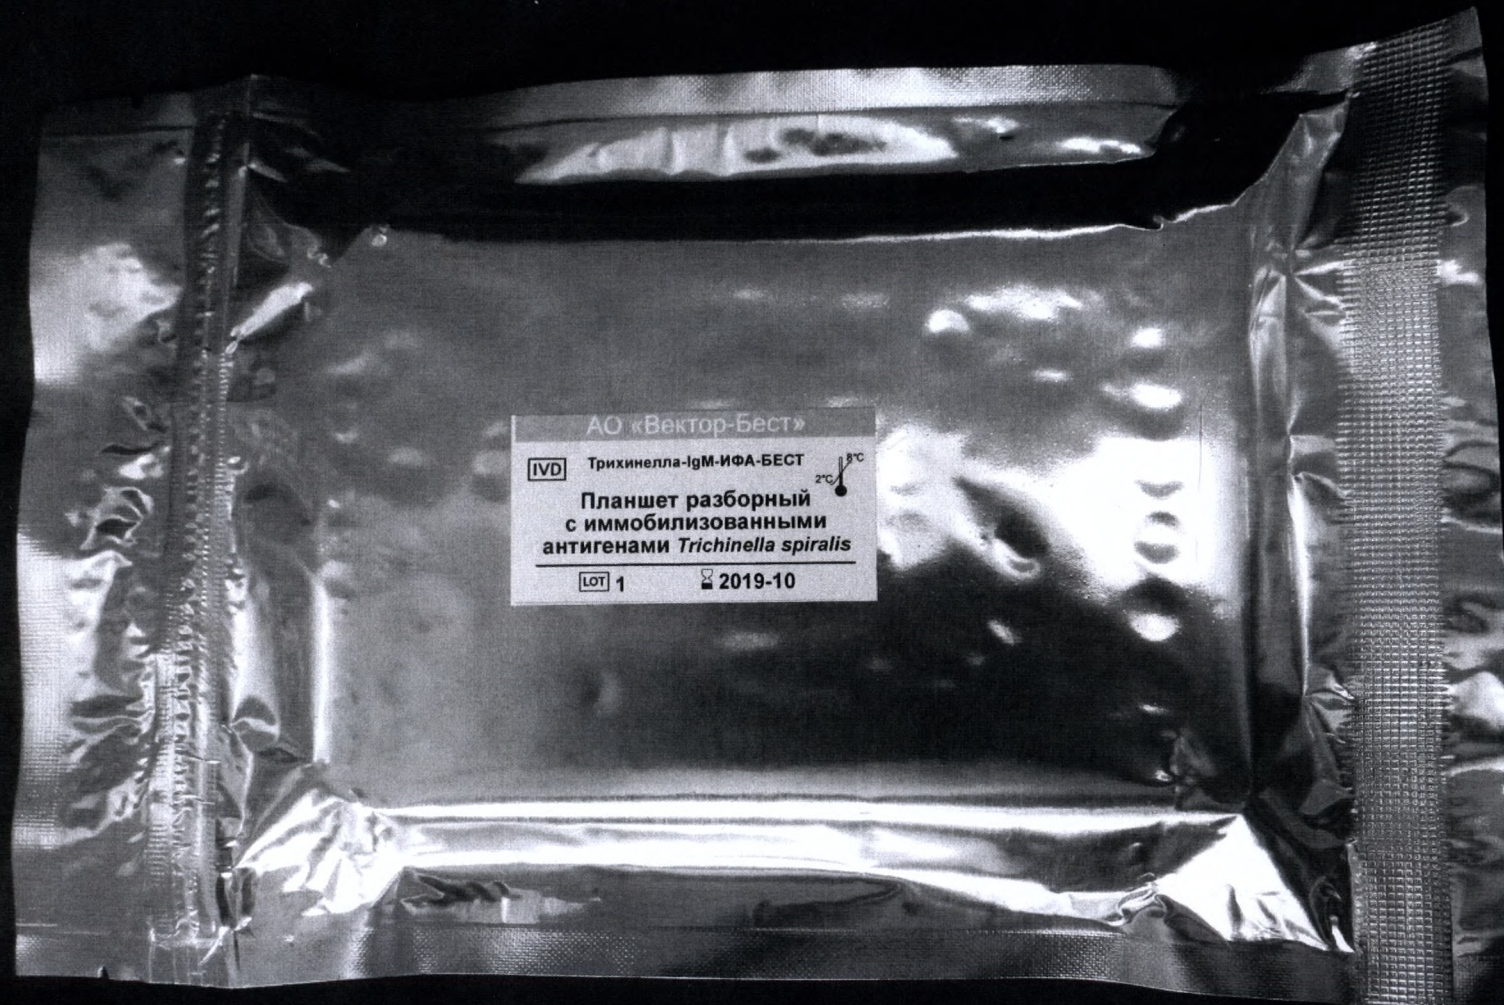

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусайнов
“04” 06 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусанов
“09” 06 2019 г.

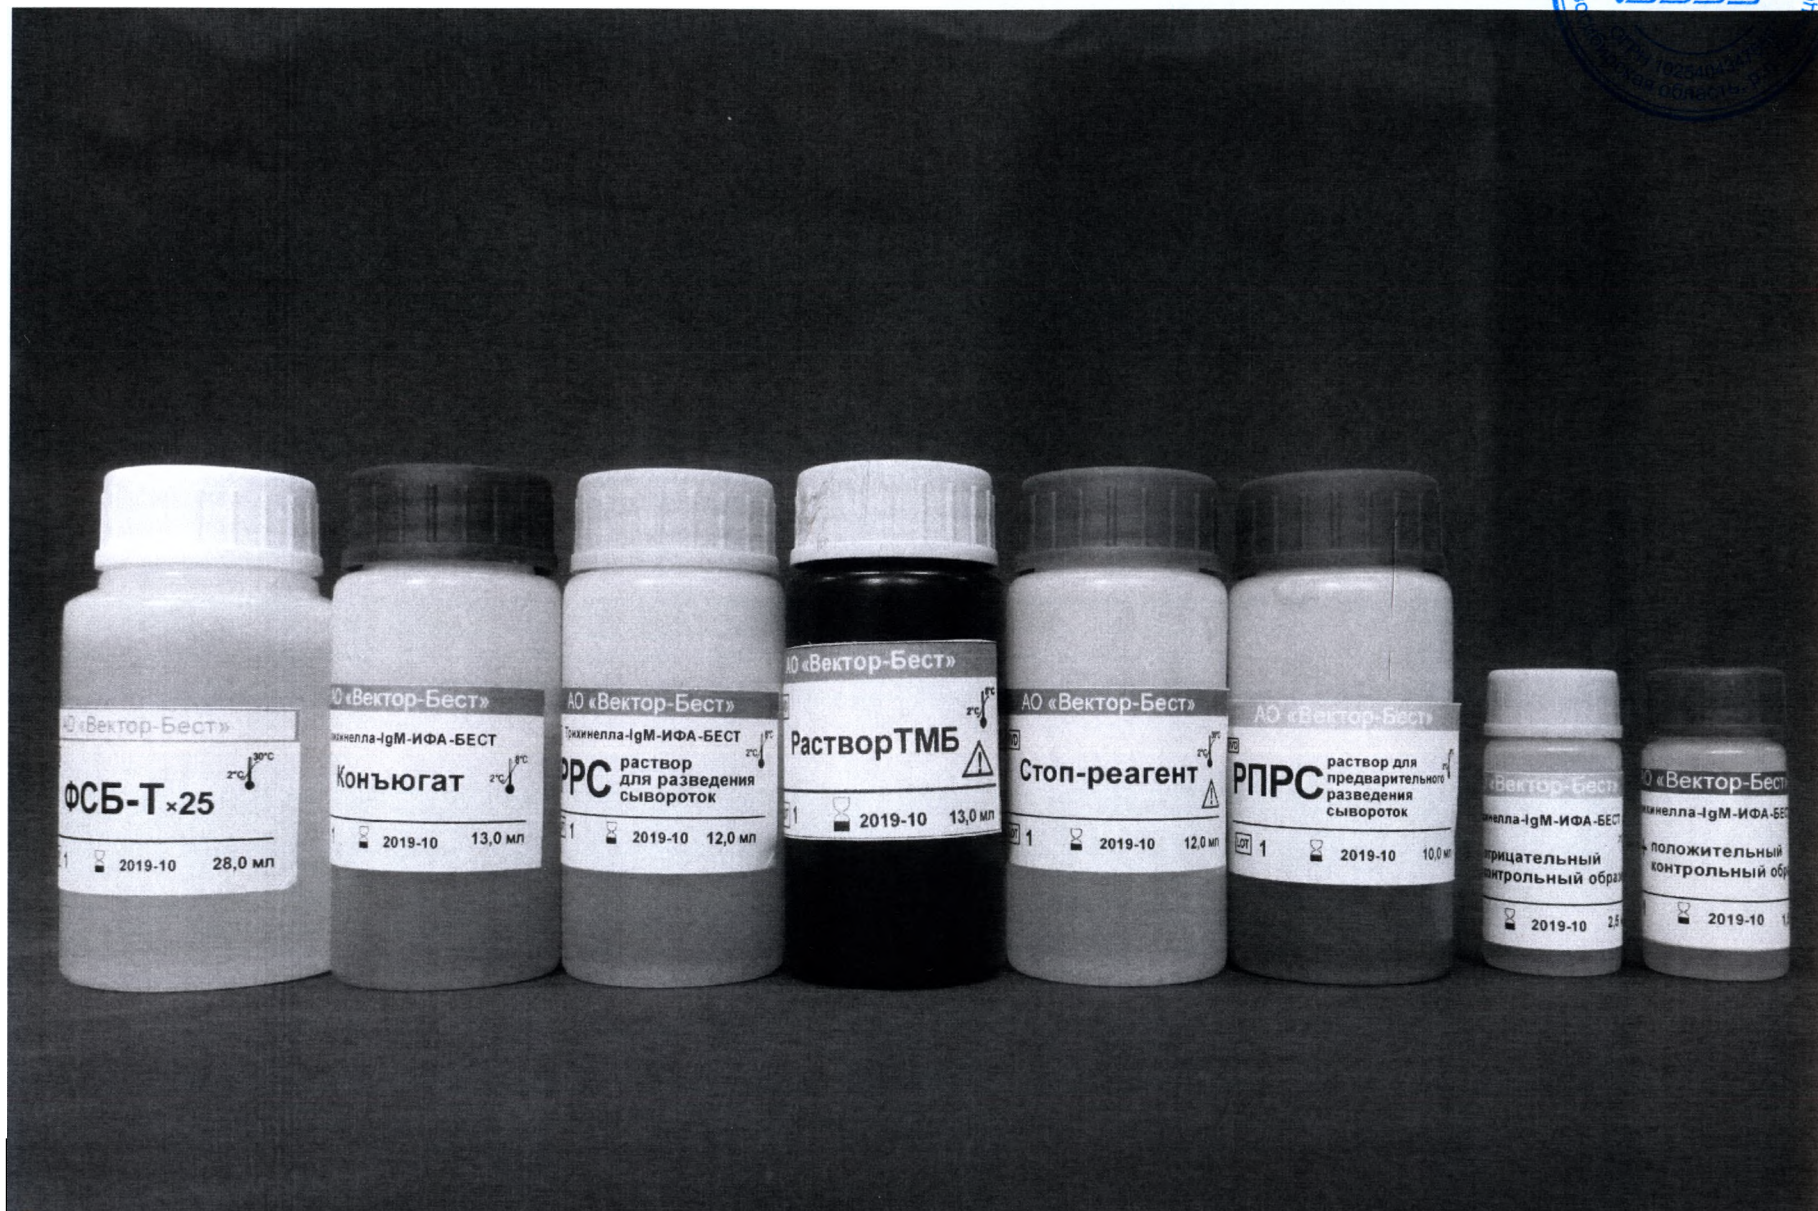

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов

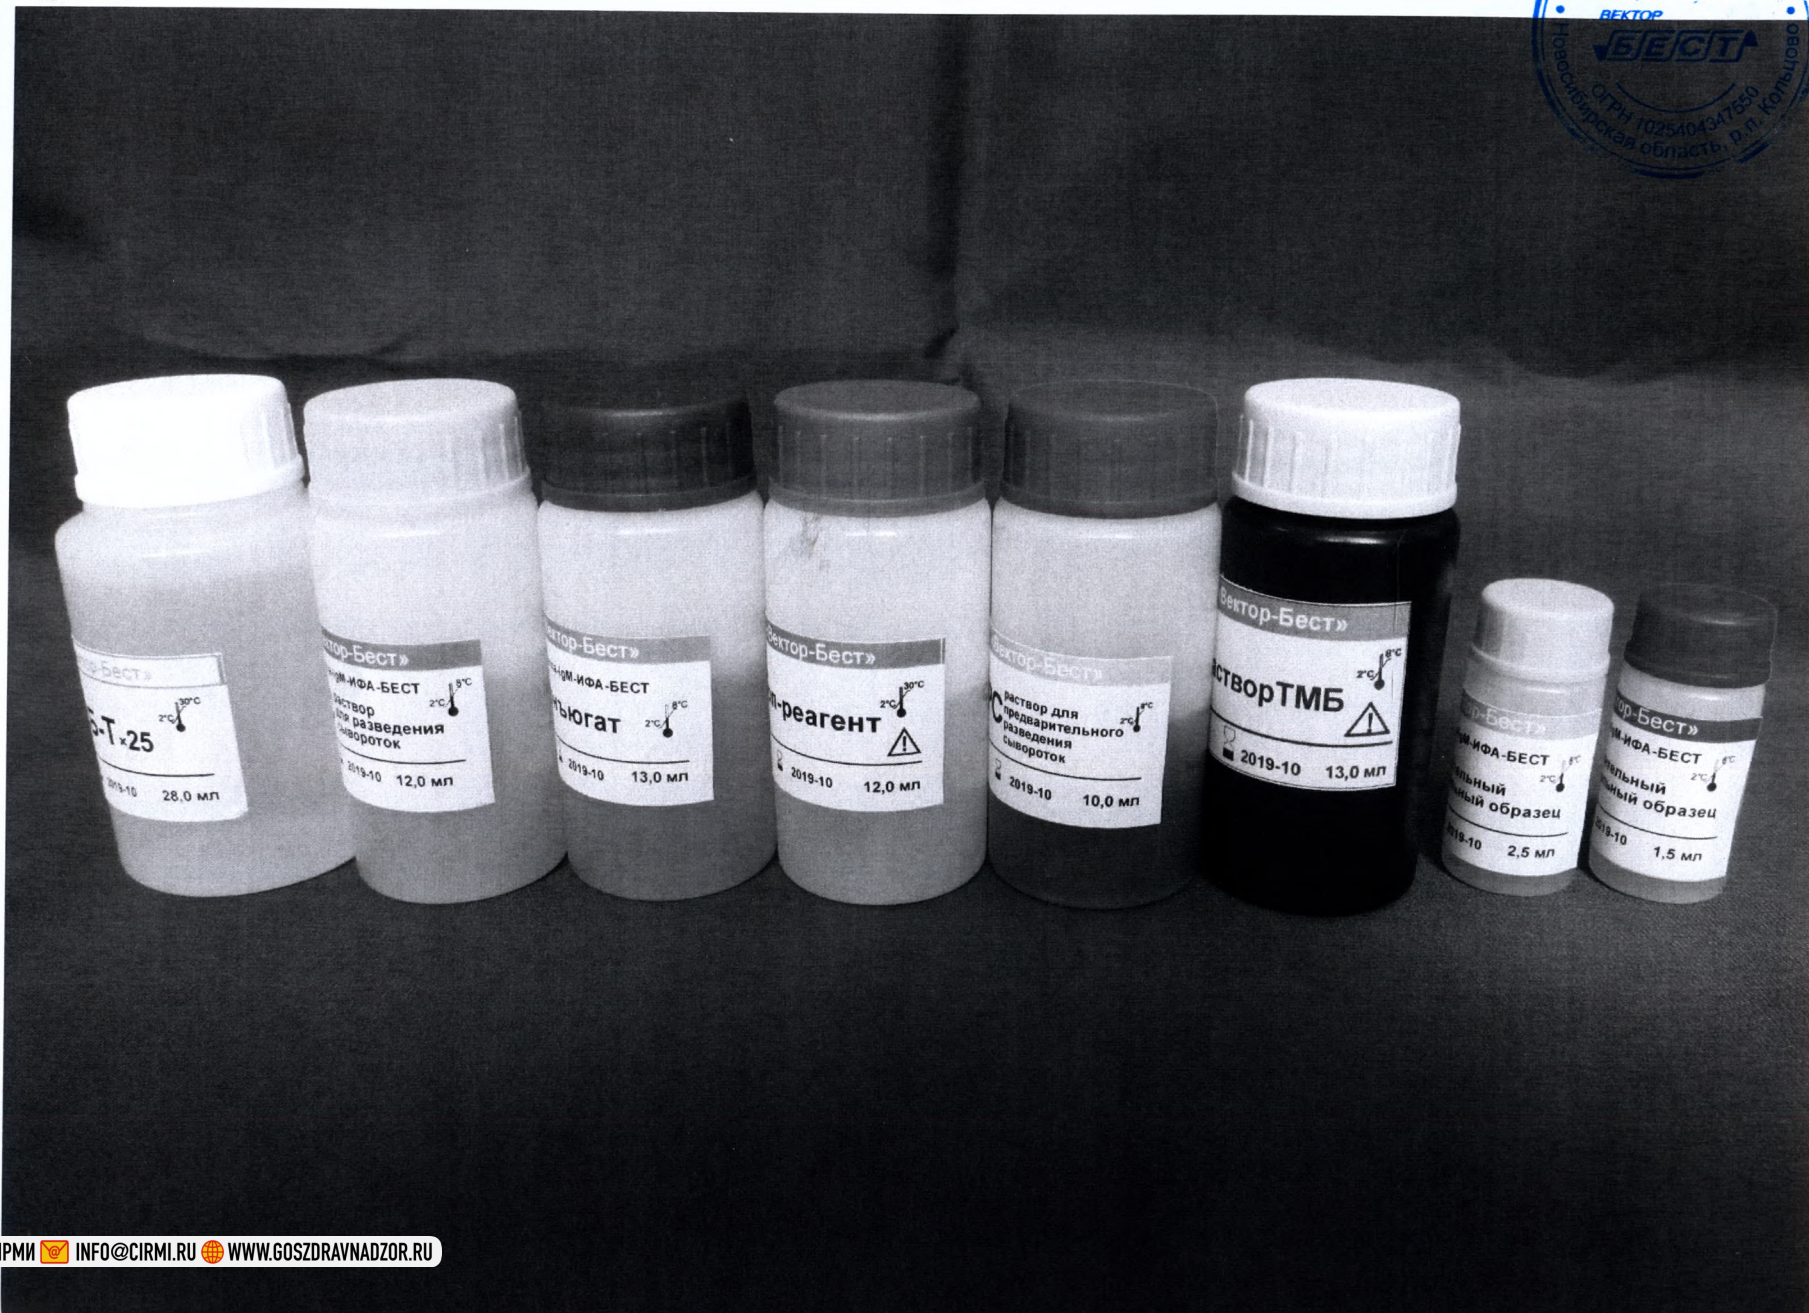


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgМ-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

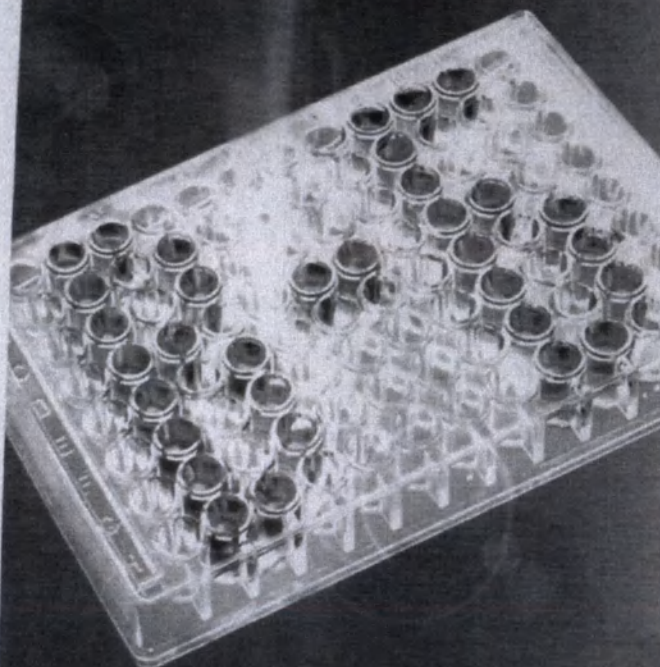

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к антигенам
Trichinella spiralis в сыворотке крови

Трихинелла-IgM – ИФА – БЕСТ

СОСТАВ:


1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Trichinella spiralis</i>	1 шт.	
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	2,5 мл
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

“04” 06/


М.Д. Хусайнов
2019 г.

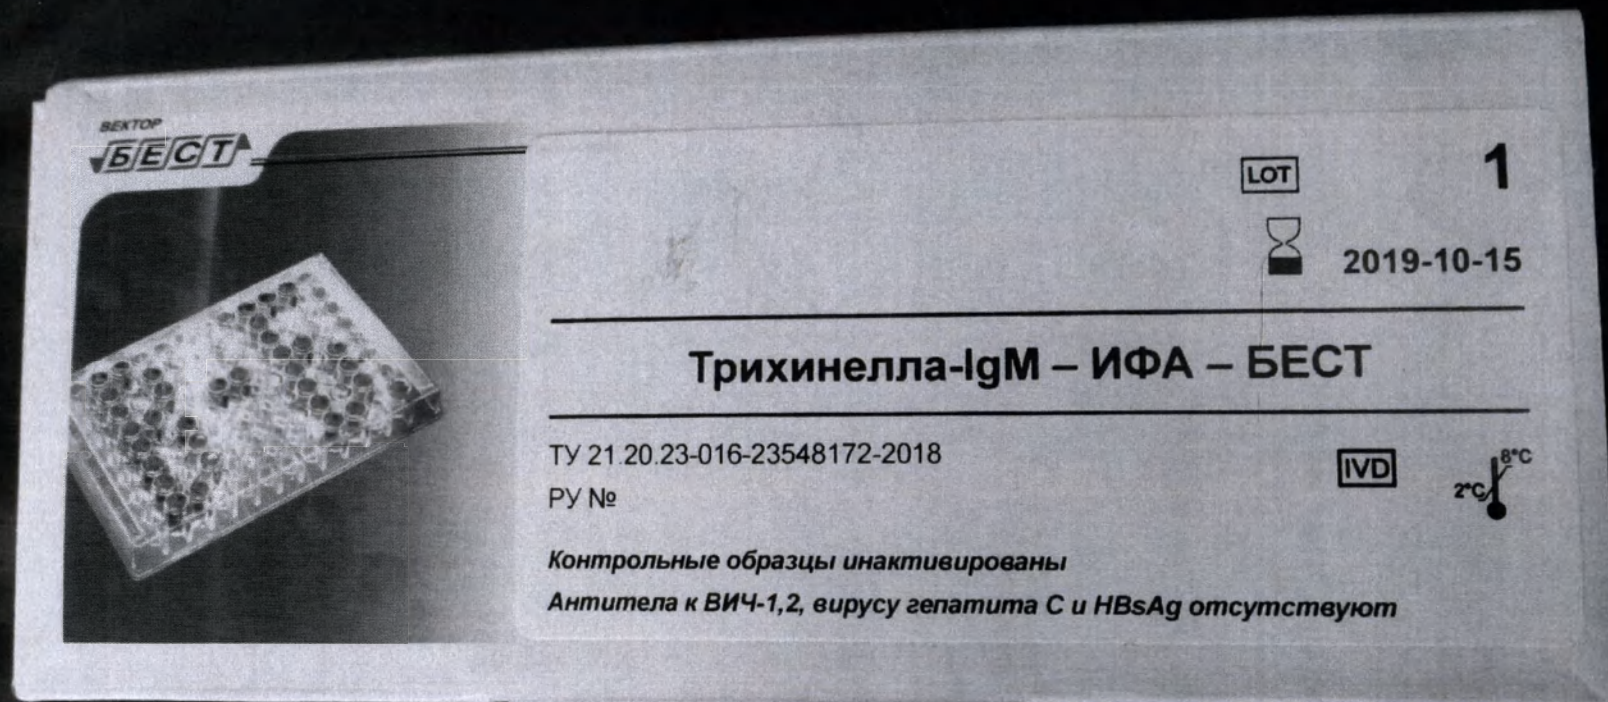

“04” 06 / 2019 年

Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ”
серия 2

025404347550
область, р.п. Колпино

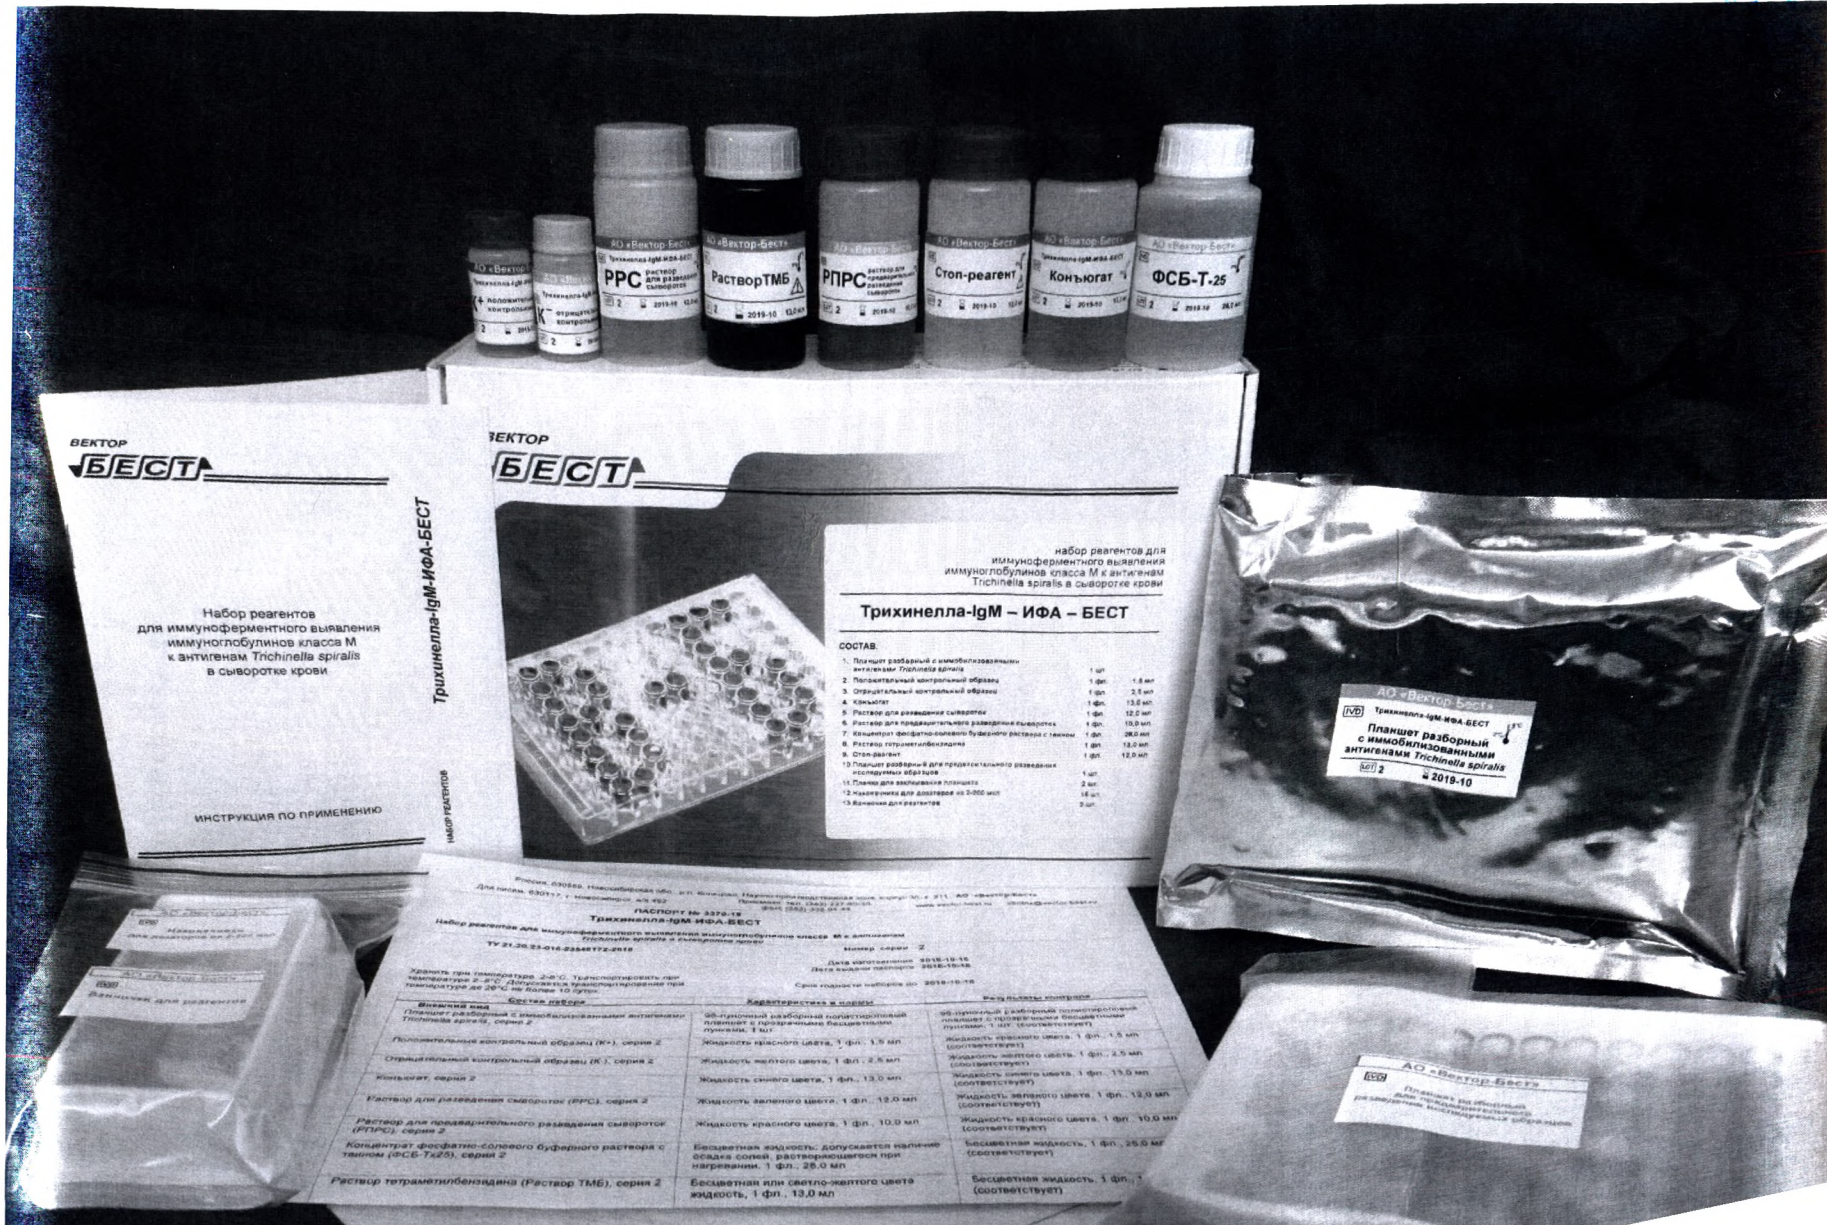


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов

2019 г.

“04” 06

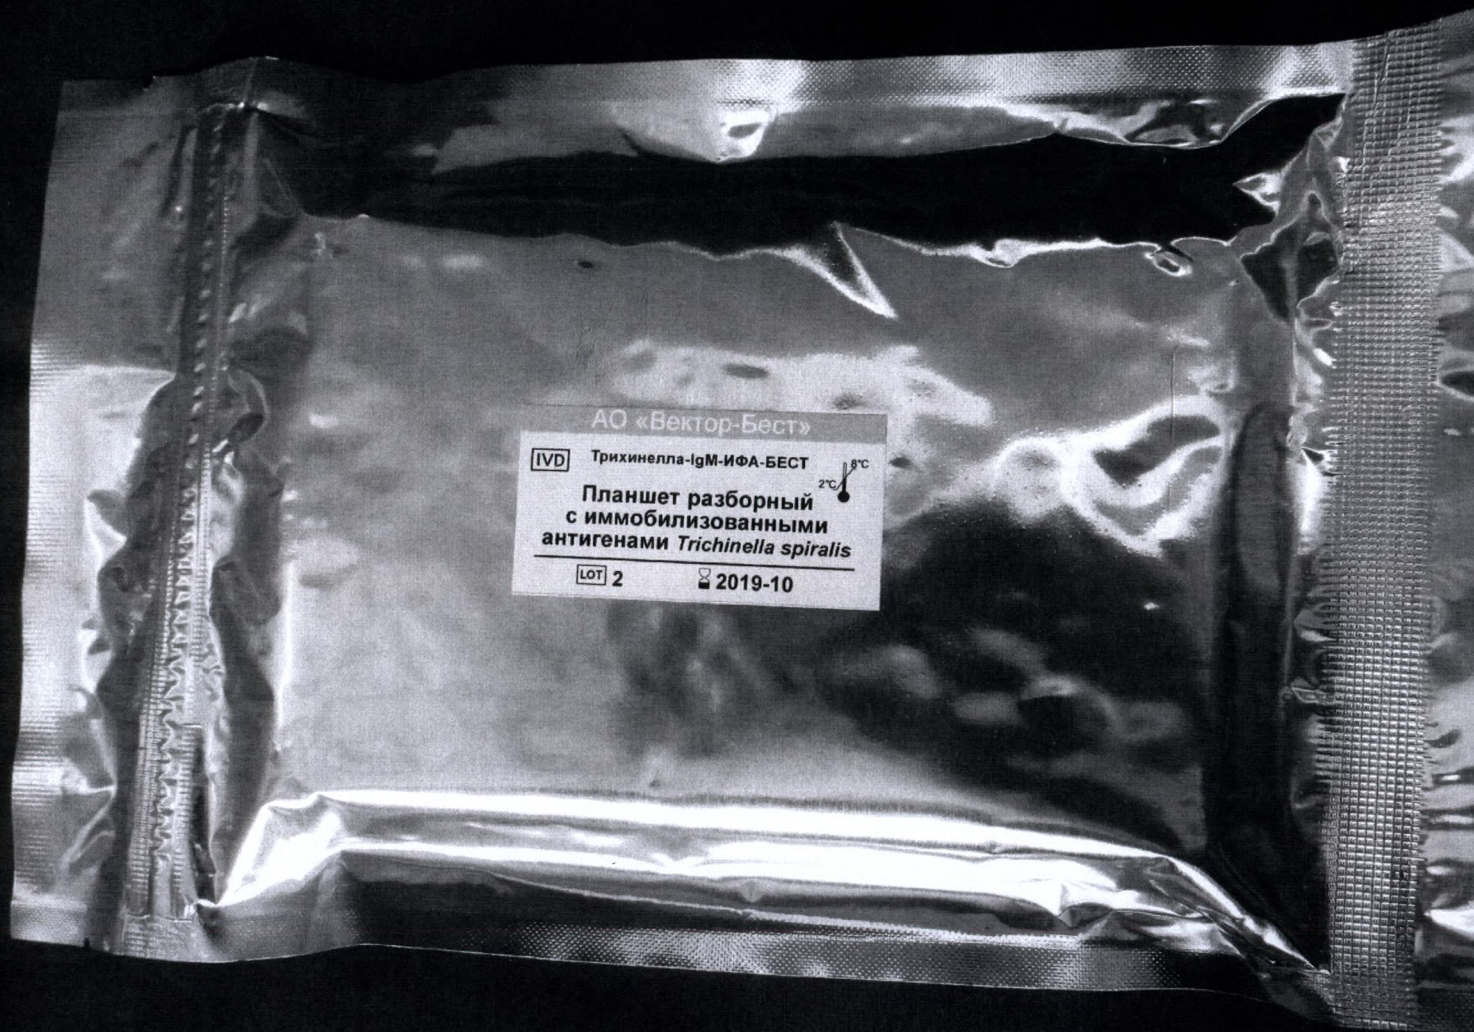


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов

“04” 06/ 2019 г.

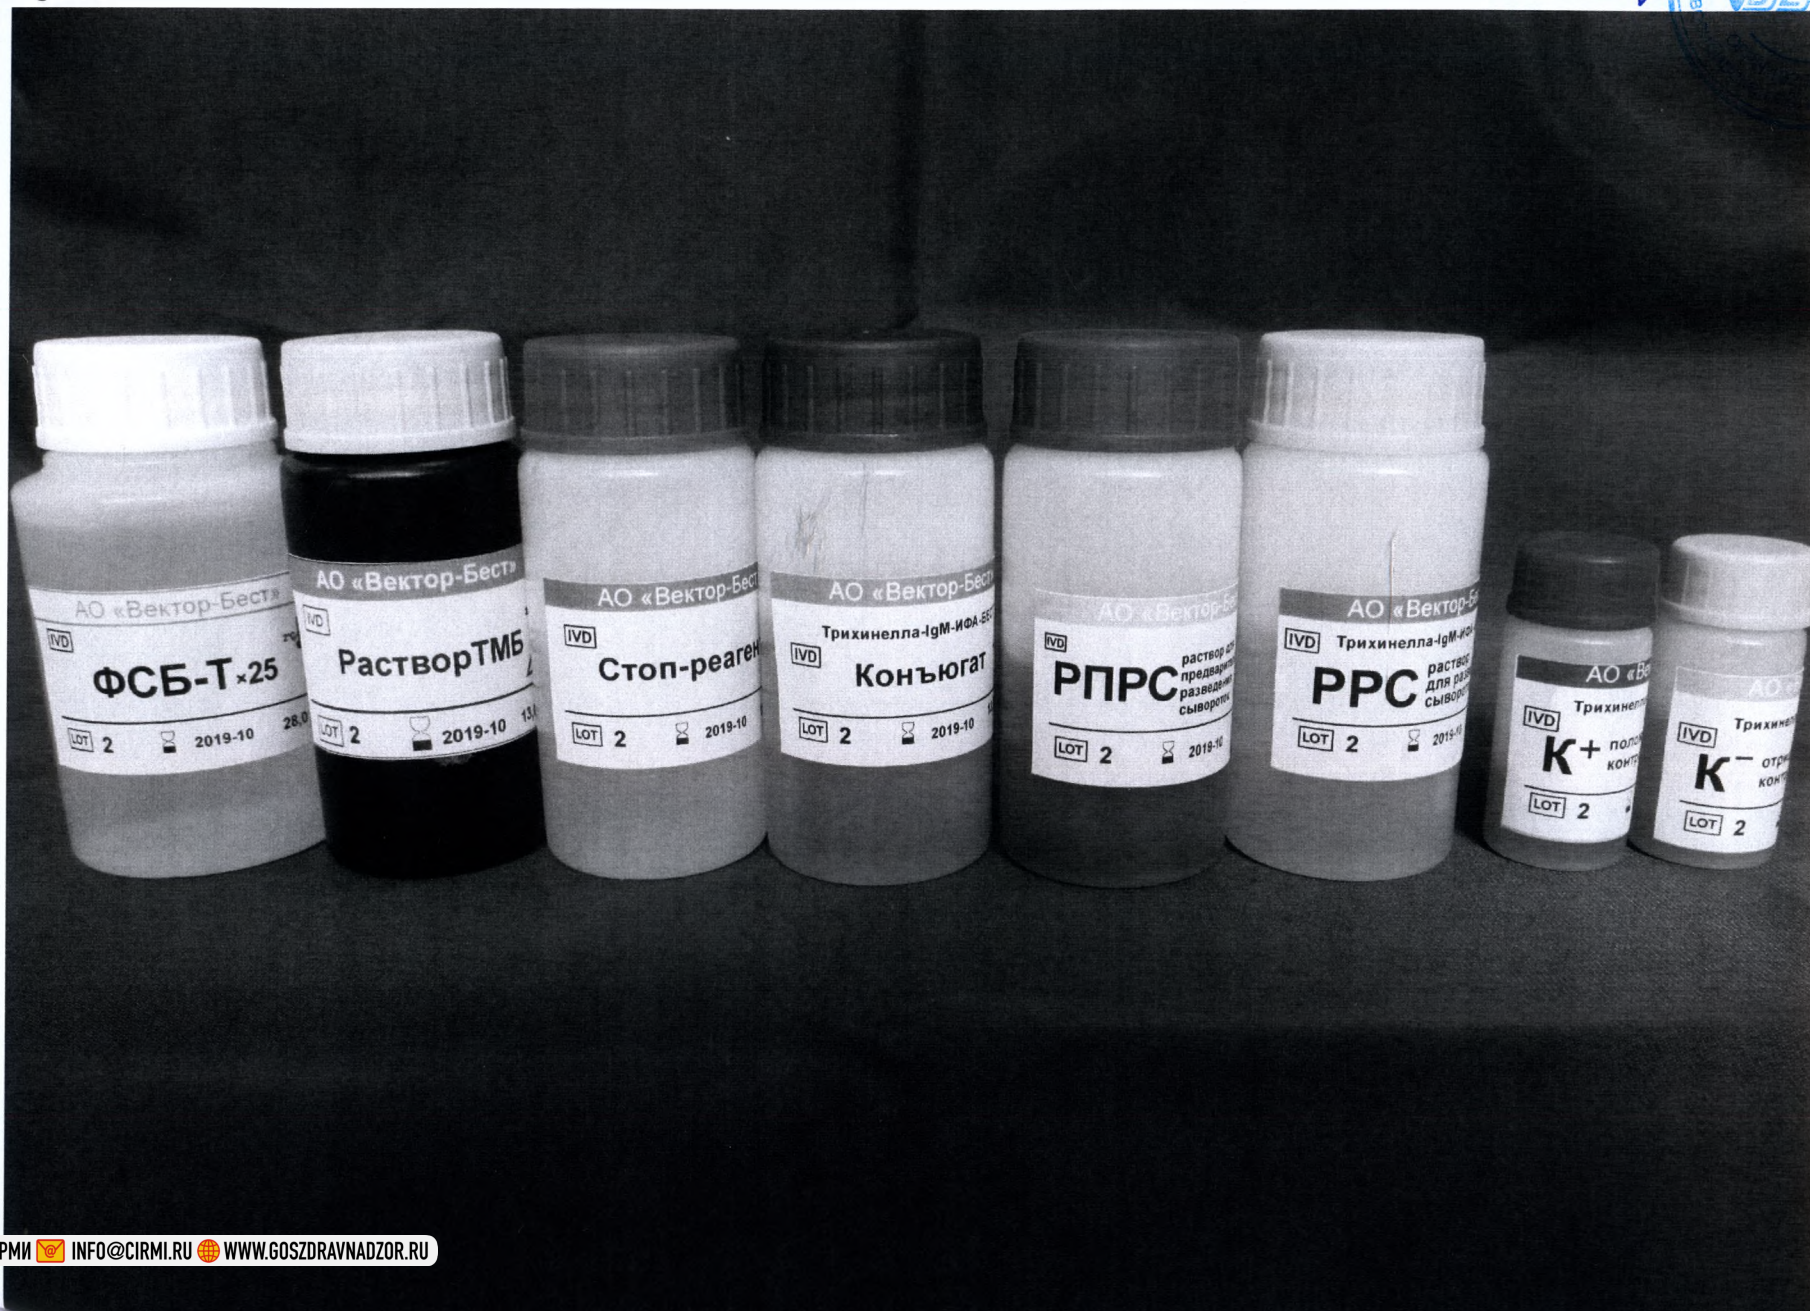

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2019 г.


“04” 06/



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
“04” 06 / 2019 г.
АО “Вектор-Бест”
Общество с ограниченной ответственностью
г. Кольцово, Р.П.
04347550

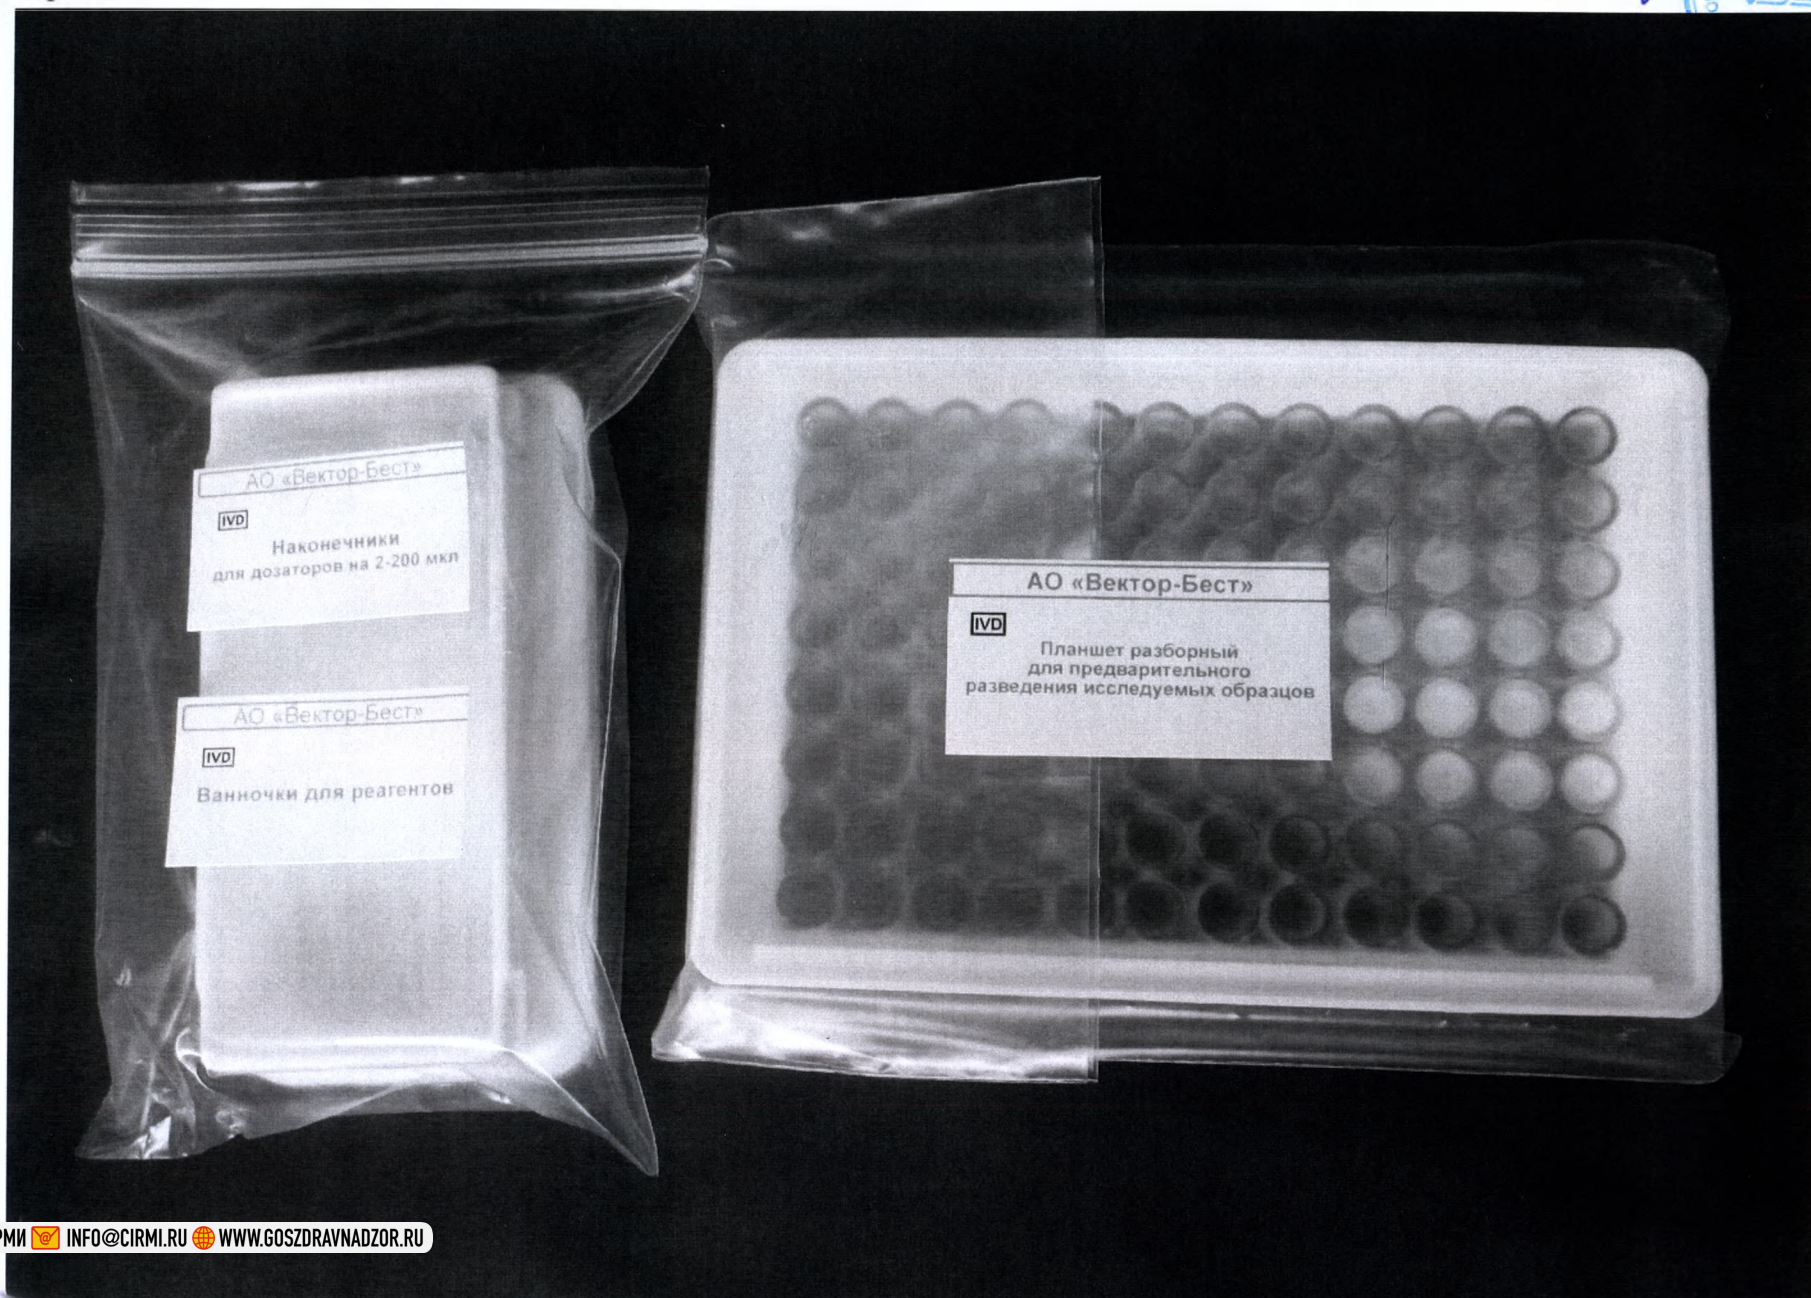

ВЕКТОР

БЕСТ

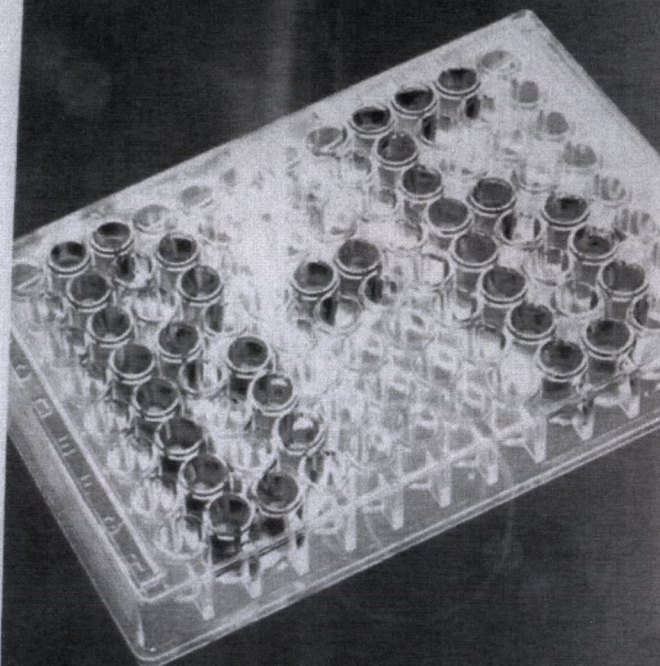

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к антигенам
Trichinella spiralis в сыворотке крови

Трихинелла-IgM – ИФА – БЕСТ

СОСТАВ:


1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Trichinella spiralis</i>	1 шт.	
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	2,5 мл
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусайнов
2019 г.

“04” 06

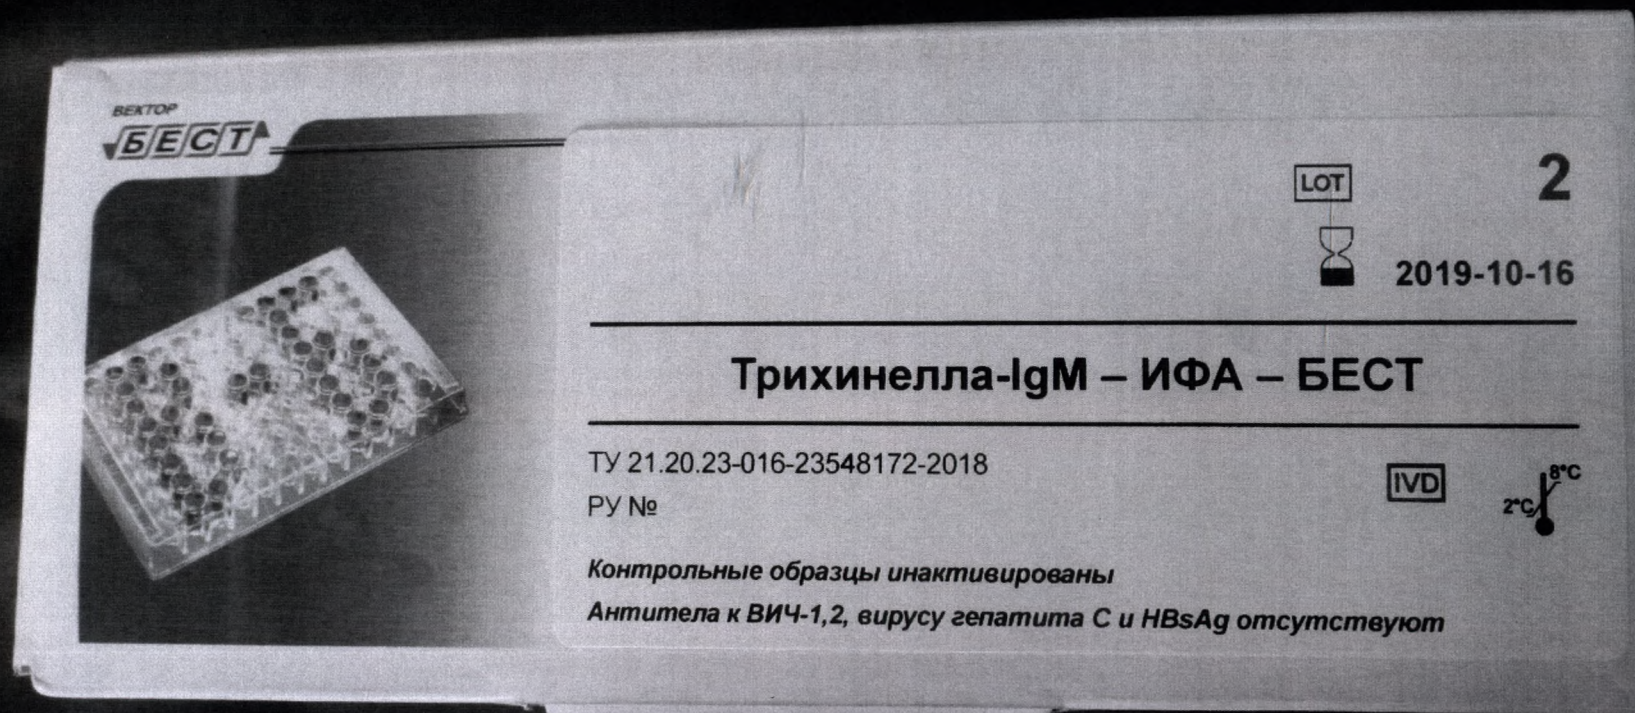



**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М
к антигенам *Trichinella spiralis* в сыворотке крови
(Трихинелла-IgМ-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “Трихинелла-IgМ-ИФА-БЕСТ”

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Trichinella spiralis</i>	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	
Ванночки для реагентов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка.

набор реагентов для
иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
класса М к антигенам *Trichinella spiralis*
в сыворотке крови

Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ

состав:

1. Планшет разборный с иммобилизованными
антигенами *Trichinella spiralis*

1 шт.

2. Положительный контрольный образец

1 фл., 1,5 мл

3. Отрицательный контрольный образец

1 фл., 2,5 мл

4. Конъюгат

1 фл., 13,0 мл

5. Раствор для разведения сывороток

1 фл., 12,0 мл

6. Раствор для предварительного
разведения сывороток

1 фл., 10,0 мл

7. Концентрат фосфатно-солевого
буферного раствора с твином

1 фл., 28,0 мл

8. Раствор тетраметилбензидина

1 фл., 13,0 мл

9. Стоп-реагент

1 фл., 12,0 мл

10. Планшет разборный для предварительного
разведения исследуемых образцов

1 шт.

11. Пленки для заклеивания планшета

2 шт.

12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл

16 шт.

13. Ванночки для реагентов

2 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2

2.2. Боковая этикетка № 1.


LOT XXXX	
XXXX-XX-XX	
Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ	
ТУ 21.20.23-016-23548172-2018 РУ №	IVD 2°C 8°C
<i>Контрольные образцы инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>	

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
« 04 » 06 2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



А.В. Масяго
А.В. Масяго
2019 г.