

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЭФА»




Лютикова Ю.А.

**Фотографические изображения медицинского изделия**

**Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-0202-ЭФА по ТУ 26.60.13-022-34305805-2017**

2018


Блок ЭХВЧ ШГИЕ 941612.0202.01

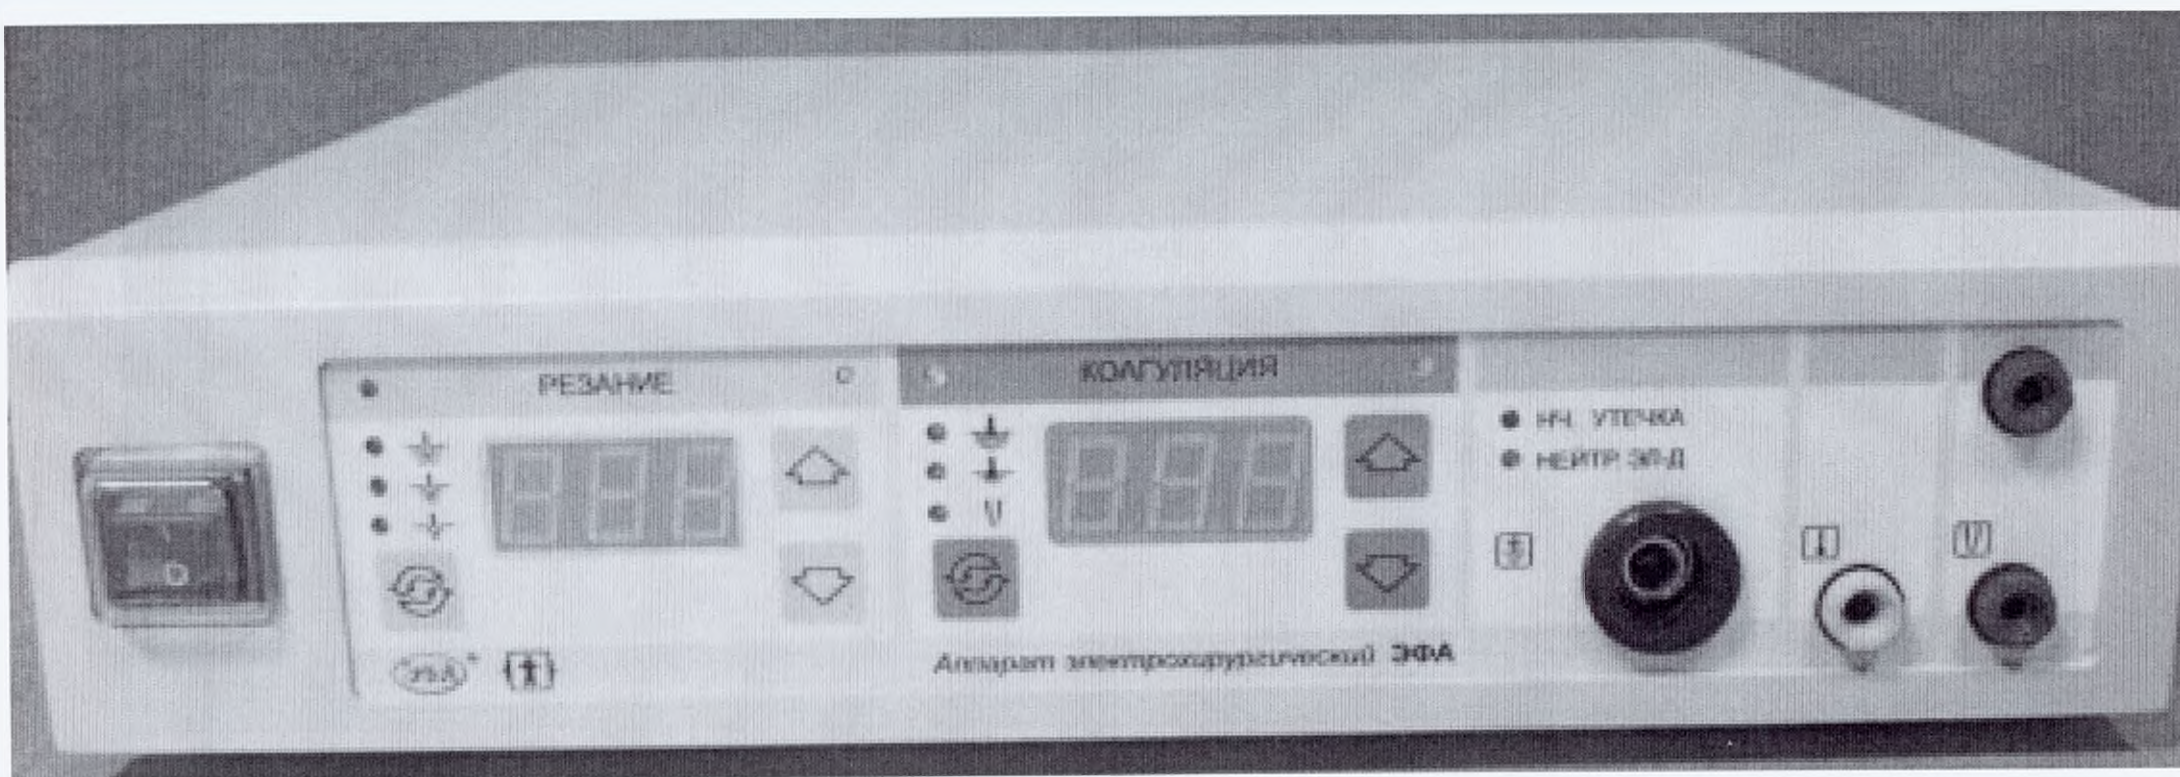


Блок ЭХВЧ ШГИЕ 941612.0202.01, модель 0202-1



Блок ЭХВЧ ШГИЕ 941612.0202.01, модель 0202-2

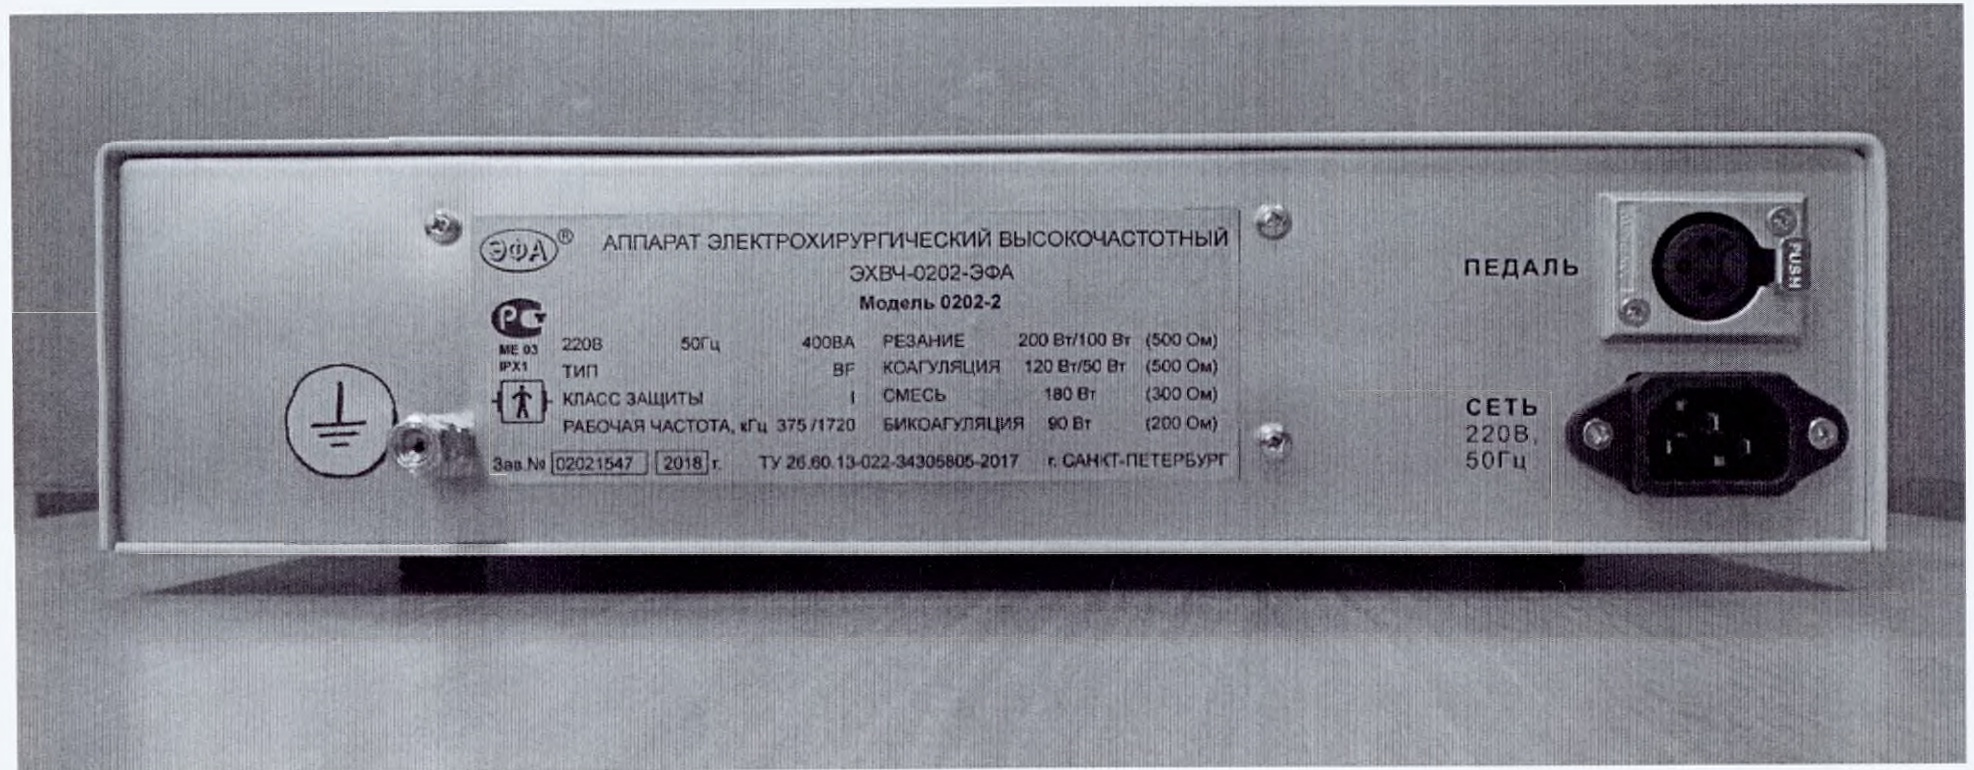

Блок ЭХВЧ ШГИЕ 941612.0202.01, модель 0202-3

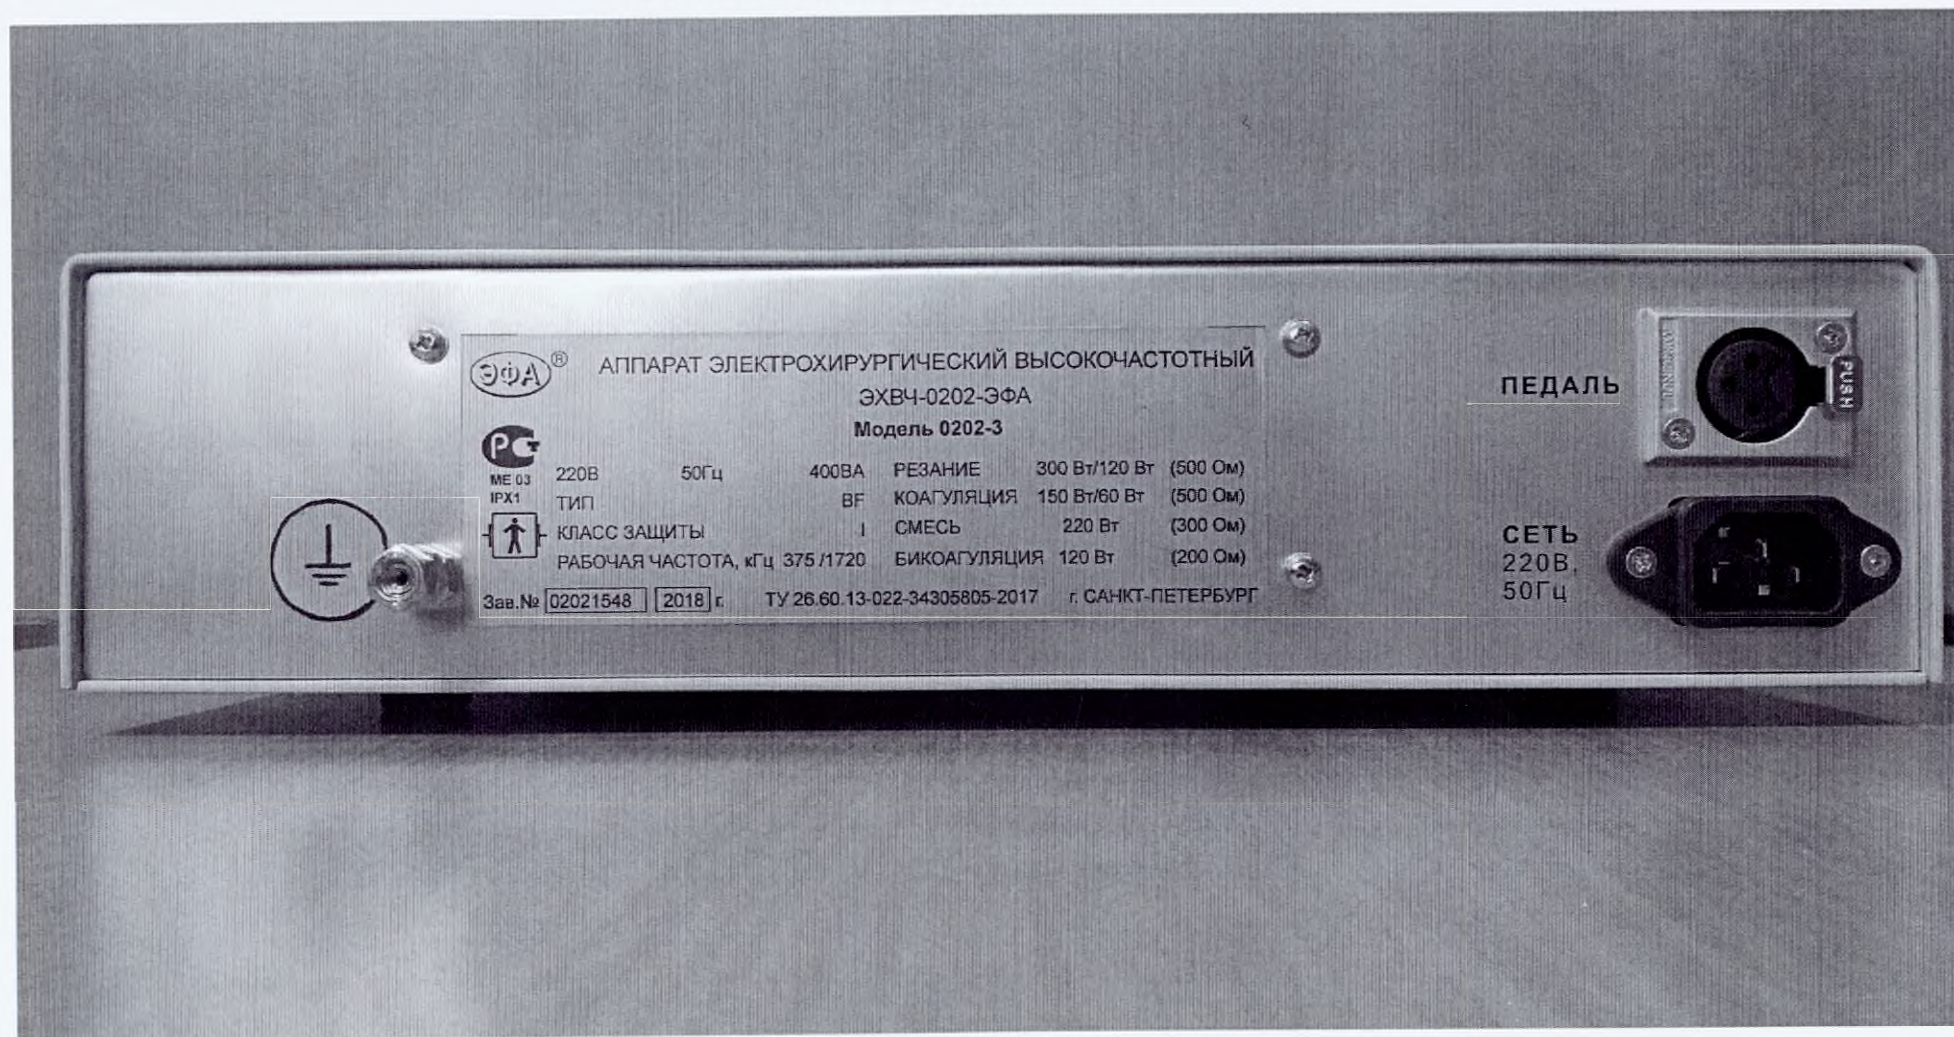


Сетевой шнур ШГИЕ 941612.0202.02




Педаль ШГИЕ 941612.0202.03



Кабель нейтрального электрода ШГИЕ 941612.0202.04

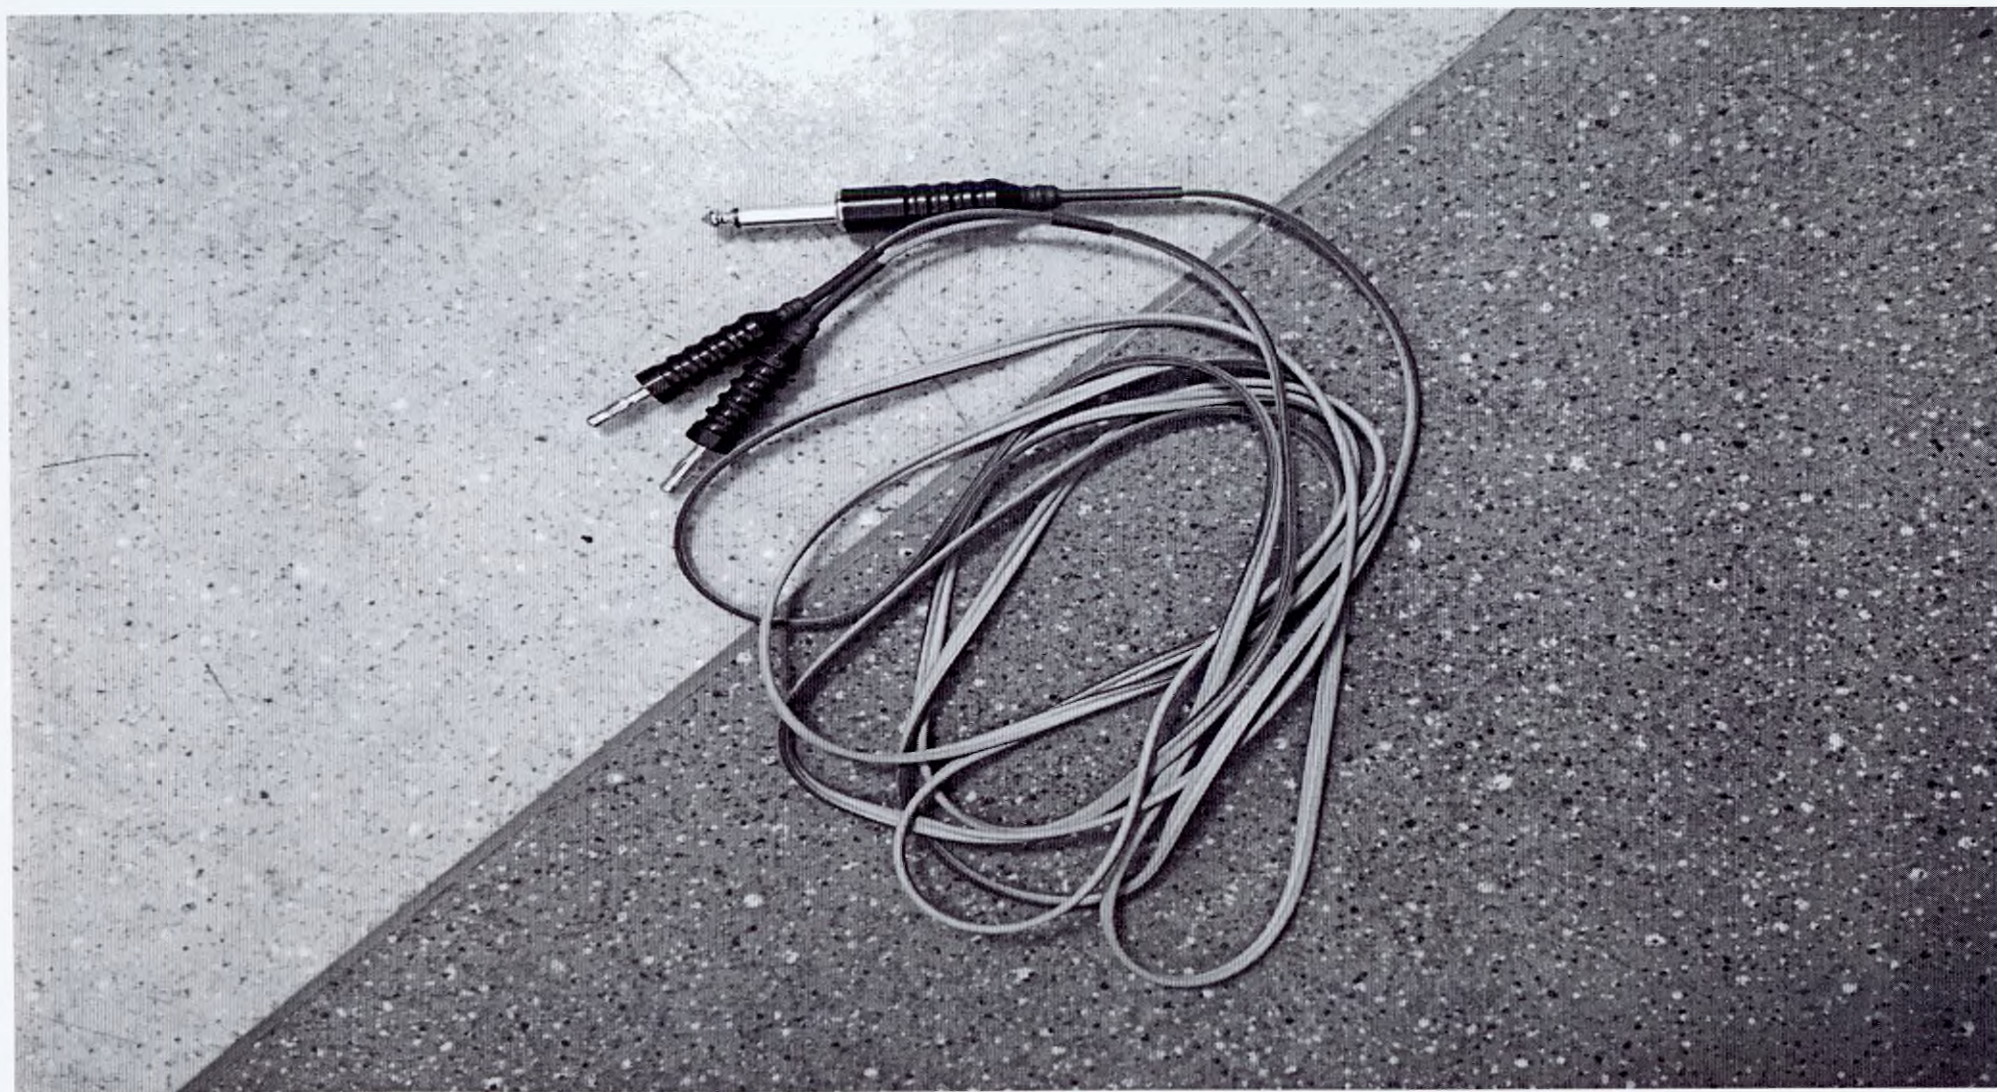


Нейтральный электрод ШГИЕ 941612.0202.05

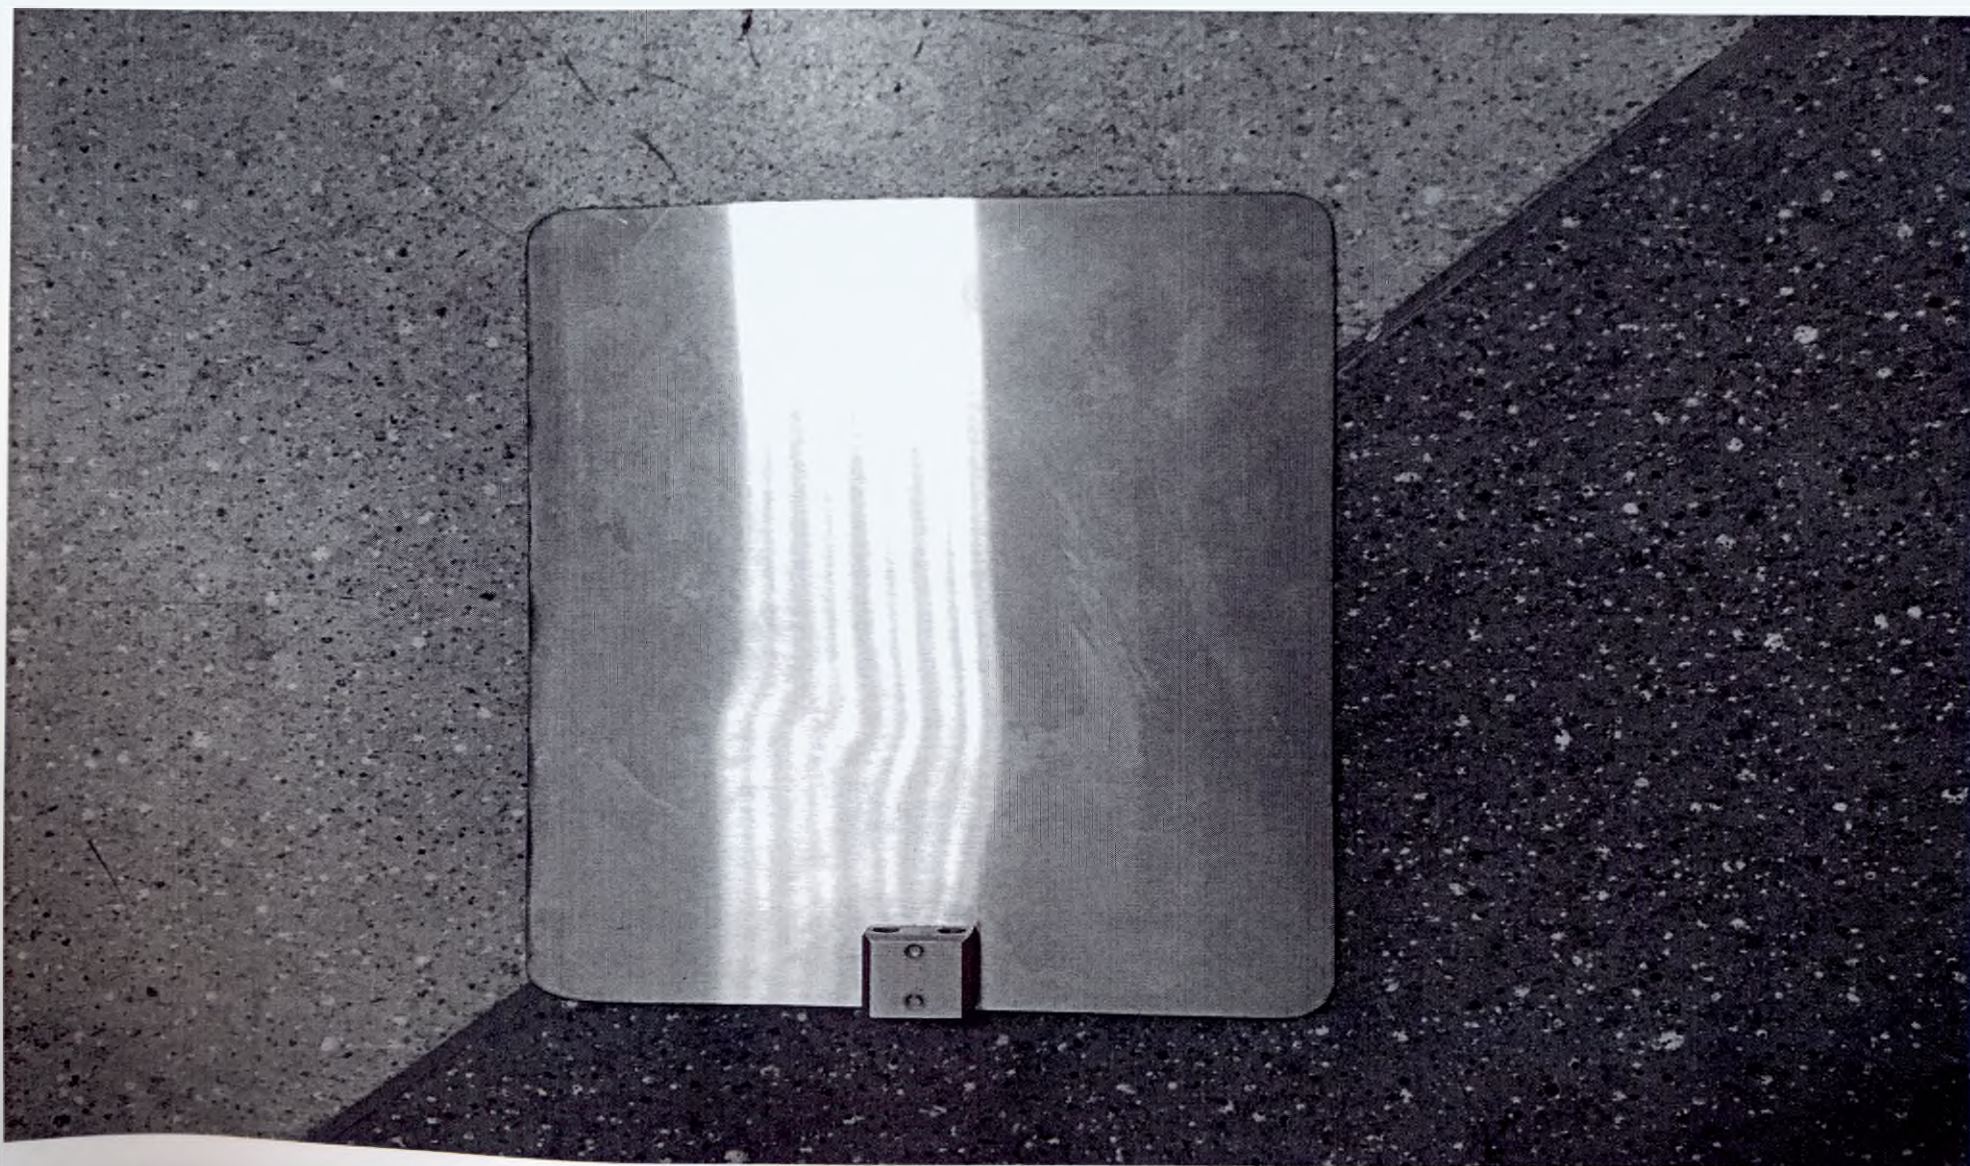


Кабель монополярного электрода ШГИЕ 941612.0202.06



Кабель биполярного электрода для пинцета ШГИЕ 941612.0202.07

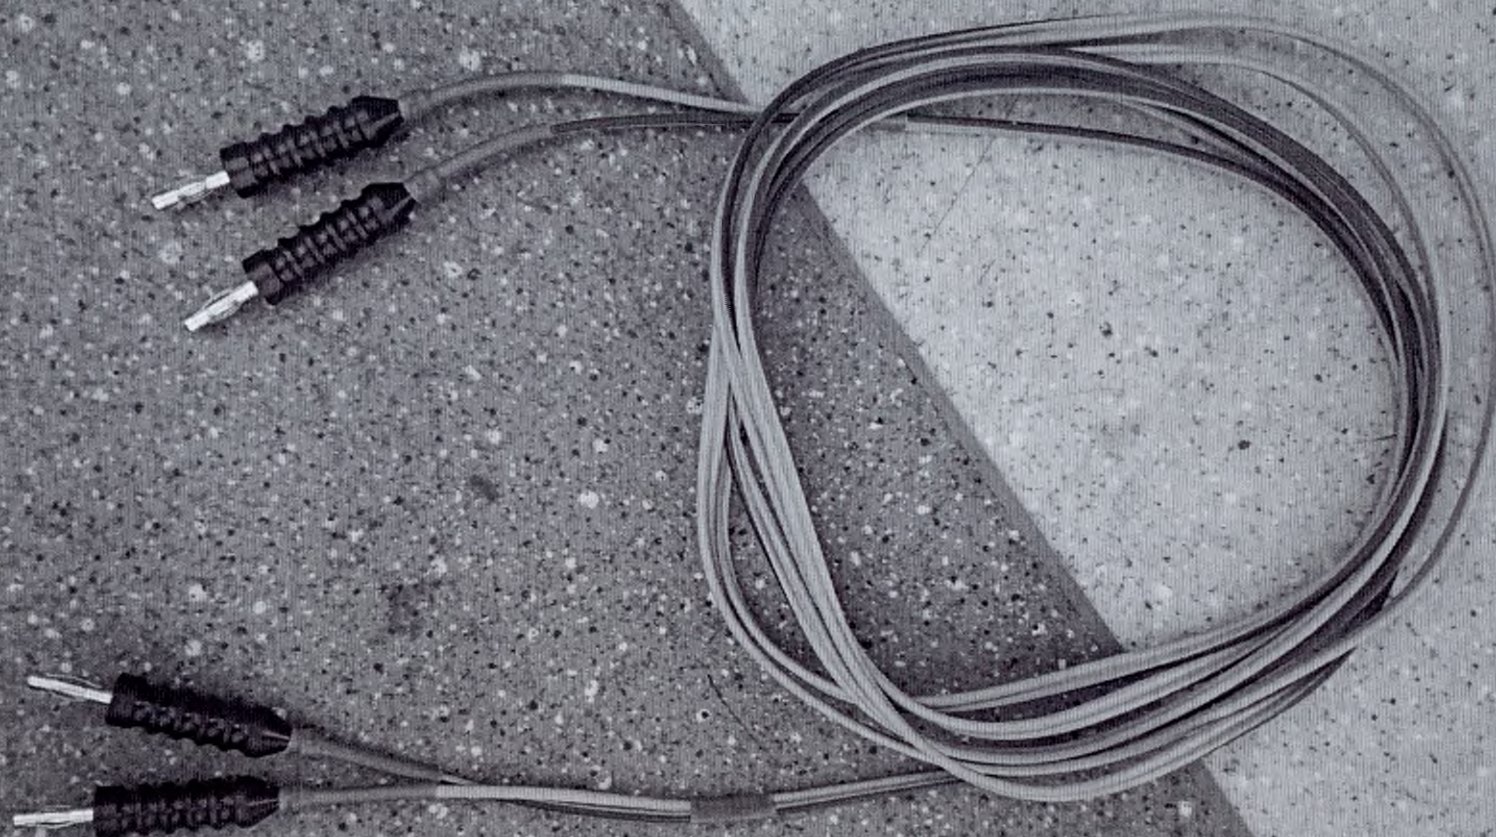

Кабель биполярного электрода лапароскопический ШГИЕ 941612.0202.08

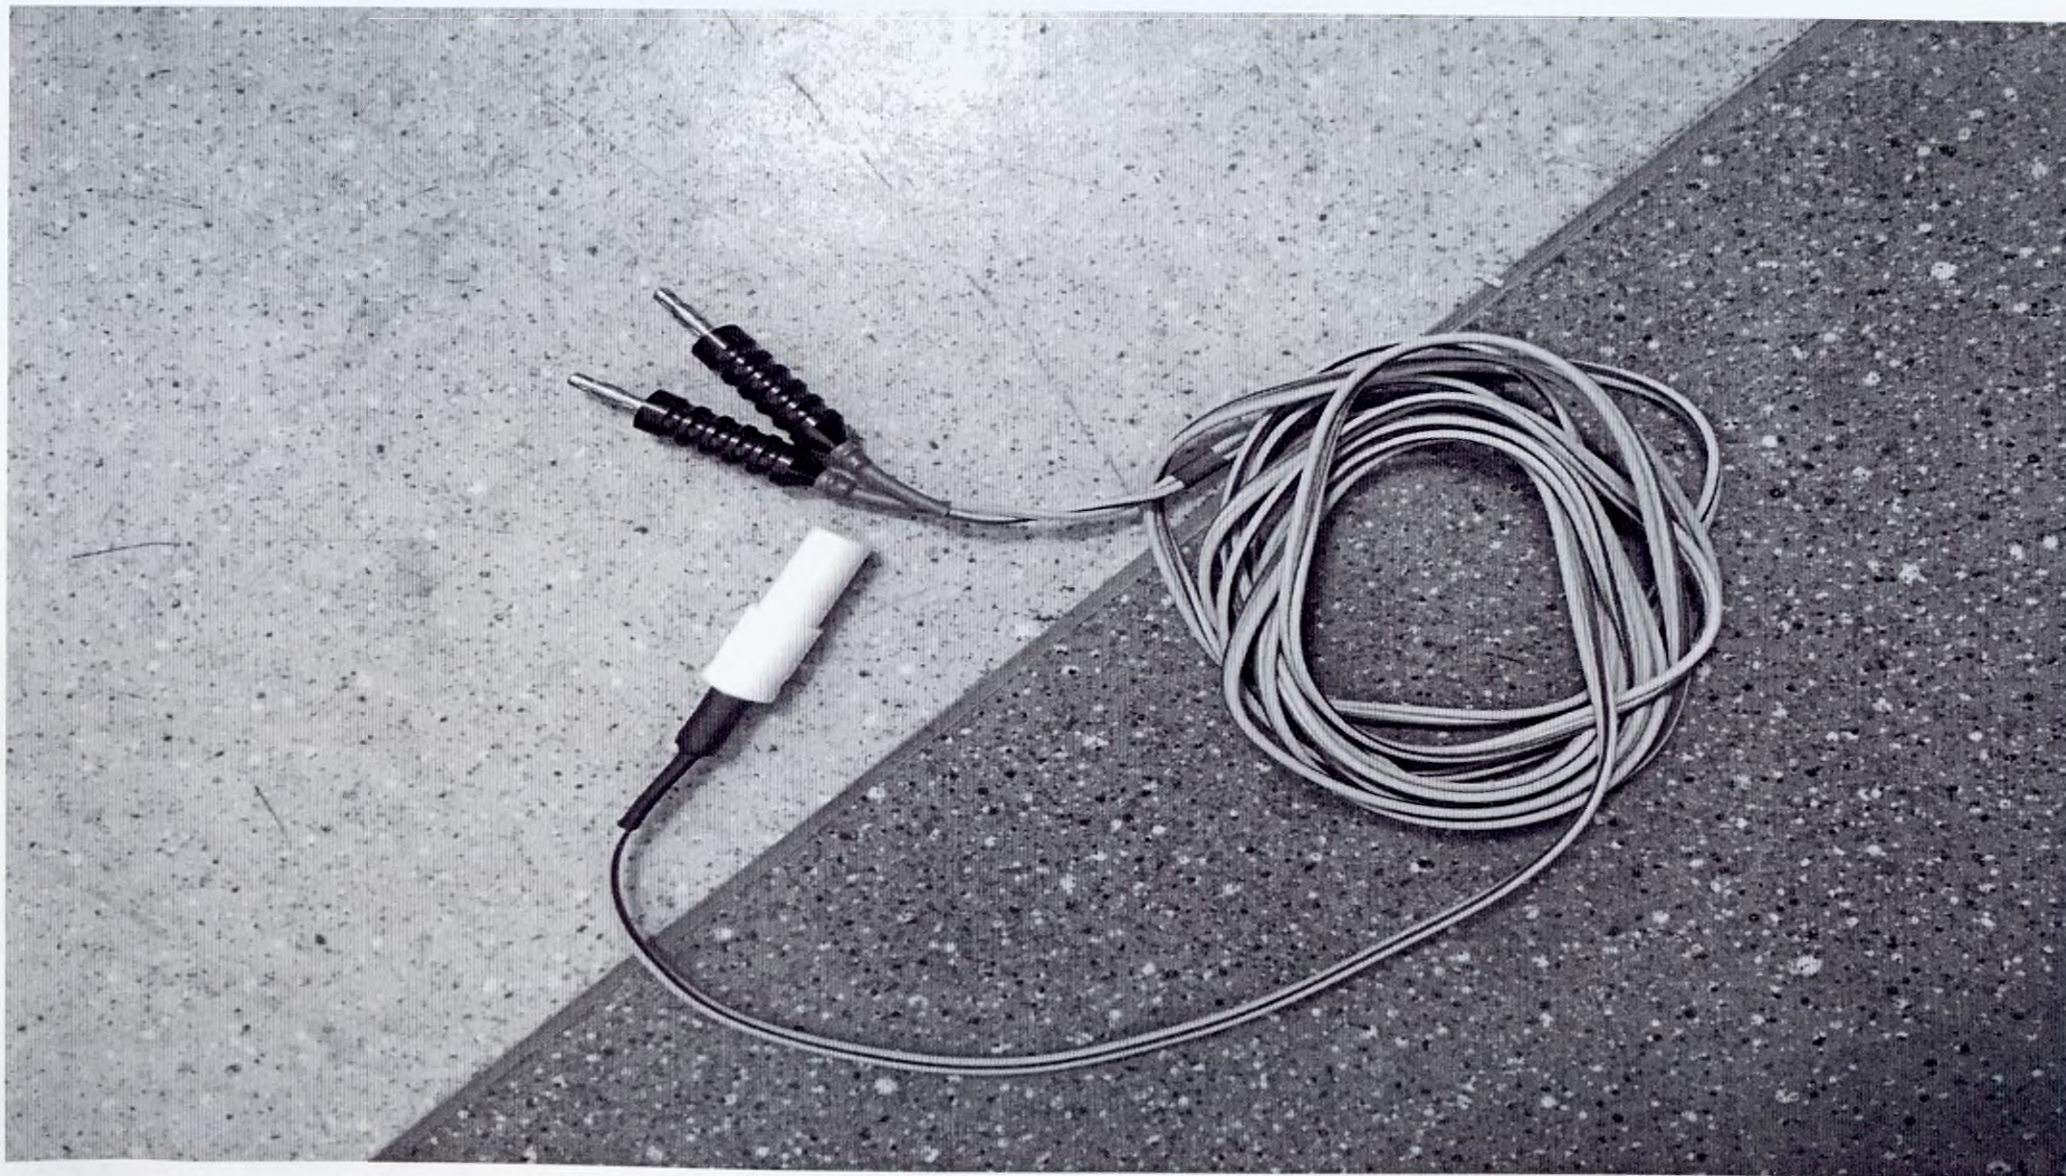

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

12 (двенадцать) листа(ов)  
цифрами прописью

Директор ООО «Эфа»

Лютикова Ю.А.

Ф.И.О.

Лютикова

личная подпись

