



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СтериИнжиниринг»

 О. В. Малоков

« 01 »  2018 г.




**Фотографии
медицинского изделия**


**Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских
отходов «ОзСТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018**




Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «O₃CTEP»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Общий вид установки

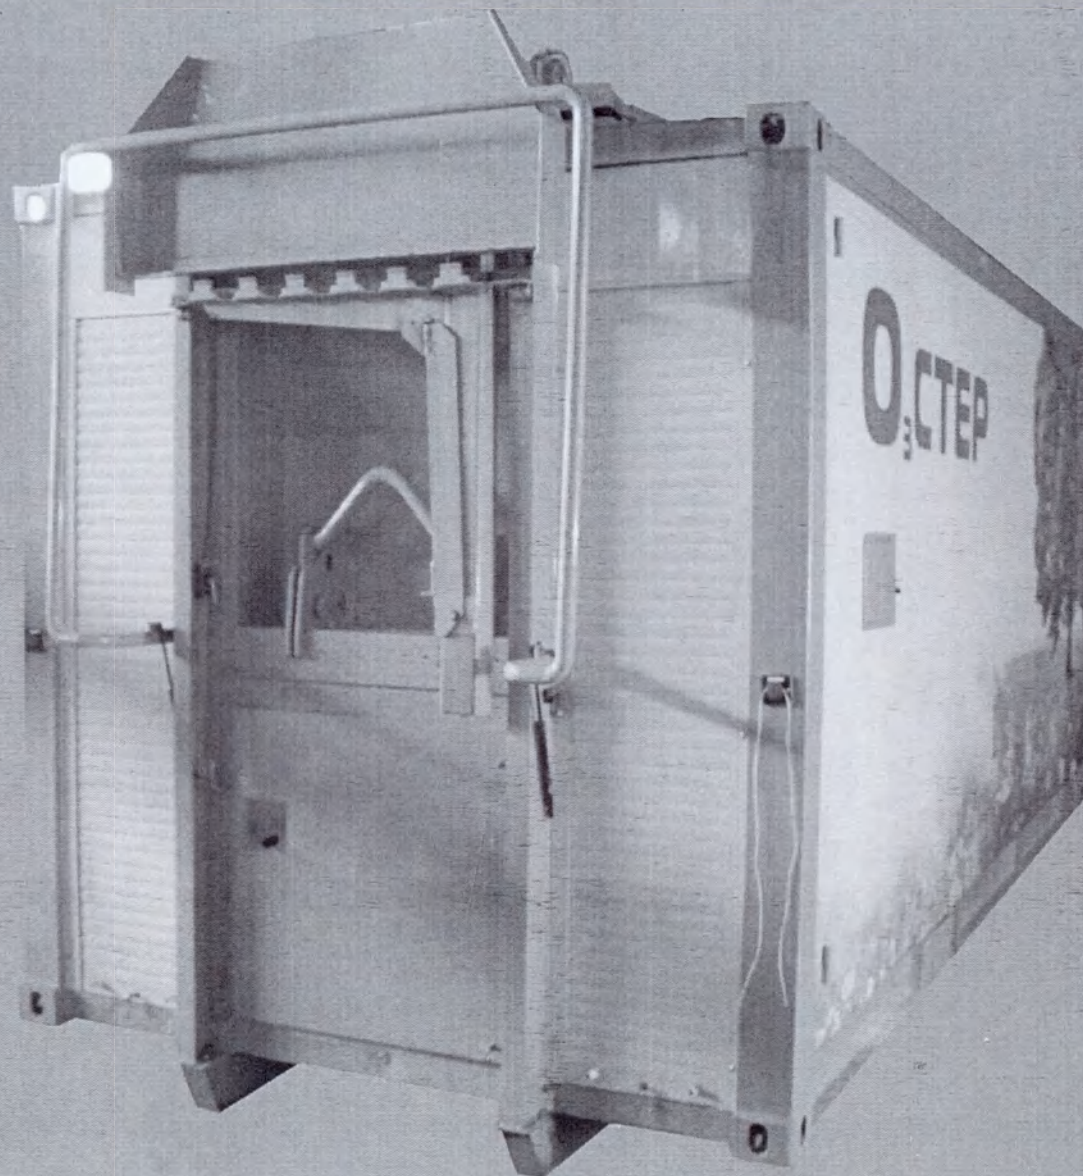


Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «O₃СТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Общий вид установки

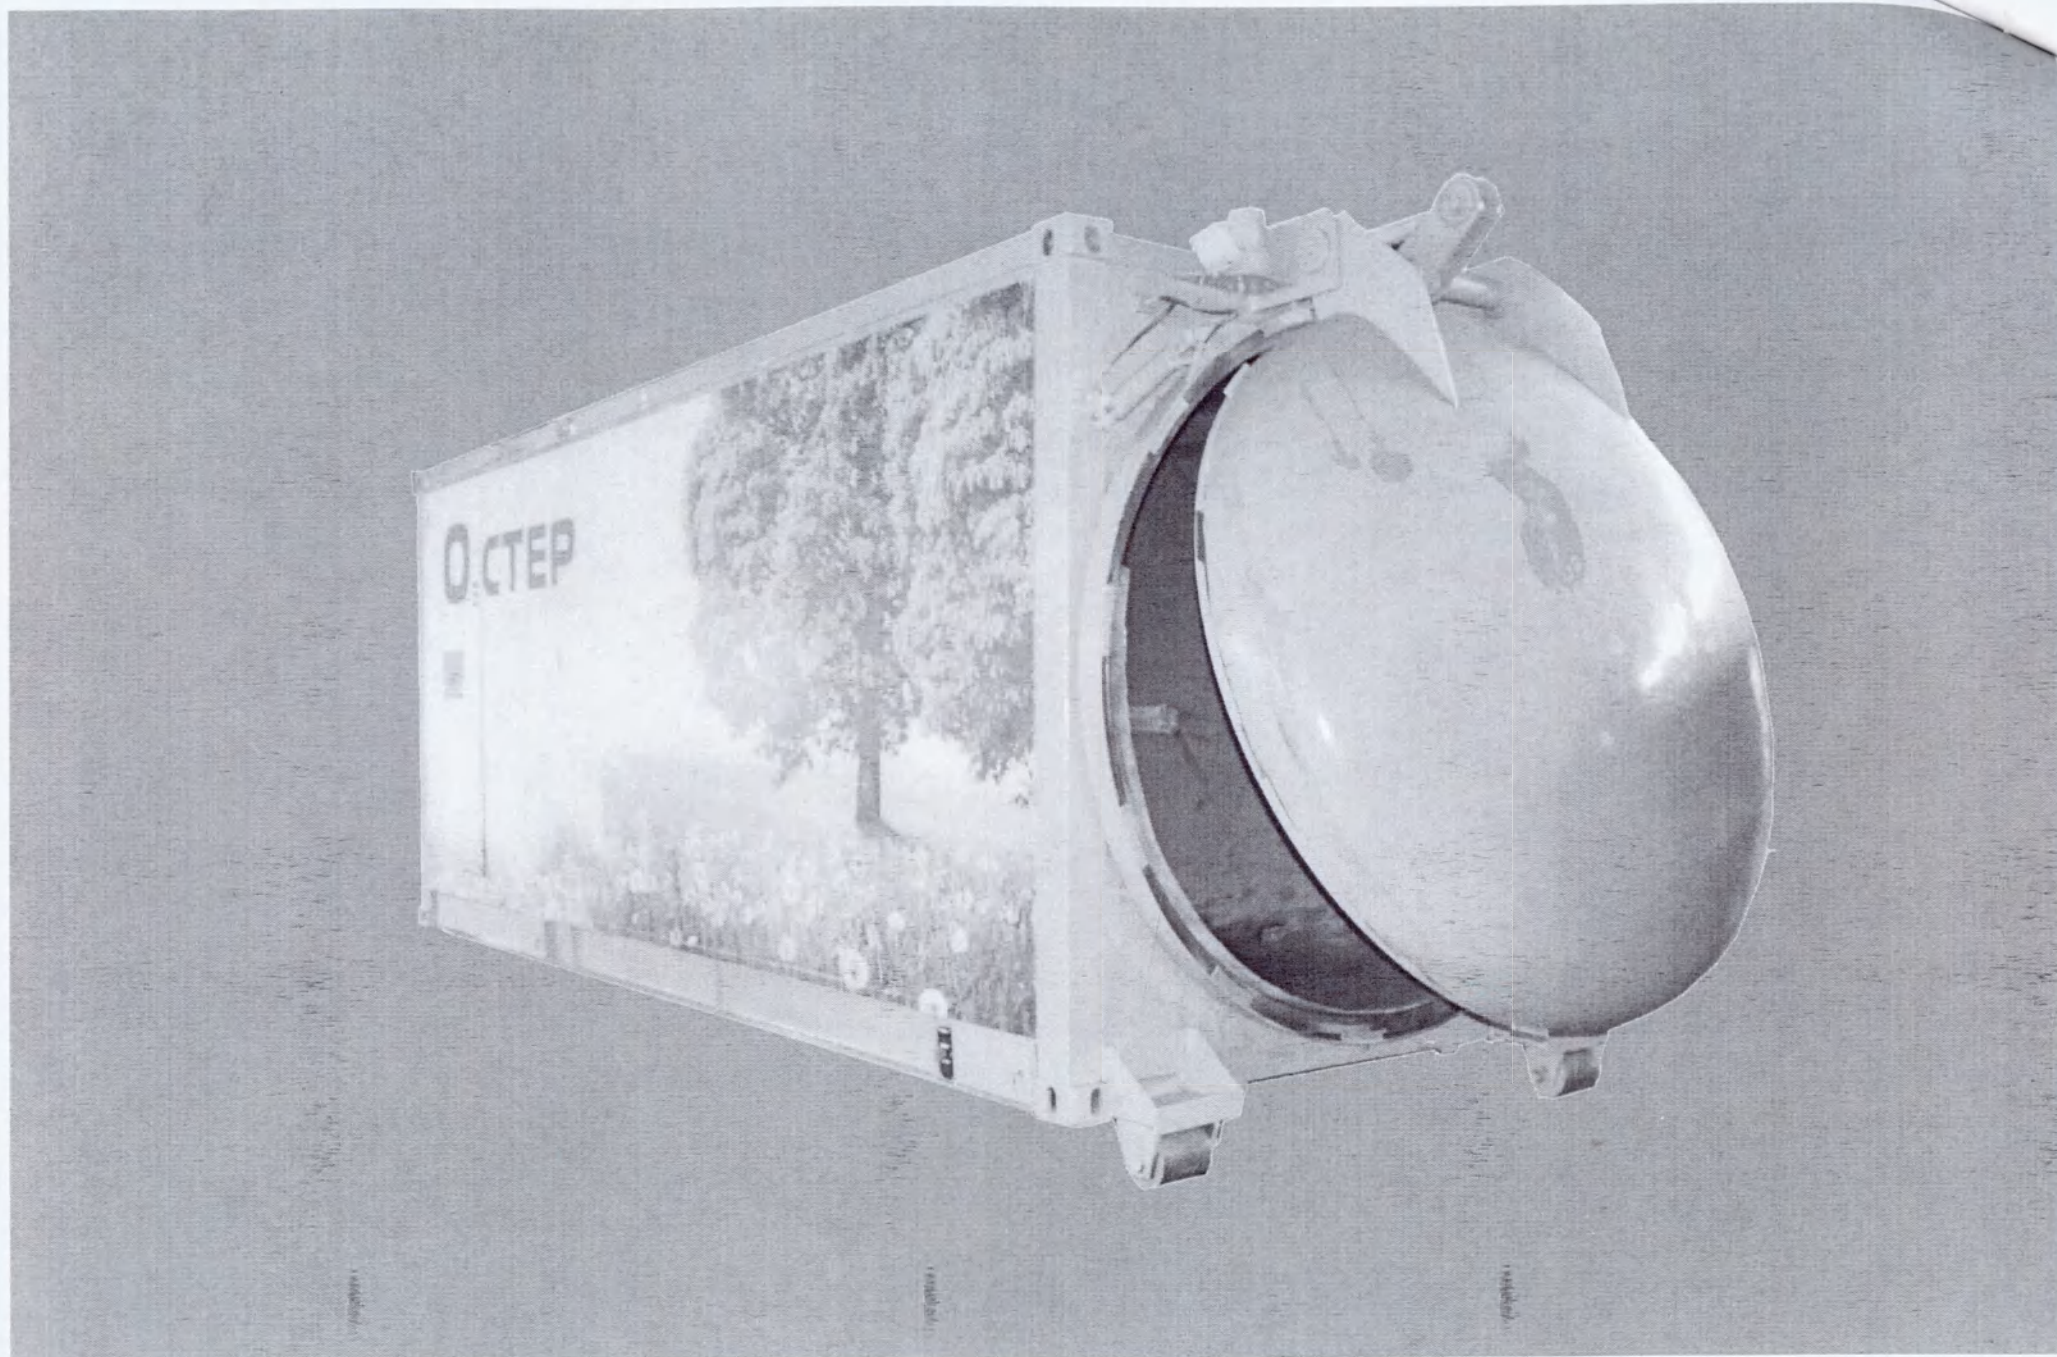


Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «О₃СТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Общий вид установки

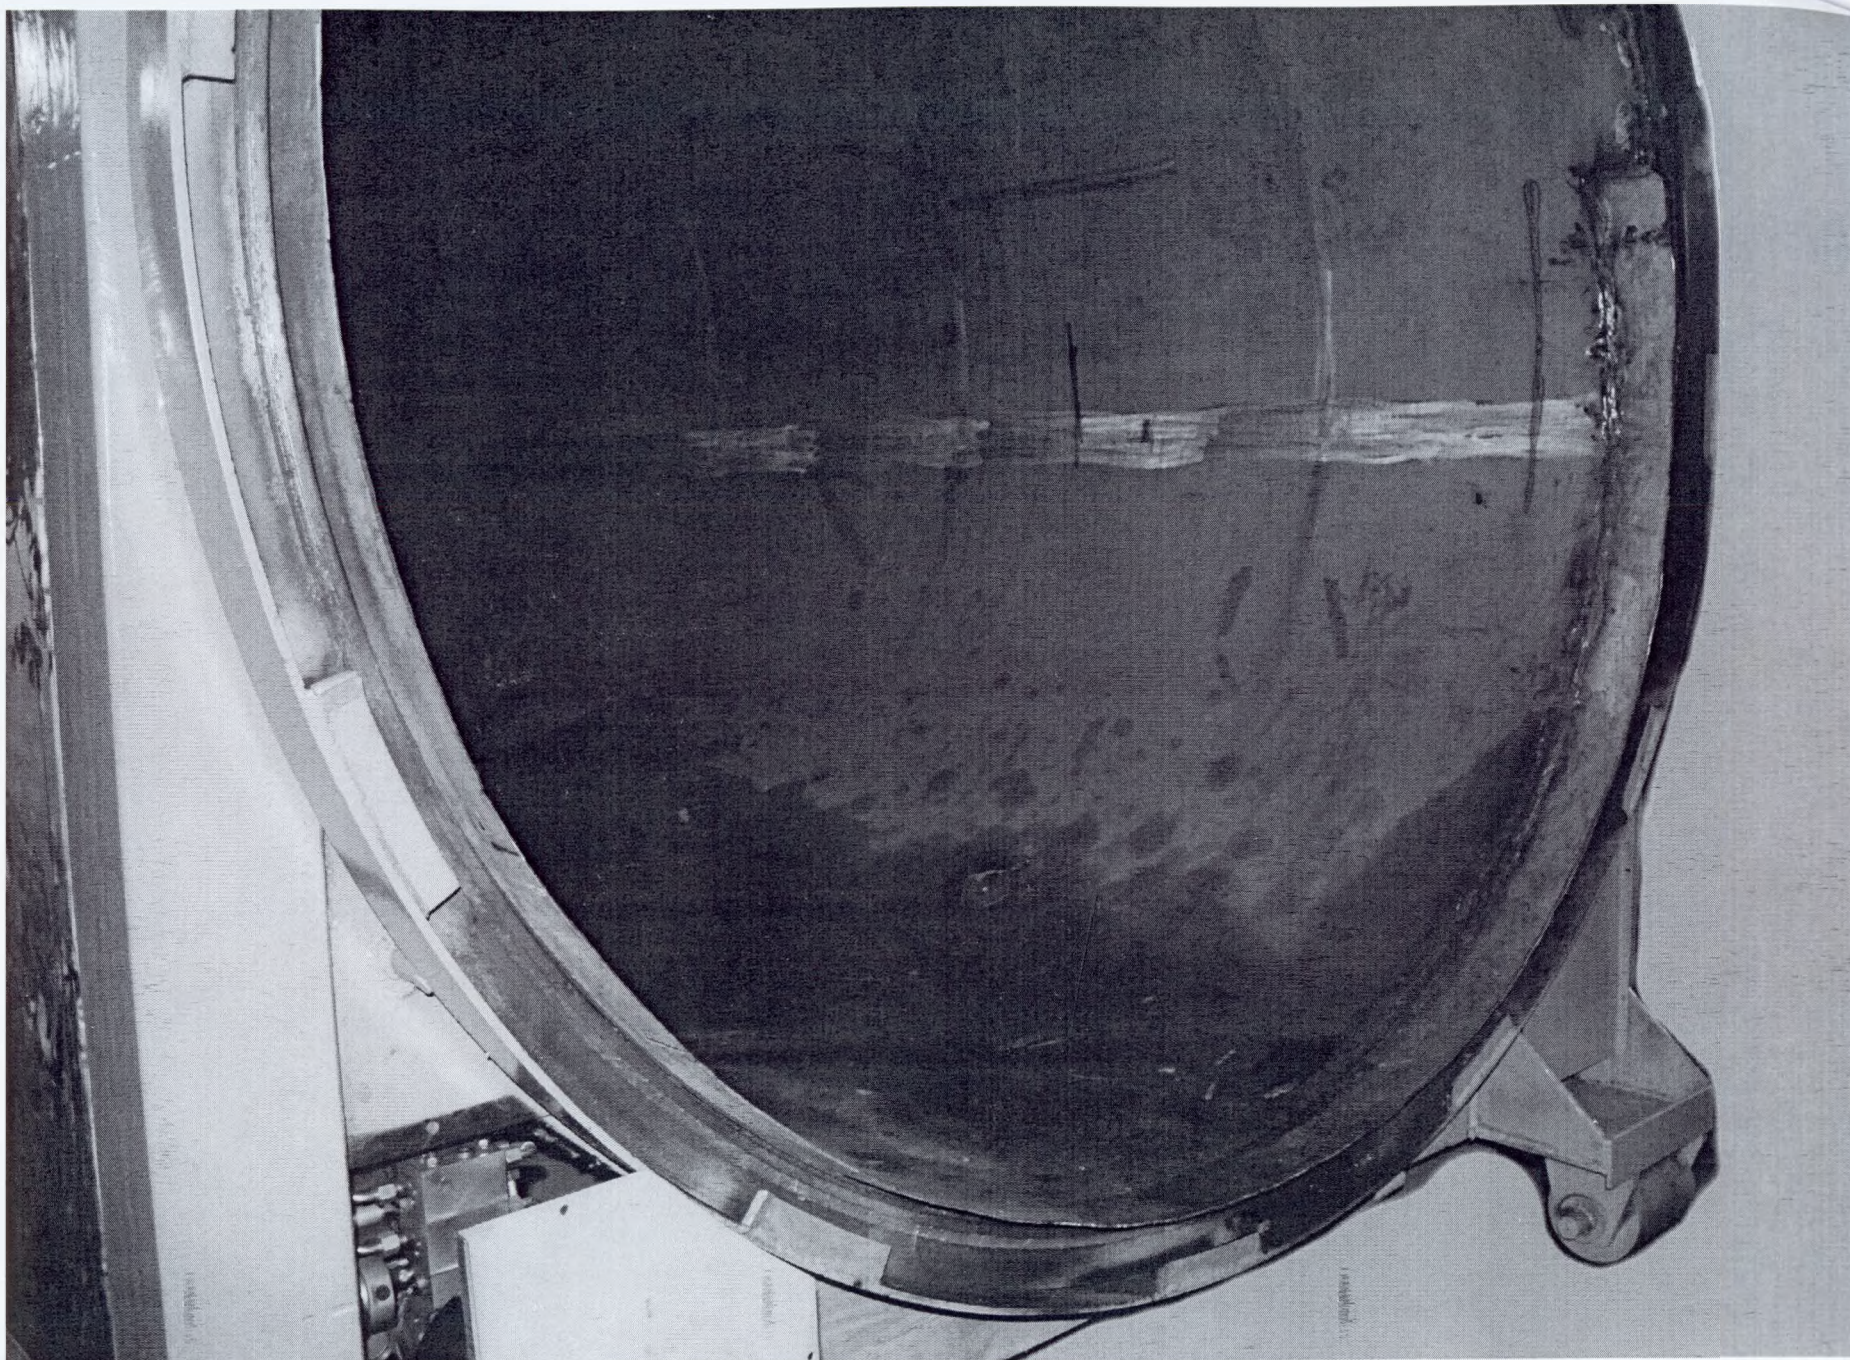

Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «О₃СТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Емкость для отходов

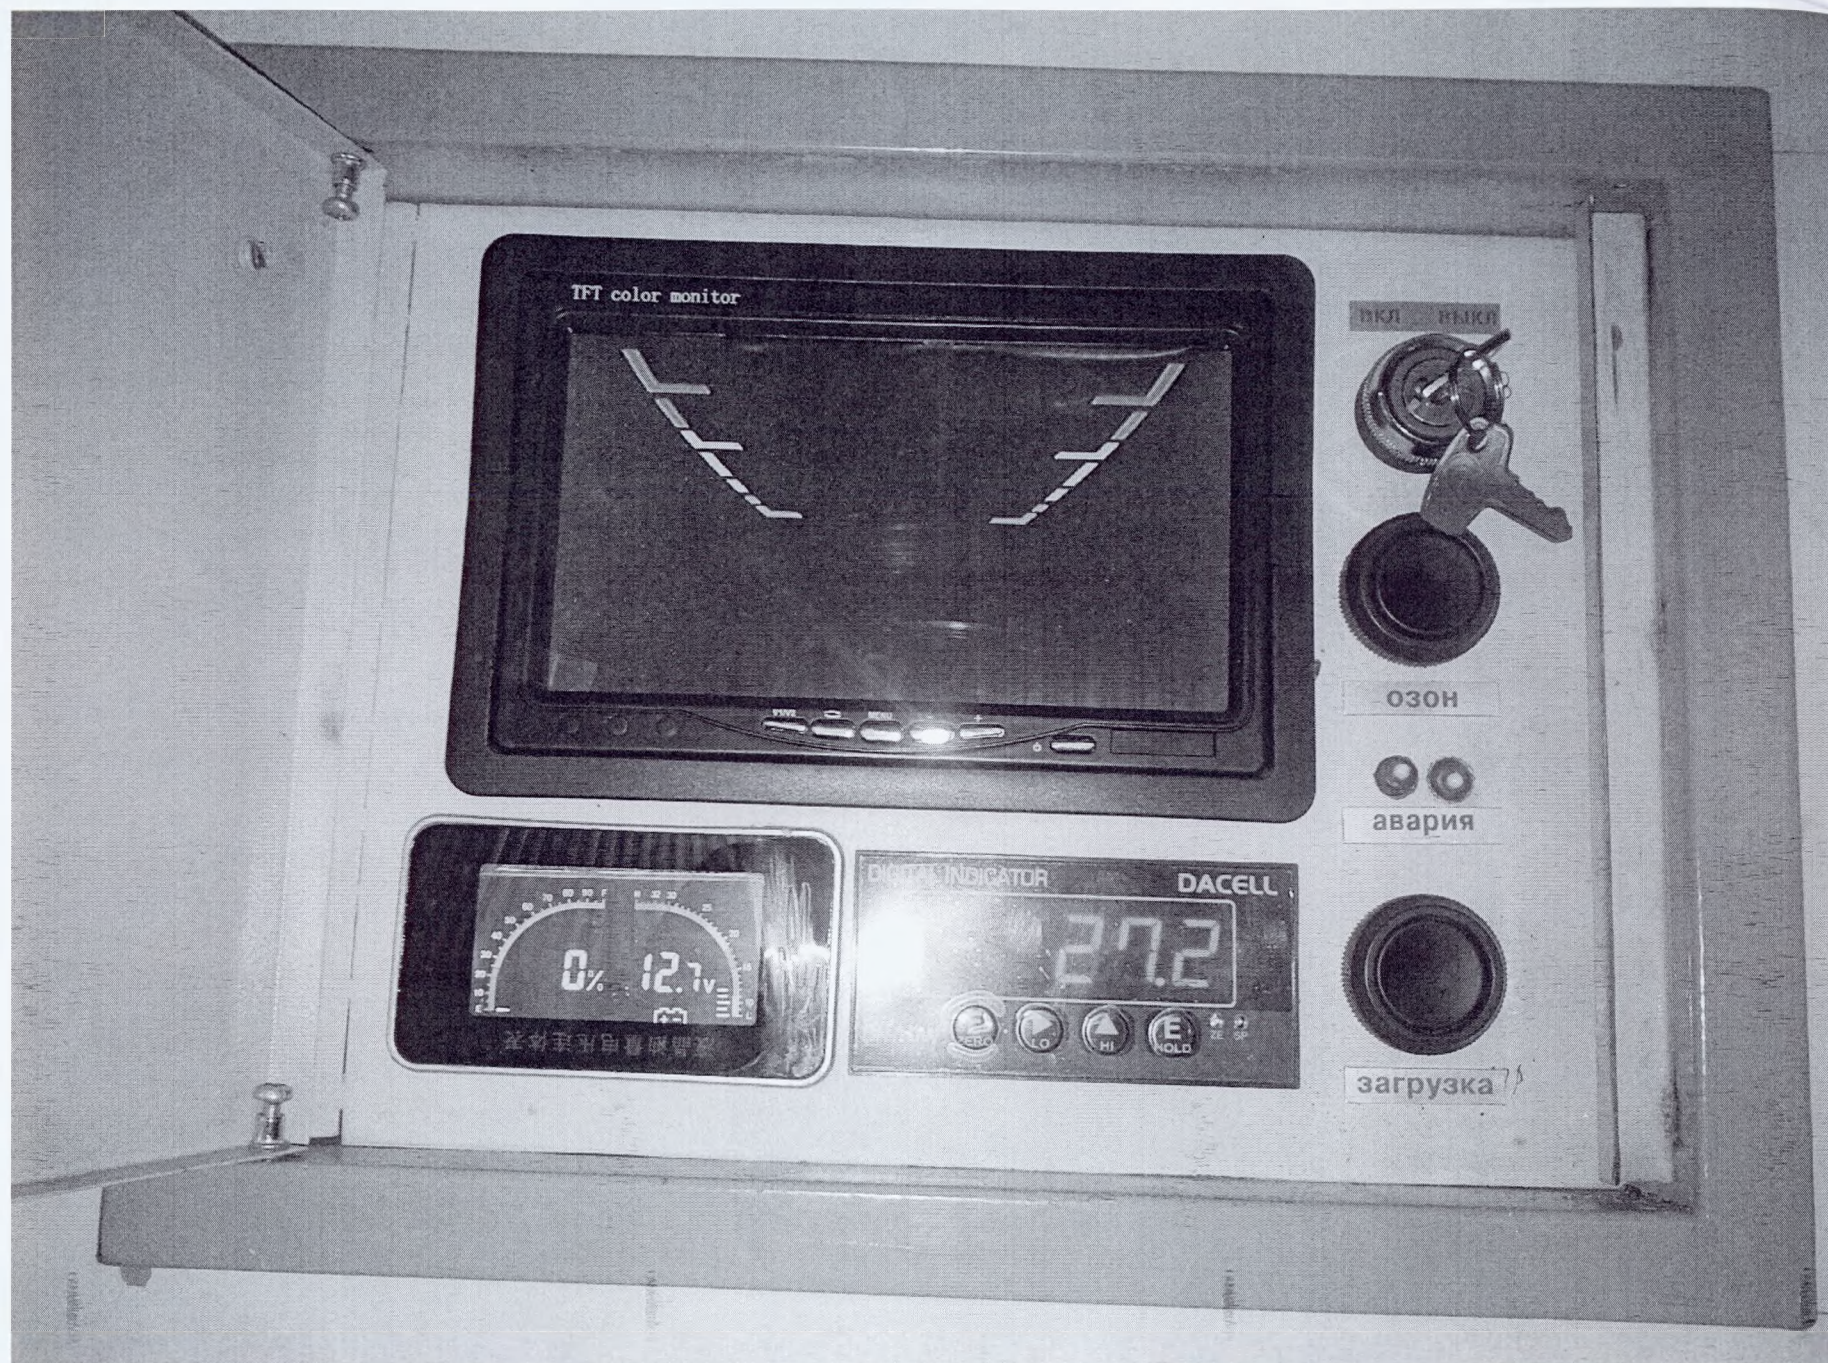

Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «ОЗСТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Электронный блок управления установкой

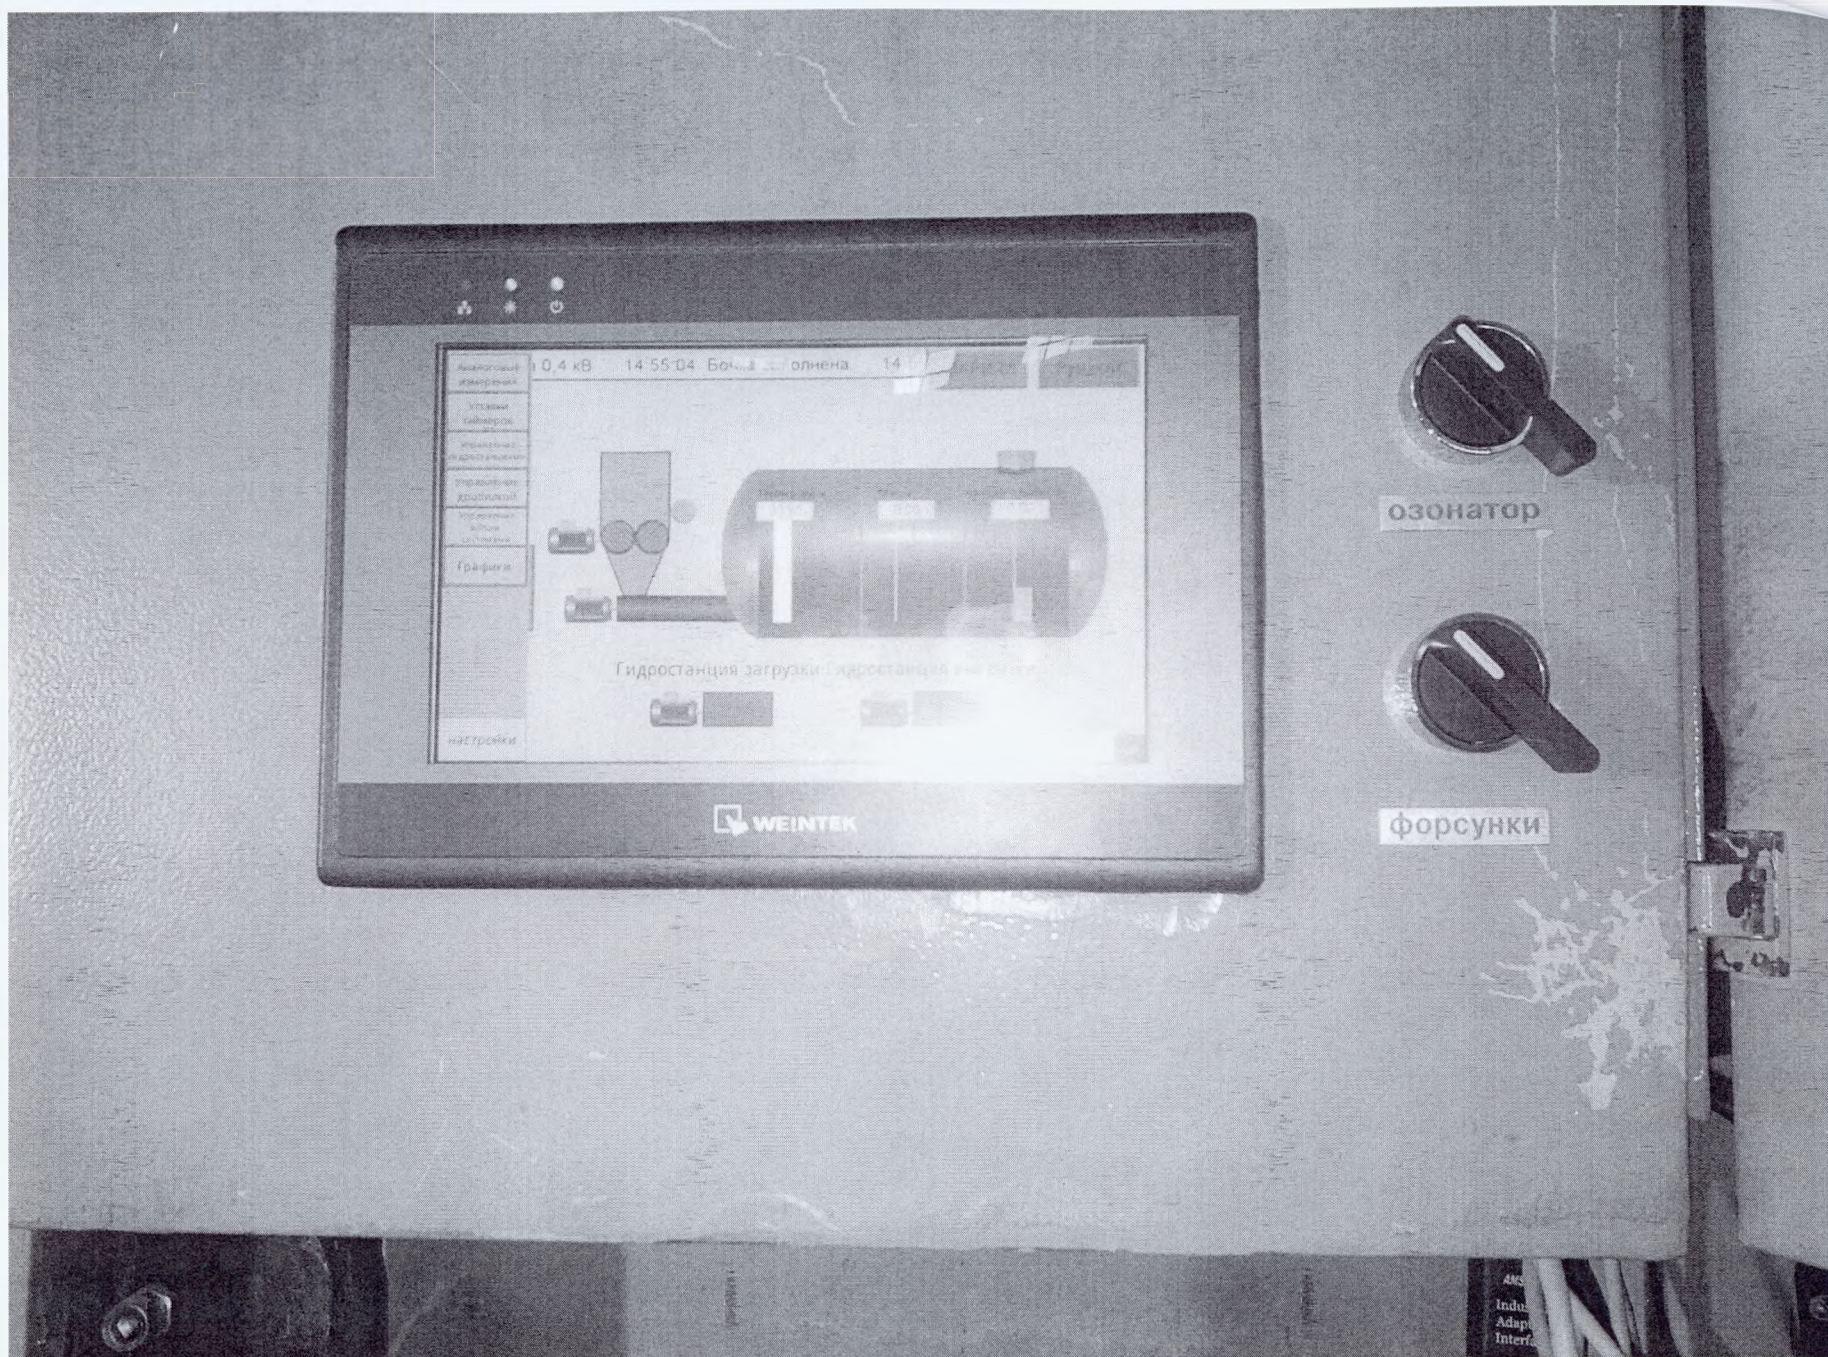

Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «ОЗСТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Программируемое контрольное устройство

ООО "СТЕРИНЖИНИРИНГ"

УСТАНОВКА МОБИЛЬНАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И
ОБЕЗОРАЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

О₃СТЕР

ТУ 32.50.50-001-05376081-2018

Рег. уд. № _____ от _____

23 kW


3 - 380V

50Гц

№

201 г

Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «О₃СТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Маркировка

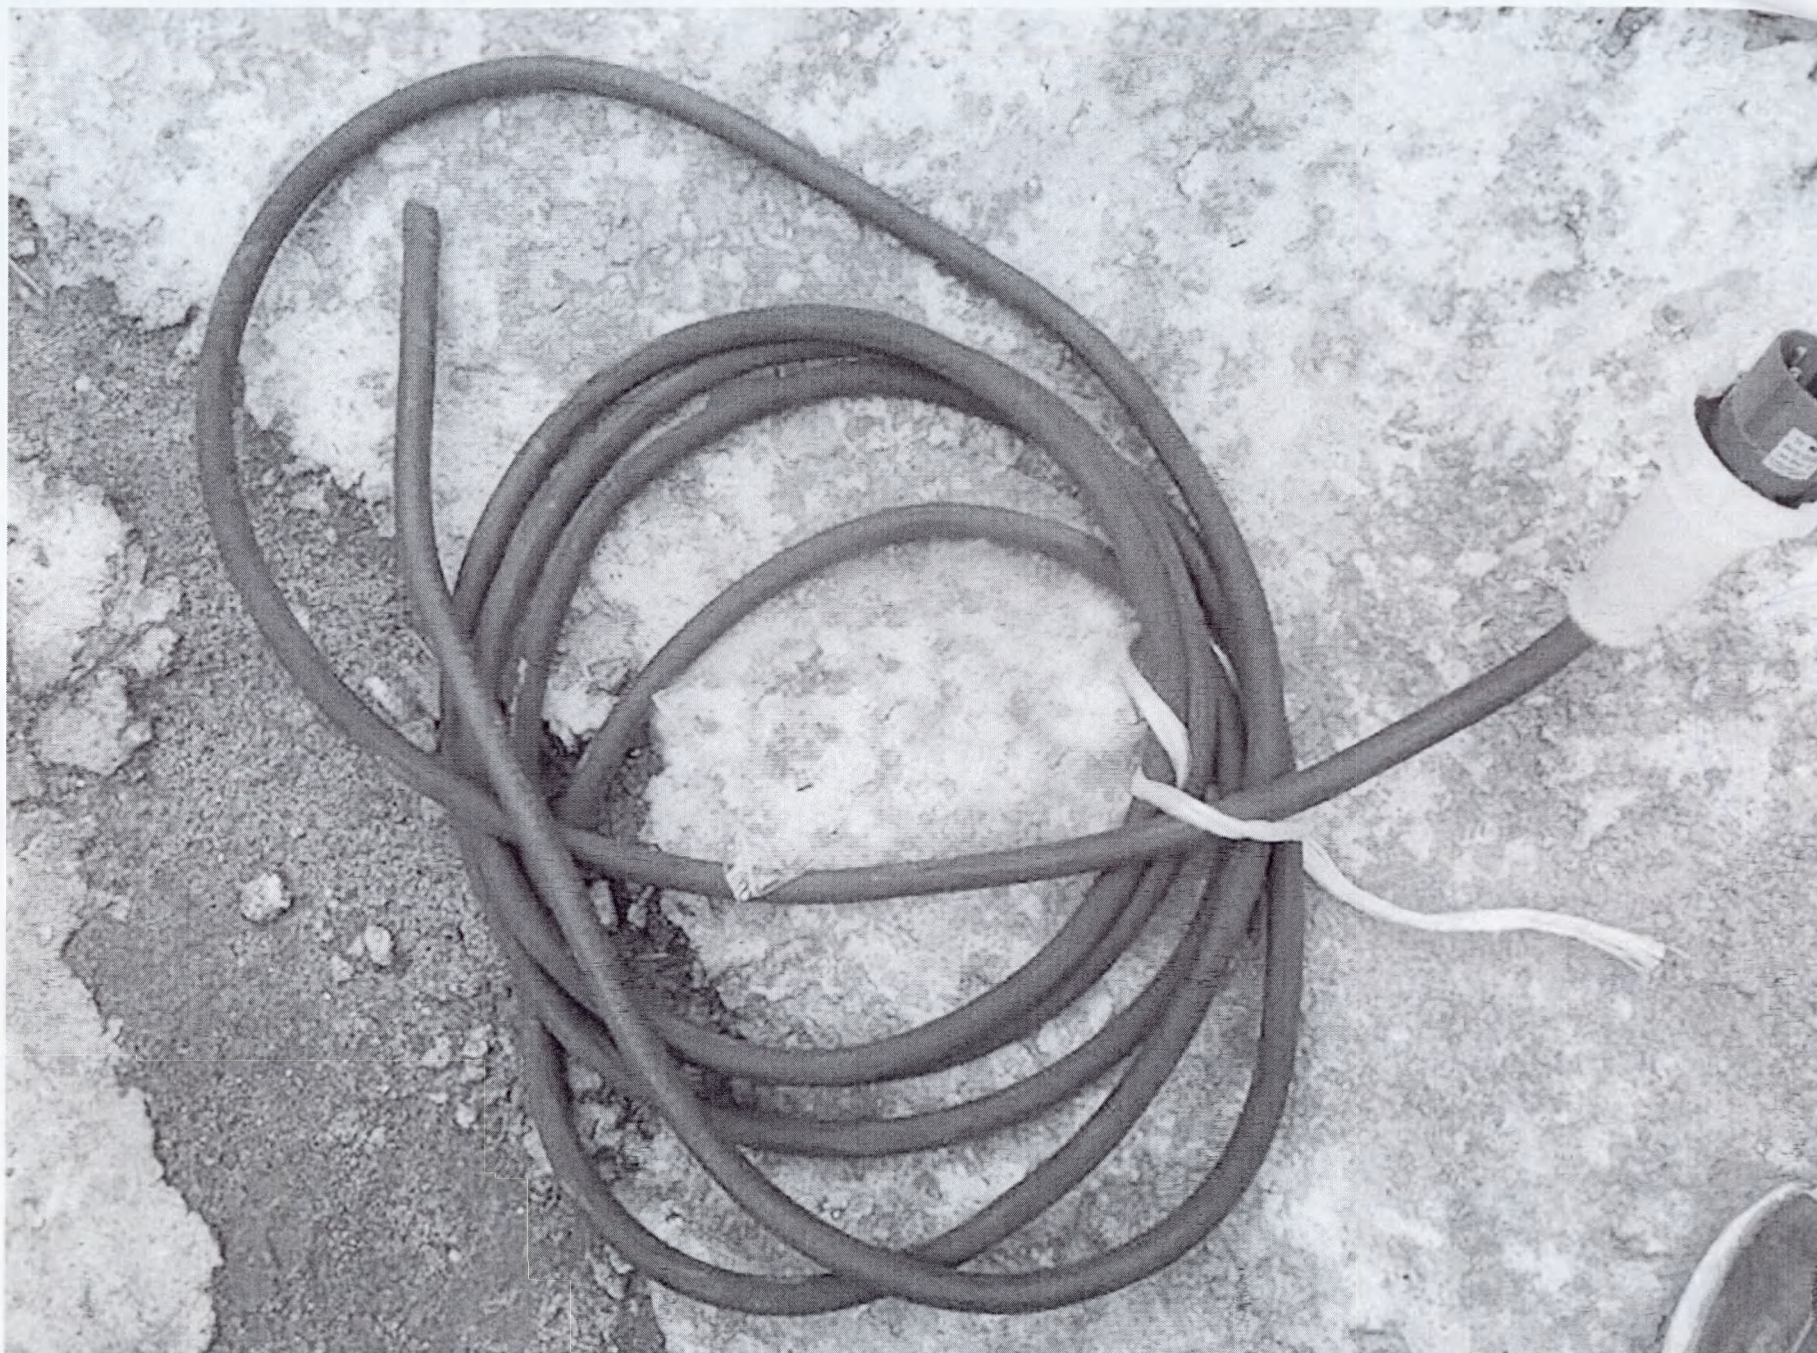

Установка мобильная по переработке и обеззараживанию медицинских отходов «О₃СТЕР»
по ТУ 32.50.50-001-05376081-2018: Кабель питания

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

9 () листа(ов)
Директор Мамонтов О.В. Ф.И.О.
Личная подпись Мамонтов О.В.

