

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НТМ Групп»

В. В. Старицын

2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплекс диагностический портативный для мониторинга состояния
пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018 в вариантах
исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

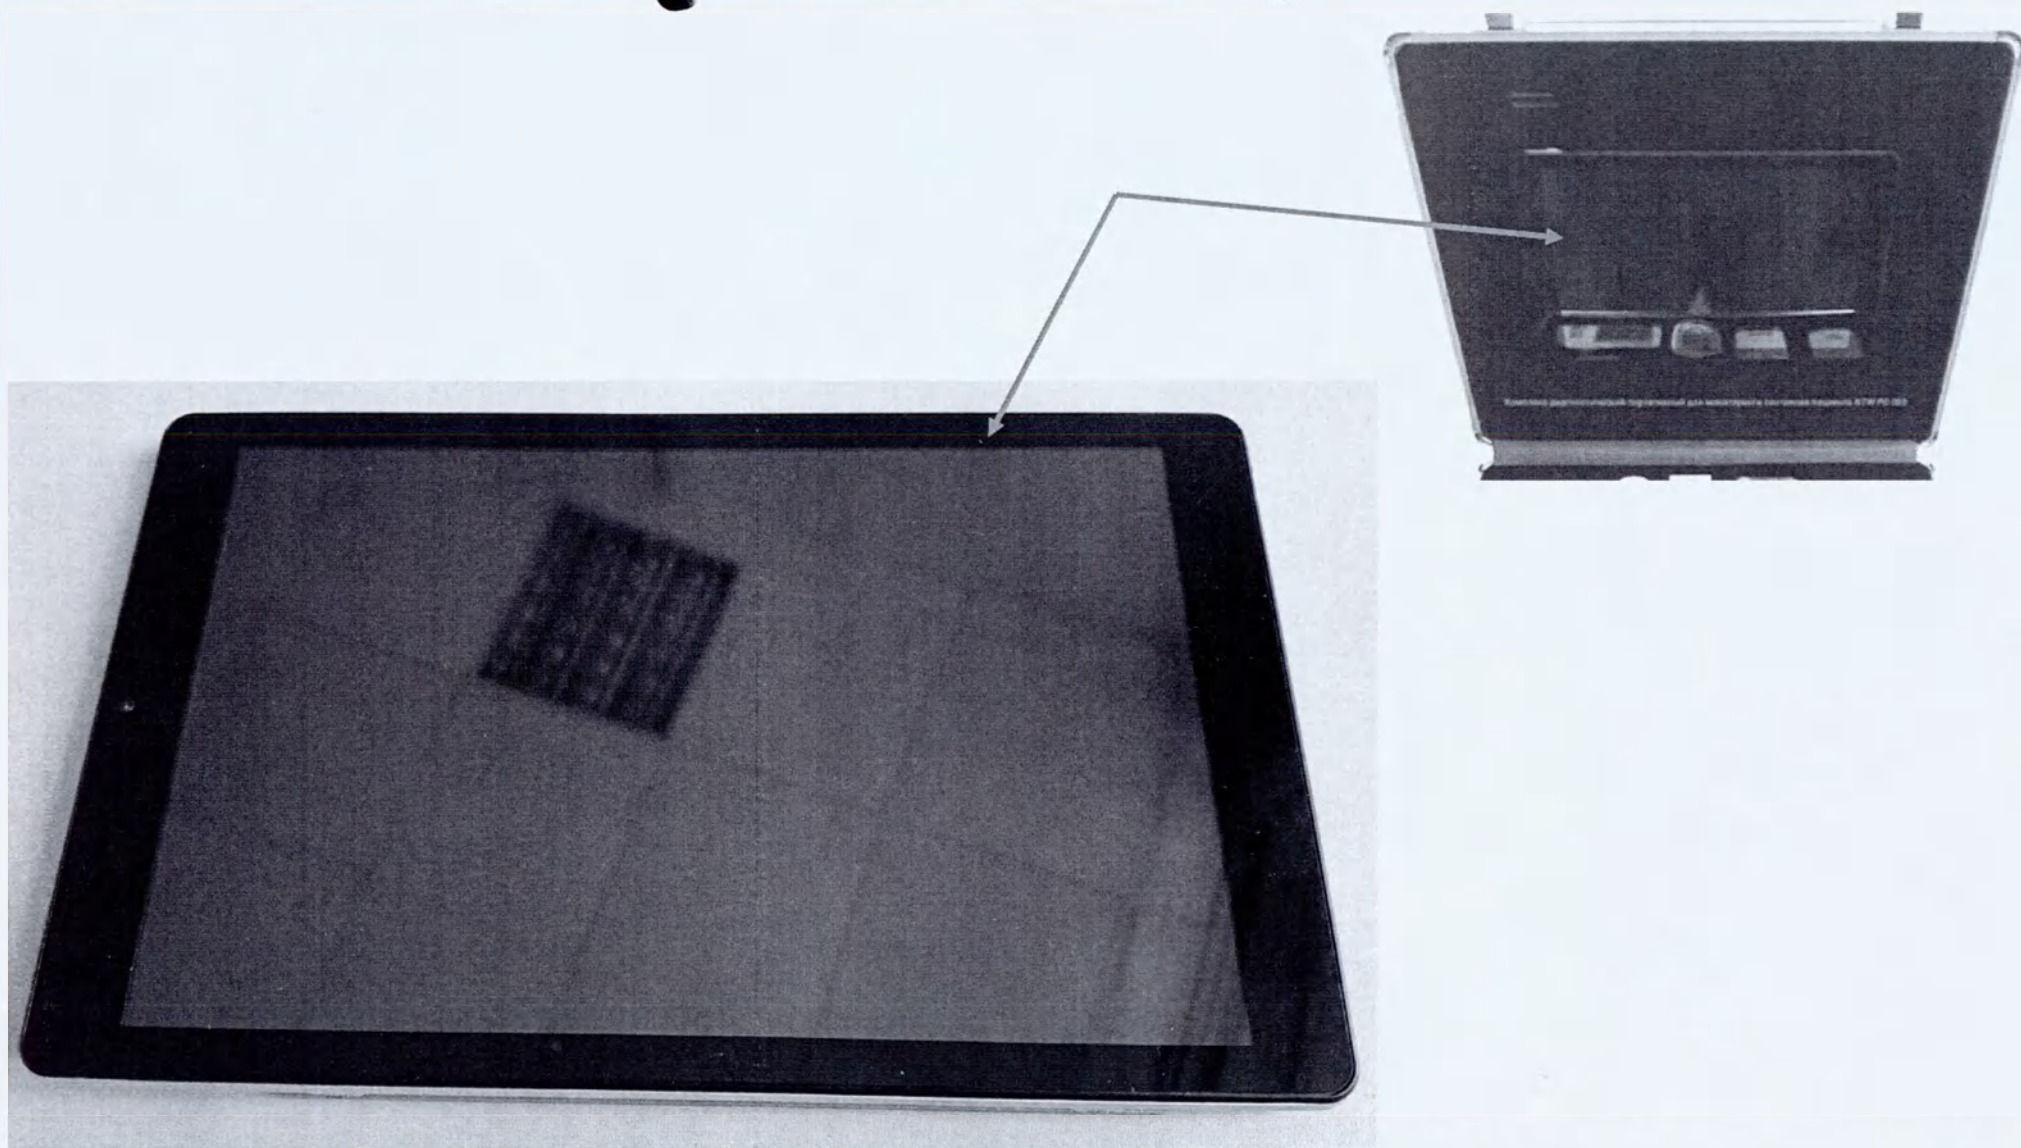


Рис. 1 Планшет

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 2 Тонометр

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

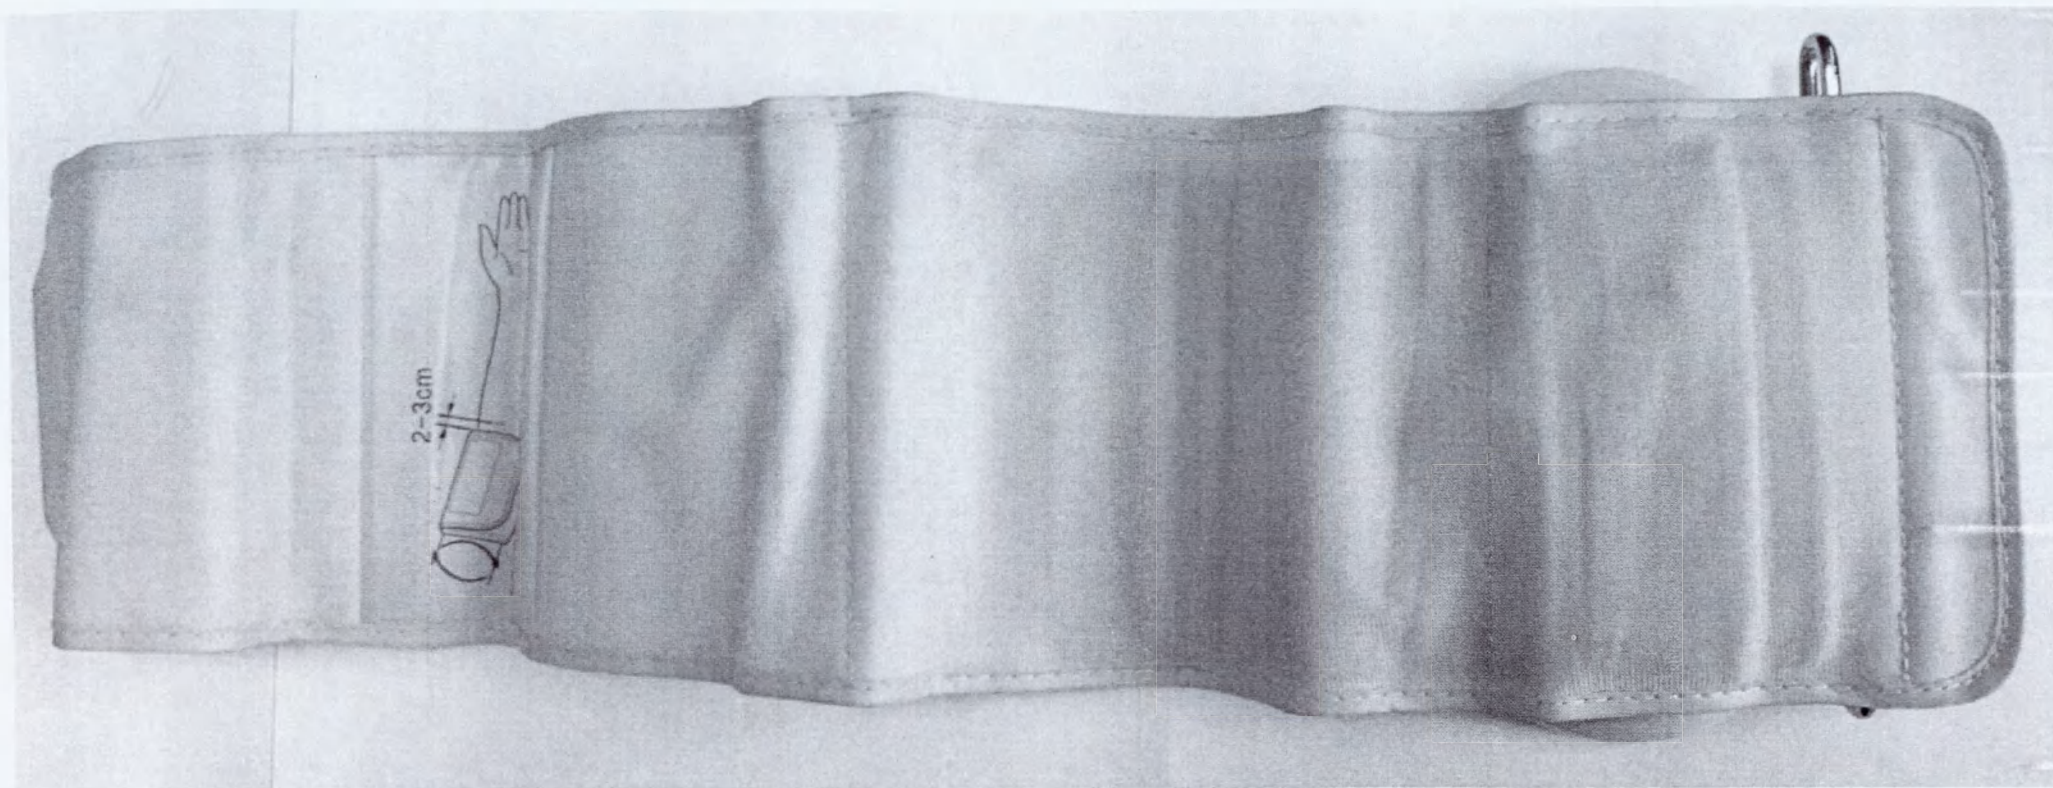


Рис. 3 Манжета для тонометра
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

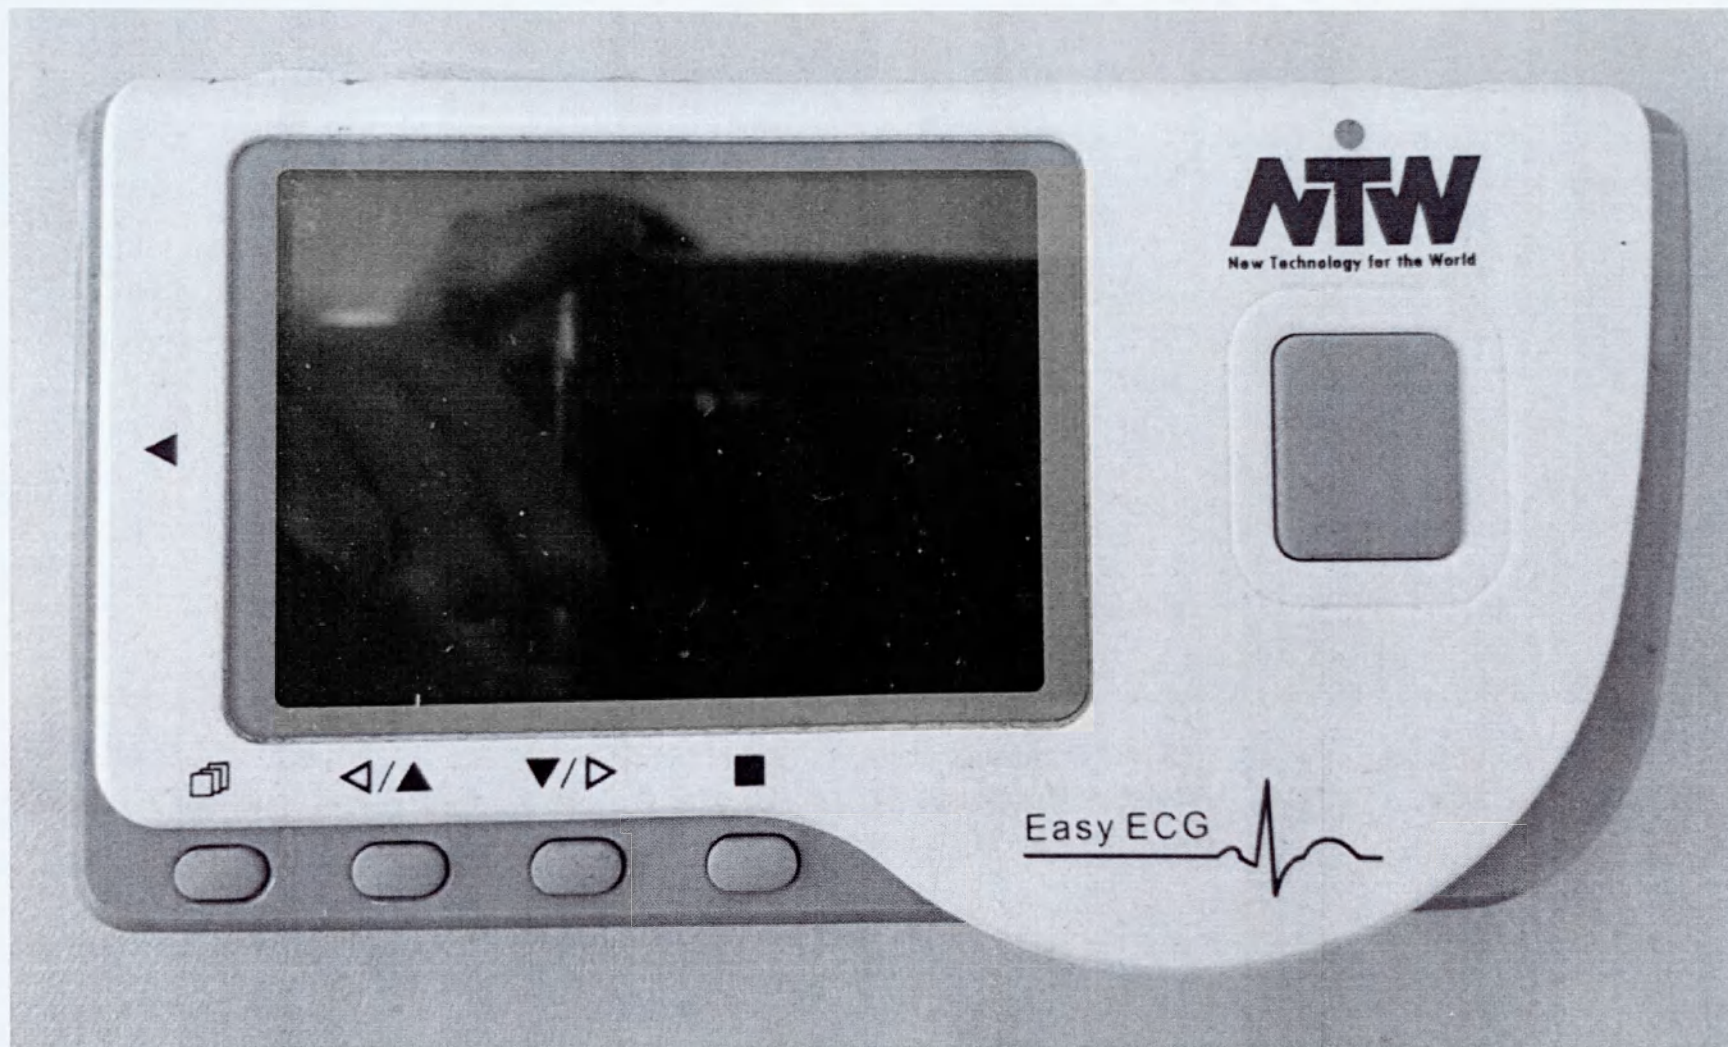


Рис. 4 Электрокардиограф
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

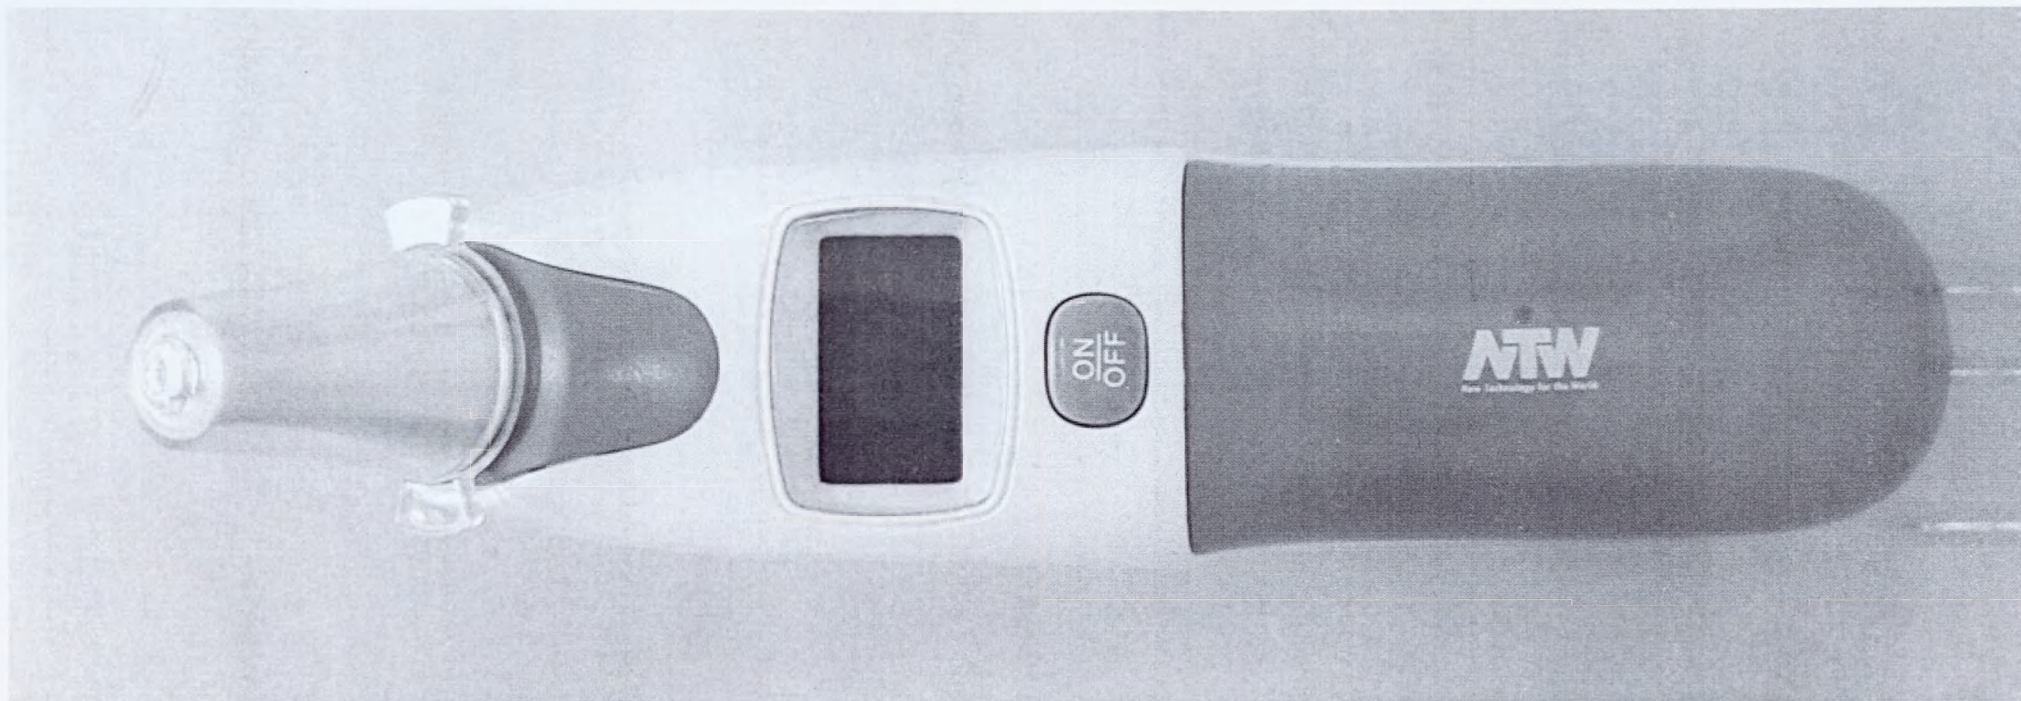


Рис. 5 Термометр ушной

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 6 Пульсоксиметр

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 7 Смарт-браслет

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

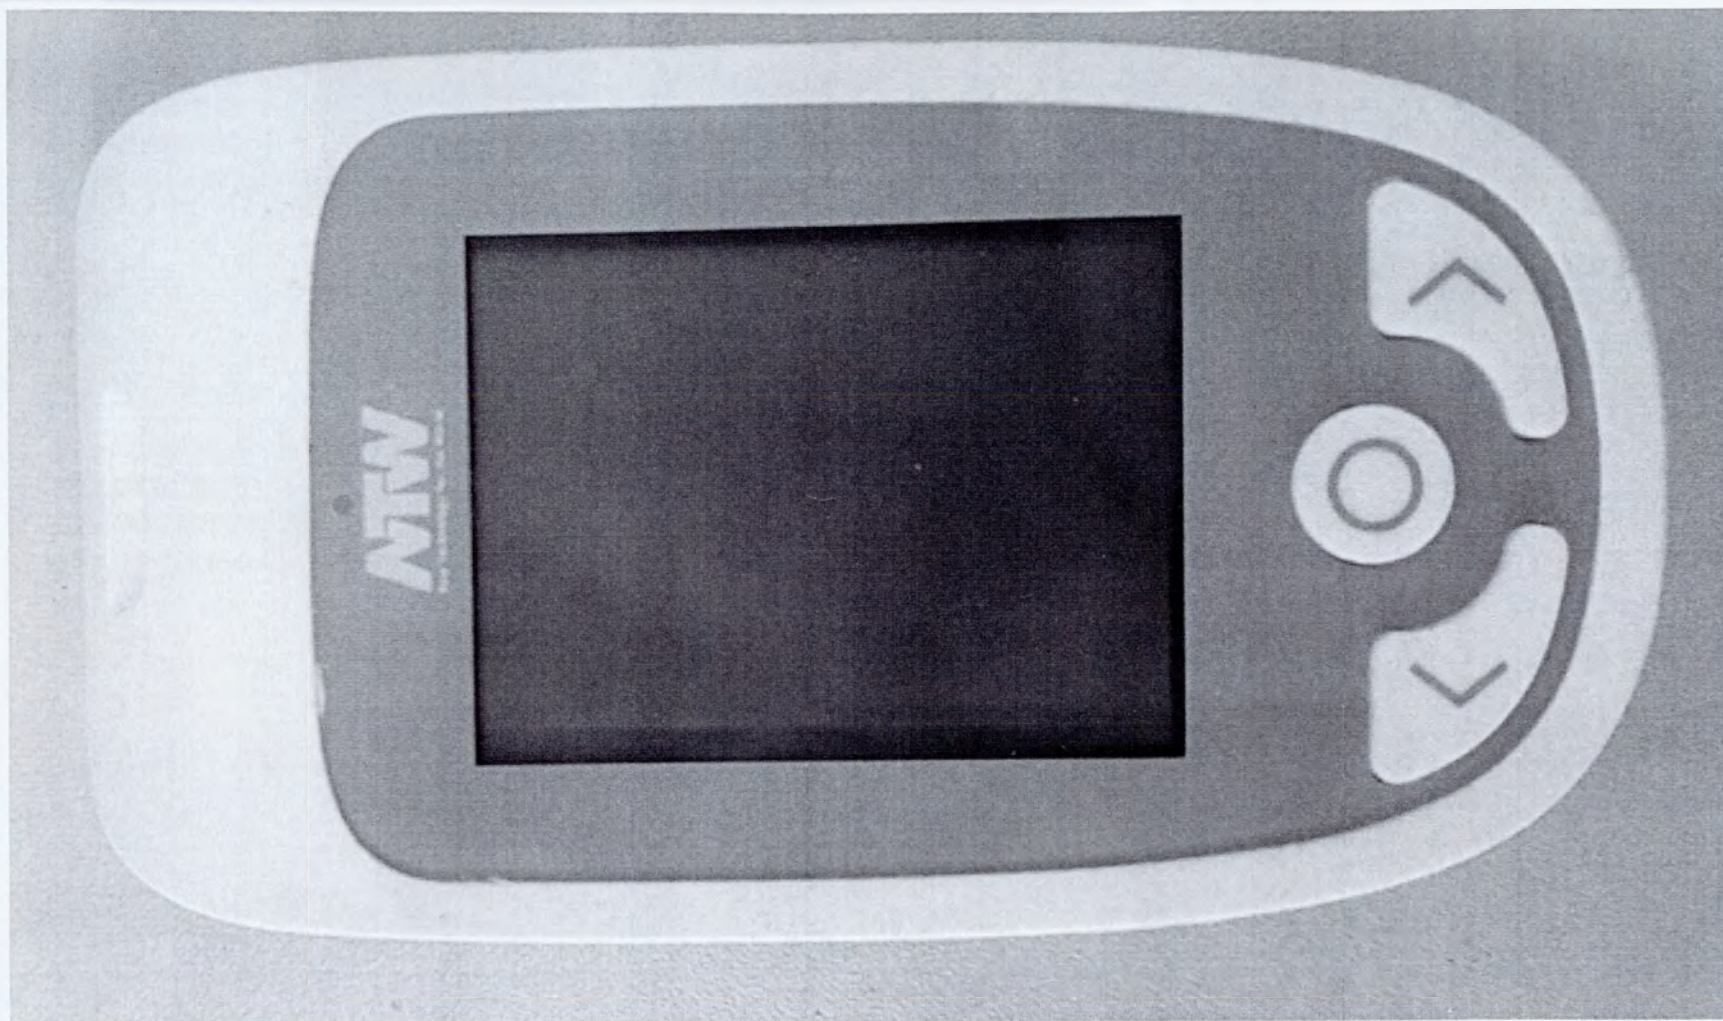


Рис. 8 Анализатор портативный для измерения уровня глюкозы, холестерина, мочевой кислоты в крови для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018 в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

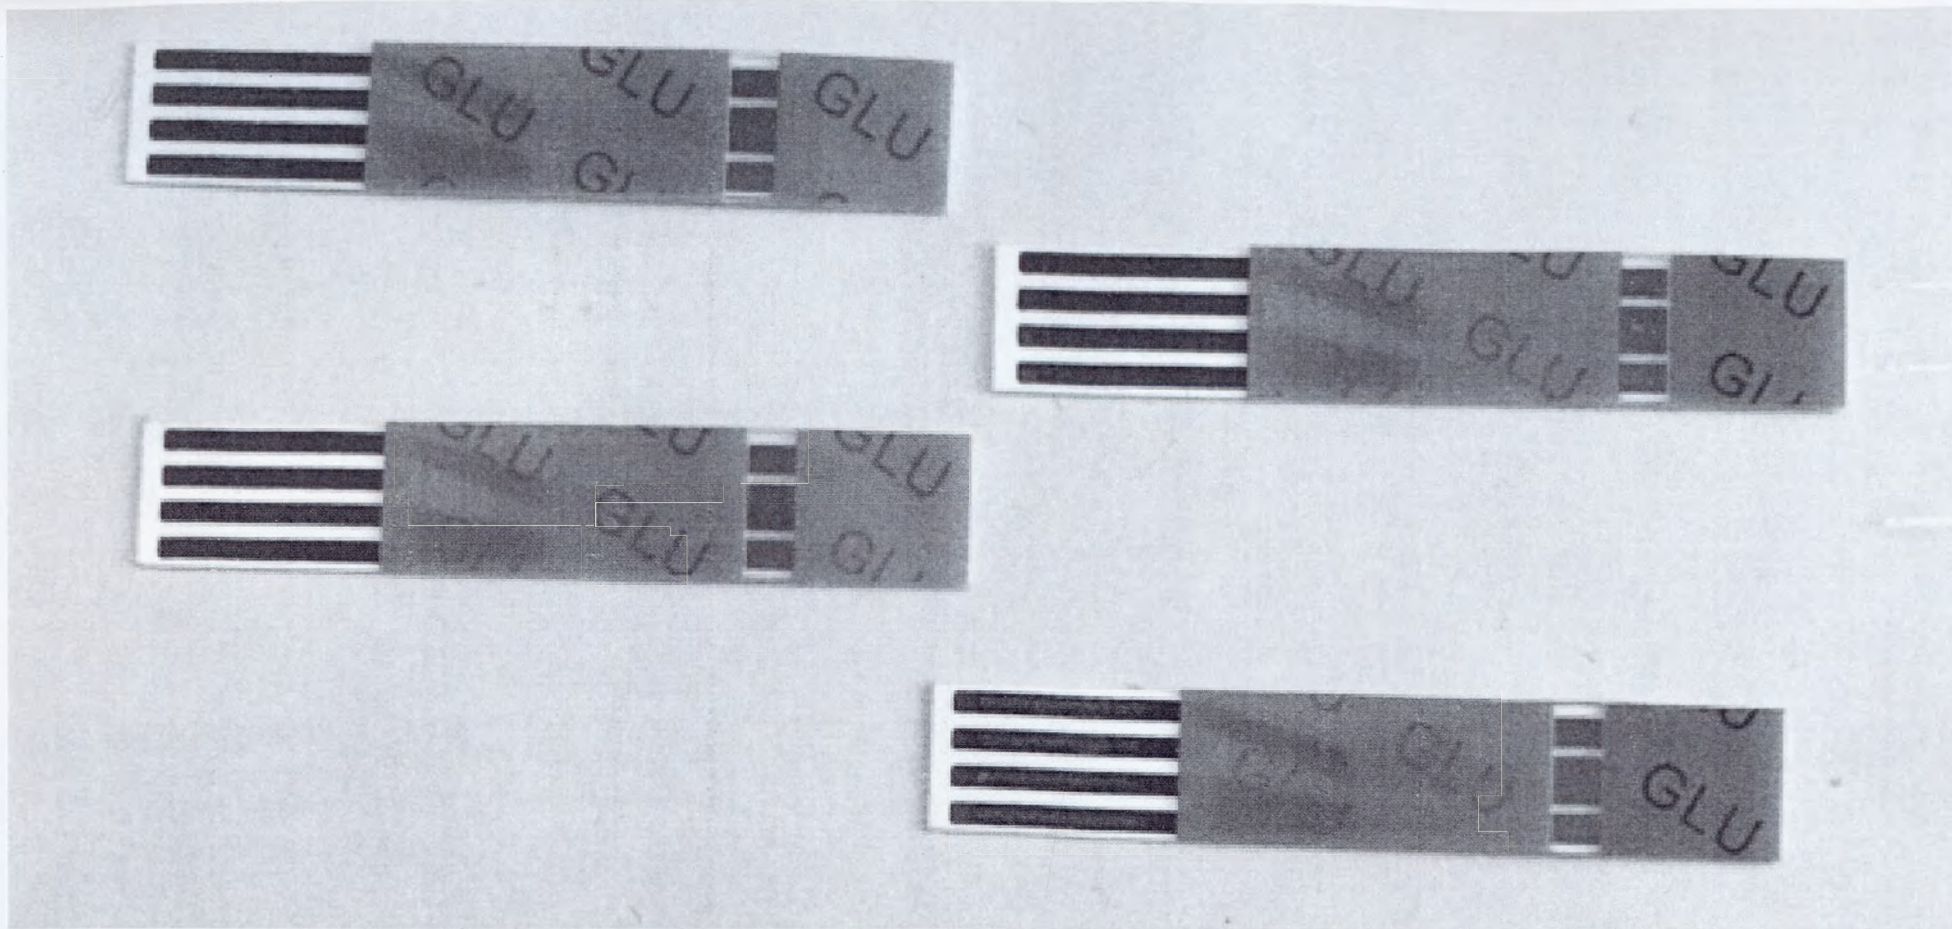


Рис. 9 Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

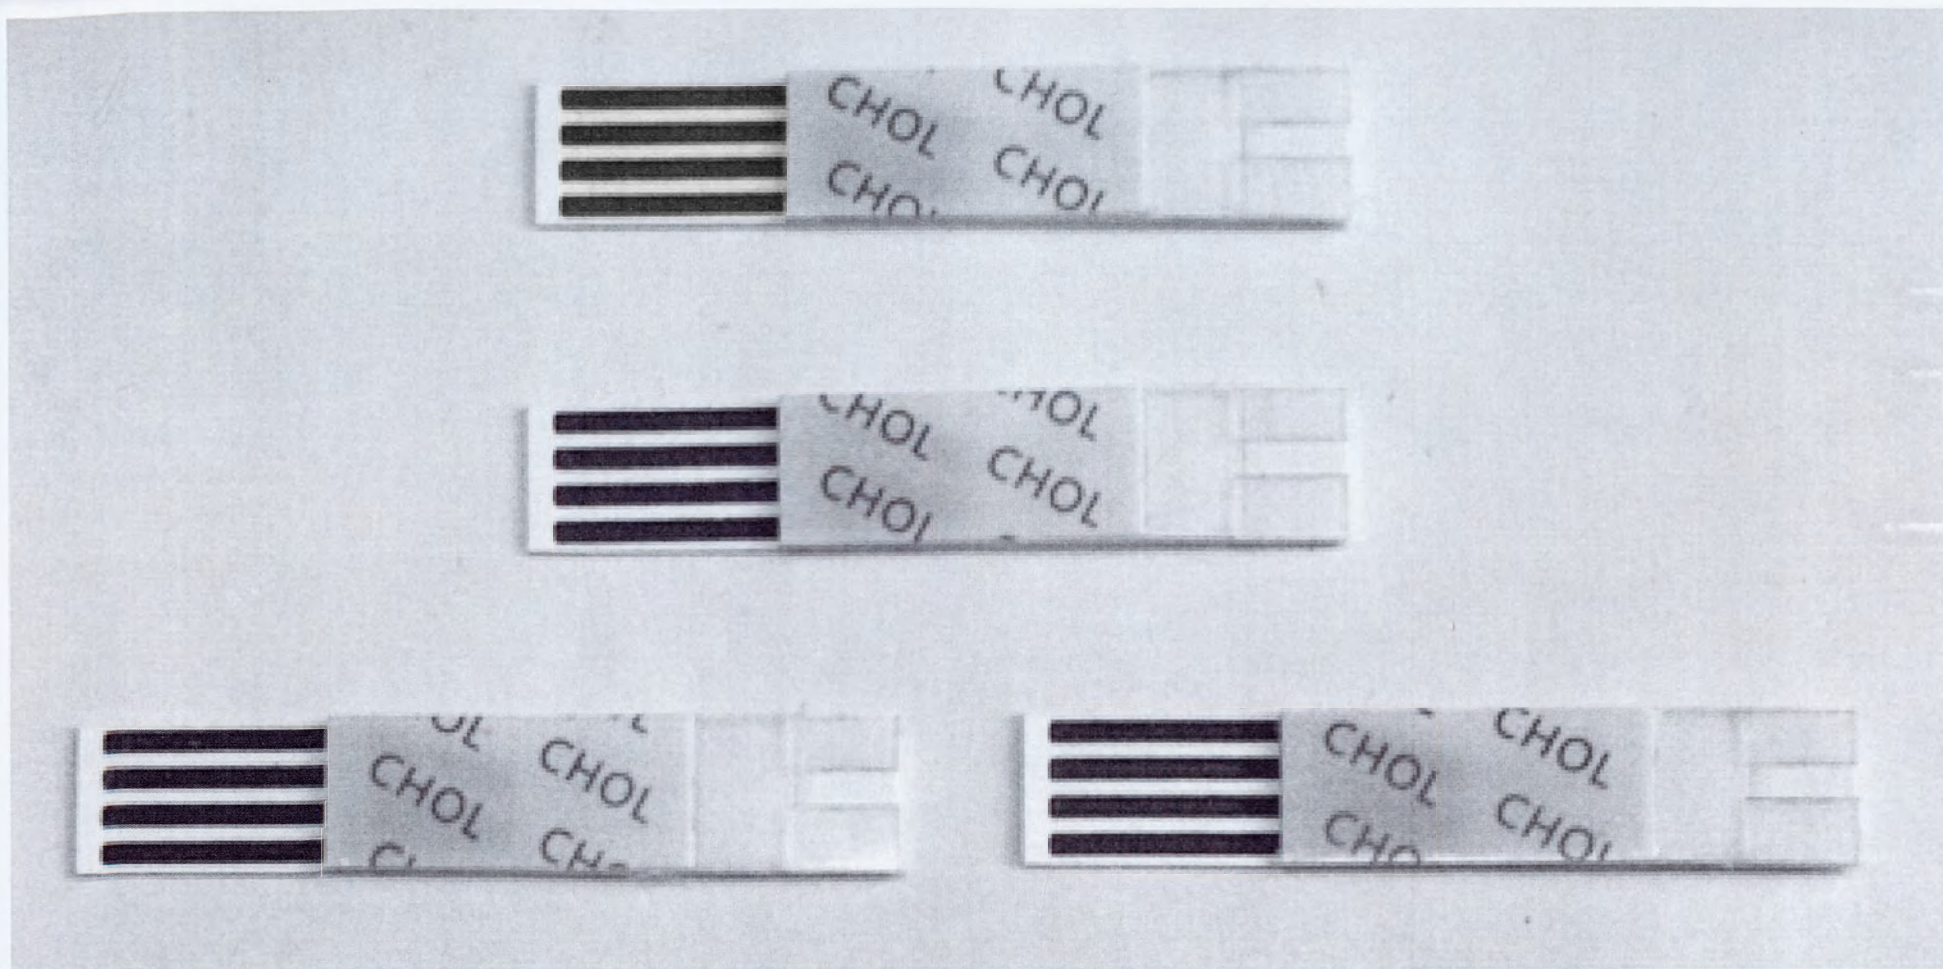


Рис. 10 Тест-полоски для измерения уровня холестерина в крови
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

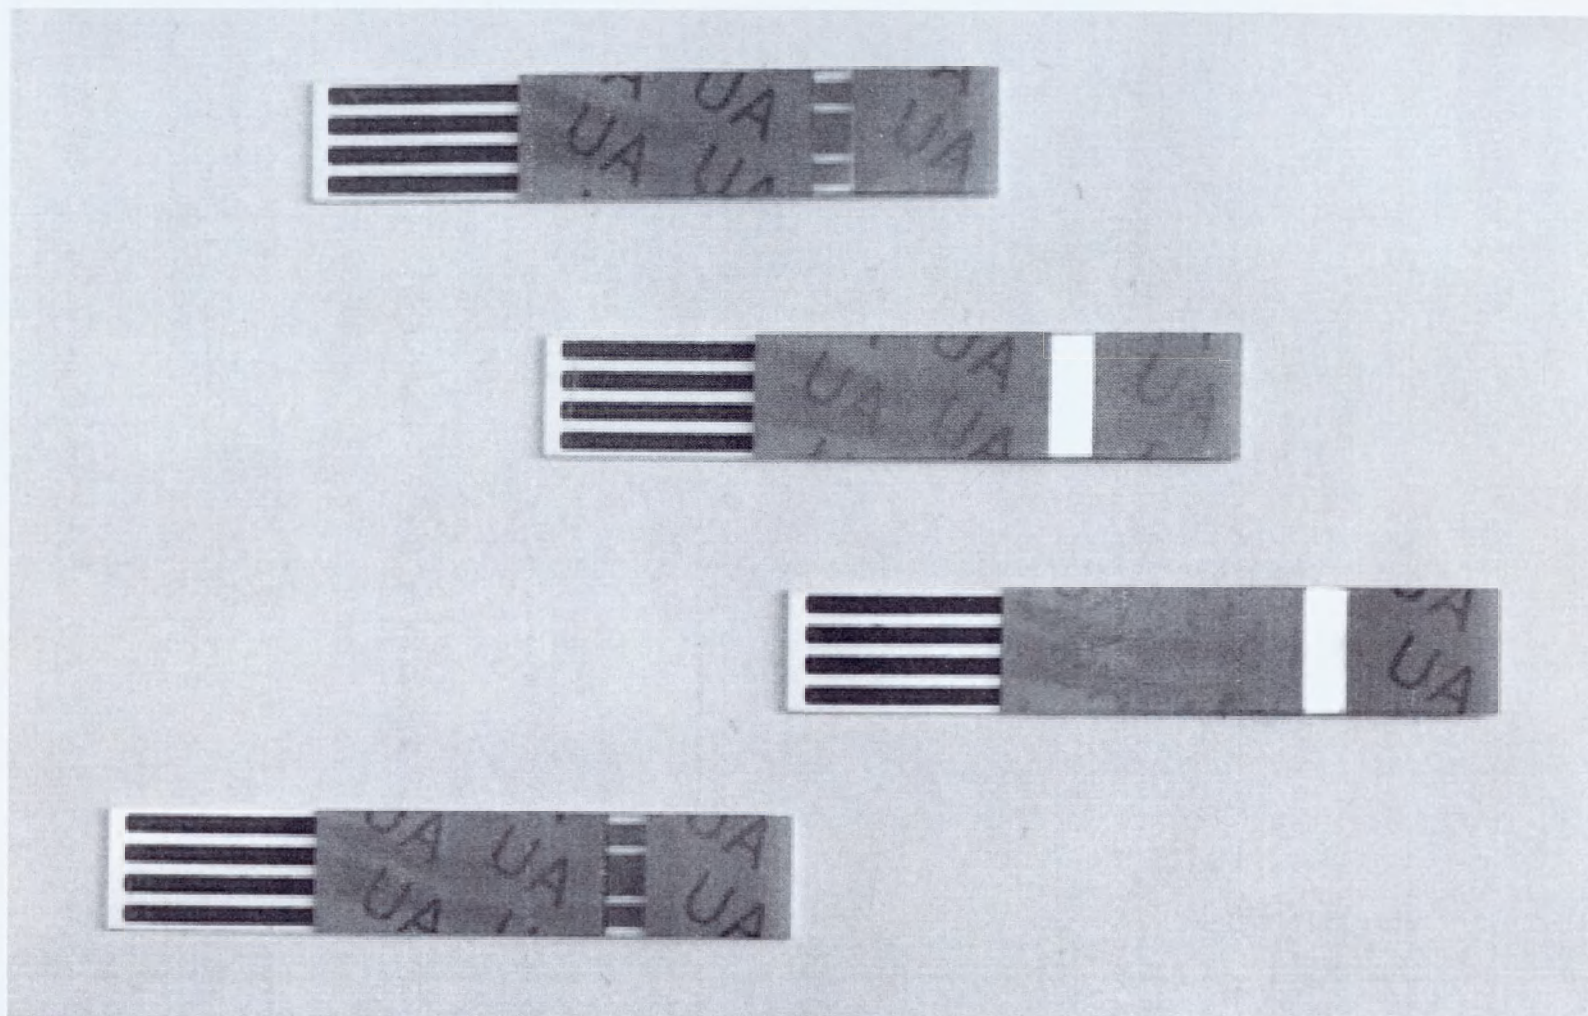


Рис. 11 Тест-полоски для измерения уровня мочевой кислоты в крови
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

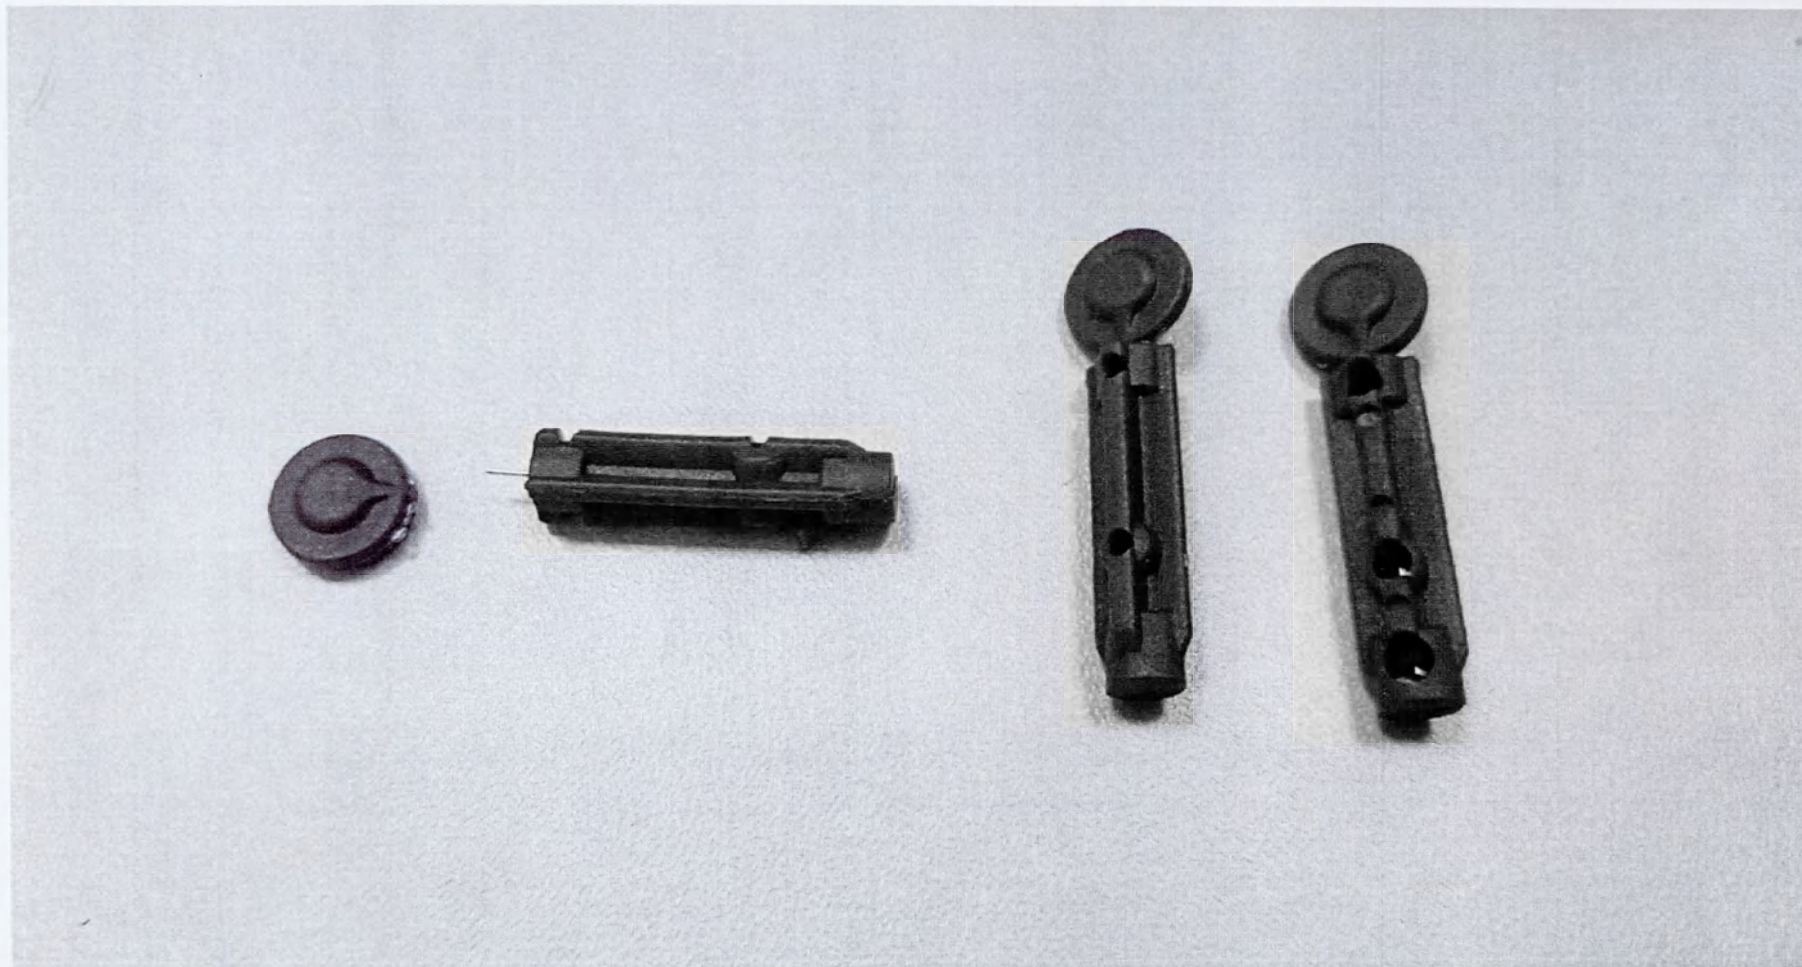


Рис. 12 Ланцет для прокалывания пальца, диаметром 28G (0,36 мм)
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

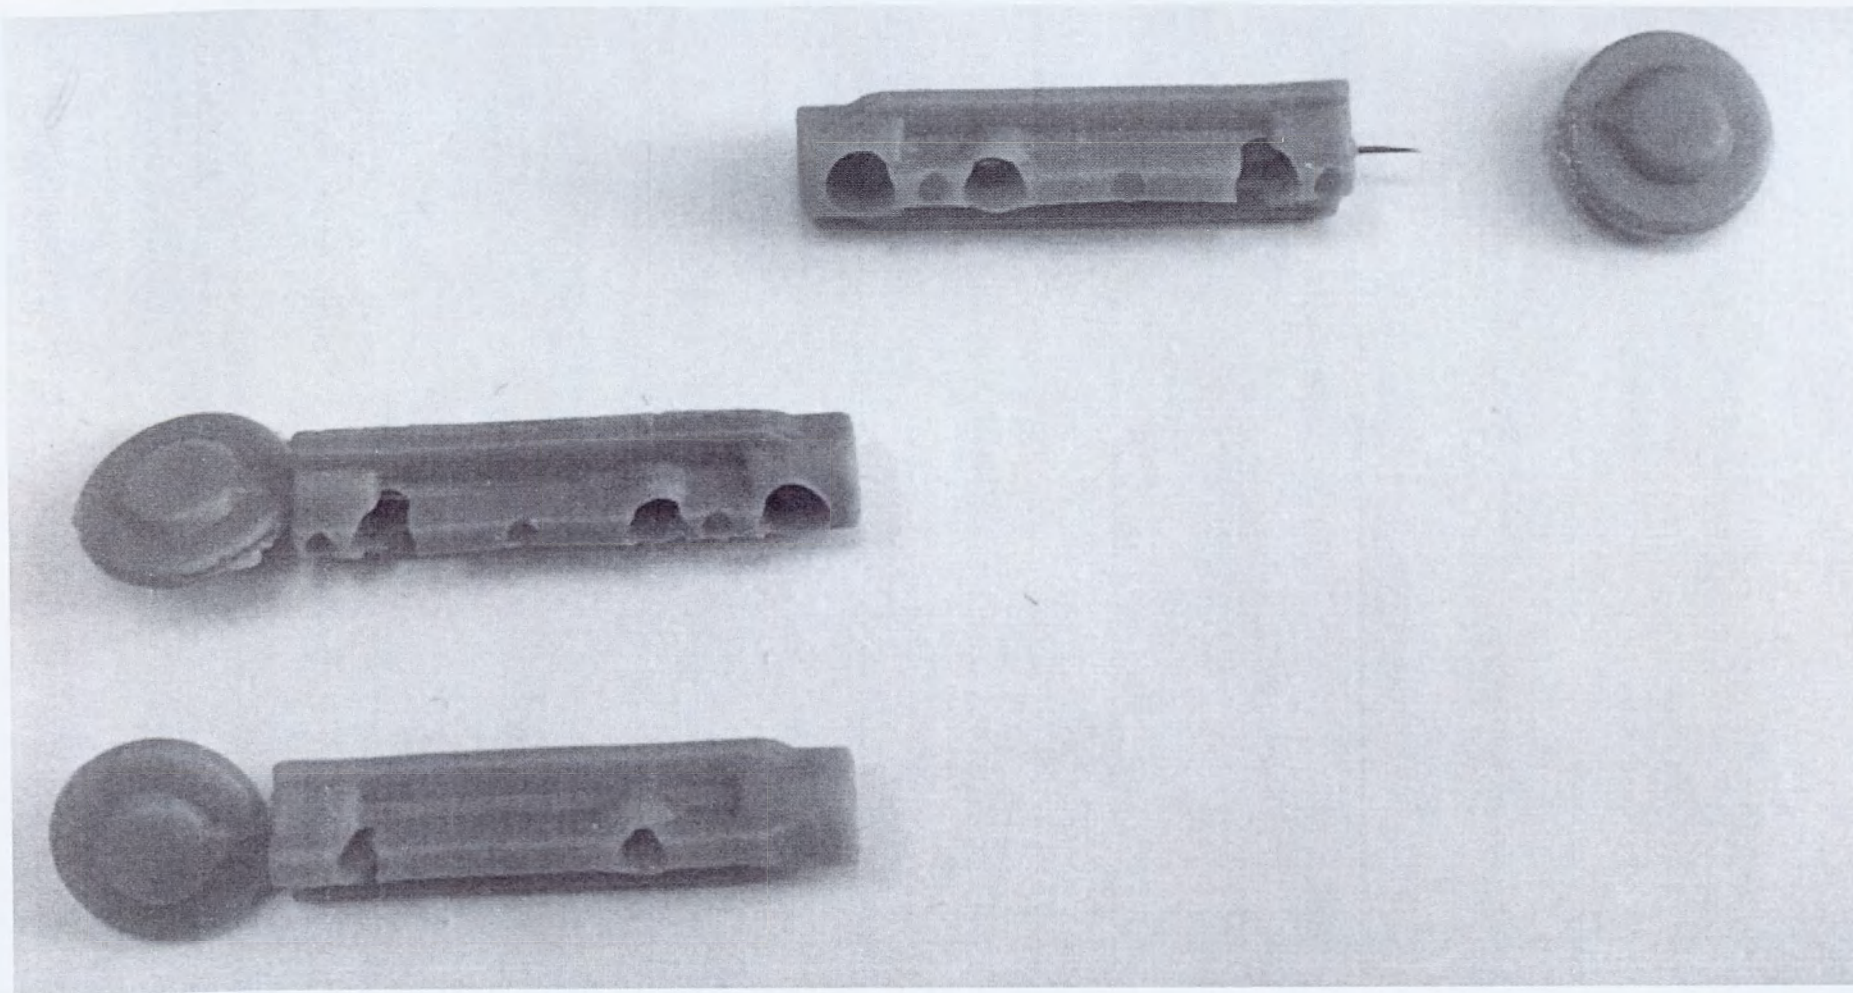


Рис. 13 Ланцет для прокалывания пальца, диаметром 30G (0,30 мм)
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

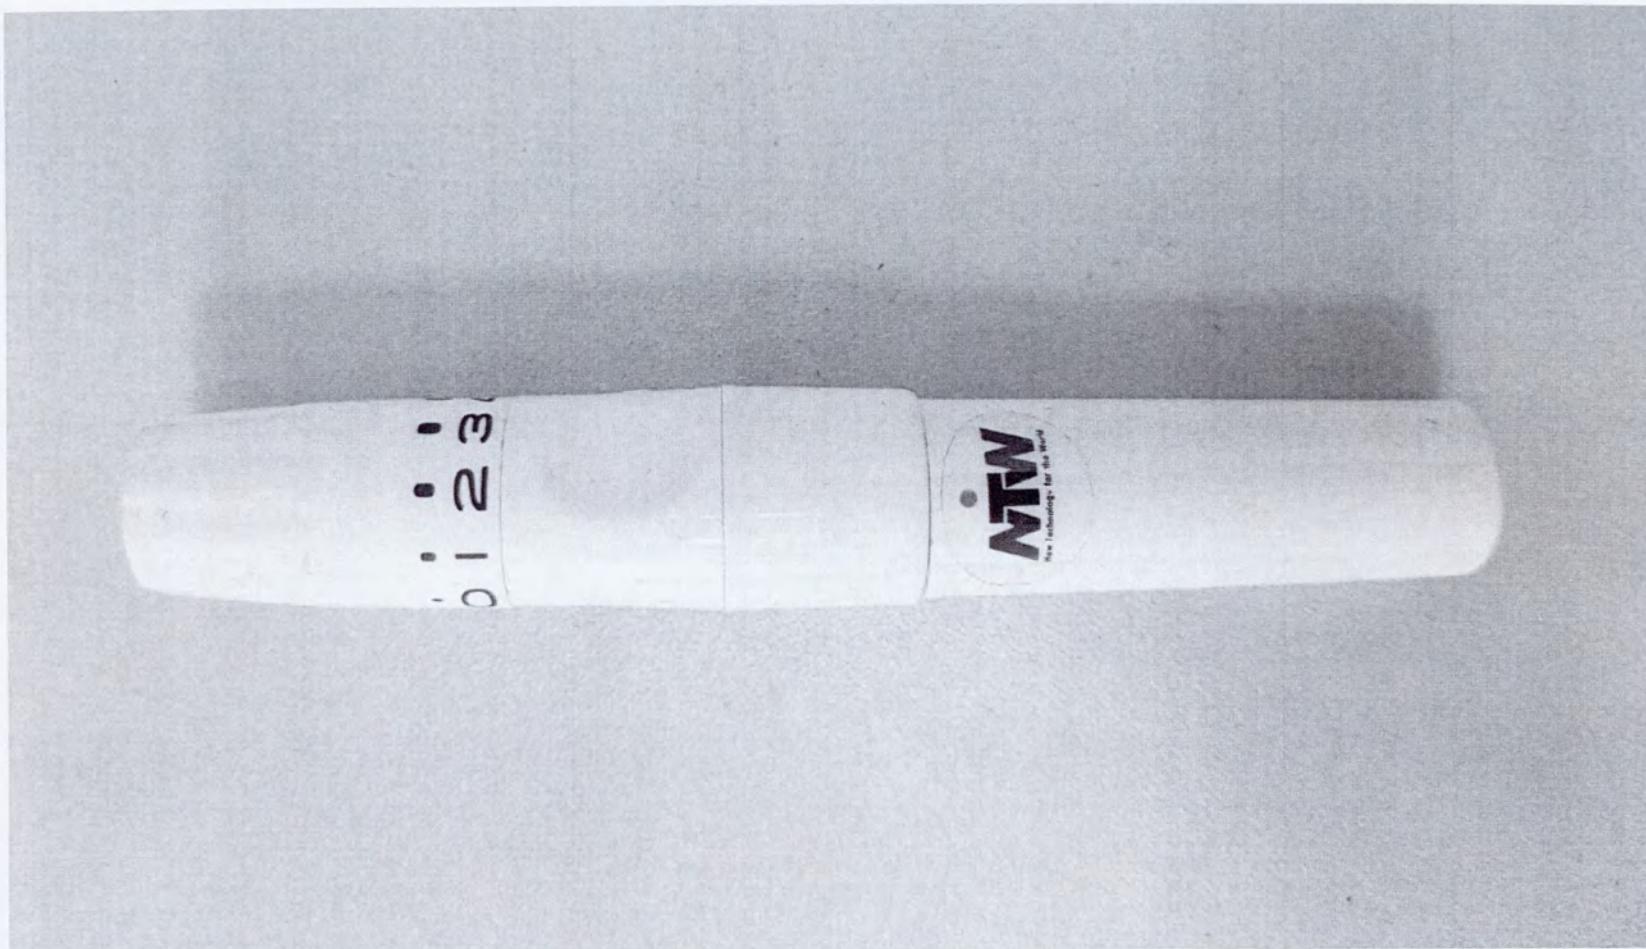


Рис. 14 Ручка-прокалыватель для забора крови
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 15 Элементы питания AAA
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

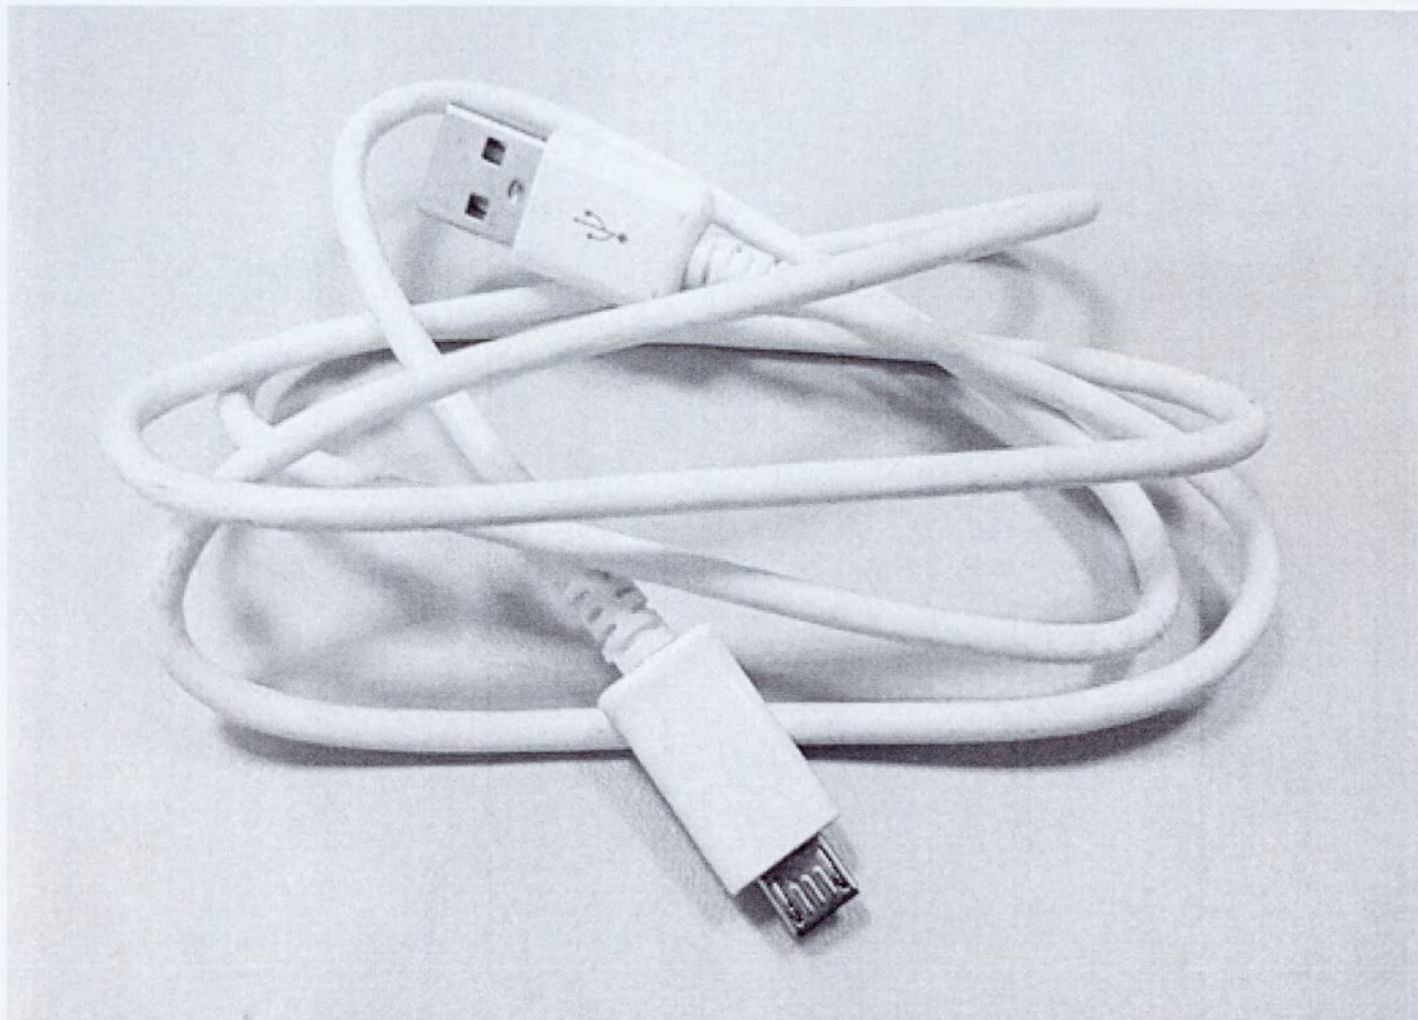


Рис. 16 USB – кабель

для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 17 Адаптер питания
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

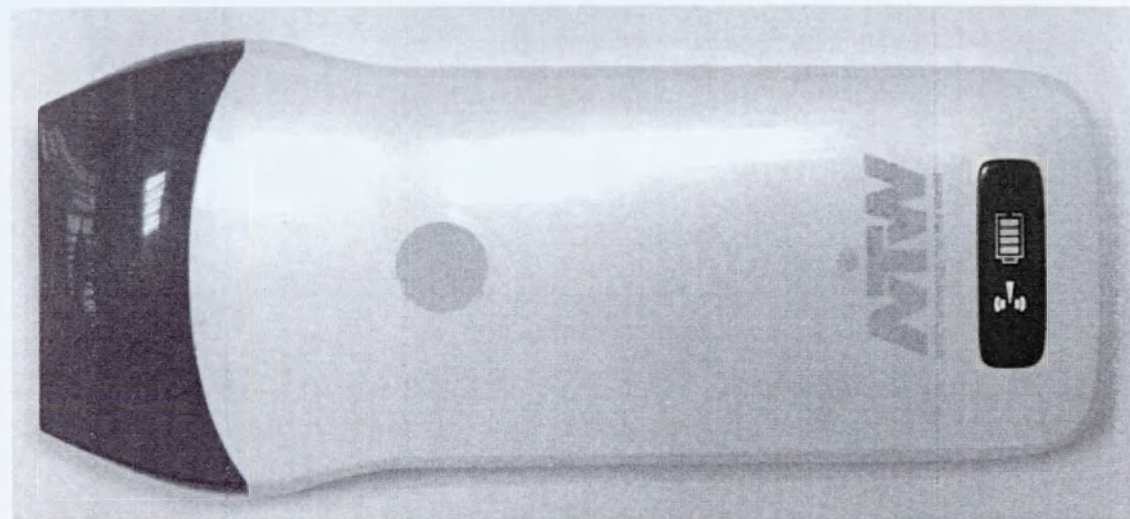


Рис. 18 Прибор ультразвуковой диагностический портативный беспроводной, исполнение 1
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 модель 02 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018

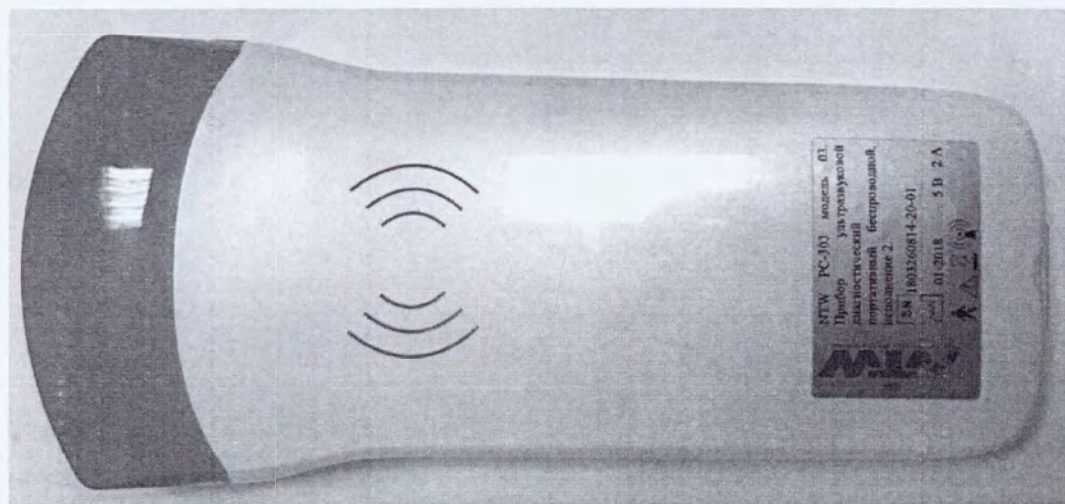
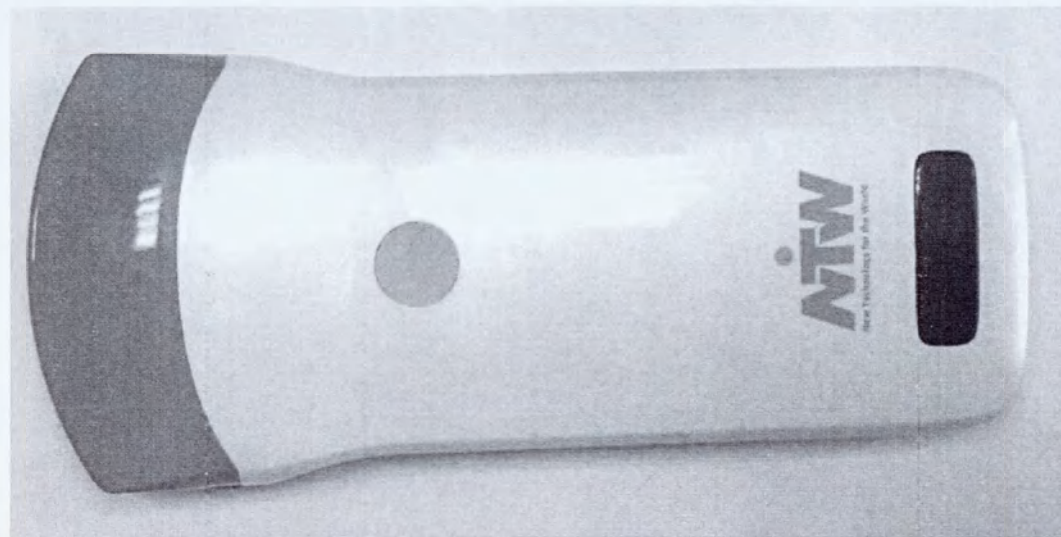


Рис. 19 Прибор ультразвуковой диагностический портативный беспроводной, исполнение 2
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 модель 03 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018



Рис. 20 Весы многофункциональные
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03



Рис. 21 Кейс для переноски комплекса диагностического
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01



Рис. 22 Кейс для переноски комплекса диагностического
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 02



Рис. 23 Кейс для переноски комплекса диагностического
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 03



**Рис. 24 Рюкзак для переноски комплекса диагностического
для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018
в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03**



Рис. 25 Сумка на колесах для переноски комплекса диагностического для Комплекса диагностического портативного для мониторинга состояния пациента NTW PC-303 по ТУ 26.60.12-001-06170364-2018 в вариантах исполнения: модель 01, модель 02, модель 03

Прошито и пронумеровано

26 лист *dv*

Ген.директор

