

Катетер наружный (уропрезерватив)



№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Рис. 1

Катетер наружный (уропрезерватив) – в скатанном виде

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

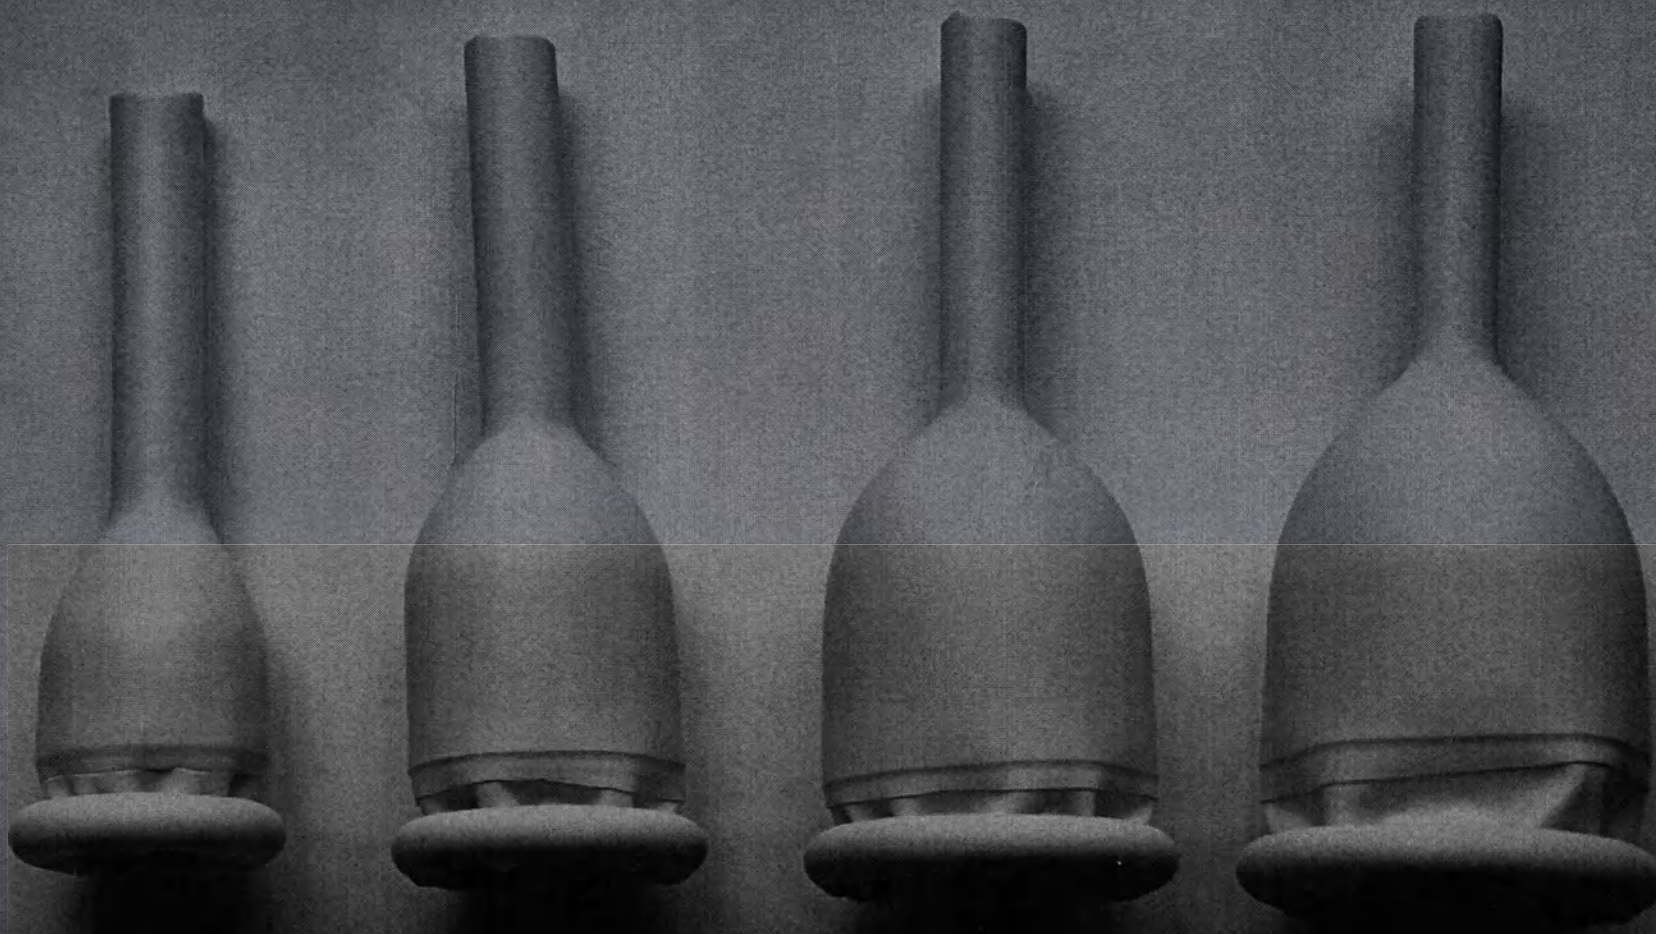


Рис. 2

Укладка комплектов катетеров № 4 в гофрокороб



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт
резиновых и полимерных изделий

Упаковочный лист

Наименование изделия: Катетер
наружный (уропрезерватив)

Номер партии:

1

Размер изделия:

4

Дата изготовления: 11.2017г.

Номер упаковщика:

1К

Акционерное общество
Научно-исследовательский институт
резиновых и полимерных изделий

107584, Москва, ул. Краснобогатырская, 42, стр. 1
тел. +7 (499) 161-02-91, факс: +7 (495) 363-49-11
secret@nirpc.ru, www.nirpc.ru

Катетер наружный (уропрезерватив)
ГОСТ Р 50444-92 / ТУ 32.50.13-071-00152164-2017
РУ №



Инструкция по применению



НИИР

ГОСТ Р
50444-92

Ин

уропрезерватив)
1-00152164-2017



Маркировка гофрокороба с катетерами



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт
резиновых и полимерных изделий

107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42, стр. 1
Тел.: +7 (495) 761-02-82, факс: +7 (495) 963-49-11
secretary@isc-niir.ru, www.isc-niir.ru

**Катетер наружный
(уропрезерватив)
РУ №**

Страна-изготовитель: Россия

Номер партии:





Размер изделия: **№ 3**

Дата изготовления: **ноябрь 2017г.**


Количество изделий, шт: **30**

Номер упаковщика: **1К**

Обозначение технических условий:
ТУ 32.50.13-071-00152164-2017

Условия хранения: в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении катетеры должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию масел, керосина, бензина и других органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей

Гарантийный срок хранения: 4 года




2021-11



Акционерное общество
Научно-исследовательский институт
резиновых и полимерных изделий

107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42, стр. 1
Тел.: +7 (495) 761-02-82, факс: +7 (495) 963-49-11
secretary@isc-niir.ru, www.isc-niir.ru

**Катетер наружный
(уропрезерватив)
РУ №**

Страна-изготовитель: Россия

Номер партии:





Размер изделия: **№ 4**

Дата изготовления: **ноябрь 2017г.**


Количество изделий, шт: **30**

Номер упаковщика: **1К**

Обозначение технических условий:
ТУ 32.50.13-071-00152164-2017

Условия хранения: в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении катетеры должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию масел, керосина, бензина и других органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей

Гарантийный срок хранения: 4 года




2021-11

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (*четыре*) листа (ов)

Генеральный директор

Корчашкин В.В.

