

dia **тера**[®]

Работа

Сеть


Пуск
Стоп

АМТО-02

аппарат магнитотерапевтический
офтальмологический





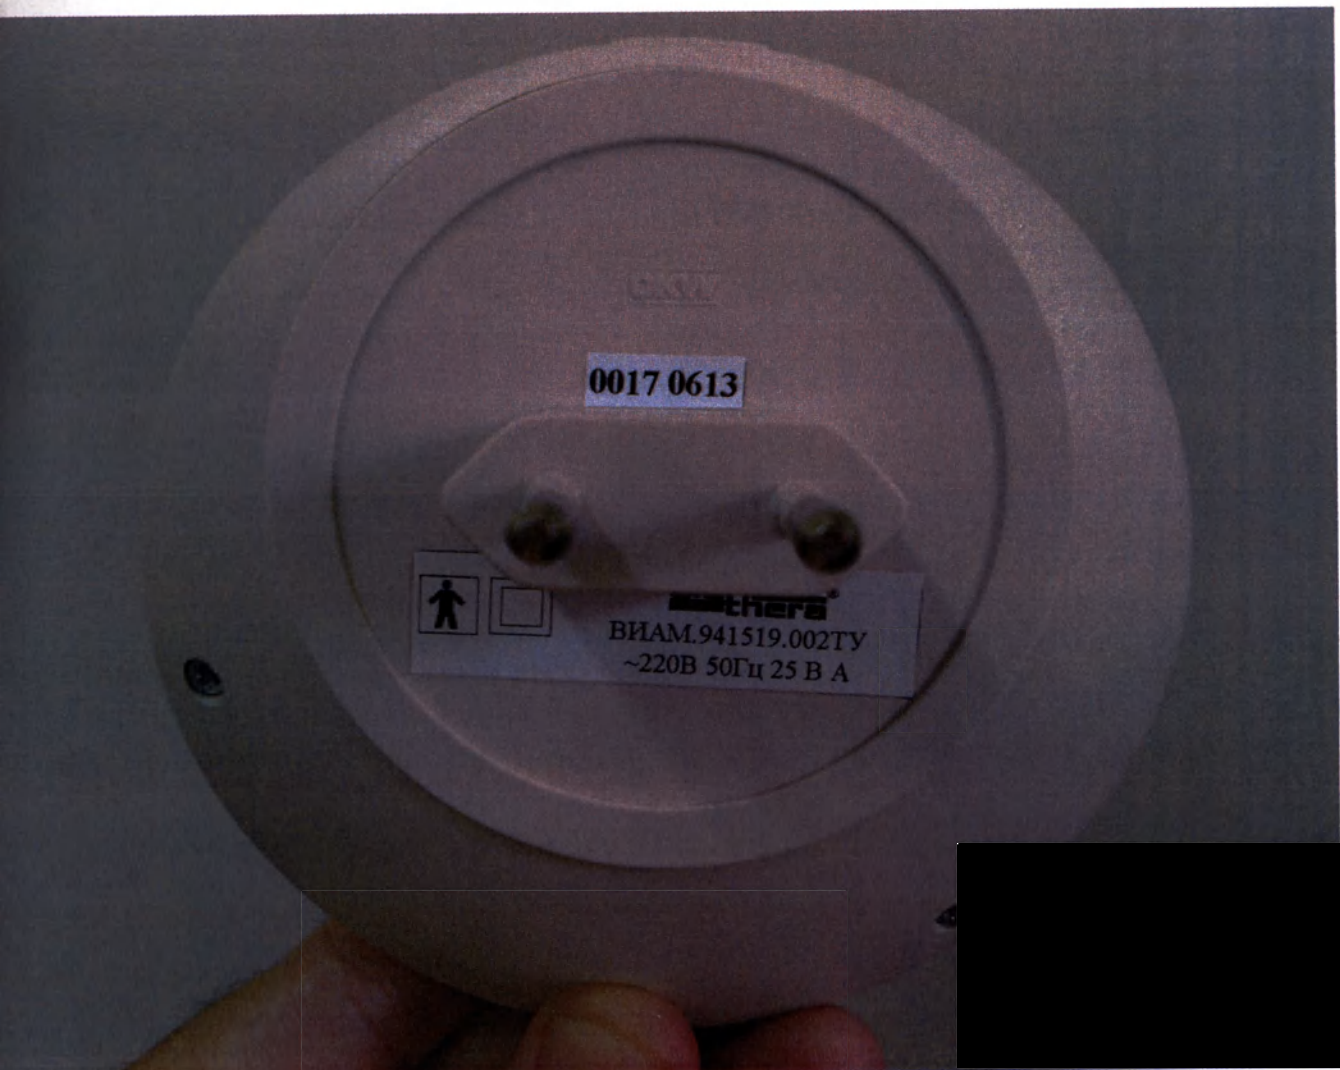

0017 0613



thera
ВИАМ.941519.002ТУ
~220В 50Гц 25 В А