


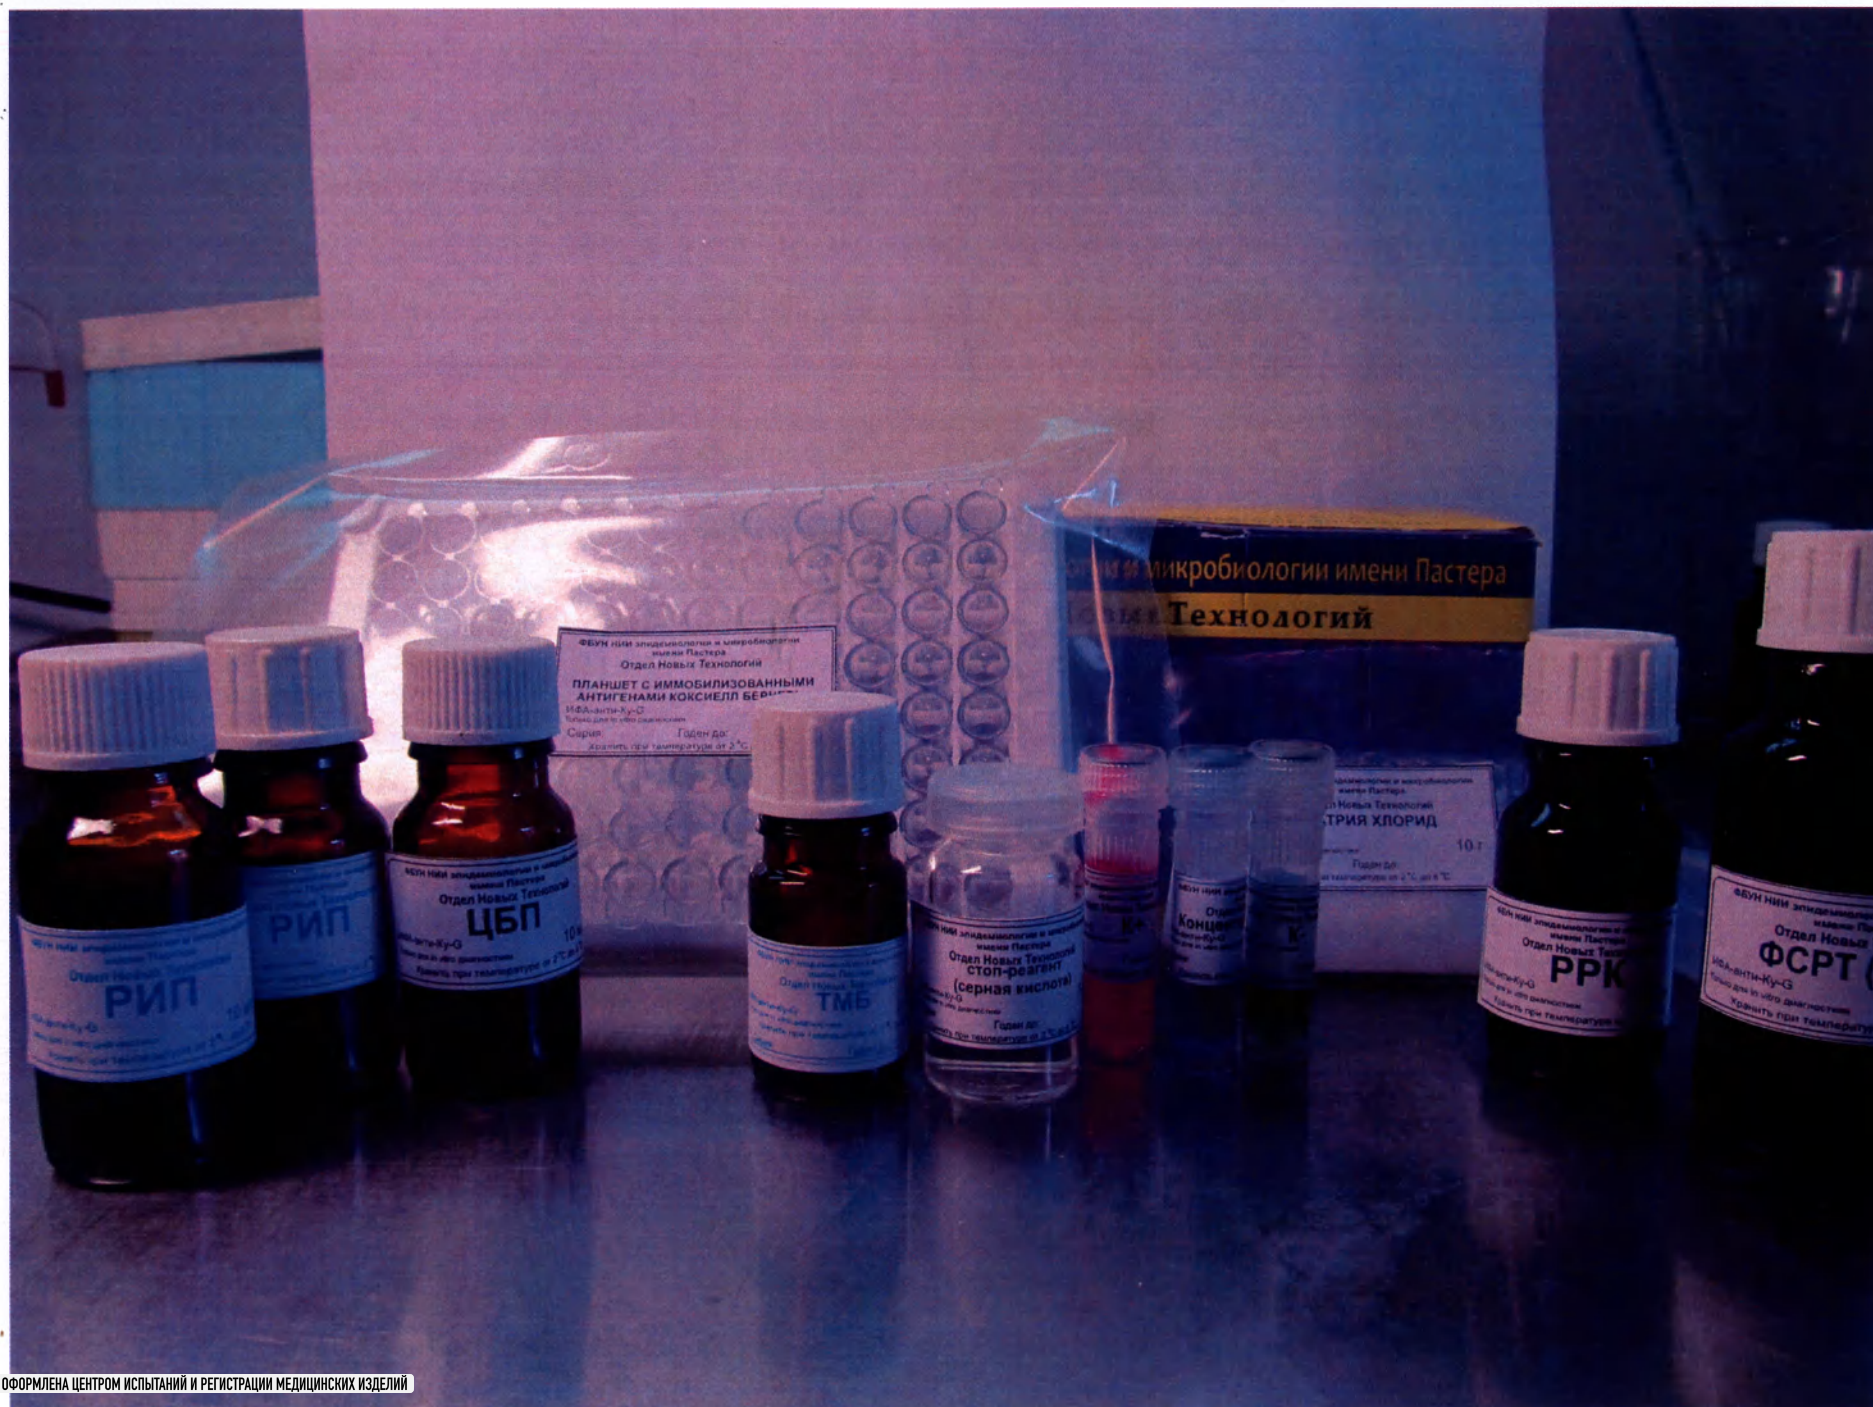

Этикетка на коробку

197101 Санкт-Петербург, ул. Мира, 14, ФБУН ИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
 Отдел Новых Технологий, тел 325-27-10, тф 233-17-03
 E-mail: rasfauldn@yandex.ru

Набор реагентов тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к антигенам коксиелл Берна (ИФА-анти-Ky-G) ТУ - 21.20.23-024-01967164-2018 Ру:

Состав комплекта:	
- полистеровый планшет с иммобилизованными антигенами коксиелл Берна	1 шт;
- положительный контрольный образец (K+)	1 пр.;
- отрицательный контрольный образец (K-)	1 пр.;
- концентрат конъюгата	1 пр.;
- цитратный буферный раствор с перманентной окраской (CBT)	1 фл.;
- раствор для разведения исследуемых проб (РМГ)	2 фл.;
- раствор для разведения конъюгата (РРК)	1 фл.;
- фосфатно-солевой буферный раствор с танном (ФСБТ)	1 фл.;
- тетраметилбензидин (ТМБ)	1 фл.;
- наборный ключик	1 шт.;
- опол-раствор (серия 100000)	1 фл.;
- инструкция по применению	1 шт.

✓ 96 анализов

LOT :1

📅:06.2018

🕒:12.2018



MD

№ по каталогу:



Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита E и HBsAg отсутствуют

197101 Санкт-Петербург, ул. Мира, 14, ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
 Отдел Новых Технологий, тел 325-27-10, тф 333-17-03
 E-mail: reagents@yandex.ru

**Набор реагентов тест-система иммуноферментная
 для выявления антител класса IgG к антигенам коконелл Бернета
 (ИФА-анти-Ky-G) ТУ - 21.20.23-024-01967164-2018**

Состав комплекта:	
- калибровочный планшет с иммобилизованными антигенами коконелл Бернета.....	1 шт.;
- положительный контрольный образец (K+)	1 пр.;
- отрицательный контрольный образец (K-)	1 пр.;
- концентрат калибровочных стандартов.....	1 пр.;
- буферный раствор с пероксидазоподобной активностью (LSTB).....	1 фла.
- раствор для разведения концентрированных проб (РМР).....	2 фла.
- раствор для разведения концентрата (РРК).....	1 фла.
- фосфатно-солевой буферный раствор с тиазом (ФСРТ).....	1 фла.
- тетраэтиламмоний (ТМА).....	1 фла.
- натрий хлорид.....	1 шт.
- стоп-реагент (содержит NaOH).....	1 фла.
- инструкция по применению.....	1 шт.

LOT : 1 06.2018 12.2018   MD

Масса нетто:
 Масса брутто:
 Количество наборов:



