



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»
Шаламов А.В.
» августа 2019 г.



Фотографические изображения
упаковки медицинского изделия
«Регулируемые проводники True Form»
с дополнительной маркировкой на русском языке

Производства

Merit Medical Systems, Inc.

(«Мерит Медикал Системз, Инк.»), США

1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA.

Регулируемые проводники True Form

Регулируемые проводники True Form в комплекте с устройством для вращения проводника (1 шт.), устройством для введения проводника (1 шт.) и выпрямителем кончика проводника (1 шт.), инструкцией по применению (1 шт.) модели:

- Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком.

Индивидуальная упаковка медицинского изделия маркированная макетом дополнительного русскоязычного стикера
(пример модели «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»)




Регулируемые проводники True Form
РУ № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 145 см,
с прямым кончиком Номер по каталогу: TF14145S
УПШ: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 30-09-2017
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02
Негорючий. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Потребительская упаковка, маркированная макетом дополнительного русскоязычного стикера
(пример модели «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»)

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE

MERIT MEDICAL

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™

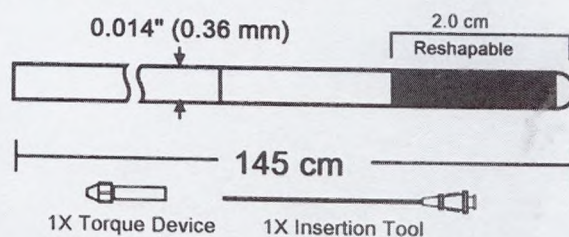

REF TF14145S

Rx ONLY

005 09/21/17 05:05:17 AM LFWR20074 REV 003 03/17

LOT H1212953

Use By: 2020-09-30

1 Unit
Made in Japan



(01)00864450207827

Non-pyrogenic



(01)00864450297827(17)200930(10)H1212953

000020409150

STERILE EO



Caution: Consult accompanying documents.



Do not use if package is damaged

CE 0086



Do not resterilize



Single Use


Регулируемые проводники True Form
РУ № XXX XXXXX.XXXX от XXXX.XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 145 см,
с прямым кончиком Номер по каталогу: TF14145S
УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 30-09-2017
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02
Неглексично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

EC REP Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3745
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22

For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

403127003/B 2017-01-17

Транспортная упаковка, маркированная макетом дополнительного русскоязычного стикера (пример модели «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»)

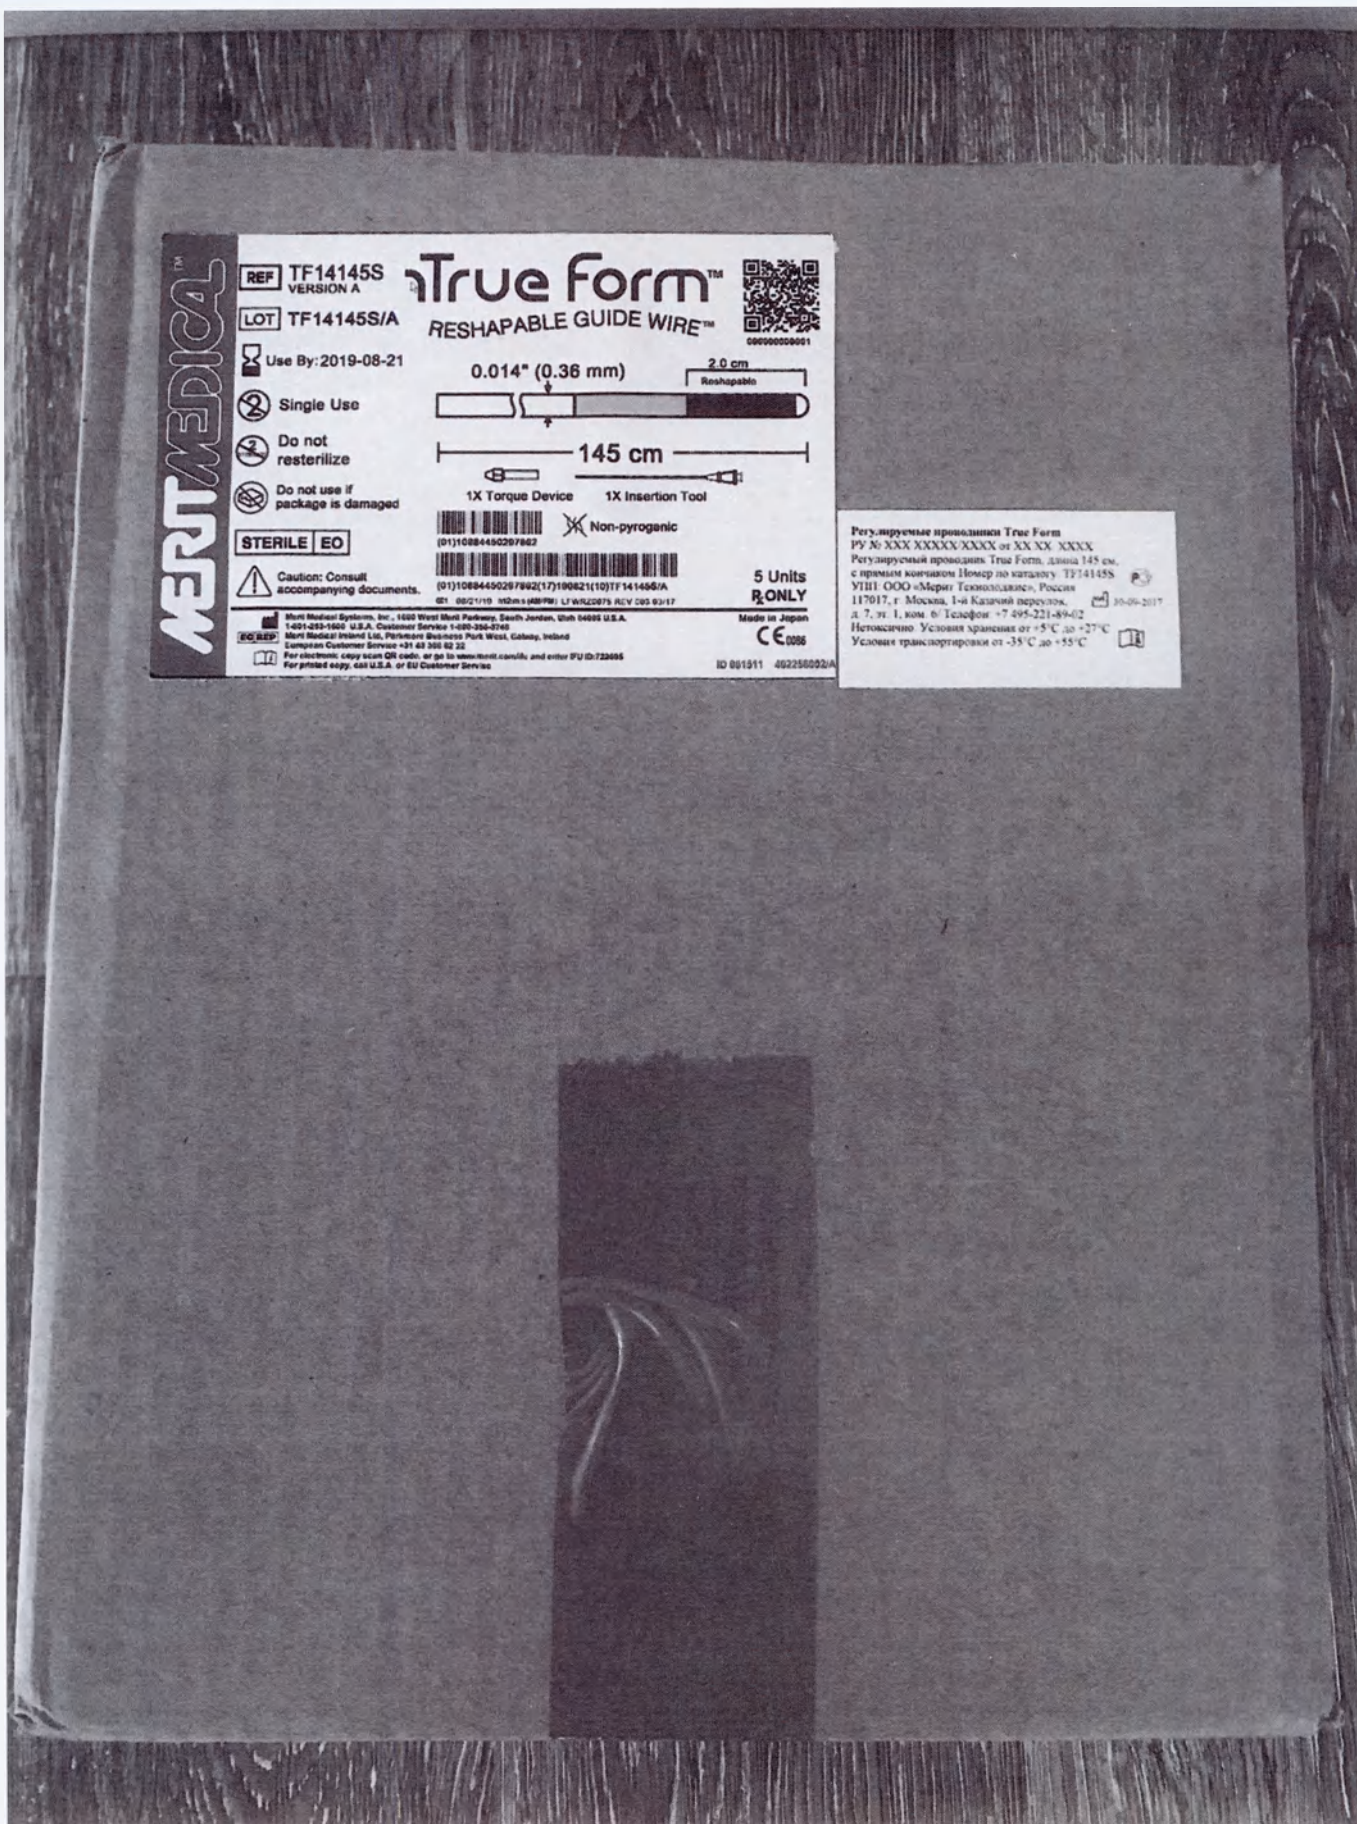


Всего прошито, пронумерован и
скреплено печатью

6 (шести)

листов

Генеральный директор
Шаламов А.В.

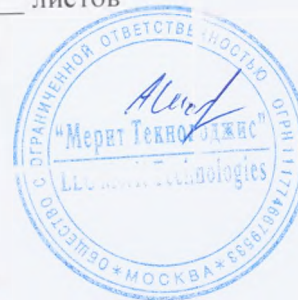



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Мерит Текнолоджис»

Шаламов А.В.

«22» августа 2019 г.



Макет маркировки
упаковки медицинского изделия
«Регулируемые проводники True Form»

(включая дополнительную маркировку на русском языке)

Производства

Merit Medical Systems, Inc.

(«Мерит Медикал Системз, Инк.»), США

1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah, 84095, USA.

Регулируемые проводники True Form

Регулируемые проводники True Form в комплекте с устройством для вращения проводника (1 шт.), устройством для введения проводника (1 шт.) и выпрямителем кончика проводника (1 шт.), инструкцией по применению (1 шт.) модели:

- Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком.
- Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком.

Оригинальная маркировка индивидуальной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

MERITMEDICA™

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm
Reshapable

145 cm
1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF **TF14145S** 1 Unit

LOT **TF14145S** Use By: 2019-08-22
Made in Japan

STERILE EO Non-pyrogenic
Caution: Consult accompanying documents
R ONLY

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™
REF **TF14145S**
LOT **TF14145S**

Do not resterilize Single Use Do not use if package is damaged CE 0086
Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1300 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 398 82 22
For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service ID 100611 402303004/A

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 145
см, с прямым кончиком
Номер по каталогу: TF14145S
Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

дд.мм.гггггг

PC i

Оригинальная маркировка потребительской упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

MERTMEDICA™

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm
Reshapable

145 cm
1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14145S 1 Unit

LOT TF14145S Use By: 2019-08-22
Made in Japan

STERILE EO Non-pyrogenic
Caution: Consult accompanying documents.
R ONLY

True Form™ REF TF14145S
RESHAPABLE GUIDE WIRE™
LOT TF14145S

Do not resterilize Single Use Do not use if package is damaged CE 0086

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1800 U.S.A. Customer Service 1-800-366-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service ID 100611 402303004/A

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 145
см, с прямым кончиком
Номер по каталогу: TF14145S
Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

ДД.ММ.ГГГГ

PC i

Оригинальная маркировка транспортной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

MERITMEDICAL™

REF TF14145S

LOT TF14145S

Use By: 2019-08-22

Single Use

Do not resterilize

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Caution: Consult accompanying documents.

True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm Reshapable

145 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

(01)10884450297824

(01)10884450297824(17)190822(10)TF14145S

001 08/22/19 h12:ms (AM/PM) LFWRZ0075 REV 003 03/17

Non-pyrogenic

5 Units
Rx ONLY

Made in Japan

CE 0086

ID 081511 402256002/A

000000000001

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком»

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 145 см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14145S

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка индивидуальной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»

MERITMEDICA™

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm
Reshapable

165 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14165S 1 Unit

LOT TF14165S Use By: 2019-08-23
Made in Japan

STERILE EO Non-pyrogenic
Caution: Consult accompanying documents.
R ONLY

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™
REF TF14165S
LOT TF14165S

Do not resterilize Single Use Do not use if package is damaged CE 0086

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service ID 100611 402303004/A

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 165
см, с прямым кончиком
Номер по каталогу: TF14165S
Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

ДД.ММ.ГГГГ


PC

Оригинальная маркировка потребительской упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»



True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™

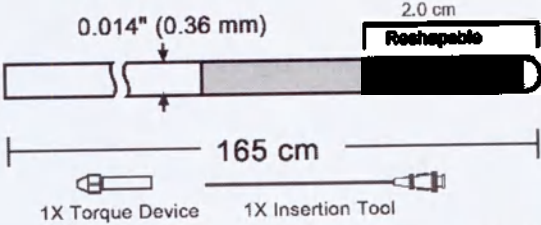

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm

165 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14165S

LOT TF14165S

Use By: 2019-08-23

1 Unit
Made in Japan

Rx ONLY


(01)0084450287831


(01)0084450287834(17)190823(10)TF14165S

 Non-pyrogenic


000000000001

STERILE EO

 Caution: Consult accompanying documents.

 Do not use if package is damaged

 Do not resterilize

 0086


 Single Use

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-396-3748
Merit Medical Ireland Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 388 82 22

EC/REP For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID:579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

400127003/B 2017-01-17

True Form™
RESHAPABLE GUIDE WIRE™



REF TF14165S 2019-08-23

LOT TF14165S

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»




УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02


Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
Регулируемый проводник True Form, длина 165
см, с прямым кончиком
Номер по каталогу: TF14165S
Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка потребительской упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»



True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™

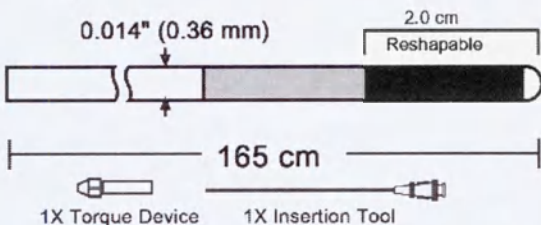

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm Reshapable

165 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14165S

LOT TF14165S

Rx ONLY


1 Unit

Made in Japan


(01)0084450297834


(01)0084450297834(17)190823(10)TF14165S

 Non-pyrogenic

 **STERILE EO**

 Caution: Consult accompanying documents.


000000000001

 CE 0086

 Do not use if package is damaged

 Do not resterilize

 Single Use

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748


Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 356 82 22

For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

40512703/3 2017-01-17

True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™



0.014" (0.36 mm) 2.0 cm

165 cm

REF TF14165S 2019-08-23

LOT TF14165S

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»



ДД.ММ.ГГГГГ



УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 165
см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14165S

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка транспортной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»

MERITMEDICAL™

True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™



000000000001

REF TF14165S

LOT TF14165S

 Use By: 2019-08-22

 Single Use


 Do not resterilize

 Do not use if package is damaged

STERILE EO

 Caution: Consult accompanying documents.

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm

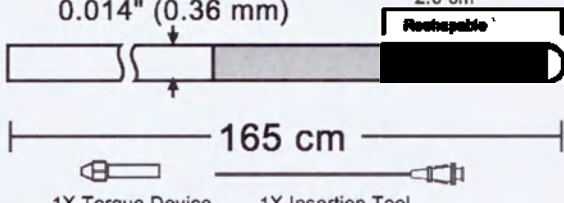

165 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

 Non-pyrogenic
(01)1088445029/831


(01)10884450297831(17)190822(10)TF14165S

001 08/22/19 h12:ms (AM/PM) LFWRZ0075 REV 003 03/17

5 Units

Rx ONLY

CE 0086

Made in Japan

ID 081511 402256002/A

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22

For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 165 см, с прямым кончиком»



ДД.ММ.ГГГГ

УП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02


Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 165
см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14165S

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка индивидуальной упаковки
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»

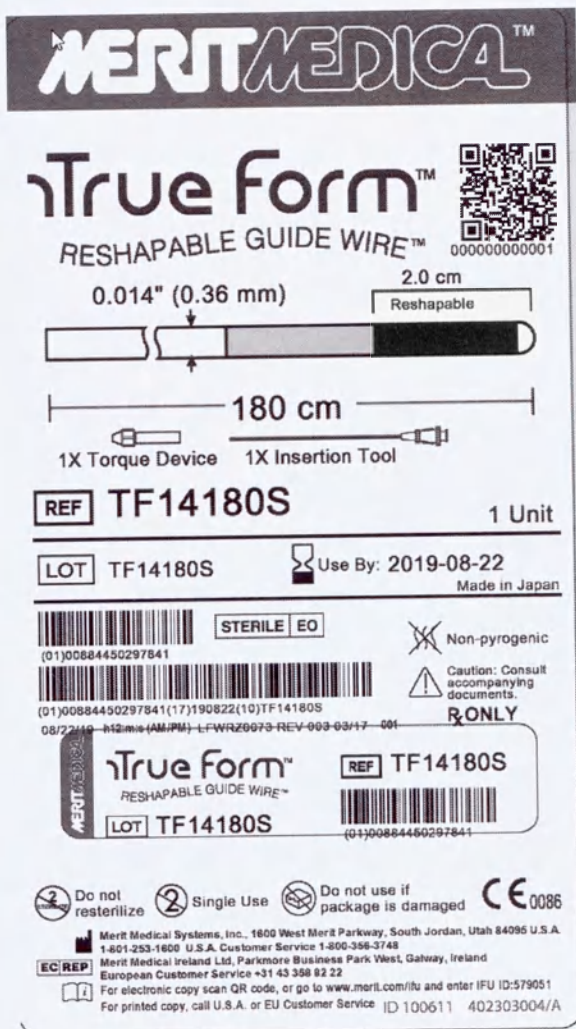

MERITMEDICA™

True Form™
 RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm
 Reshapable

180 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14180S 1 Unit

LOT TF14180S Use By: 2019-08-22
 Made in Japan

STERILE EO

Non-pyrogenic

Caution: Consult accompanying documents.

R ONLY

True Form™
 RESHAPABLE GUIDE WIRE™


REF TF14180S
LOT TF14180S

Do not resterilize Single Use Do not use if package is damaged

CE 0086

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
 Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
 European Customer Service +31 43 358 82 22
 For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
 For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service ID 100611 402303004/A

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»

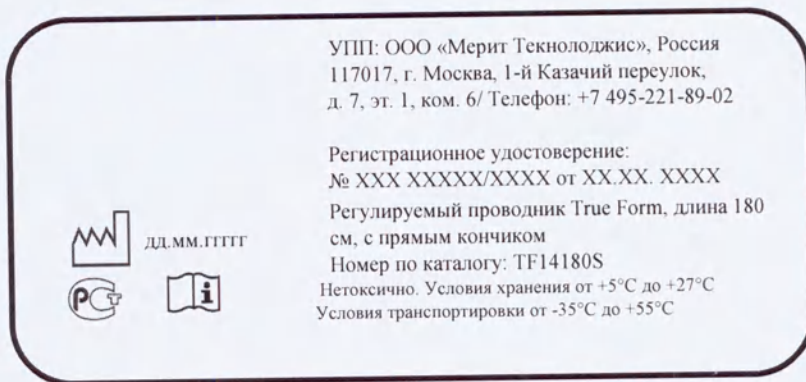

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
 117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
 д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
 № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
 Регулируемый проводник True Form, длина 180
 см, с прямым кончиком
 Номер по каталогу: TF14180S

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
 Условия транспортировки от -35°C до +55°C


ДД.ММ.ГГГГ

PC i

Оригинальная маркировка потребительской упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»



Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»

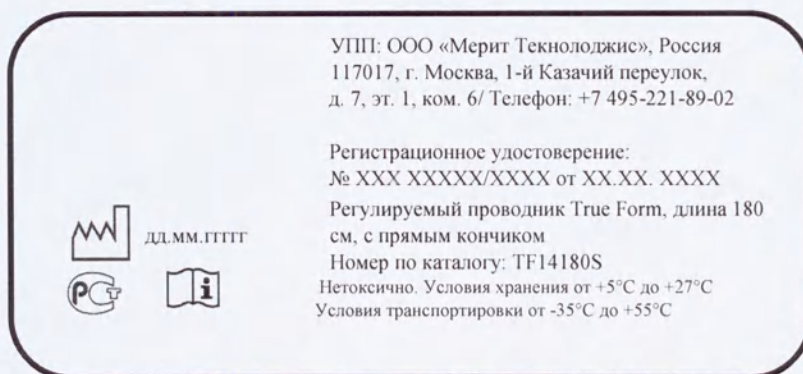

Оригинальная маркировка транспортной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»

MERITMEDICAL™

REF TF14180S

LOT TF14180S

Use By: 2019-08-22

Single Use

Do not resterilize

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Caution: Consult accompanying documents.

True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm)

2.0 cm Reshapeable

180 cm

1X Torque Device 1X Insertion Tool

(01)10884450297848

(01)10884450297848(17)190822(10)TF14180S

001 08/22/19 h12:mks (AM/PM) LFWRZ0075 REV 003 03/17

Non-pyrogenic

000000000001

5 Units
Rx ONLY

Made in Japan

0086

ID 081511 402256002/A

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с прямым кончиком»

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. I, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 180
см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14180S

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка индивидуальной упаковки
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»




True Form™
 RESHAPABLE GUIDE WIRE™



000000000001

0.014" (0.36 mm) 2.0 cm
 Reshapable

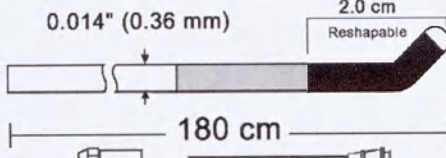

180 cm
 1X Torque Device 1X Insertion Tool

REF TF14180A 1 Unit

LOT TF14180A Use By: 2019-08-23
 Made in Japan

STERILE EO Non-pyrogenic
 Caution: Consult accompanying documents.

06/23/19 - M2-Me (M2M) - LFWZ0079-REV-005-09/17-001

True Form™ RESHAPABLE GUIDE WIRE™
REF TF14180A
LOT TF14180A

Do not resterilize Single Use Do not use if package is damaged **CE 0086**

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
 Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
 European Customer Service +31 43 358 82 22
 For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579651
 For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service ID 100611 402303004/A

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»




ДД.ММ.ГГГГ



УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
 117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
 д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
 № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX
 Регулируемый проводник True Form, длина 180
 см, с прямым кончиком
 Номер по каталогу: TF14180A
 Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
 Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка потребительской упаковки
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»

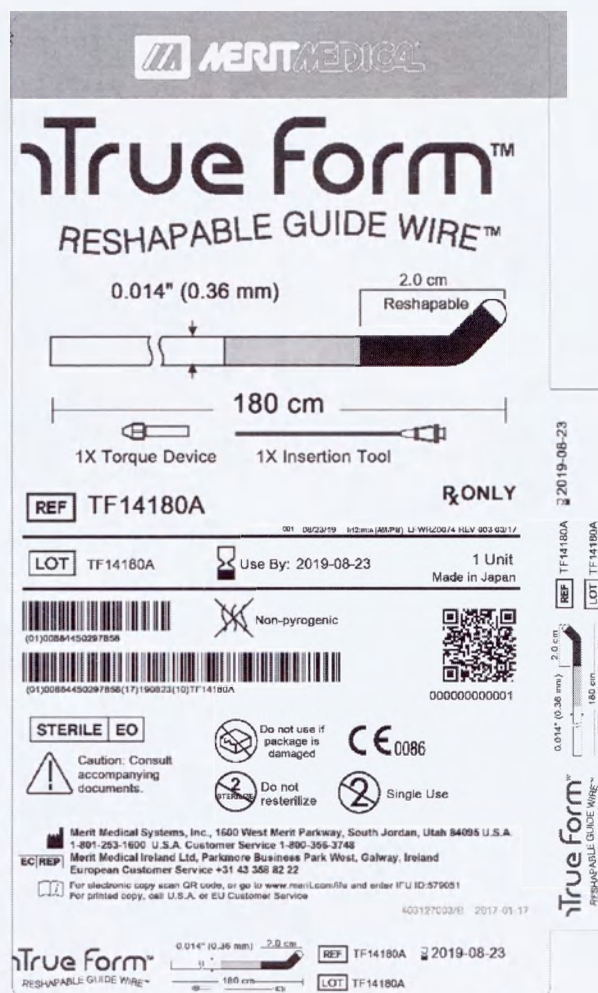

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
 Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»



ДД.ММ.ГГГГ

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
 117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
 д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
 № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 180
 см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14180A

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
 Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Оригинальная маркировка транспортной упаковки
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»

MERITMEDICAL™

REF TF14180A

LOT TF14180A

Use By: 2019-08-22

Single Use

Do not resterilize

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Caution: Consult accompanying documents.

True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE™

0.014" (0.36 mm)

180 cm

2.0 cm Reshapable

1X Torque Device 1X Insertion Tool

000000000001

(01)10884450297855

(01)10884450297855(17)190822(10)TF14180A

001 08/22/19 h12:m:s (AM/PM) LFWRZ0075 REV 003 03/17

5 Units

R ONLY

Made in Japan

0086

ID 081511 402256002/A

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3743

Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22

For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID: 579051
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

Макет дополнительного русскоязычного стикера для обращения на территории Российской Федерации
Вариант исполнения «Регулируемый проводник True Form, длина 180 см, с изогнутым кончиком»

ДД.ММ.ГГГГГ

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис», Россия
117017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д. 7, эт. 1, ком. 6/ Телефон: +7 495-221-89-02

Регистрационное удостоверение:
№ XXX XXXXX/XXXX от XX.XX. XXXX

Регулируемый проводник True Form, длина 180
см, с прямым кончиком

Номер по каталогу: TF14180A

Нетоксично. Условия хранения от +5°C до +27°C
Условия транспортировки от -35°C до +55°C

Всего прошито, пронумерован и
скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор
Шаламов А.В.

