


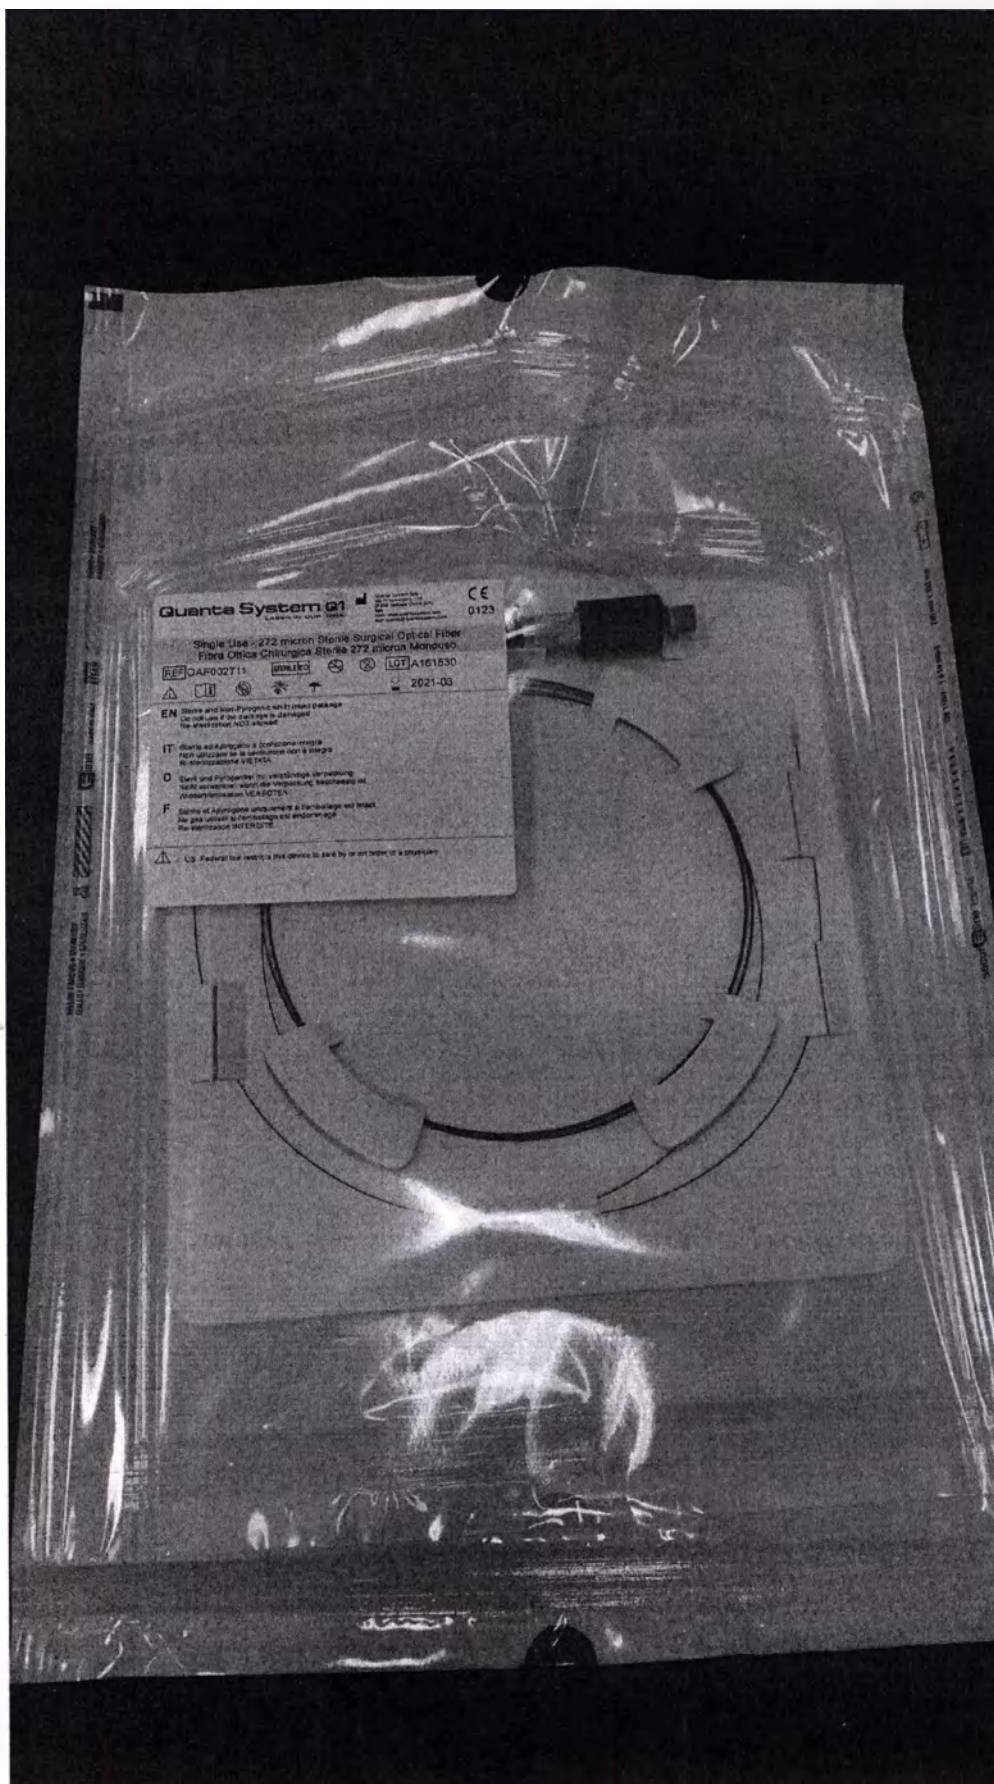

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия на примере варианта исполнения «Волокно хирургическое лазерное стерильное Quanta System одноразового использования, диаметр сердечника: 272 микрона, с плоским наконечником без покрытия» (внешний вид всех вариантов исполнения идентичен)