


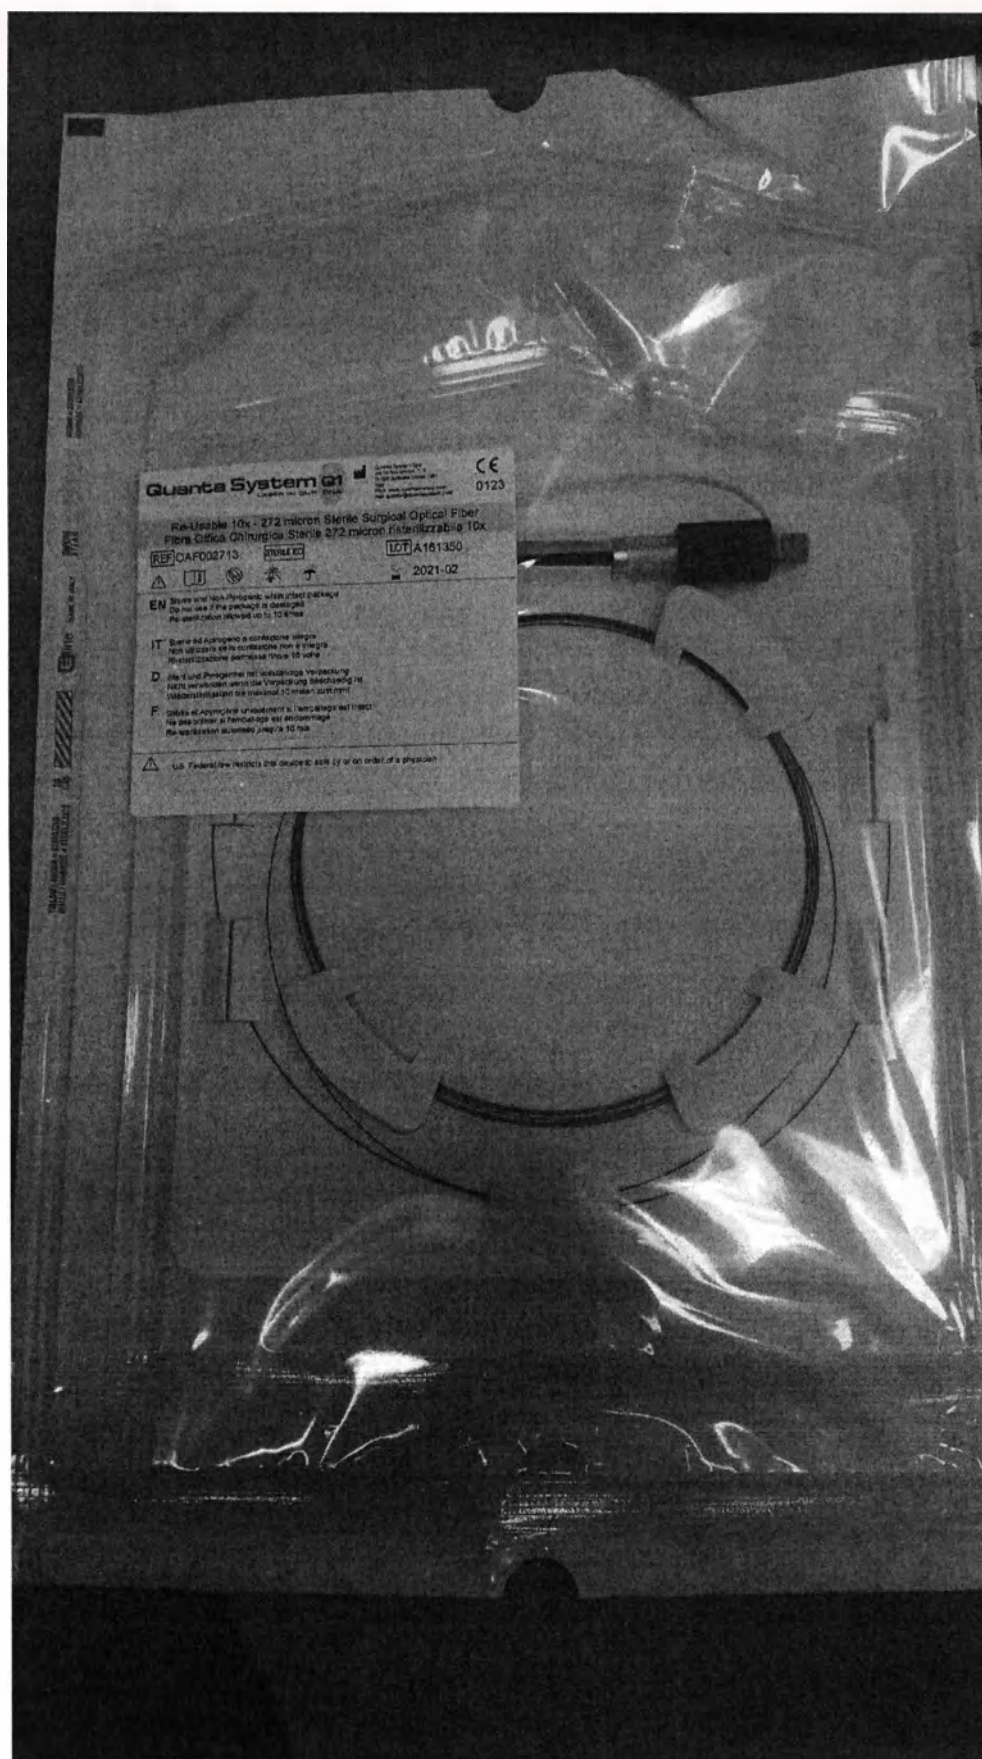

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия на примере варианта исполнения «2. Волокно хирургическое лазерное стерильное Quanta System десятикратного использования, диаметр сердечника: 272 микрона, с плоским наконечником без покрытия.» (внешний вид всех вариантов исполнения идентичен)