

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
эпидемиологии - Врио директора
Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора)




В.Г. Акимкин



«14» 2018 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов
(HSV I, II) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с электрофоретической детекцией продуктов амплификации
в агарозном геле

«АмплиСенс[®] HSV I, II-EPh»

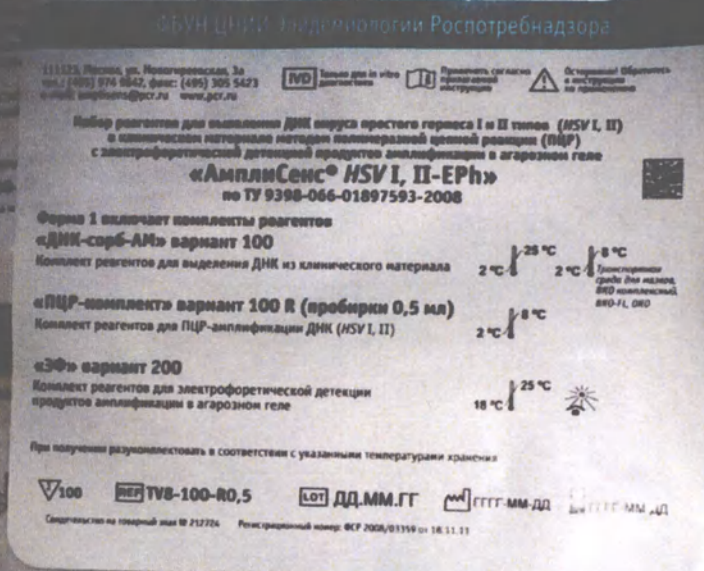

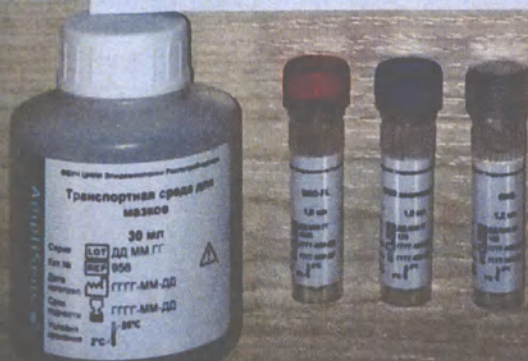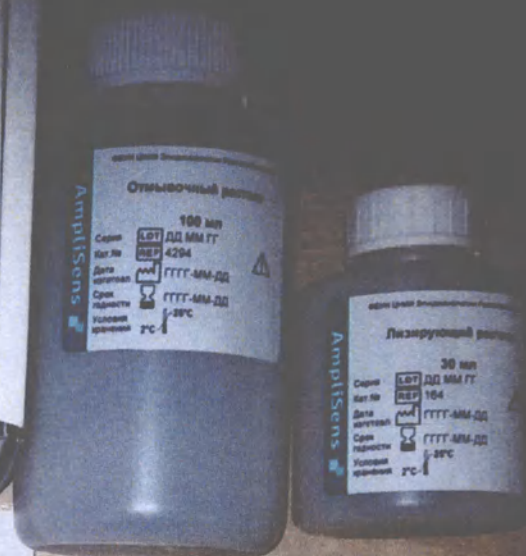

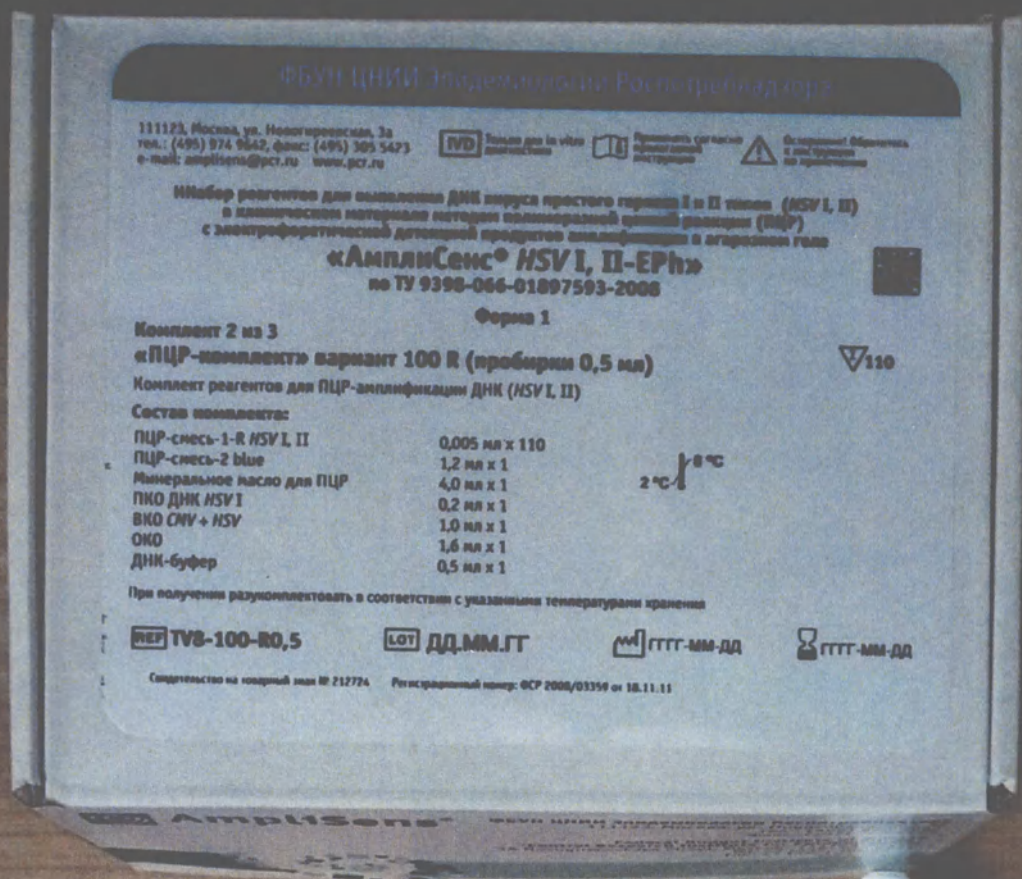

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
 e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru



Только для in vitro
 диагностики



Принимать согласно
 прилагаемой
 инструкции



Осторожно! Обратиться
 к инструкции
 по применению

Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II)
 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
 с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле

«АмплиСенс® HSV I, II-EPH»
 по ТУ 9398-066-01897593-2008

Форма 1

Комплект 3 из 3

«ЭФ» вариант 200

Комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов
 амплификации в агарозном геле

Состав комплекта:

Трис-боратный буфер (ТБЕ)

концентрированный с бромидом этидия

50 мл x 1

18°C 25°C



Агароза для электрофореза ДНК

1,7 г x 2

При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения

REF TVB-100-RO,5




LOT ДД.ММ.ГГ

ГГТТ-ММ-ДД

ГГТТ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724

Регистрационный номер: ФСР 2008/03359 от 18.11.11

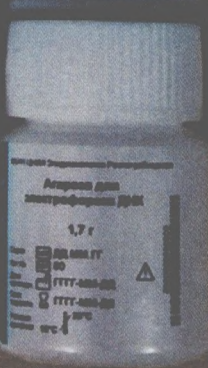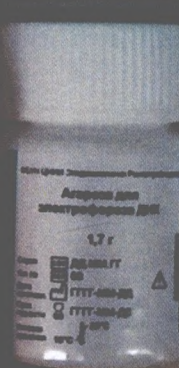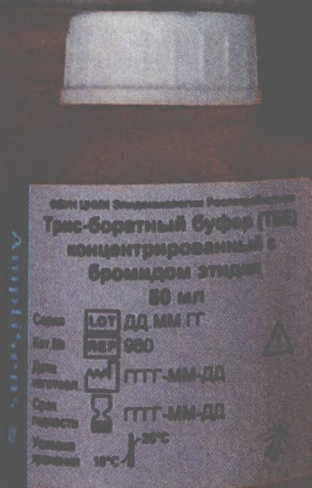

111123, Москва, ул. Новотроицкая, 15
тел.: (495) 974 5444, факс: (495) 383 5423
e-mail: info@amplisen.ru, www.amplisen.ru

Набор реагентов для выявления ДНК вирусной инфекции герпеса 1 и 2 типов (HSV 1, II) и электрофоретический детектор амплифицированных вирусных продуктов (EPH) с электрофоретическим детектором амплифицированных вирусных продуктов (EPH)

«АмплиСенс® HSV 1, II-EPH»
по ТУ 9300-004-01007200-0000

Формы 2

Комплект 1 из 3
«ДНК-суб-АМ» вариант 100
Комплект реагентов для выделения ДНК из биологического материала

Содержимое:
Вспомогательный раствор: 30 мл x 1
Экстракционный раствор: 100 мл x 1
Средство для фиксации: 10 мл x 1

25-н ЦИМИ Эндокринологический институт

111123, Москва, ул. Новотроицкая, 15
тел.: (495) 974 5444, факс: (495) 383 5423
e-mail: info@amplisen.ru, www.amplisen.ru

Набор реагентов для выявления ДНК вирусной инфекции герпеса 1 и 2 типов (HSV 1, II) и электрофоретический детектор амплифицированных вирусных продуктов (EPH) с электрофоретическим детектором амплифицированных вирусных продуктов (EPH)

«АмплиСенс® HSV 1, II-EPH»
по ТУ 9300-004-01007200-0000

Формы 2

Комплект 2 из 3
«ДНК-суб-АМ» вариант 100
Комплект реагентов для выделения ДНК из биологического материала




«ПР-амплификт» вариант 100 Я (пробирки 0,2 мл)
Комплект реагентов для ПР-амплификации ДНК (HSV 1, II)


«ЭФ» вариант 200
Комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов амплификации в агарозном геле

При получении разворачивать в соответствии с рекомендациями производителя

✓ V100 ✓ TWS-100-00,2 ✓ ДАММЛТ ✓ ППТ-000-00 ✓ ППТ-000-00

Сопоставить по коду маркировки с рекомендациями производителя

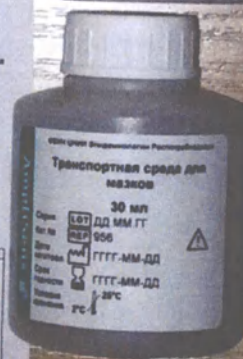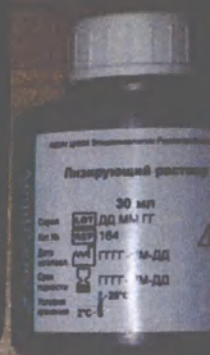

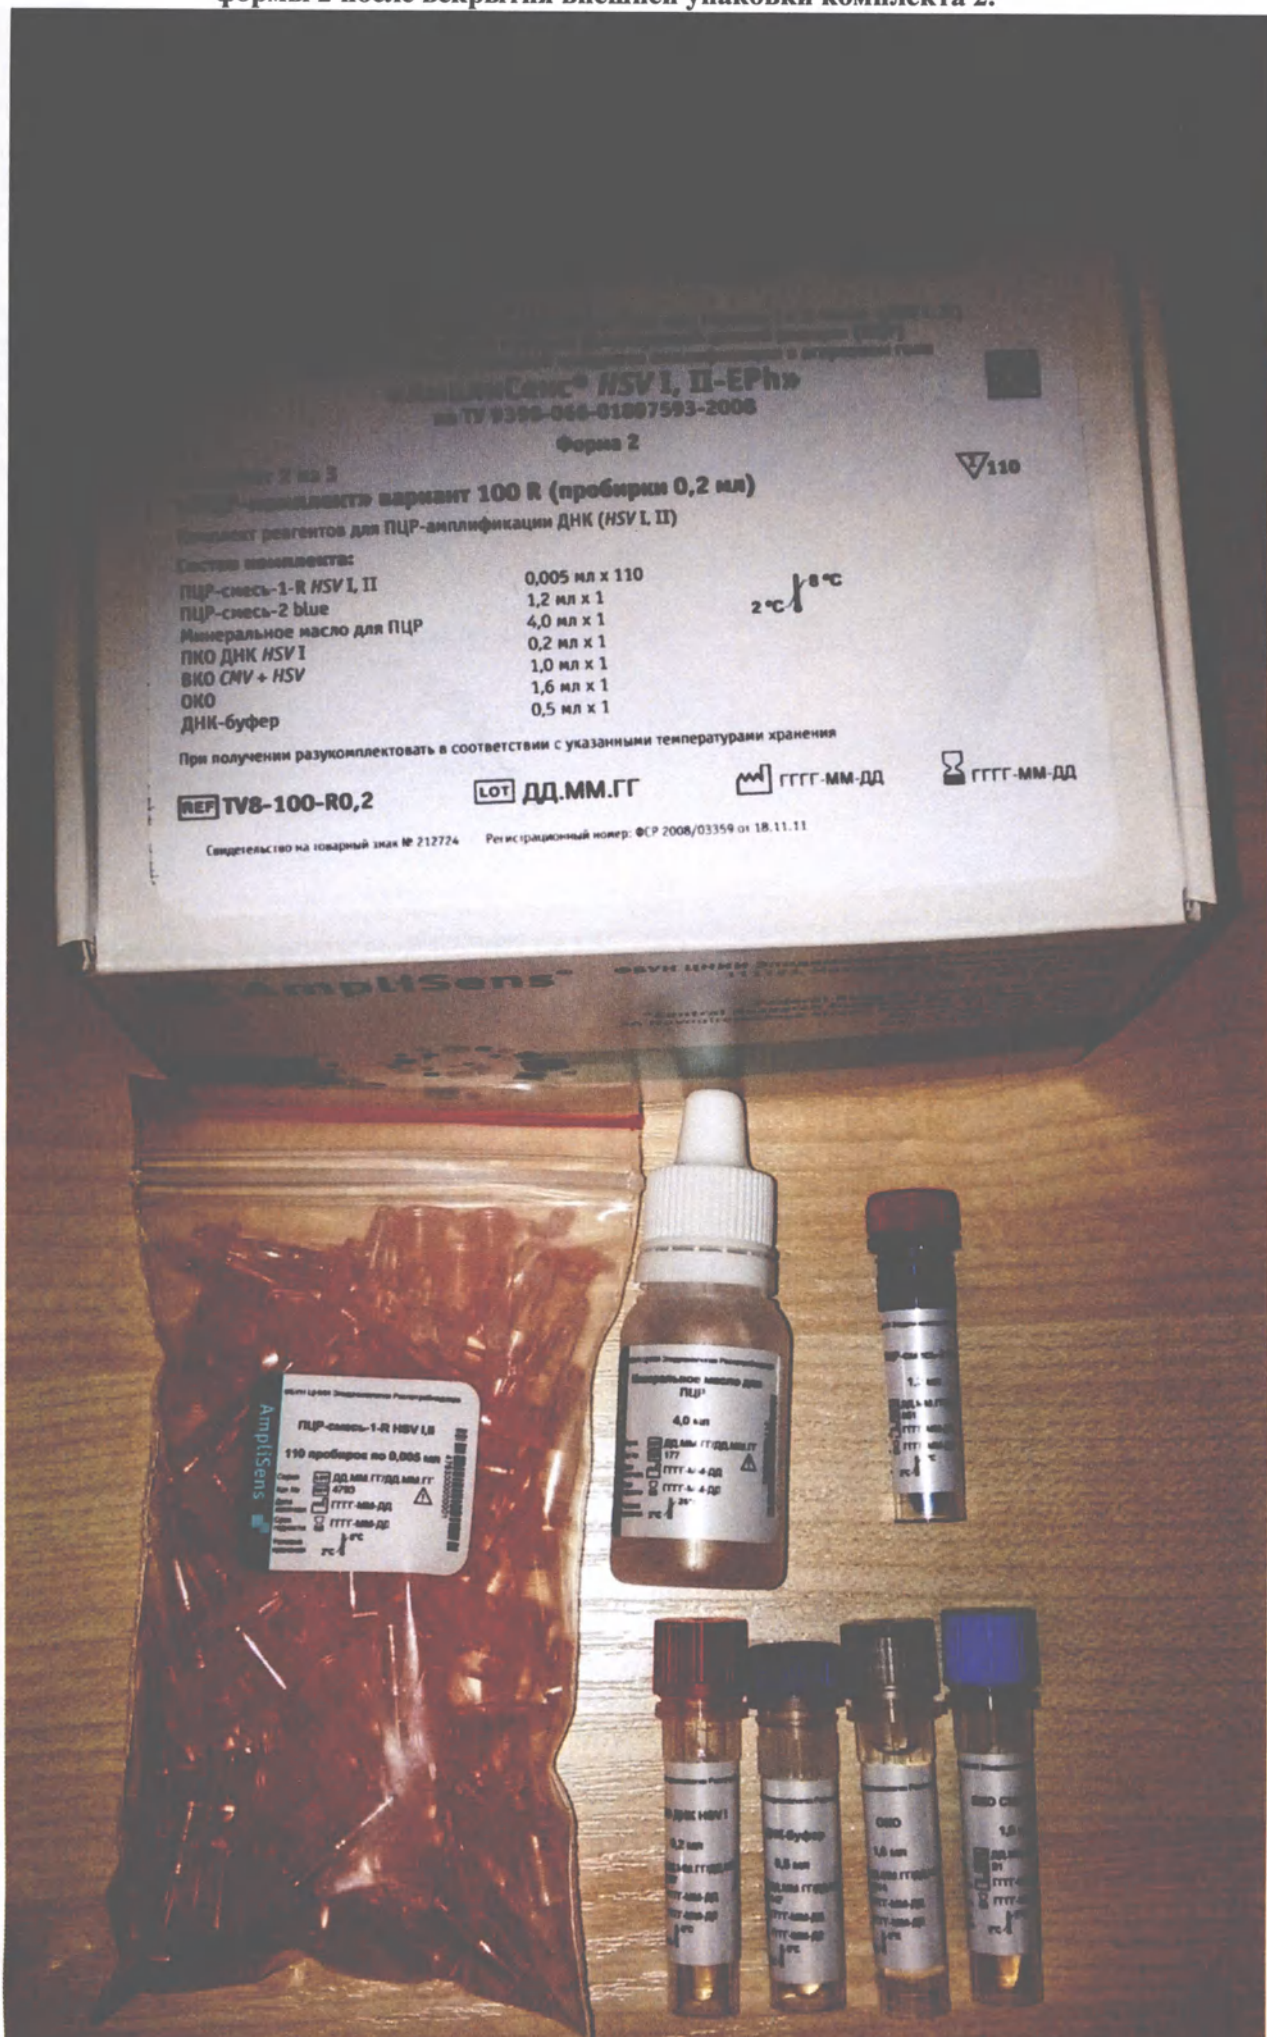

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Новосибирская, 34
650042, Факс: (495) 305 5423
amplisen@pct.ru www.pct.ru



Только для in vitro
диагностики



Применять согласно
прилагаемой
инструкции



Осторожно! Обратитесь
к инструкции
по применению

Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II)
в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле

«АмплиСенс® HSV I, II-EPh»

по ТУ 9398-066-01897593-2008

Форма 2



240

Комплект 3 из 3

«ЭФ» вариант 200

Комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов
амплификации в агарозном геле

Состав комплекта:

Трис-боратный буфер (ТБЕ)

концентрированный с бромидом этидия

50 мл x 1

18 °C / 25 °C



Агароза для электрофореза ДНК

1,7 г x 2

При получении разупаковывать в соответствии с указанными температурами хранения

REF TV8-100-R0,2

LOT ДД.ММ.ГГ



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724

Регистрационный номер: ФСР 2008/03359 от 18.11.11

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Трис-боратный буфер (ТБЕ)
концентрированный с
бромидом этидия
50 мл
ДД.ММ.ГГ
000
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД

Агароза для
электрофореза ДНК
1,7 г
ДД.ММ.ГГ
000
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД
18 °C

АмплиСенс®
HSV I, II-EPh

2°C

ГГГГ-ММ-ДД

Регистрационный номер: ФСР 2008/03359 от 18.12.11

Надпись расположена под рисунком ДНК вируса герпетического герпеса I в типичной HSV-1. В
 «АмплиСекс» HSV-1. П.Е.Р.Н.

ГТТГ-ММ-ДД

Комплектность, упаковка и маркировка набора указанной серии соответствуют требованиям ТУ

[illegible]

Фигура 1: **TVS-100-R0.5**; Фигура 2: **TVS-100-R0.2**; Фигура 3: **VS-100-R0.5**; **H-0003-4.5**; Фигура 4: **VS-100-R0.2**; **H-0004-4.2**; Фигура 5: **VS-100**


«АмплиСен



ФБУН ЦРНИ Эпидемиологи
Роспотребнадзора,
Российская Федерация, 11112,
г. Москва, улица Новооси

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 13 лист 06

Заместитель директора по эпидемиологии - Врио
директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора


В.Г. Акимкин

