

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ТЕХНО-МЕД»

Герлеман Н.Г.

2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат рентгеновский портативный Porta 100HF

JOB Corporation

2019

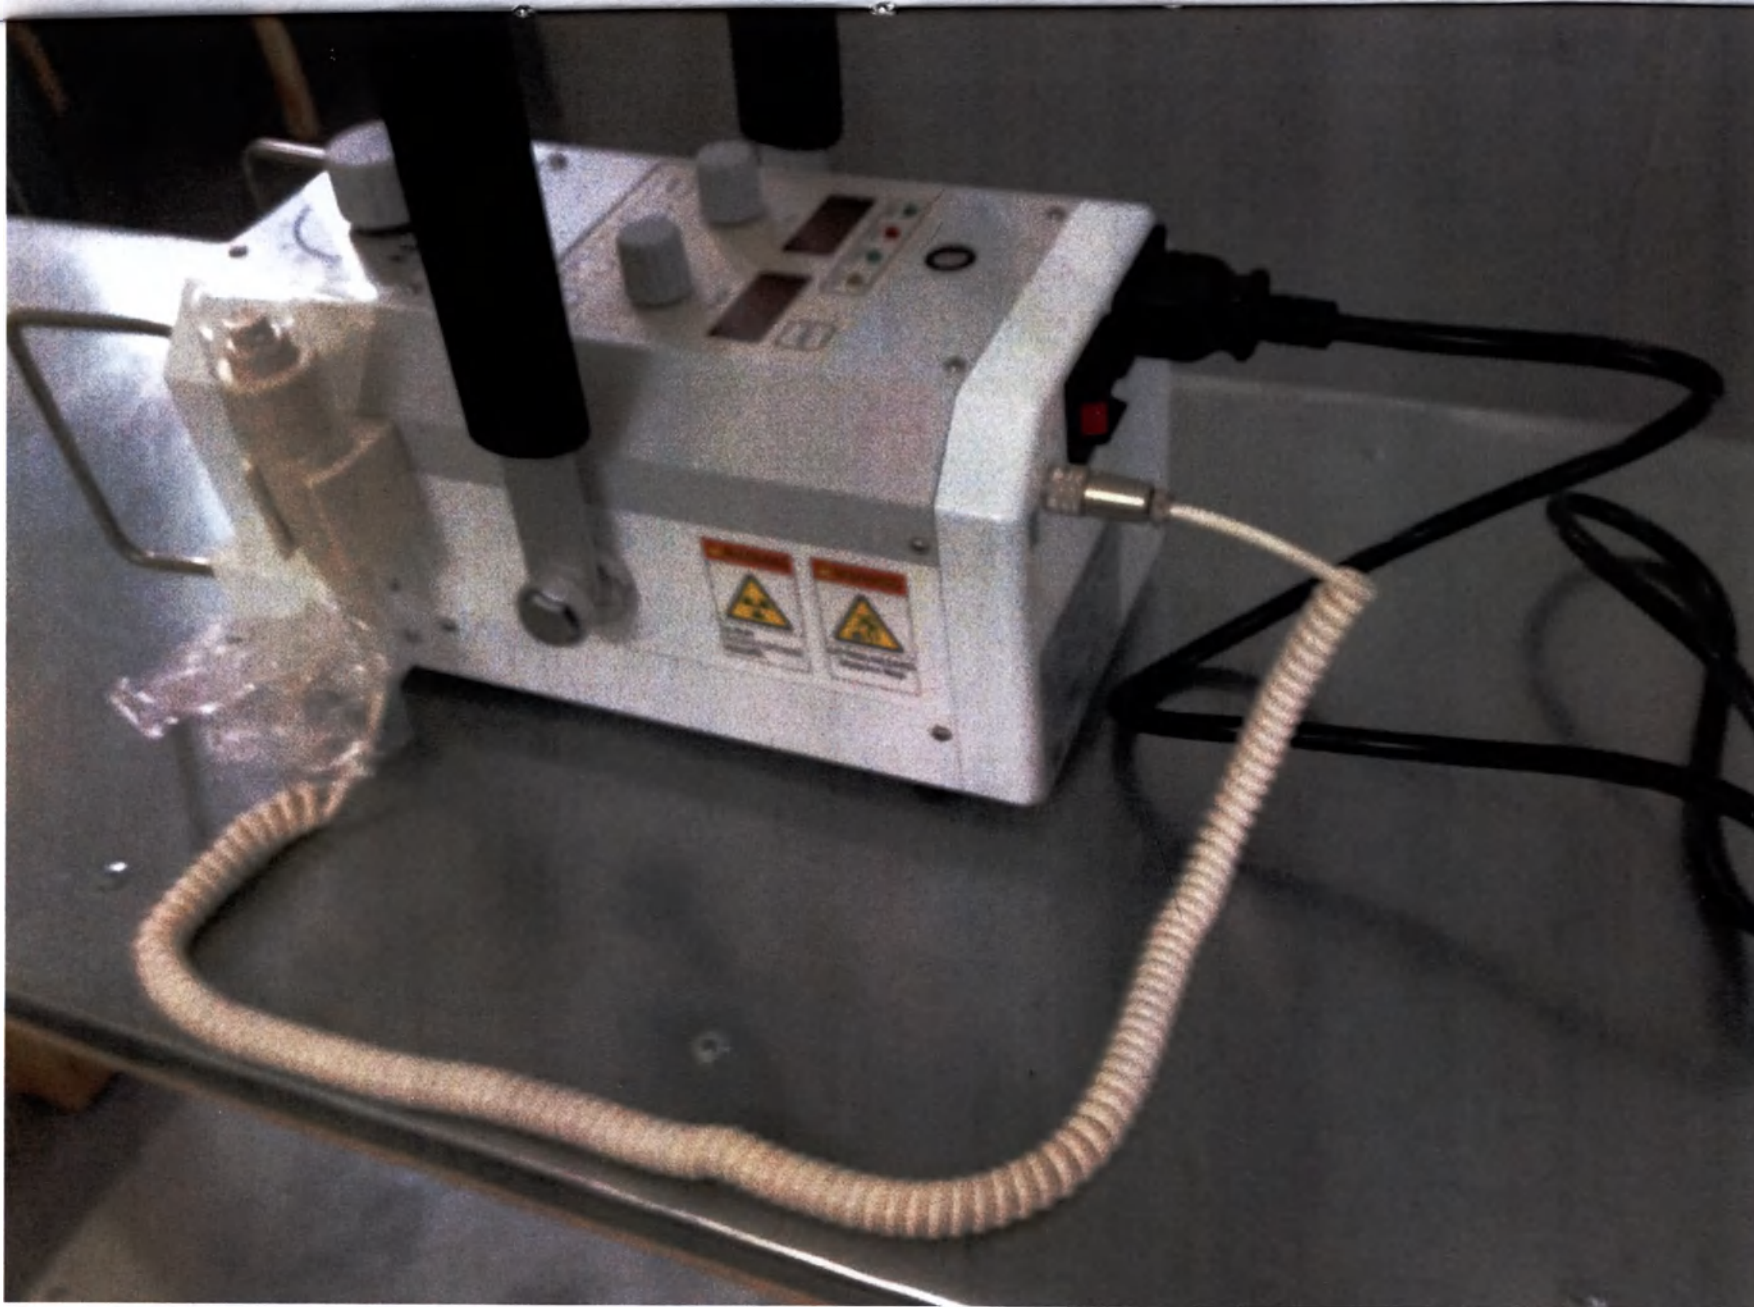


Рис.1 Фото аппарата в собранном виде



Рис.2. Рентгеновский генератор и контроллер рентгеновского излучения (моноблок) с коллиматором
(вид спереди)



Рис.3. Рентгеновский генератор и контроллер рентгеновского излучения (моноблок) с коллиматором (вид сзади)

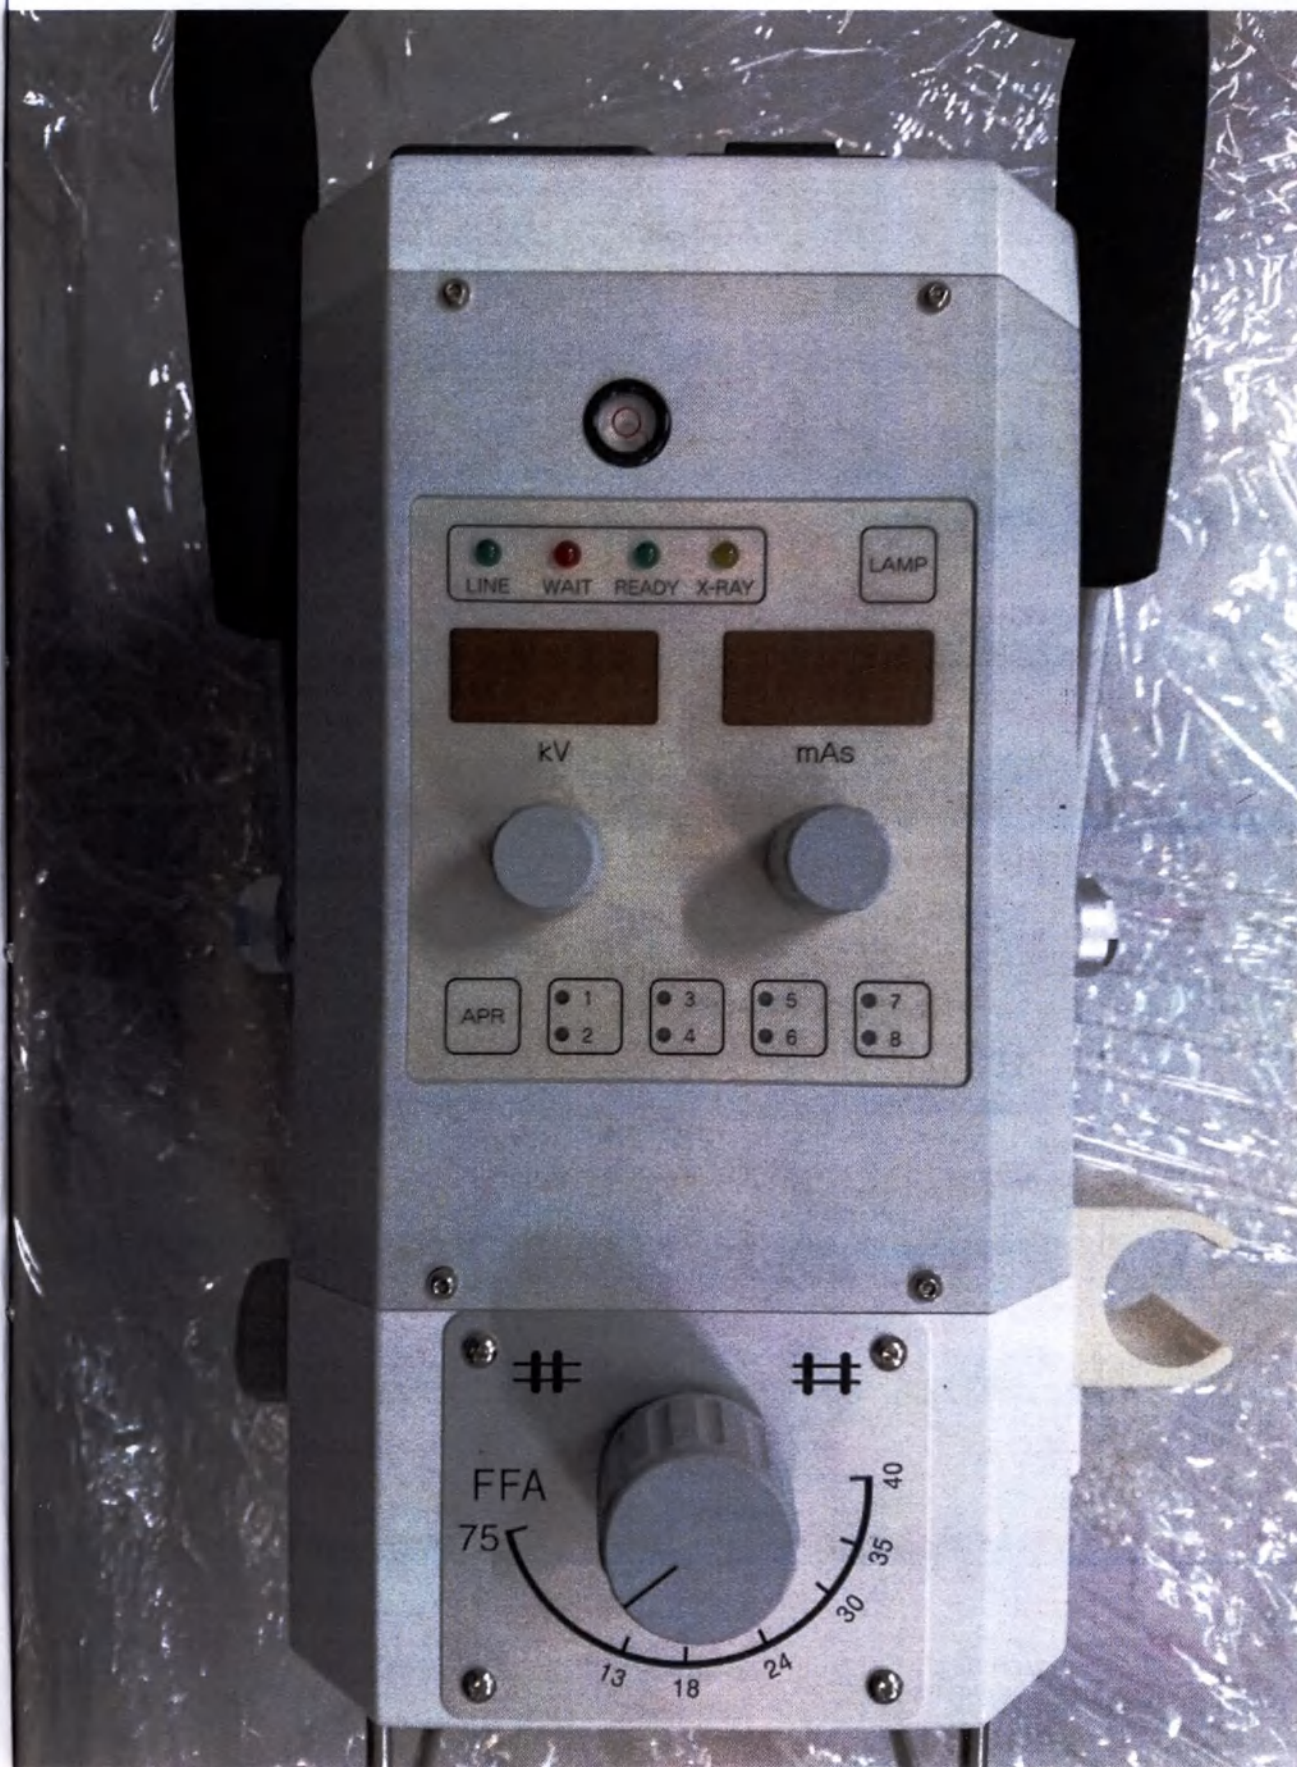


Рис.4. Рентгеновский генератор и контроллер рентгеновского излучения (моноблок) с коллиматором (вид сверху)



Рис.5. Рентгеновский генератор и контроллер рентгеновского излучения (моноблок) с коллиматором
(вид сбоку (справа))

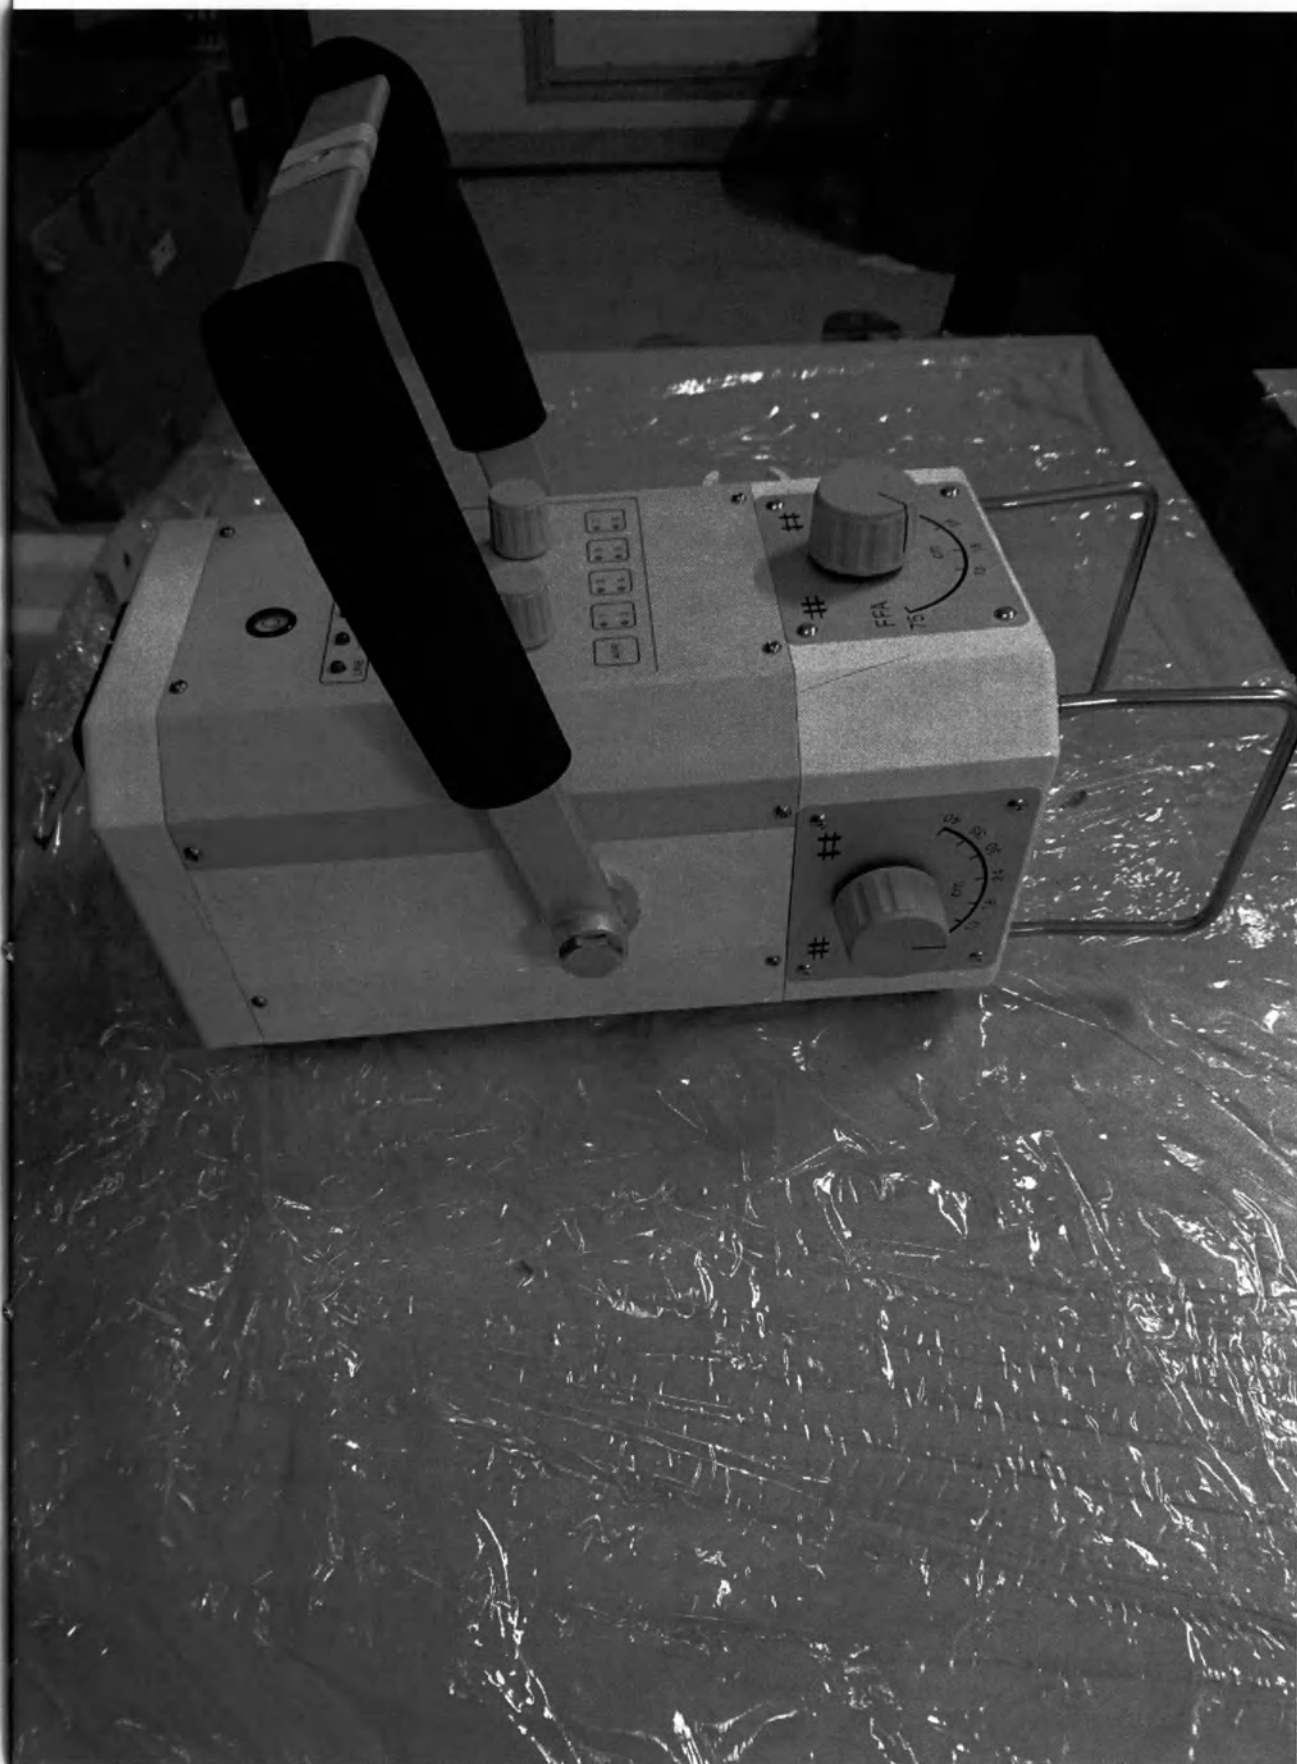


Рис.6. Рентгеновский генератор и контроллер рентгеновского излучения (моноблок) с коллиматором (Вид сбоку (слева))



Рис.7. Кабель питания



Рис.8. Радиографический переключатель



Рис.9. Портативный кейс (в закрытом состоянии)

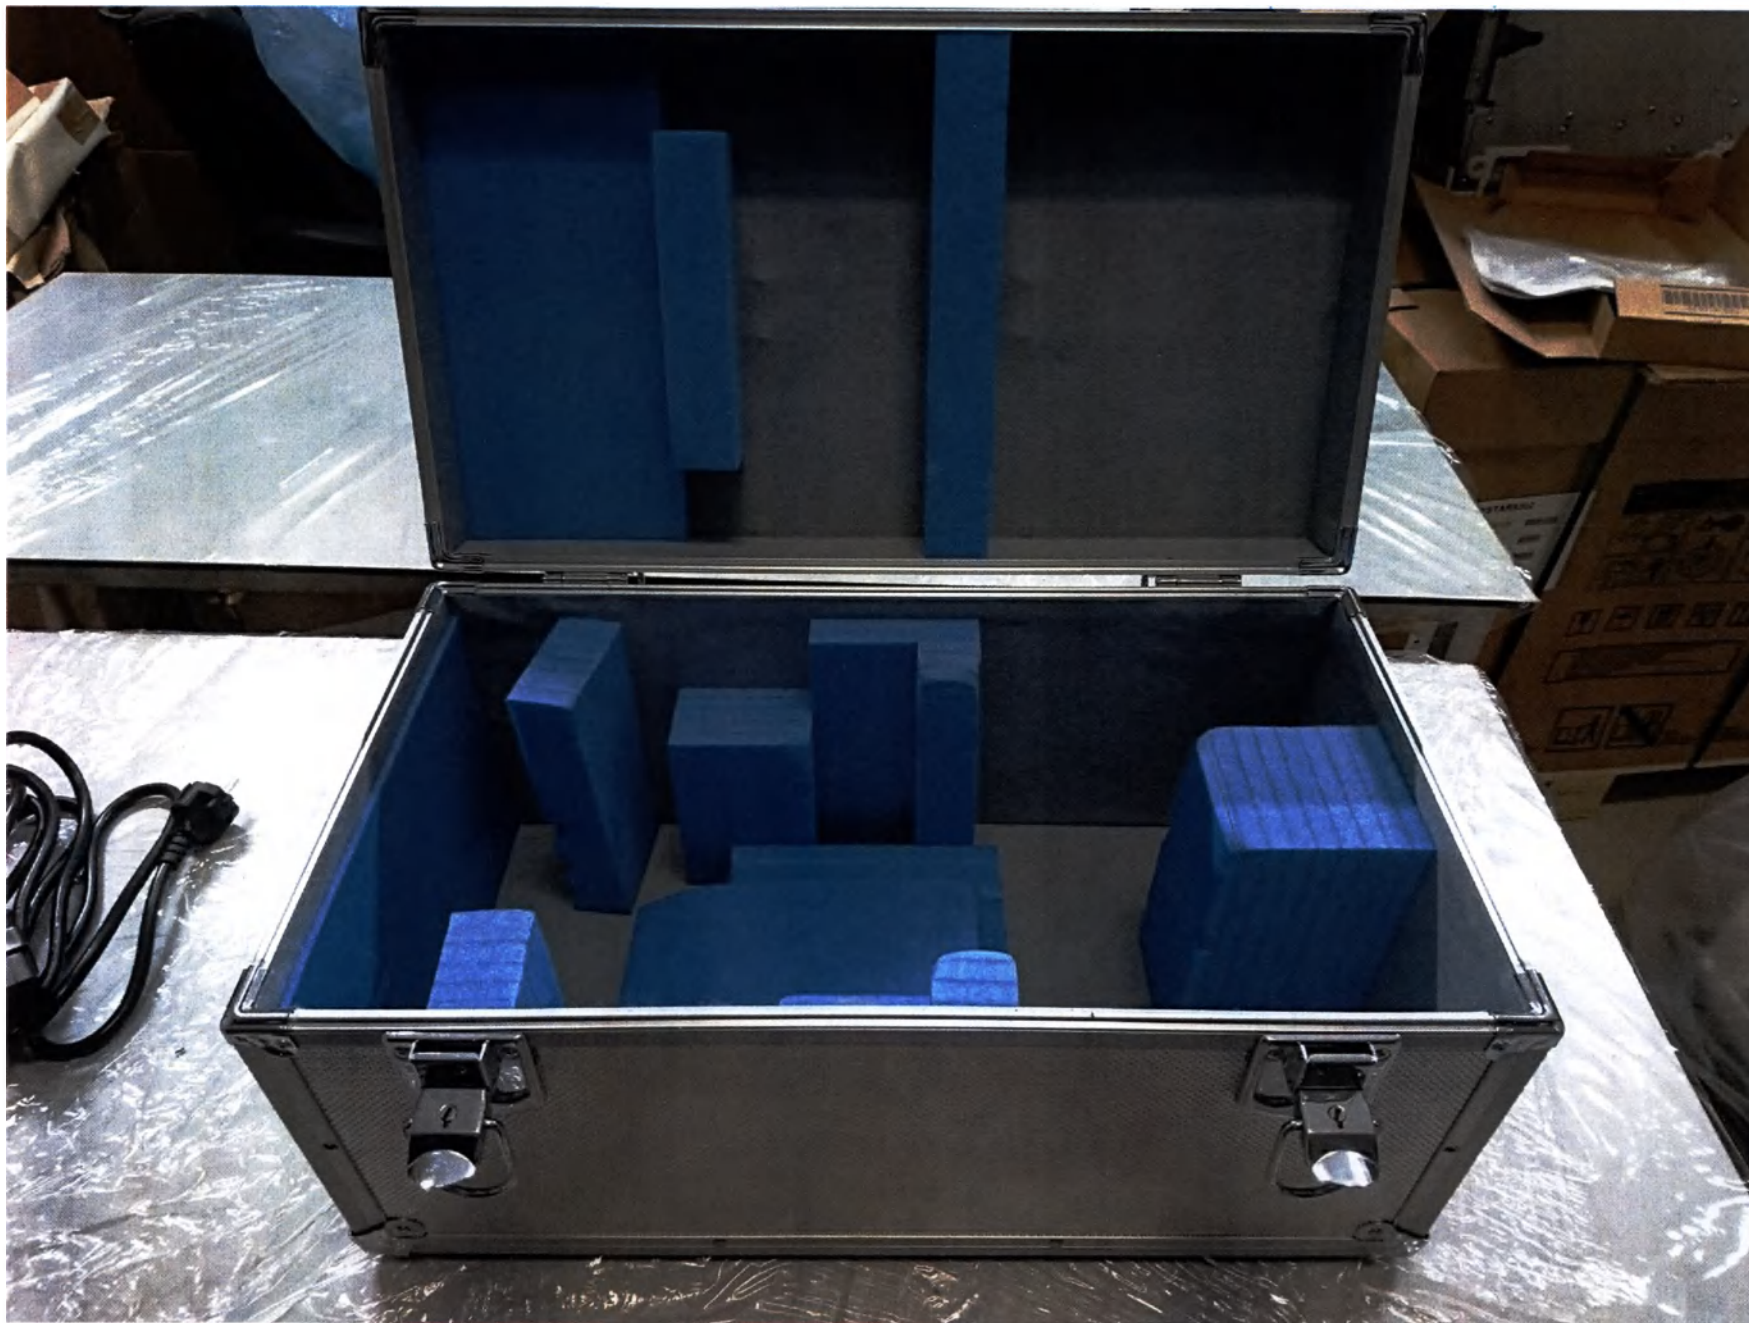


Рис.10. Портативный кейс (в открытом состоянии)



Рис.11 Стойка для позиционирования аппарата (при необходимости)



Рис.12 Стойка для позиционирования с закрепленным на ней аппаратом

Фото маркировки

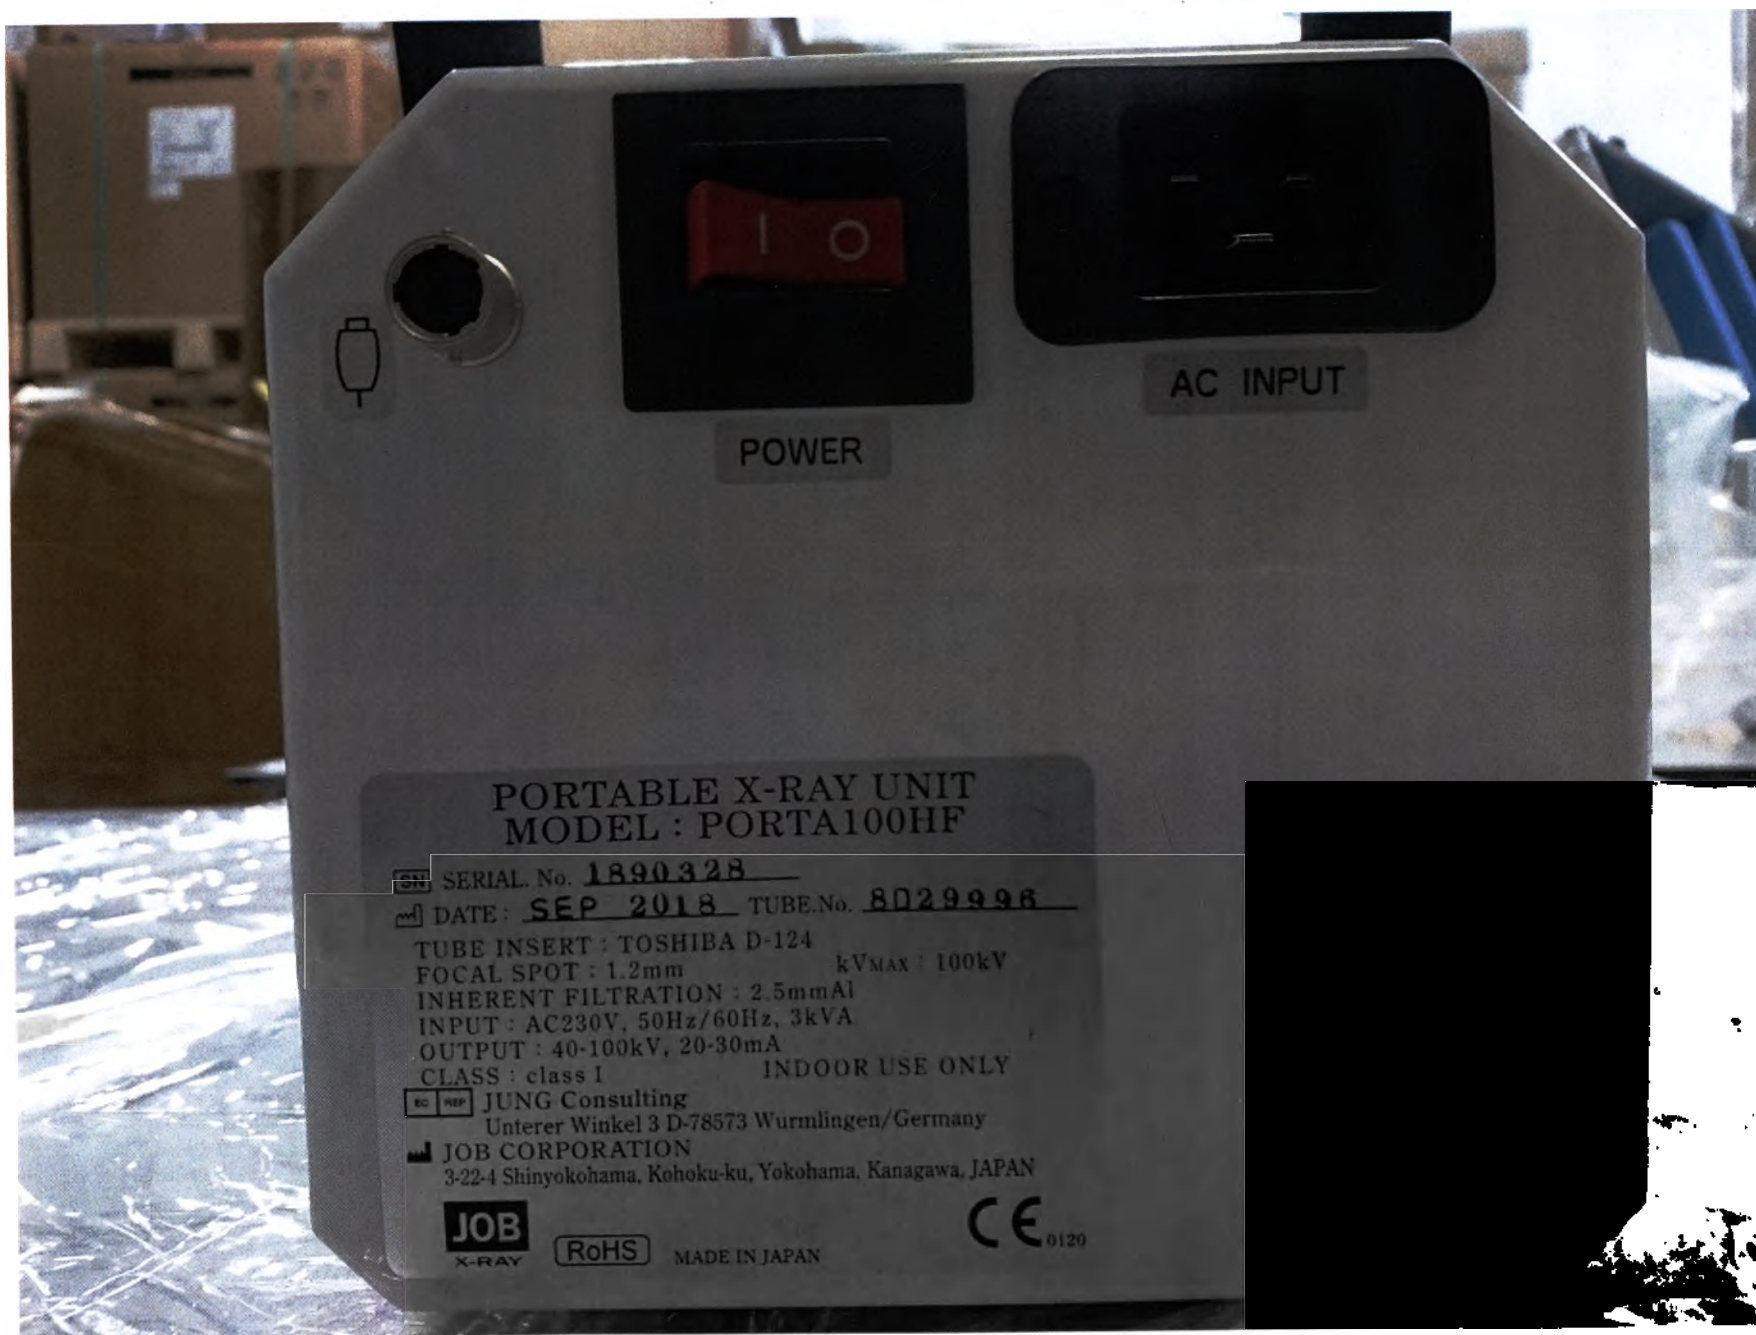


Рис.1 Маркировка аппарата



Рис.2 Маркировка аппарата

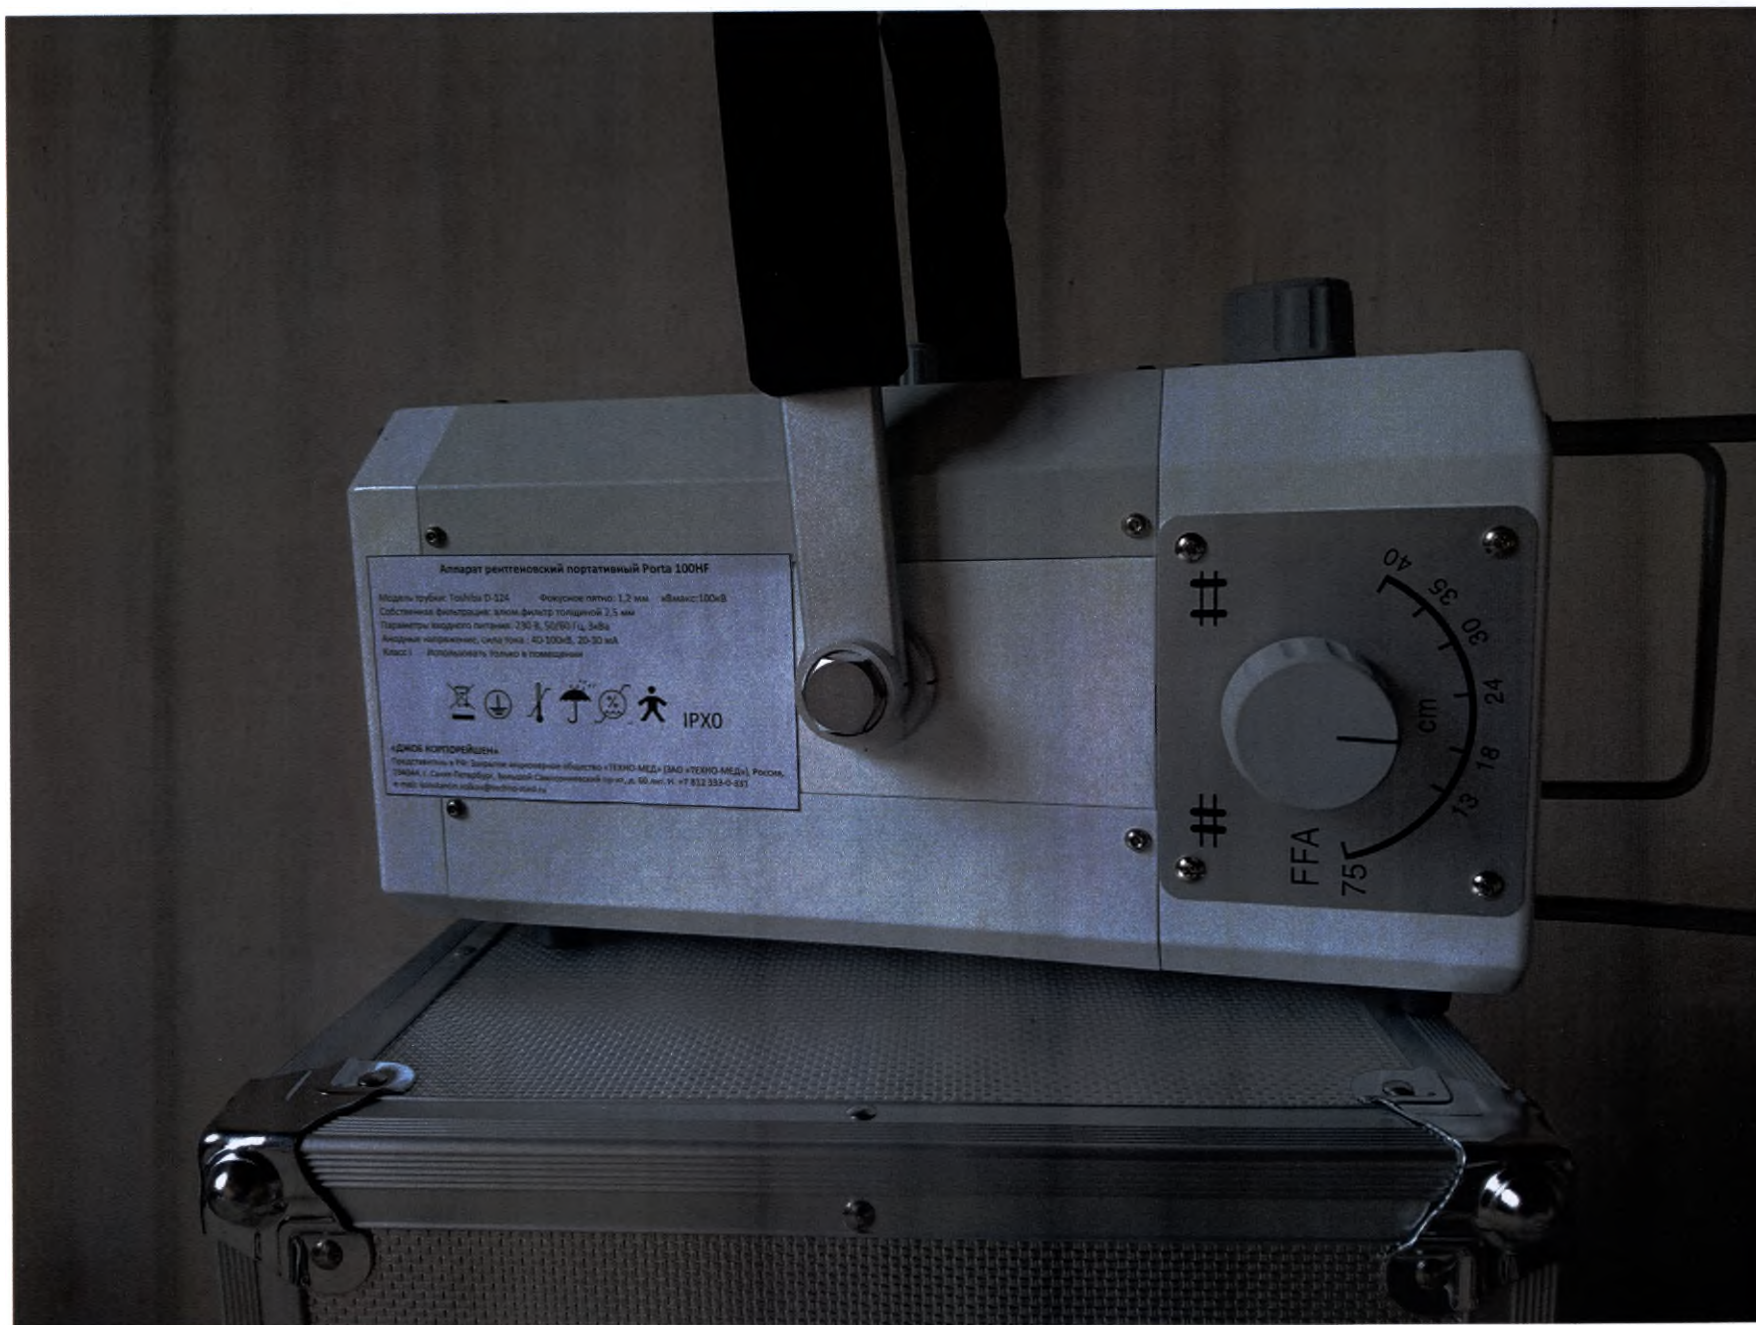


Рис.3 Маркировка аппарата



Рис.5 Маркировка стойки для позиционирования на русском языке

Прошнуровано
и пронумеровано

14 деветица листа
листов

Генеральный
директор Герлеман Н.Г.

