


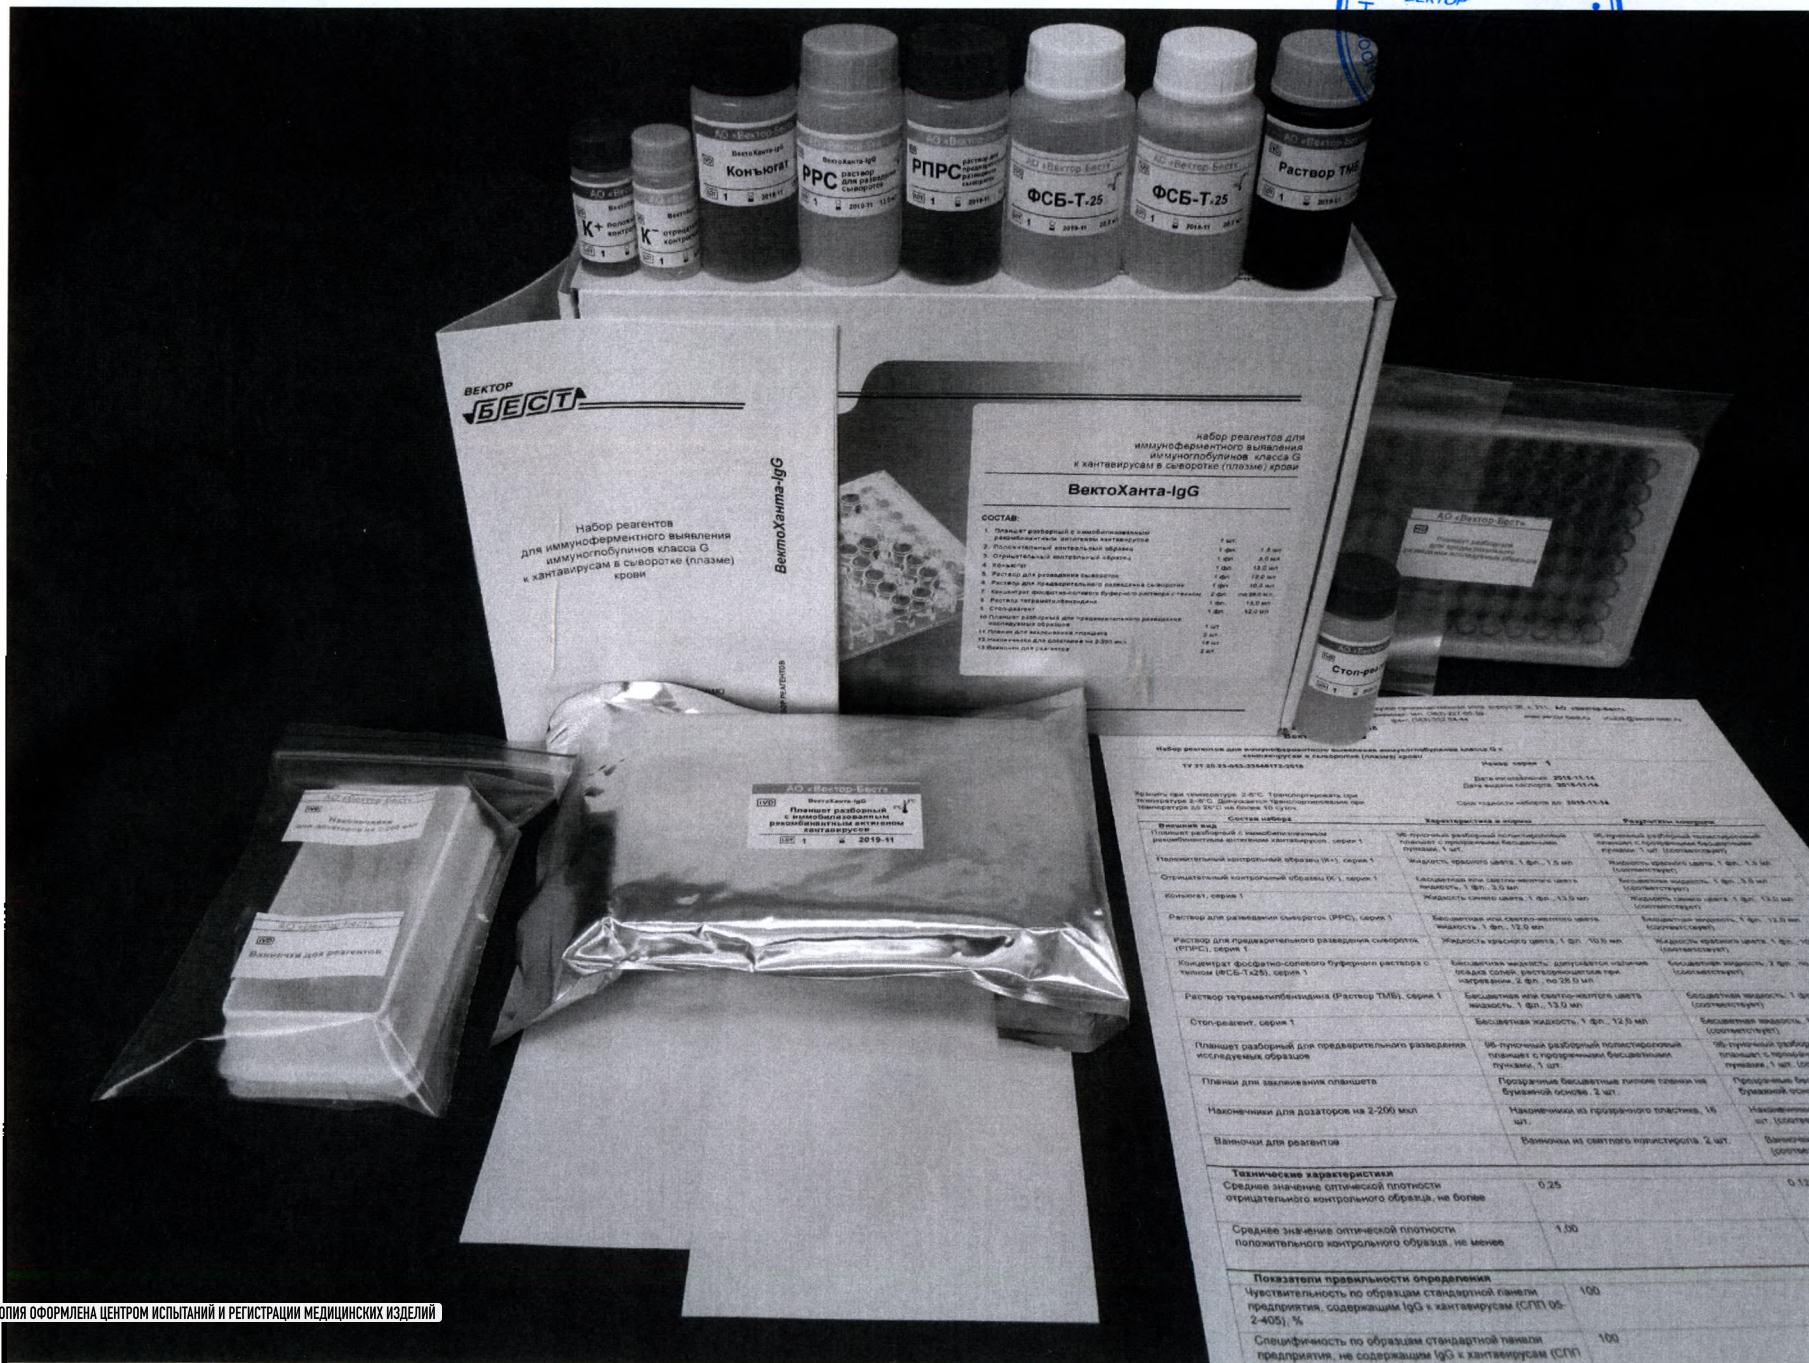

набор реагентов для иммуноферментного выявления вирусного белка класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови

ВектоХанта-IgG

СОСТАВ:

1. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
2. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
3. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
4. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
5. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
6. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
7. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
8. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
9. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
10. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
11. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
12. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
13. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
14. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.
15. Плакит разбавитель с иммуноглобулином	1 шт.	1 шт.


Набор реагентов для иммуноферментного выявления вирусного белка класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови		Упаковка серия 1	
ТТ 21.20.15.045-254417-0010		Дата изготовления: 2019-11-14	
		Дата выпуска: 2019-11-14	
		Срок годности: 12 мес.	
Состав набора		Характеристики и описание	
Внешний вид	Плакит разбавитель с иммуноглобулином	96-луночный разбавитель полистироловый, типичный с прозрачными бесцветными лунками, 1 шт.	96-луночный разбывитель полистироловый, типичный с прозрачными бесцветными лунками, 1 шт.
Оптический контрольный образец (K+), серия 1	Оптический контрольный образец (K-), серия 1	Бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)	Бесцветная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)
Конъюгат, серия 1	Раствор для предварительного разведения сыворотки (RPRC), серия 1	Бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)	Бесцветная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)
Раствор для предварительного разведения сыворотки (RPRC), серия 1	Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с типичом (FCSB-T.25), серия 1	Бесцветная жидкость, типичная наливная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)	Бесцветная жидкость, типичная наливная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)
Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ), серия 1	Стоп-реагент, серия 1	Бесцветная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)	Бесцветная жидкость, 1 шт., 12,0 мл (соответствует)
Плакит разбавитель для предварительного разведения исследуемых образцов	Плакит для выявления плазмента	96-луночный разбывитель полистироловый, типичный с прозрачными бесцветными лунками, 1 шт.	96-луночный разбывитель полистироловый, типичный с прозрачными бесцветными лунками, 1 шт.
Плакит для выявления плазмента	Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	Прозрачные бесцветные лунки типичные наливные, 1 шт.	Прозрачные бесцветные лунки типичные наливные, 1 шт.
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	Валочки для реагентов	Наконечники из прозрачного пластика, 16 шт.	Наконечники из прозрачного пластика, 16 шт.
Валочки для реагентов		Валочки из светлого поликарбоната, 2 шт.	Валочки из светлого поликарбоната, 2 шт.
Технические характеристики			
Среднее значение оптической плотности отрицательного контрольного образца, не более		0,25	0,22
Среднее значение оптической плотности положительного контрольного образца, не менее		1,00	1,00
Показатели правильности определения			
Чувствительность по образцам стандартной панели предприятия, содержащим IgG к хантавирусам (СПП 05-2-405), %		100	100
Специфичность по образцам стандартной панели предприятия, не содержащим IgG к хантавирусам (СПП 05-2-405), %		100	100


Фототрафическое изображение компонентов медицинского изделия
"ВектоХанта-IgG" №1
серия 1


АО "Вектор-Бест"






М.Д. Хусаинов
2019 г.

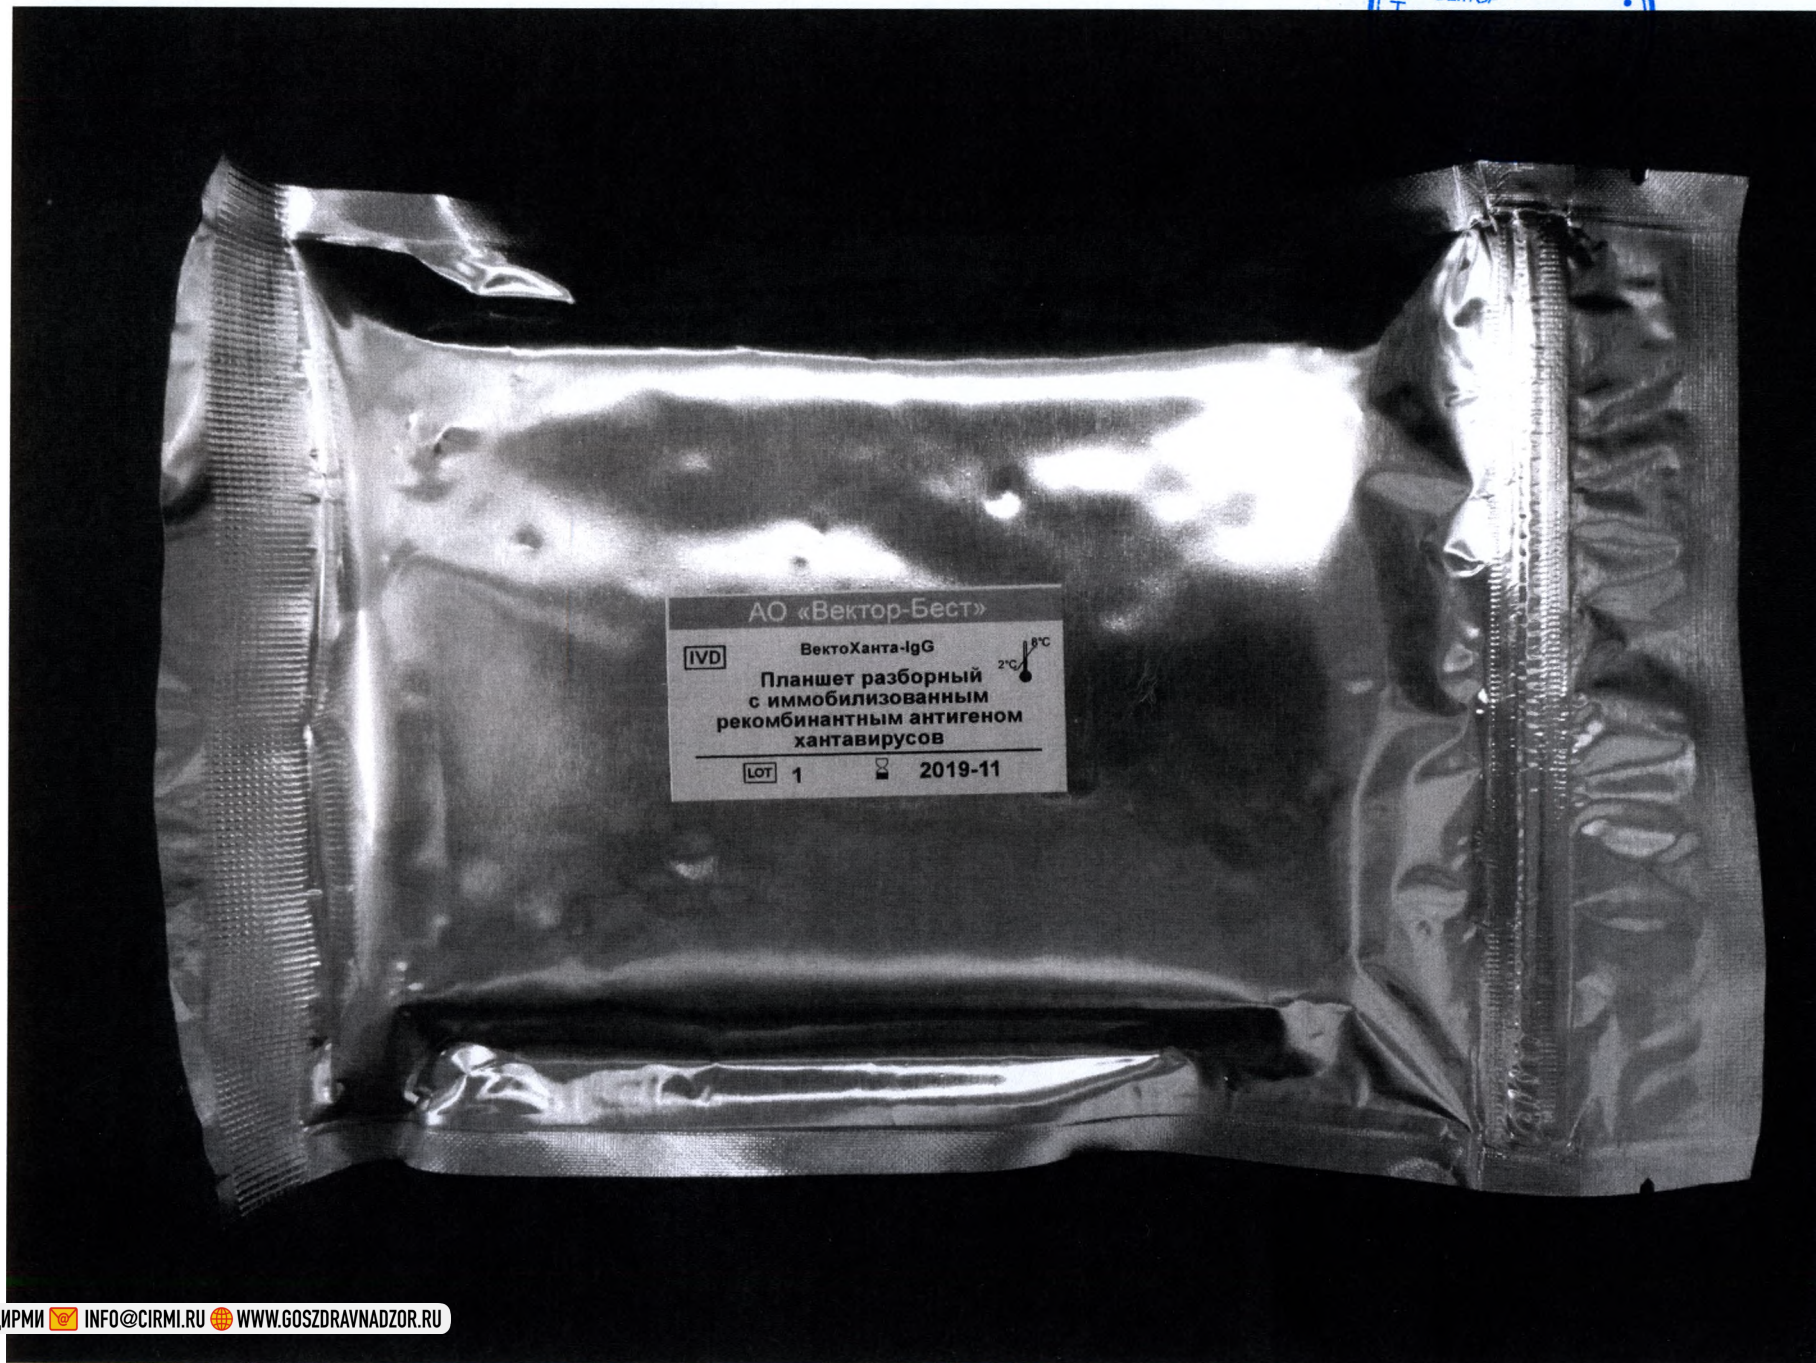


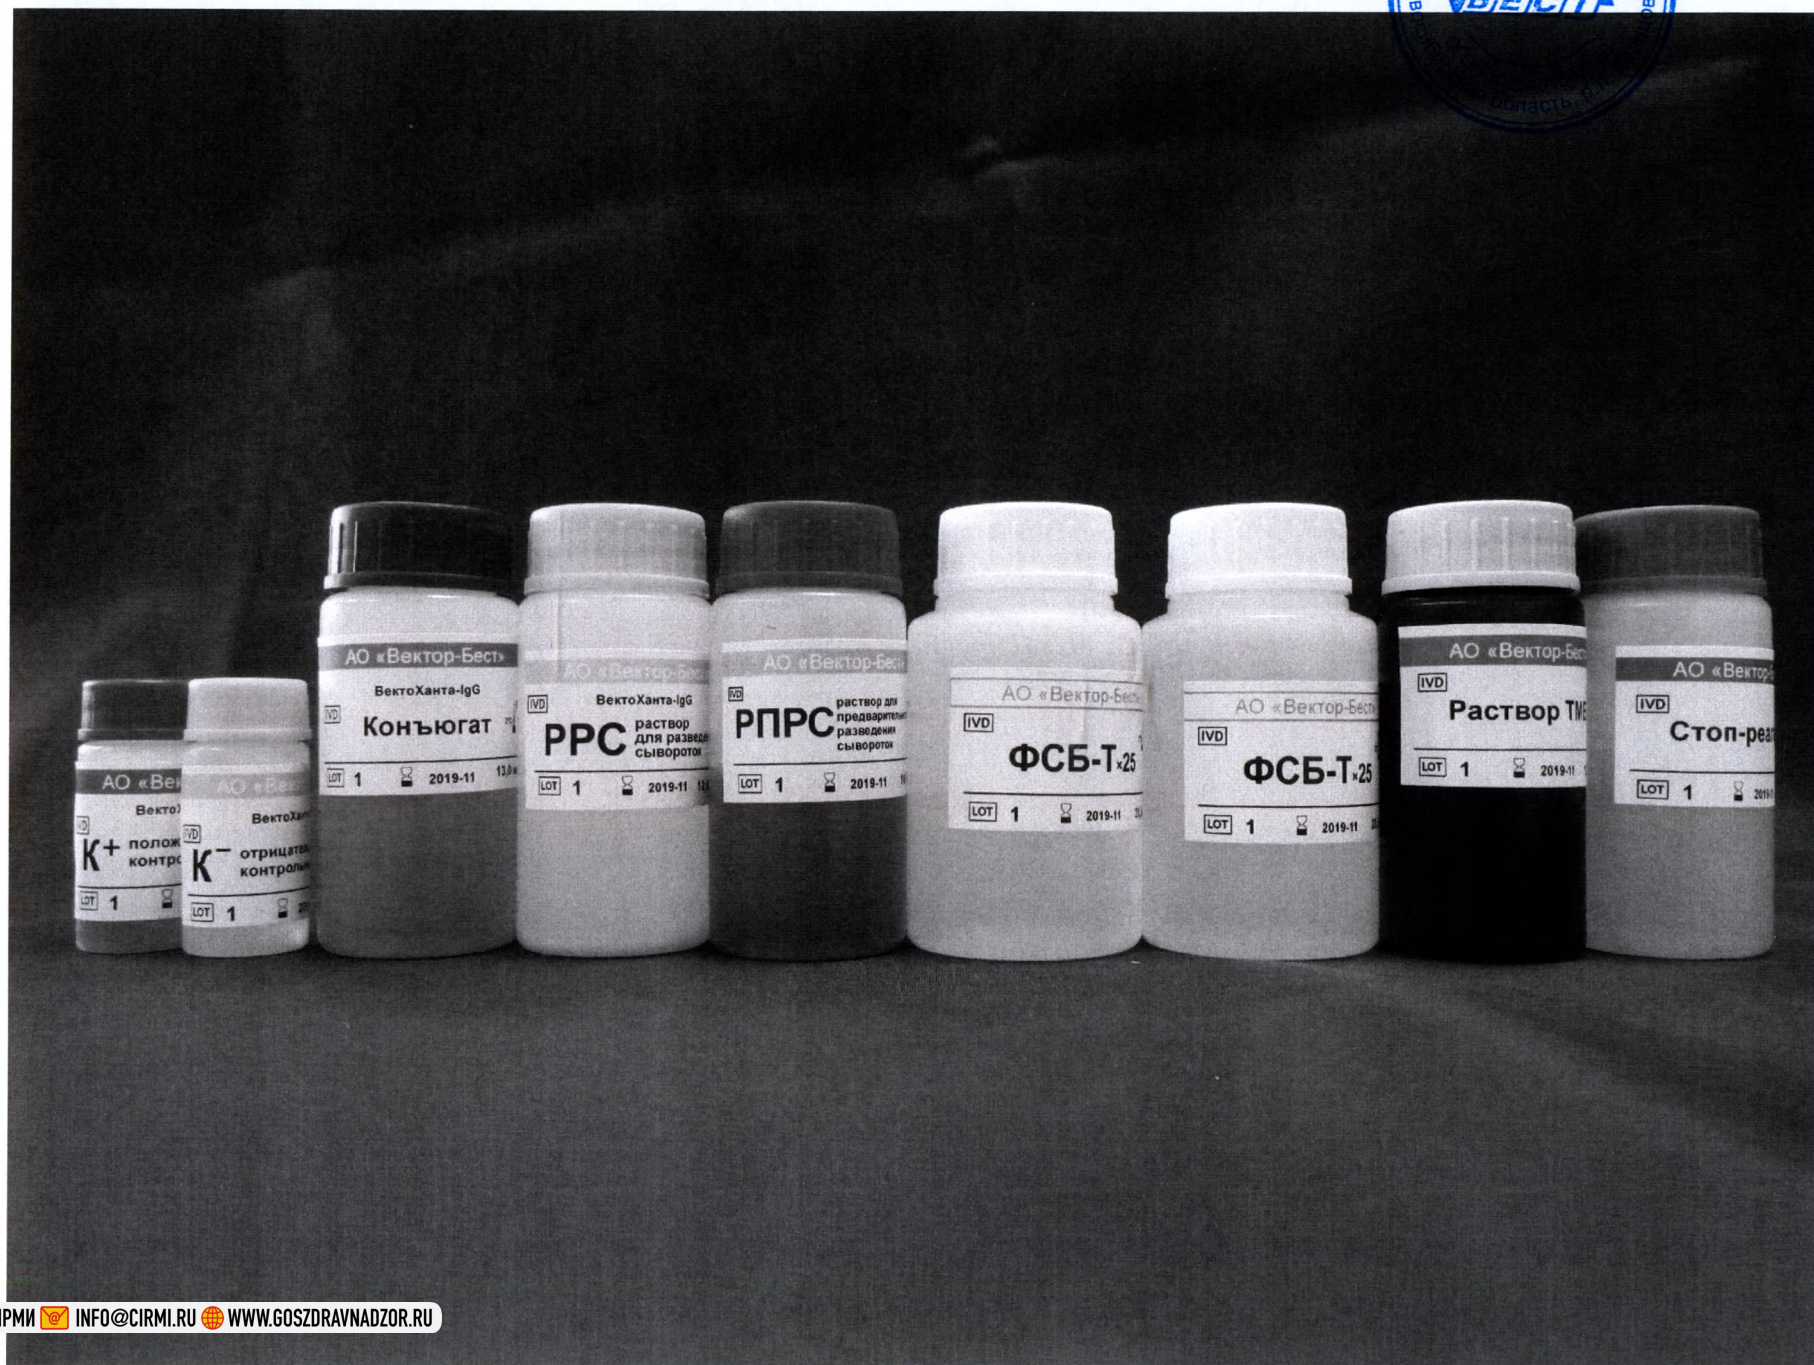

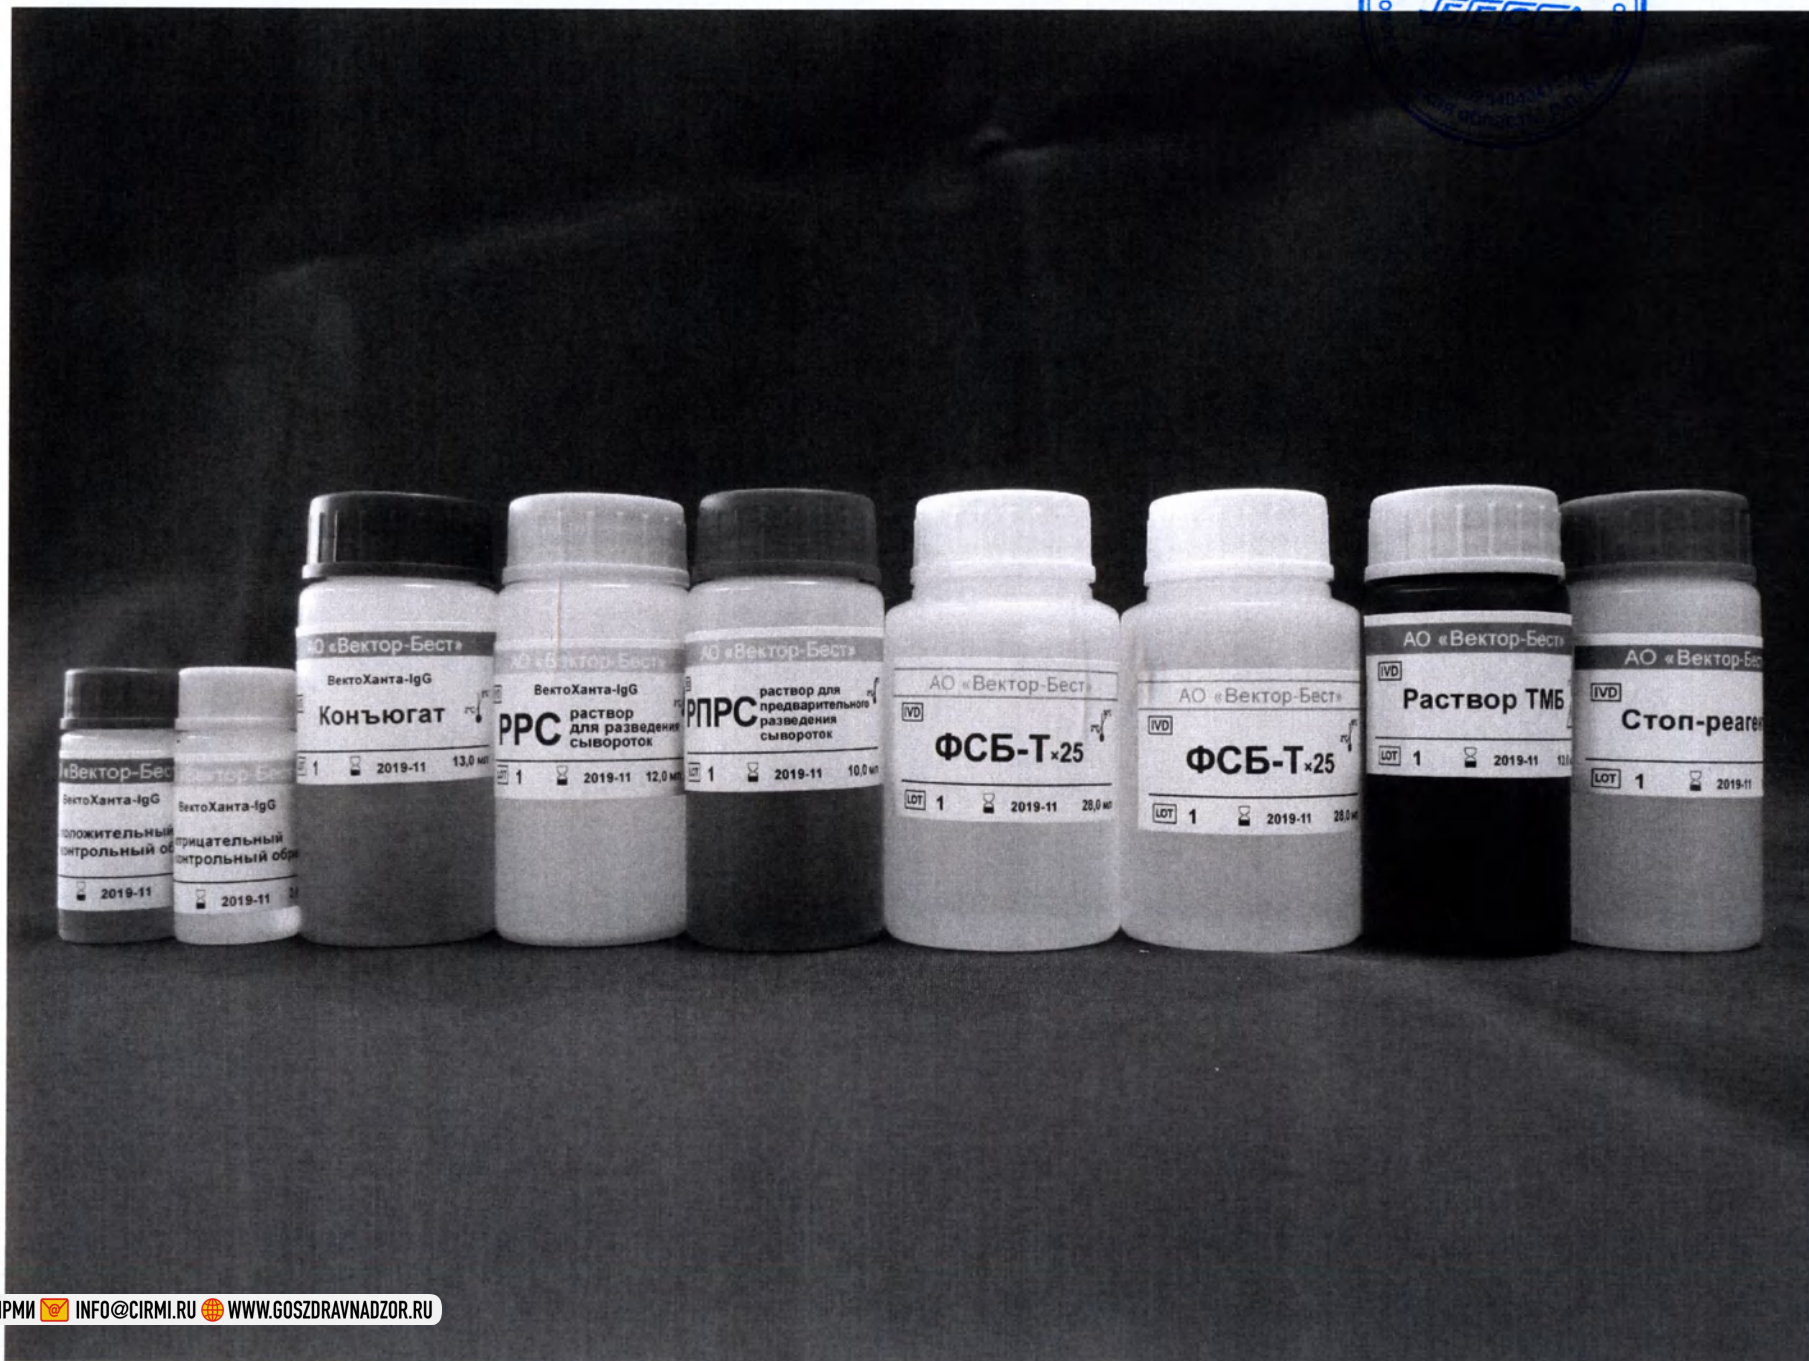

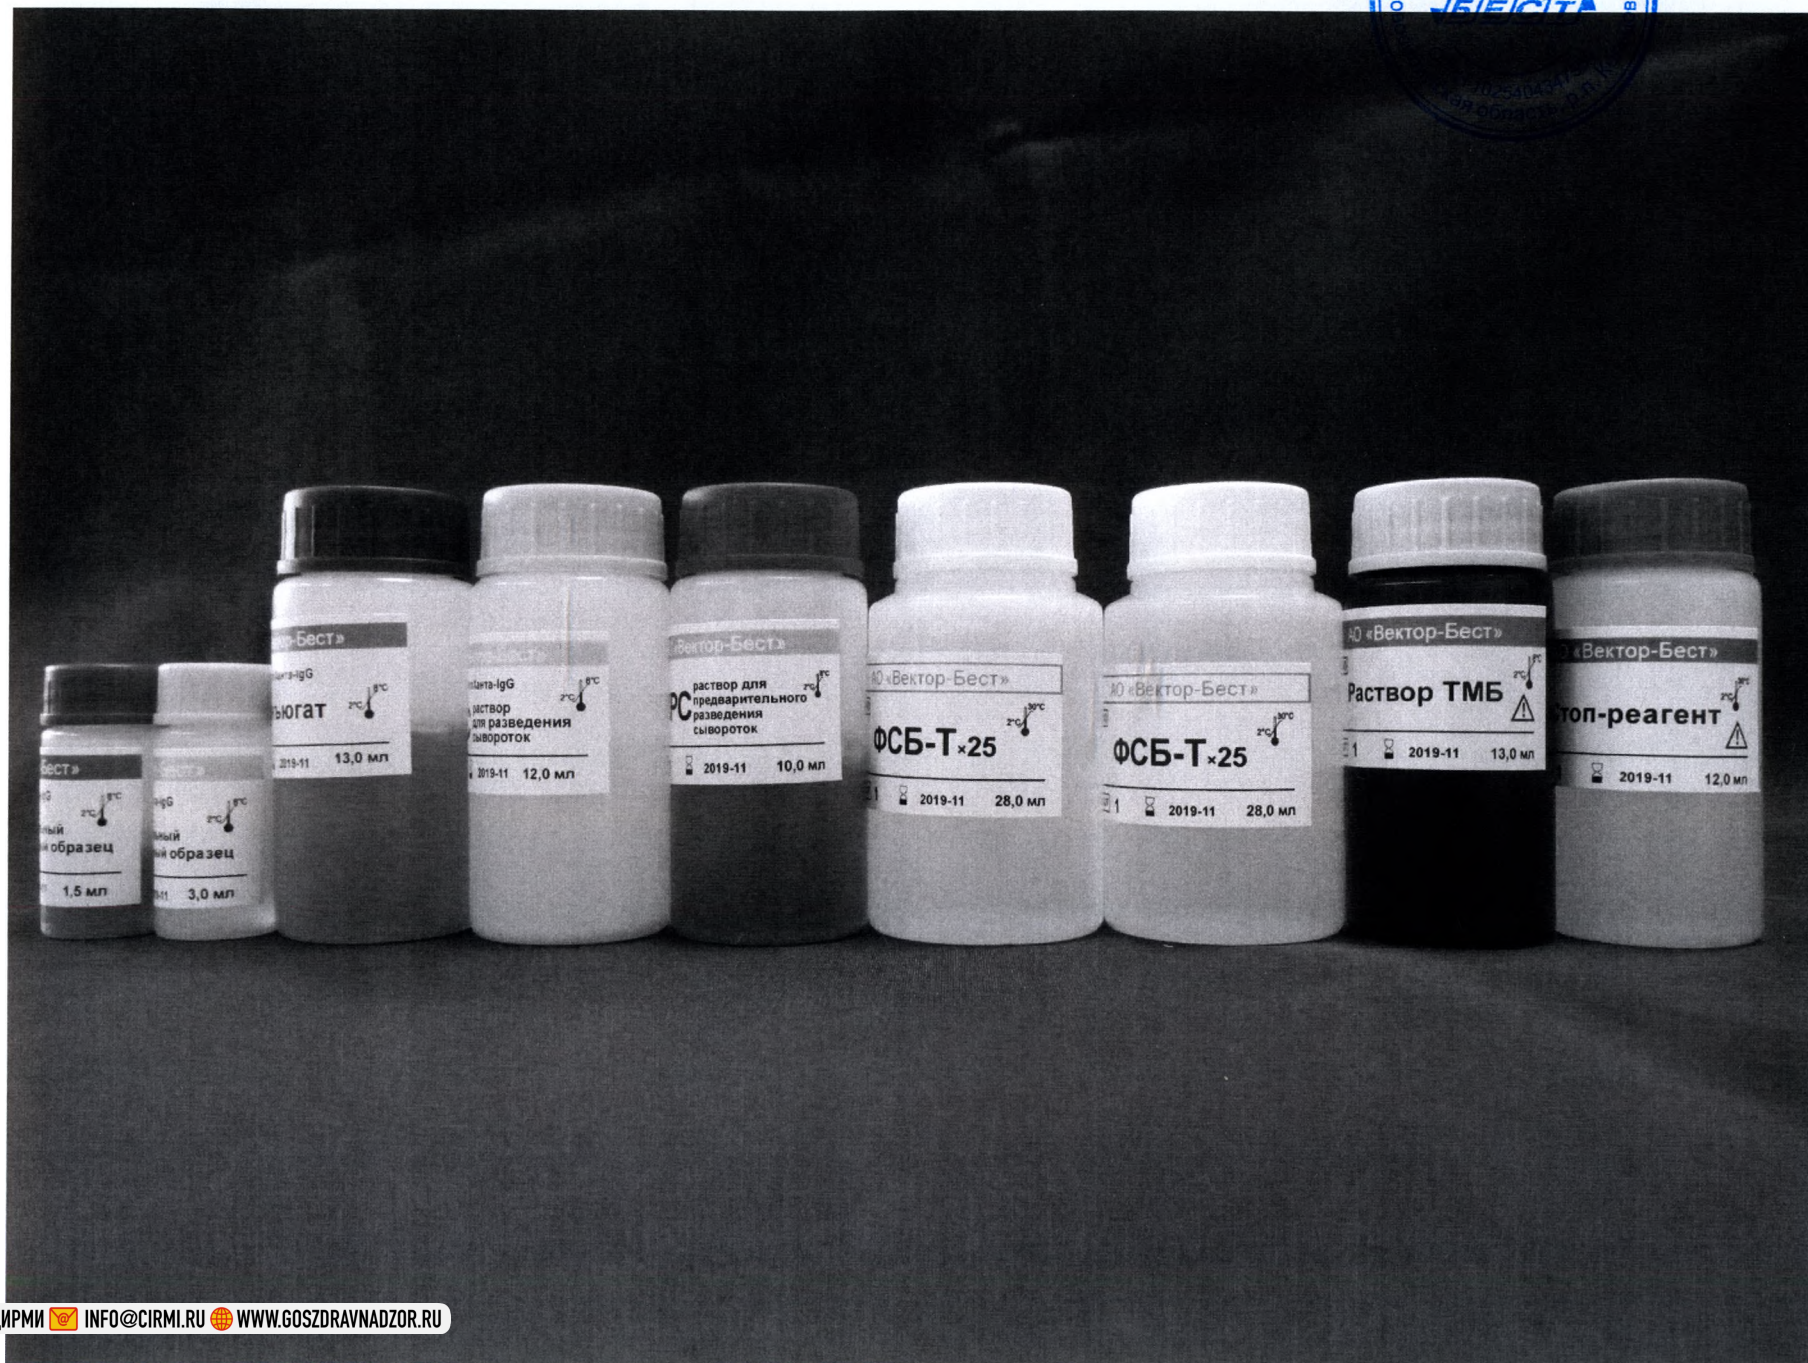


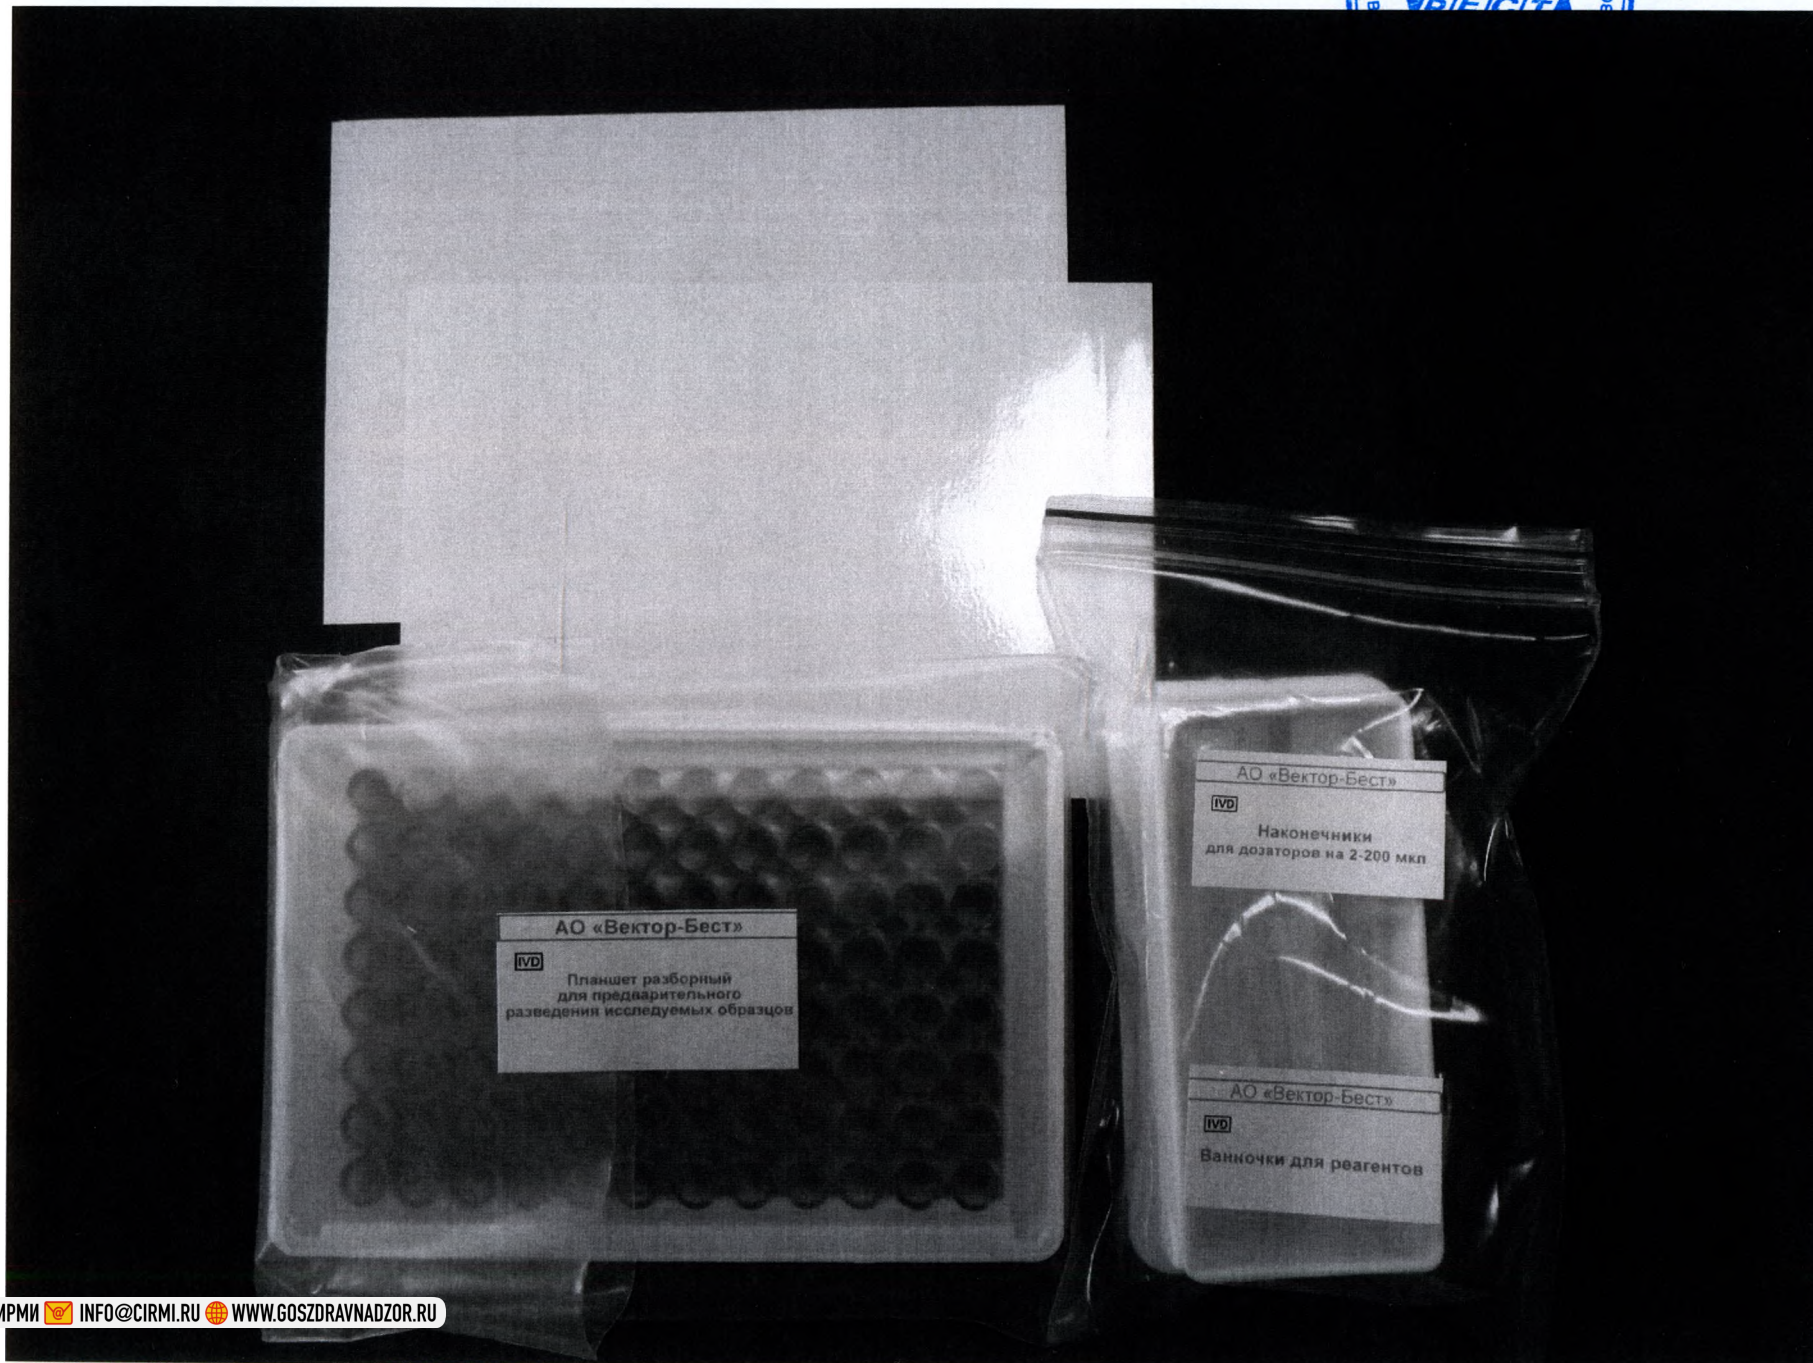



ВЕКТОР

БЕСТ

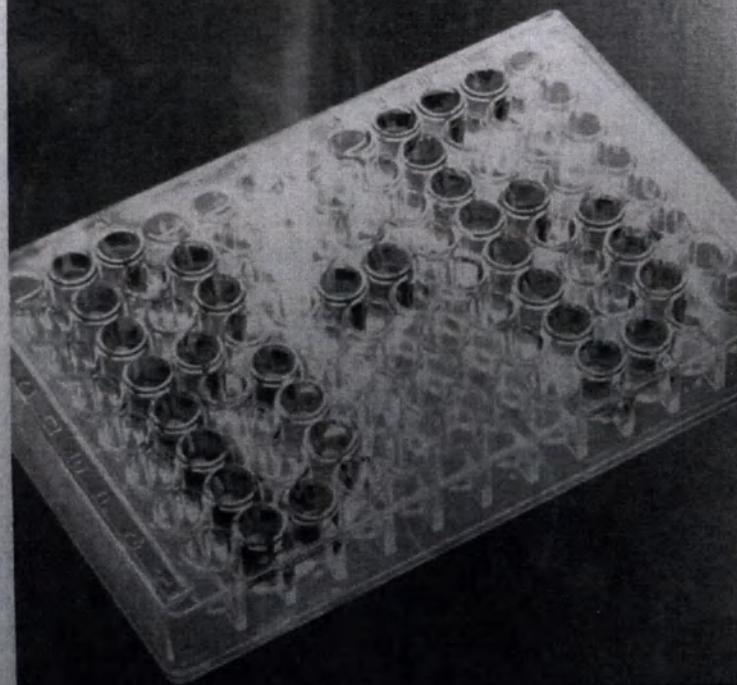

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови


ВектоХанта-IgG

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном хантавирусов	1 шт.	
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	3,0 мл
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ВектоХанта-IgG" №2
серия 1



Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2019 г.

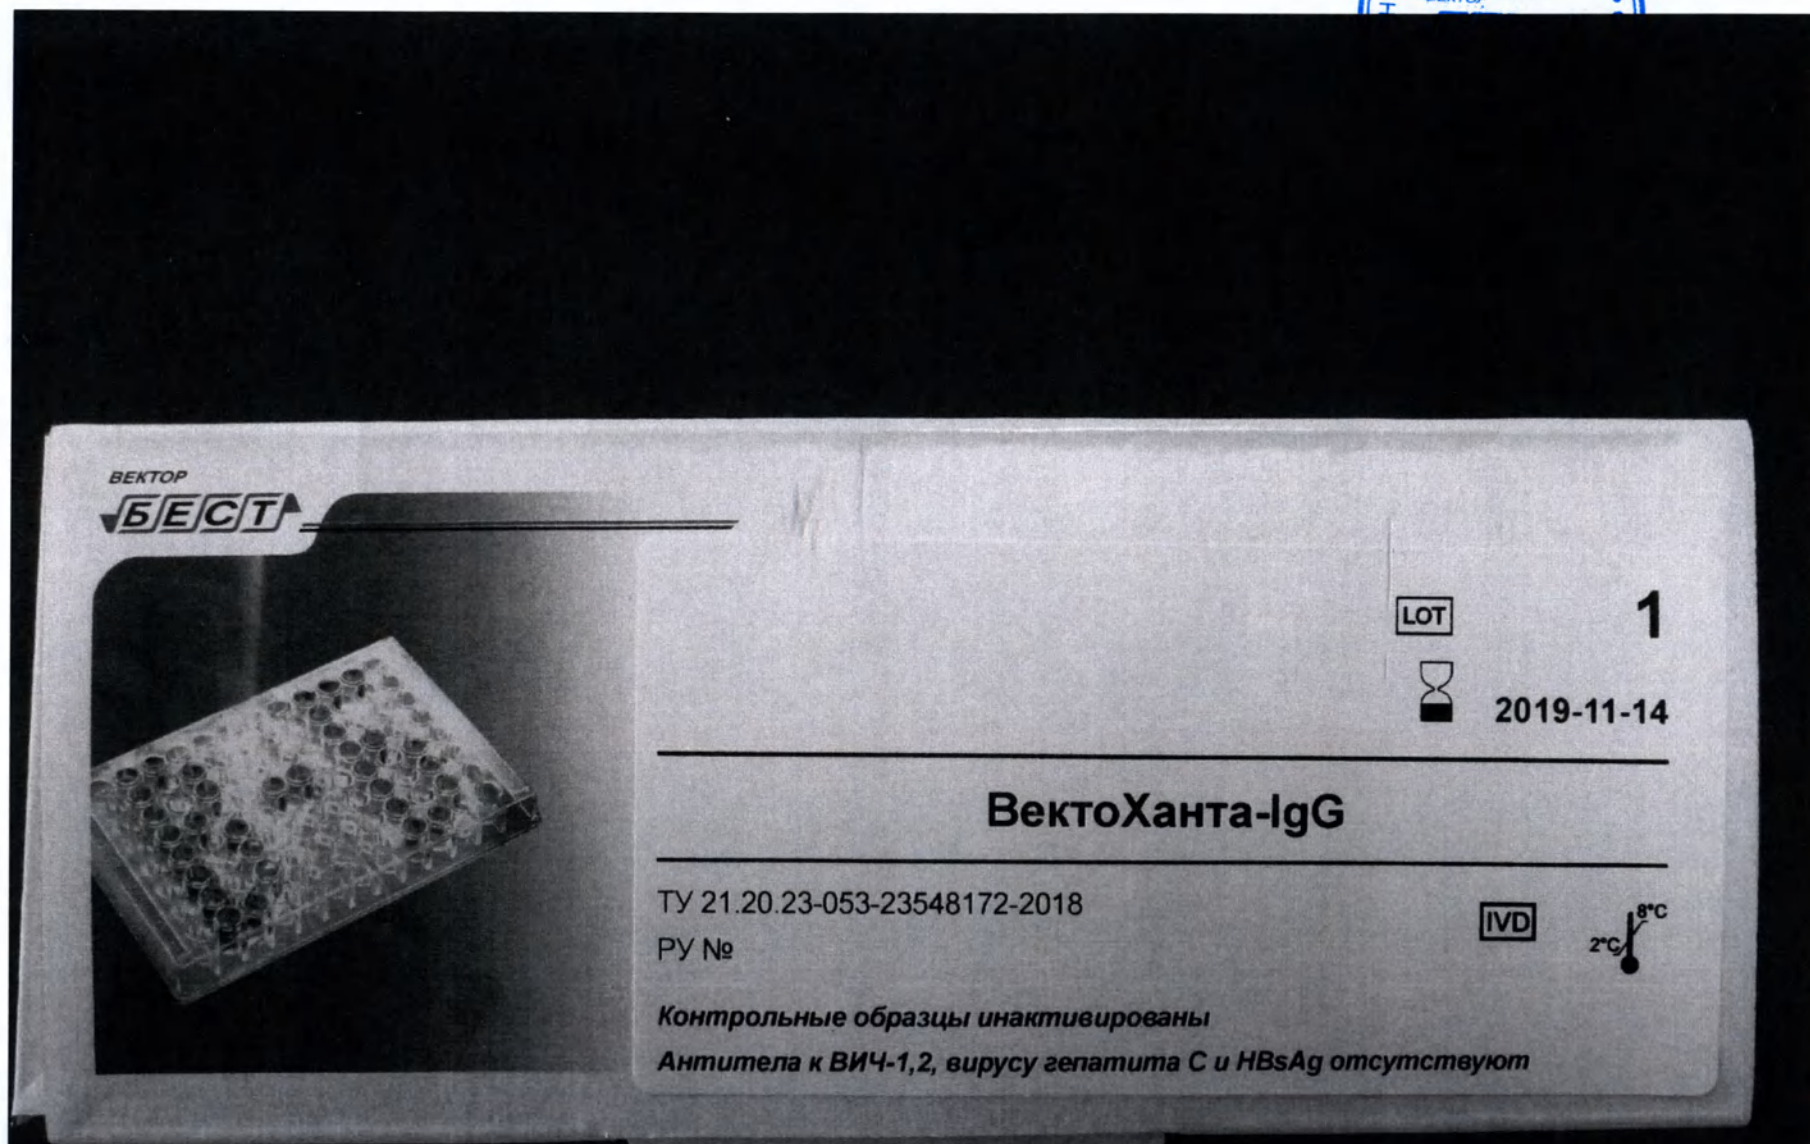

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ВектоХанта-IgG”
 серия 2


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2019 г.

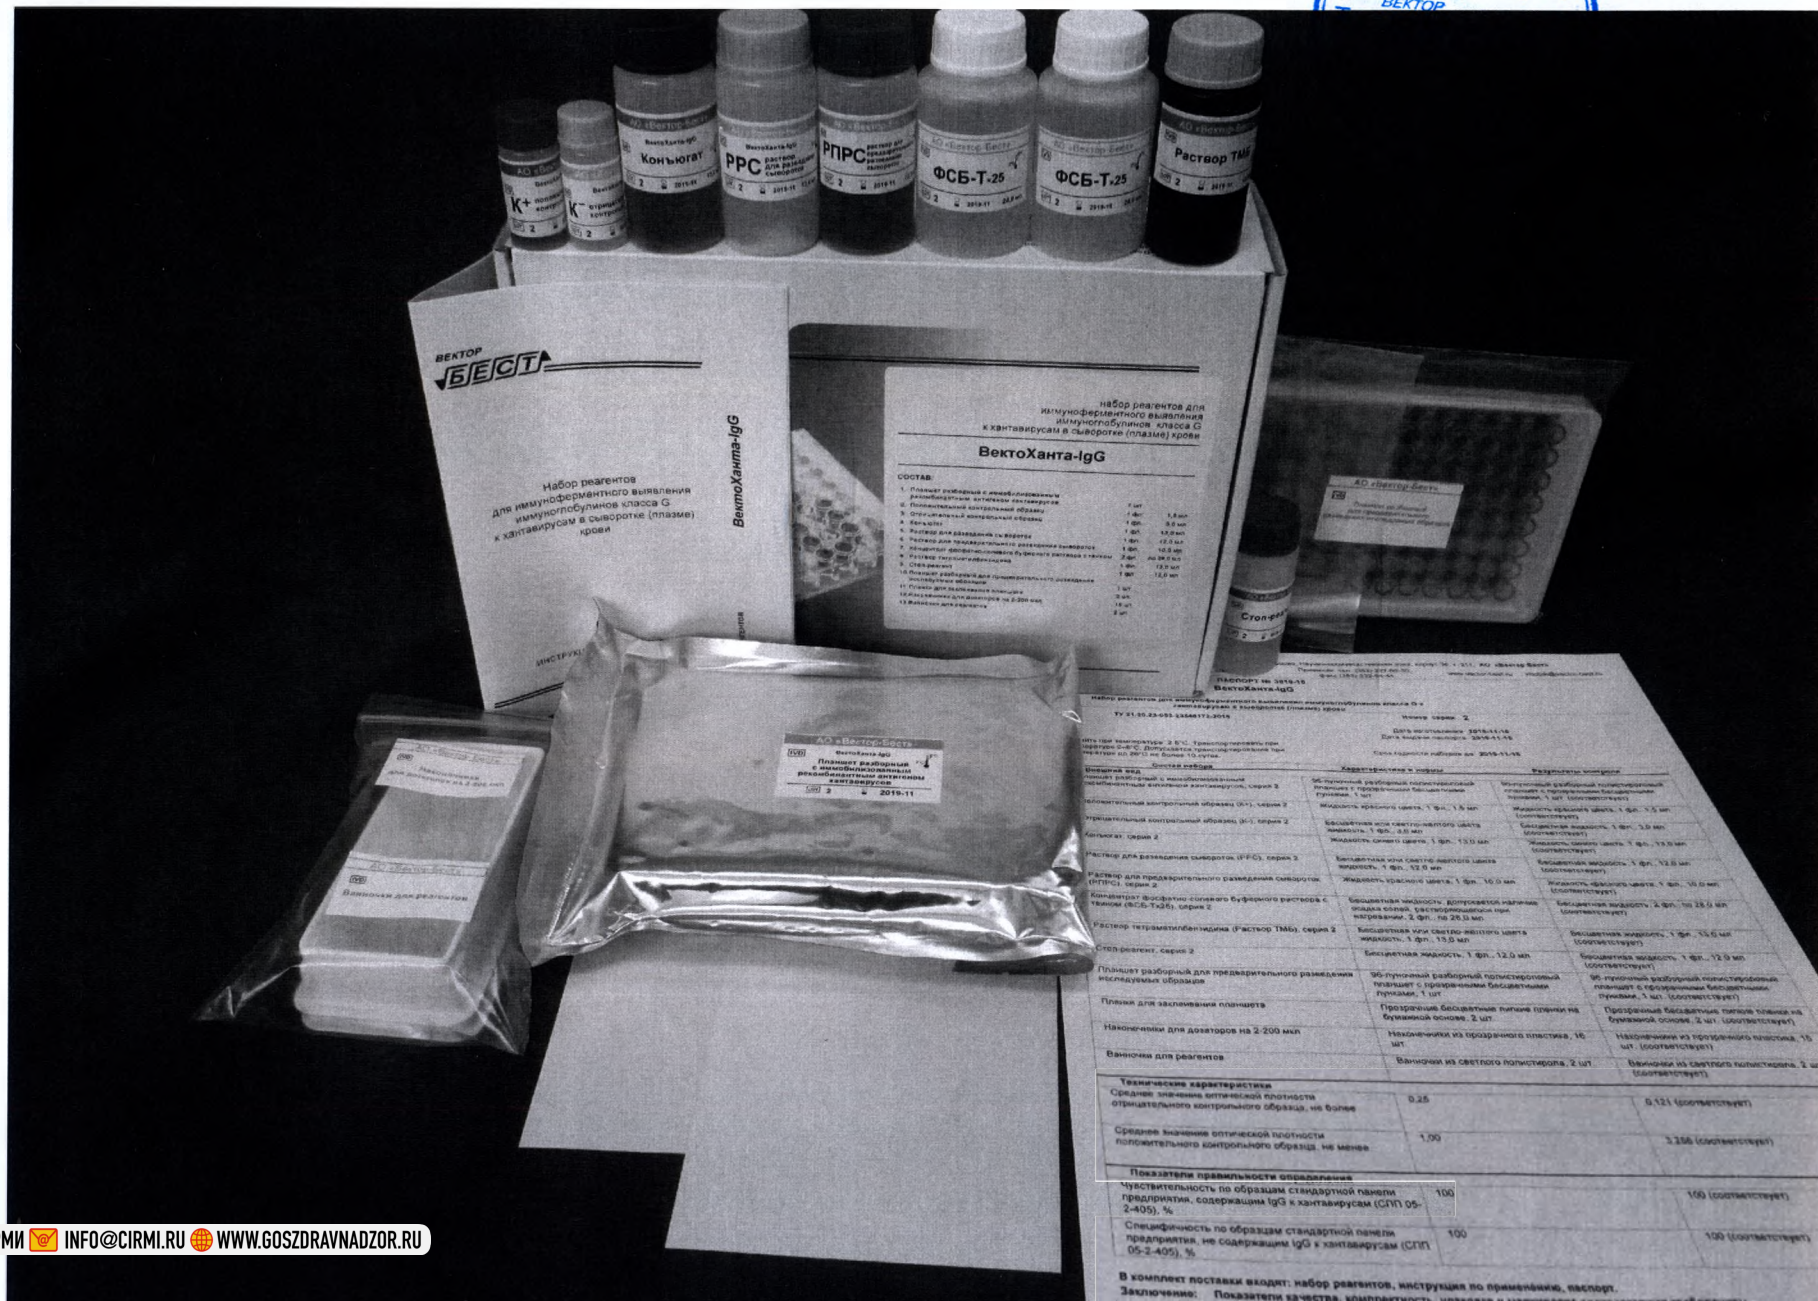

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ВектоХанта-IgG" №1
серия 2


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2019 г.

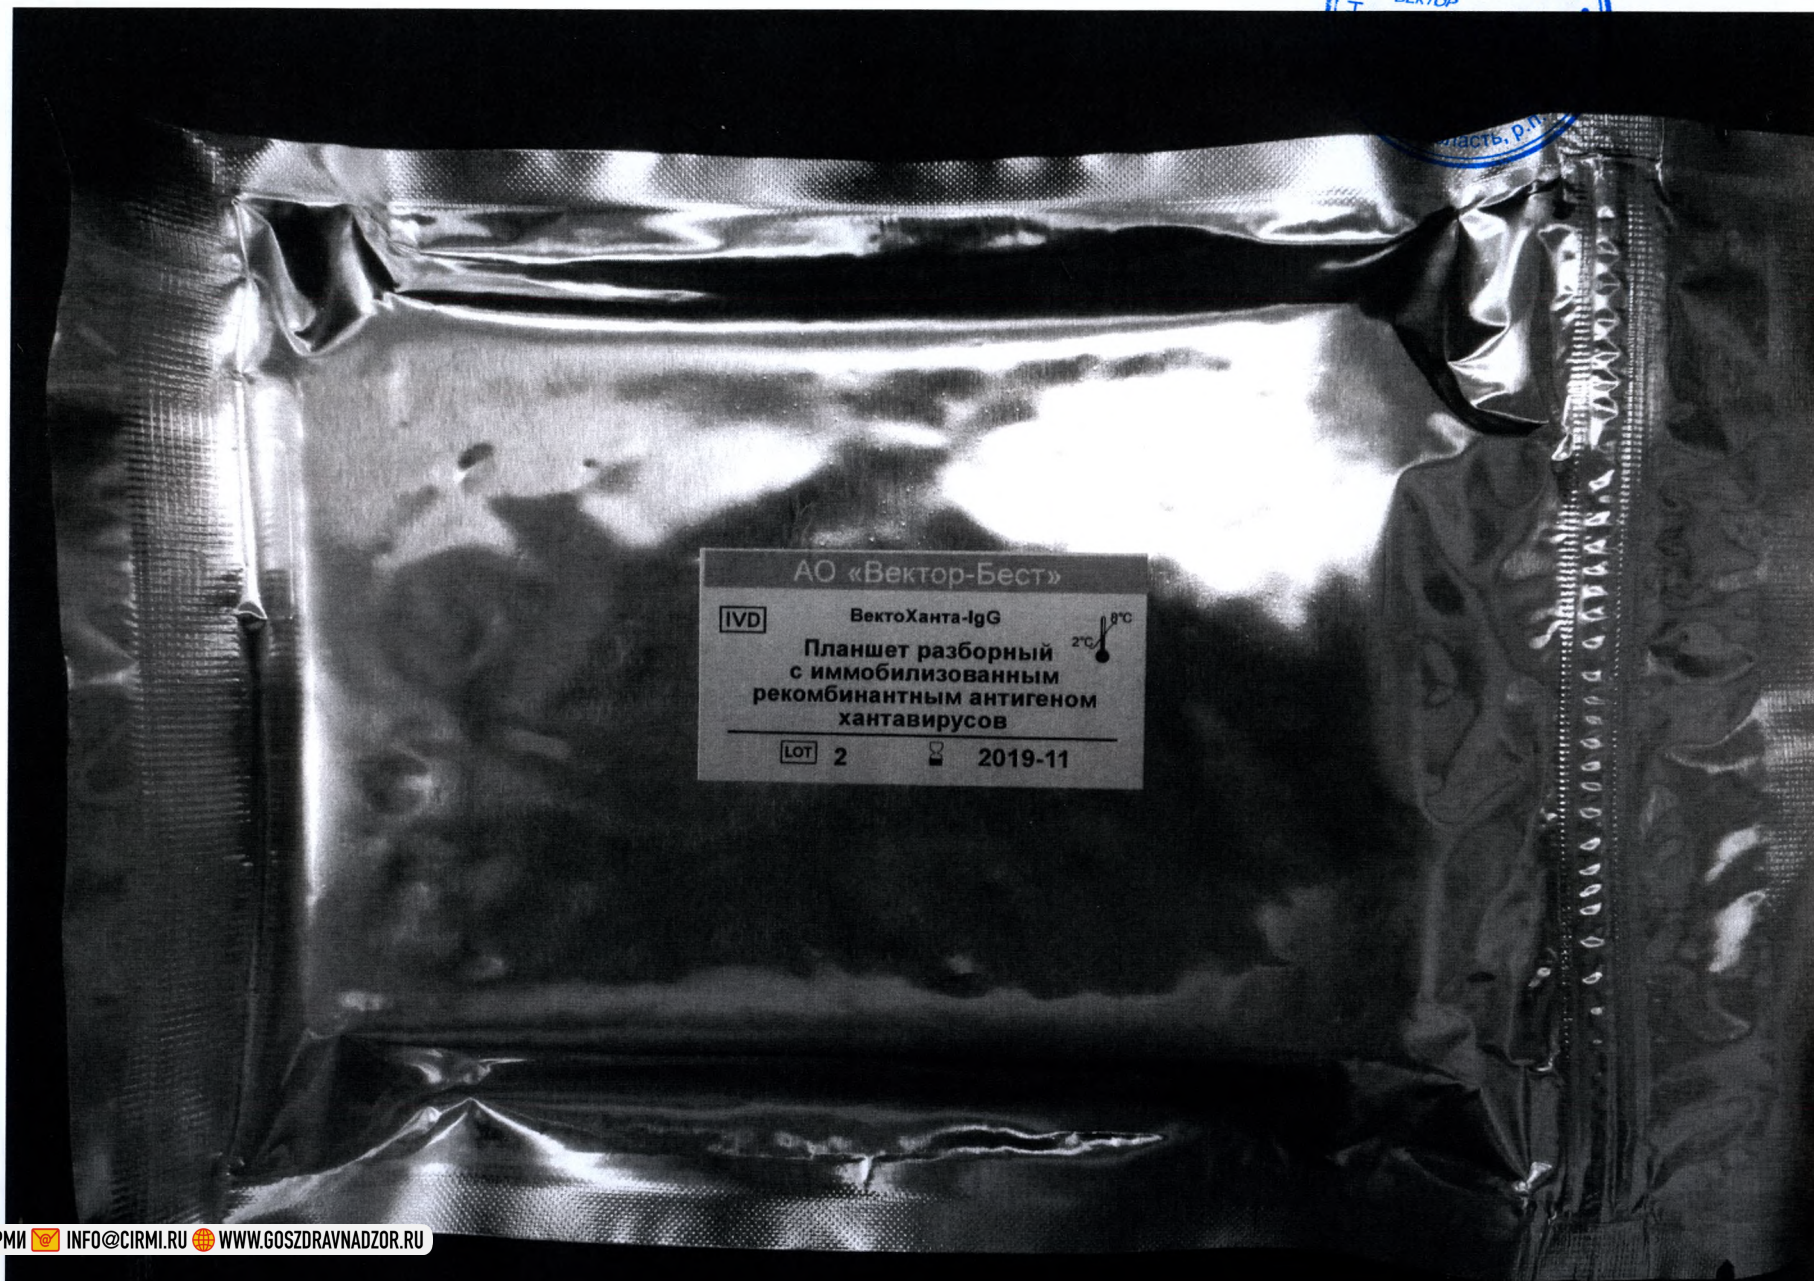


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ВектоХанта-IgG" №2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2019 г.

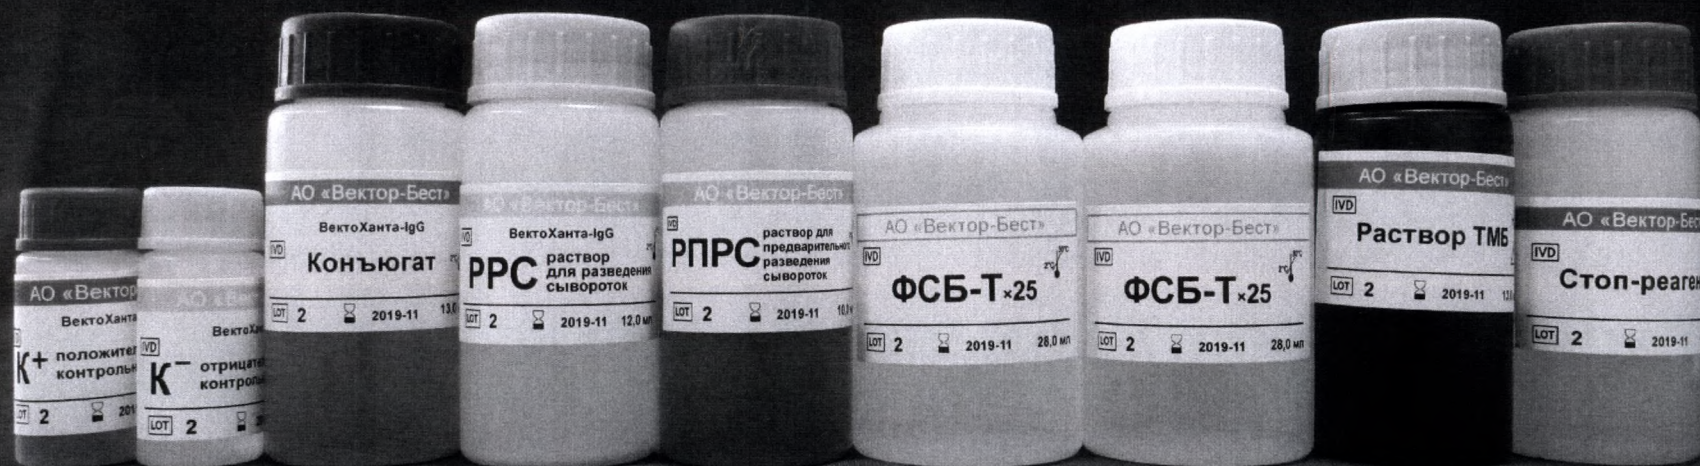




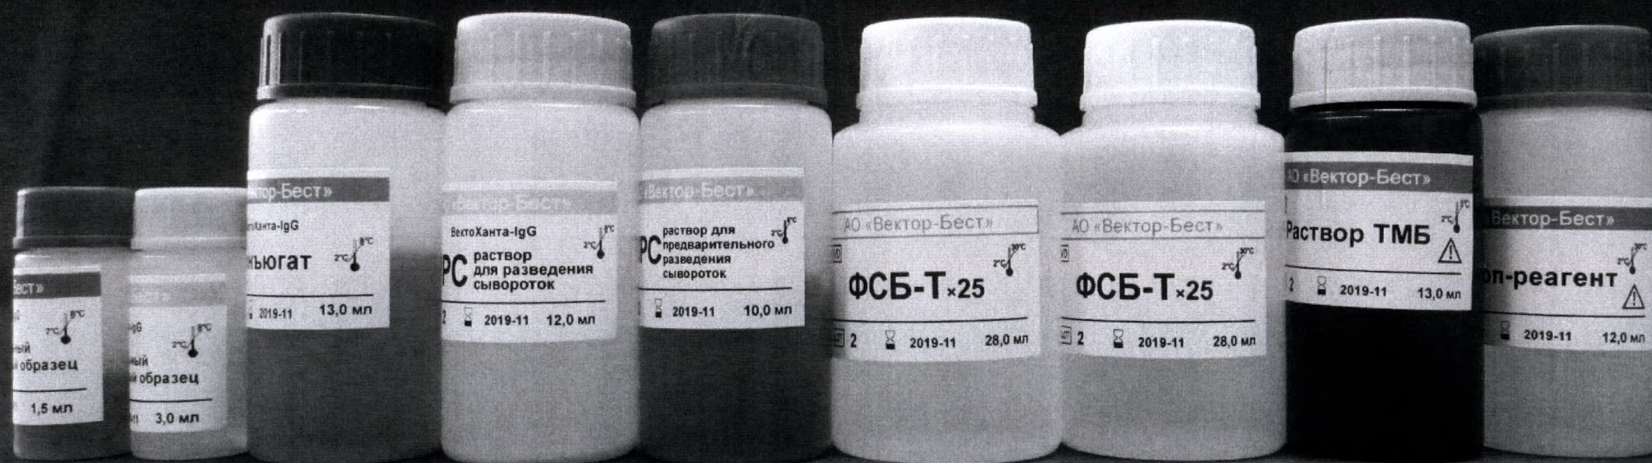

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоХанга-IgG” №5
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.

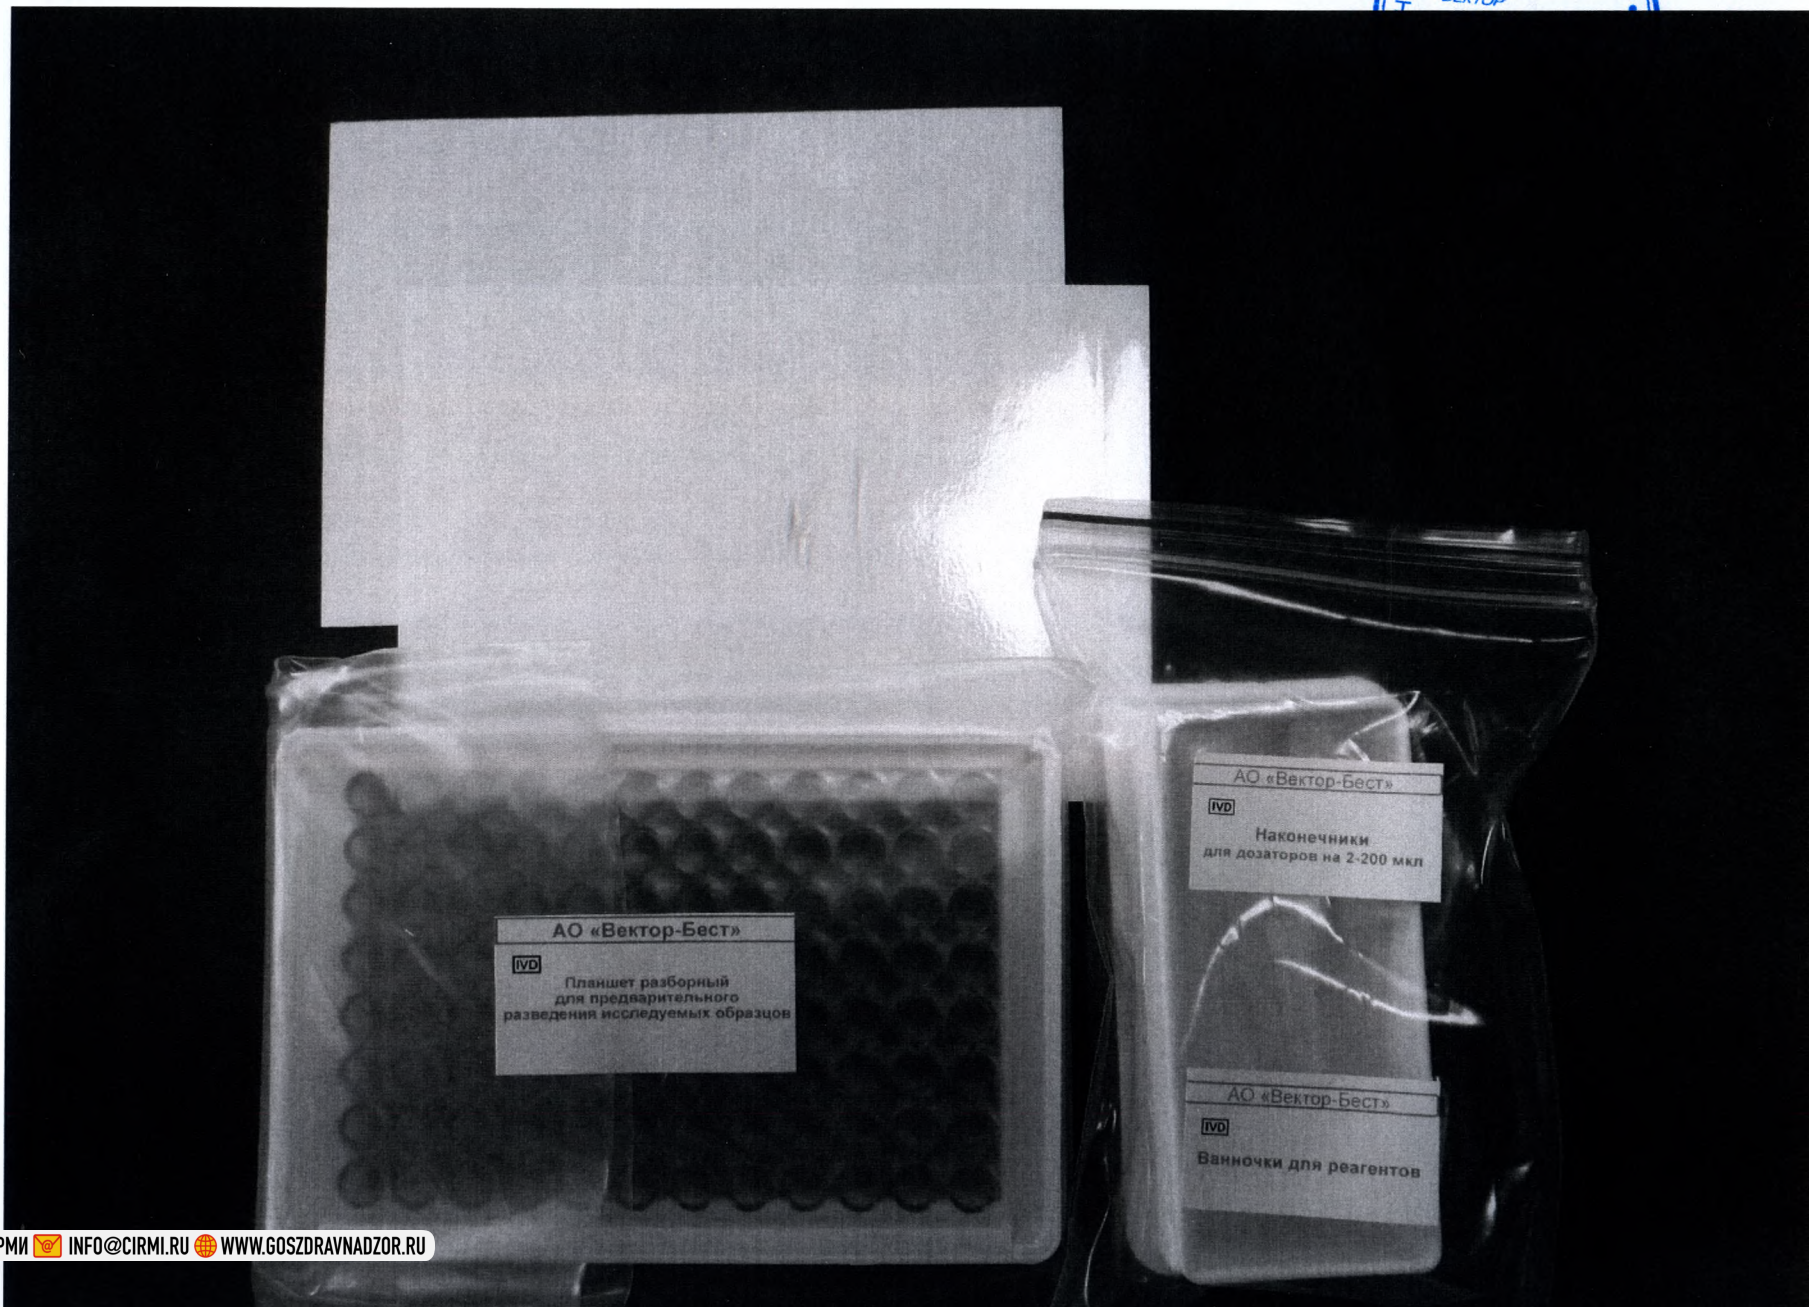



ВЕКТОР

БЕСТ

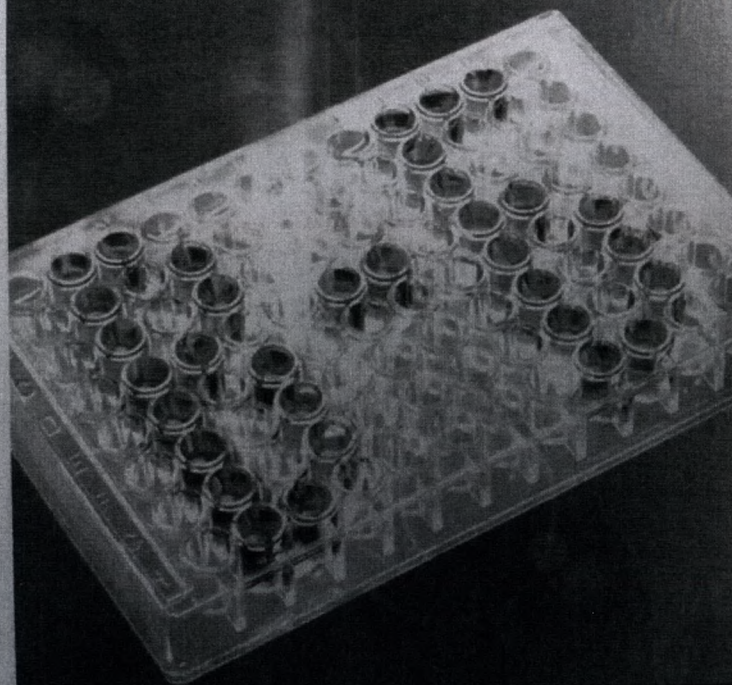

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови

ВектоХанта-IgG

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном хантавирусов	1 шт.	
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	3,0 мл
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидаина	1 фл.	13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ВектоХанта-IgG" №2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусанов
2019 г.

