

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев


«01» Ноября 2018 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ» набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018

2

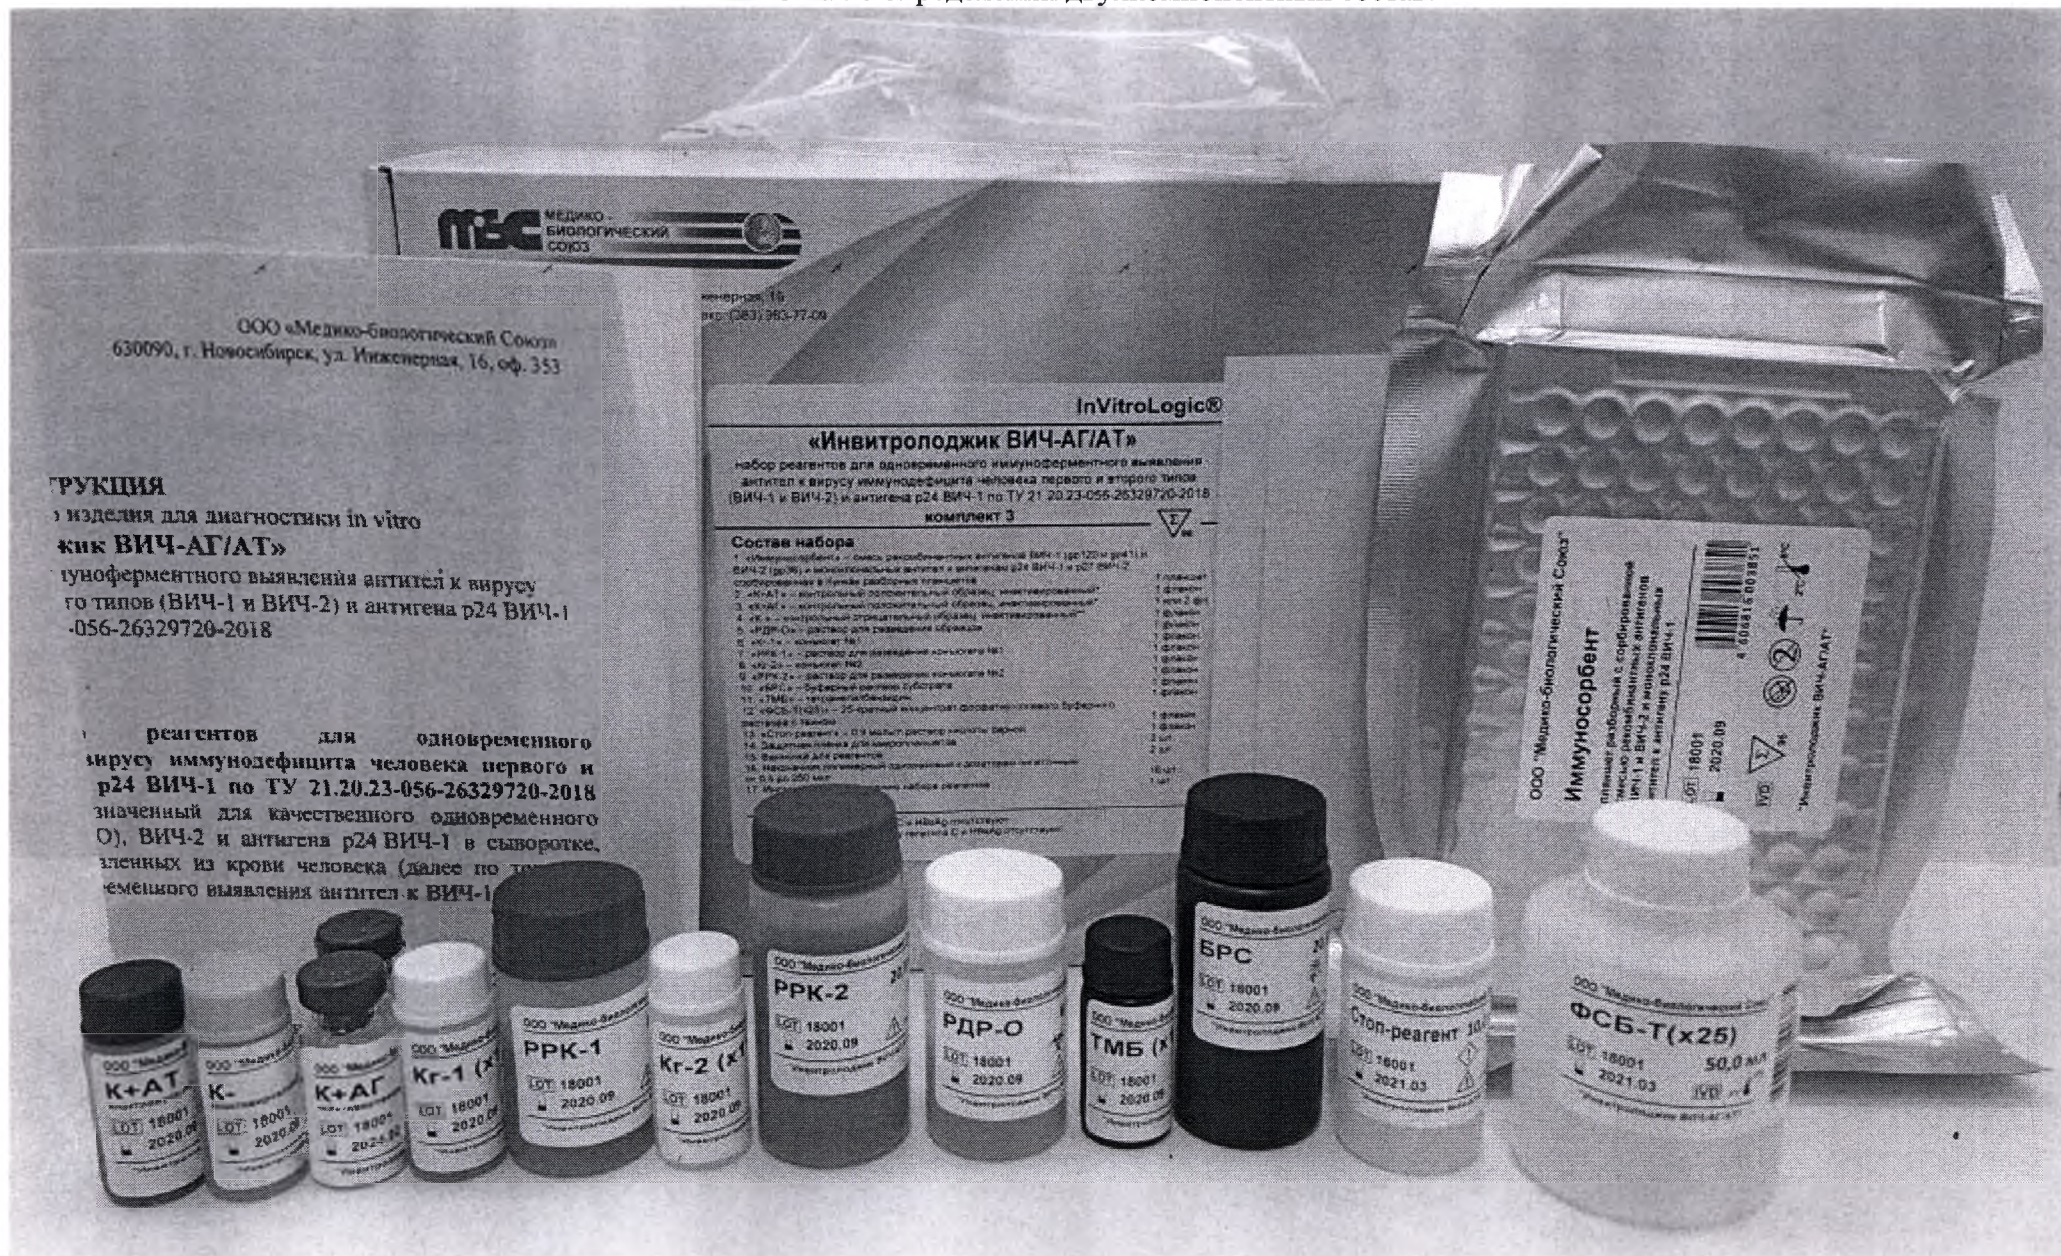

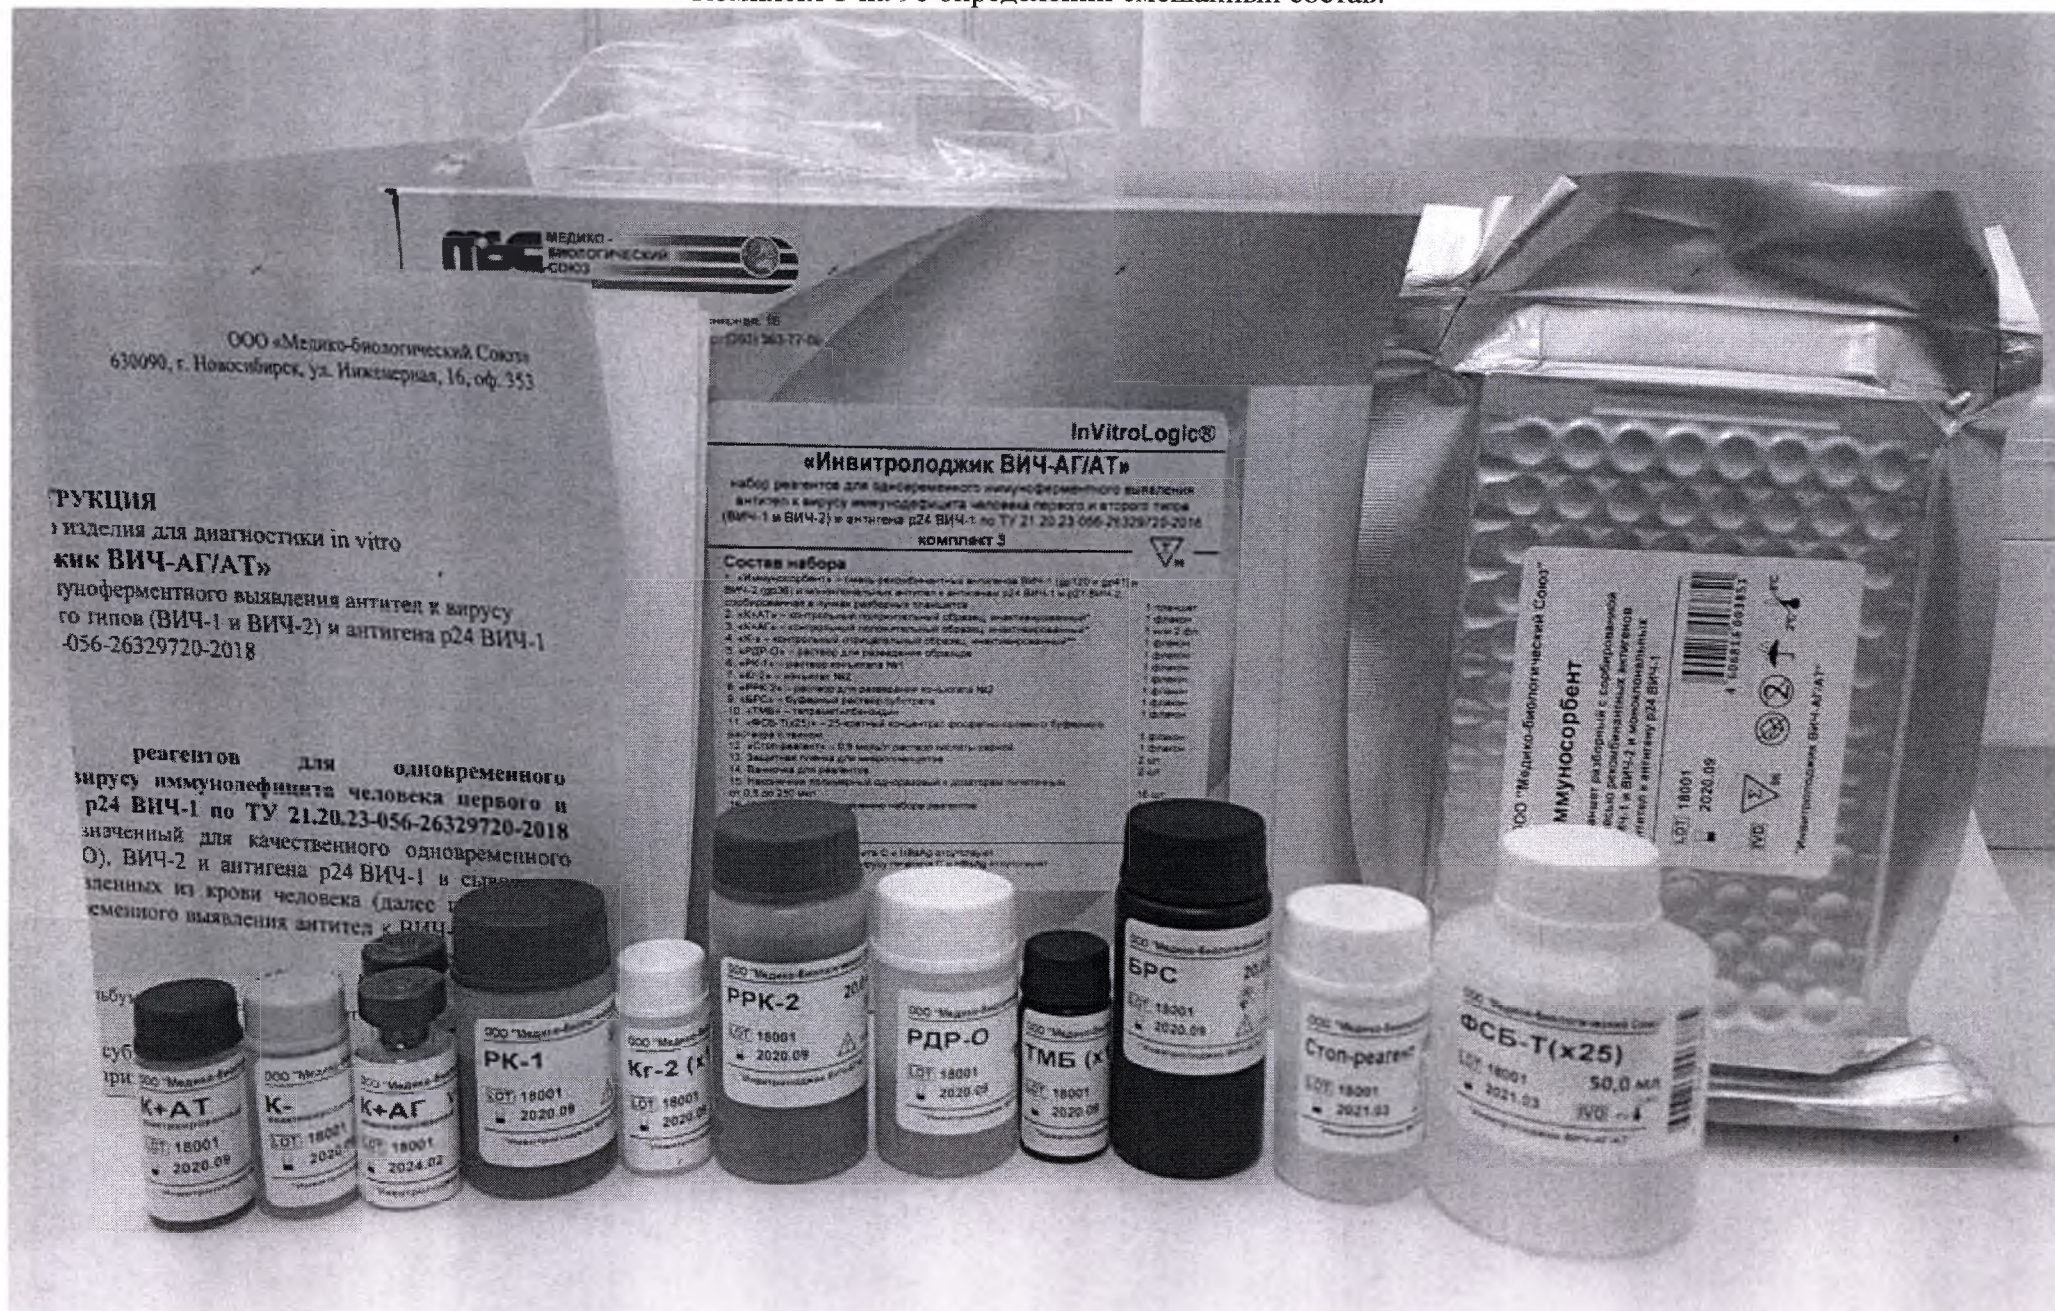

ООО «Медико-биологический Сангем»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

ГРУКЦИЯ

УЗДЕСЛІЯ ДЛІ ДІАГНОСТИКИ *in vitro*

жик ВИЧ-АБ/АТ»

гупоферментного выявления антител к вирусам
го типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1
-056-26329720-2018

реактивов для одновременного
вирусу иммунодефицита человека первого и
р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018
значений для качественного однофакторного
О), ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке,
аленных из крови человека (далее по тексту
емного выявления антител к ВИЧ-1 и

In Vitro Logic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»


набор реагентов для одностадийного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26529720-2018
комплект 3


Состав набора


1. «Иллюстрация» – серия репродуктивных работ БЭИ, (1919) – 1919
2. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
3. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
4. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
5. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
6. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
7. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
8. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
9. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
10. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
11. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
12. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
13. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
14. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
15. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
16. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
17. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
18. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
19. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919
20. «1919» – серия репродуктивных работ в выставках БЭИ, (1919) – 1919


2. 1980-1981
3. 1982-1983
4. 1984-1985
5. 1986-1987
6. 1988-1989
7. 1990-1991
8. 1992-1993
9. 1994-1995
10. 1996-1997
11. 1998-1999
12. 2000-2001
13. 2002-2003
14. 2004-2005
15. 2006-2007
16. 2008-2009
17. 2010-2011
18. 2012-2013
19. 2014-2015
20. 2016-2017
21. 2018-2019
22. 2020-2021
23. 2022-2023
24. 2024-2025
25. 2026-2027
26. 2028-2029
27. 2030-2031
28. 2032-2033
29. 2034-2035
30. 2036-2037
31. 2038-2039
32. 2040-2041
33. 2042-2043
34. 2044-2045
35. 2046-2047
36. 2048-2049
37. 2050-2051
38. 2052-2053
39. 2054-2055
40. 2056-2057
41. 2058-2059
42. 2060-2061
43. 2062-2063
44. 2064-2065
45. 2066-2067
46. 2068-2069
47. 2070-2071
48. 2072-2073
49. 2074-2075
50. 2076-2077
51. 2078-2079
52. 2080-2081
53. 2082-2083
54. 2084-2085
55. 2086-2087
56. 2088-2089
57. 2090-2091
58. 2092-2093
59. 2094-2095
60. 2096-2097
61. 2098-2099
62. 2100-2101
63. 2102-2103
64. 2104-2105
65. 2106-2107
66. 2108-2109
67. 2110-2111
68. 2112-2113
69. 2114-2115
70. 2116-2117
71. 2118-2119
72. 2120-2121
73. 2122-2123
74. 2124-2125
75. 2126-2127
76. 2128-2129
77. 2130-2131
78. 2132-2133
79. 2134-2135
80. 2136-2137
81. 2138-2139
82. 2140-2141
83. 2142-2143
84. 2144-2145
85. 2146-2147
86. 2148-2149
87. 2150-2151
88. 2152-2153
89. 2154-2155
90. 2156-2157
91. 2158-2159
92. 2160-2161
93. 2162-2163
94. 2164-2165
95. 2166-2167
96. 2168-2169
97. 2170-2171
98. 2172-2173
99. 2174-2175
100. 2176-2177
101. 2178-2179
102. 2180-2181
103. 2182-2183
104. 2184-2185
105. 2186-2187
106. 2188-2189
107. 2190-2191
108. 2192-2193
109. 2194-2195
110. 2196-2197
111. 2198-2199
112. 2200-2201
113. 2202-2203
114. 2204-2205
115. 2206-2207
116. 2208-2209
117. 2210-2211
118. 2212-2213
119. 2214-2215
120. 2216-2217
121. 2218-2219
122. 2220-2221
123. 2222-2223
124. 2224-2225
125. 2226-2227
126. 2228-2229
127. 2230-2231
128. 2232-2233
129. 2234-2235
130. 2236-2237
131. 2238-2239
132. 2240-2241
133. 2242-2243
134. 2244-2245
135. 2246-2247
136. 2248-2249
137. 2250-2251
138. 2252-2253
139. 2254-2255
140. 2256-2257
141. 2258-2259
142. 2260-2261
143. 2262-2263
144. 2264-2265
145. 2266-2267
146. 2268-2269
147. 2270-2271
148. 2272-2273
149. 2274-2275
150. 2276-2277
151. 2278-2279
152. 2280-2281
153. 2282-2283
154. 2284-2285
155. 2286-2287
156. 2288-2289
157. 2290-2291
158. 2292-2293
159. 2294-2295
160. 2296-2297
161. 2298-2299
162. 2300-2301
163. 2302-2303
164. 2304-2305
165. 2306-2307
166. 2308-2309
167. 2310-2311
168. 2312-2313
169. 2314-2315
170. 2316-2317
171. 2318-2319
172. 2320-2321
173. 2322-2323
174. 2324-2325
175. 2326-2327
176. 2328-2329
177. 2330-2331
178. 2332-2333
179. 2334-2335
180. 2336-2337
181. 2338-2339
182. 2340-2341
183. 2342-2343
184. 2344-2345
185. 2346-2347
186. 2348-2349
187. 2350-2351
188. 2352-2353
189. 2354-2355
190. 2356-2357
191. 2358-2359
192. 2360-2361
193. 2362-2363
194. 2364-2365
195. 2366-2367
196. 2368-2369
197. 2370-2371
198. 2372-2373
199. 2374-2375
200. 2376-2377
201. 2378-2379
202. 2380-2381
203. 2382-2383
204. 2384-2385
205. 2386-2387
206. 2388-2389
207. 2390-2391
208. 2392-2393
209. 2394-2395
210. 2396-2397
211. 2398-2399
212. 2400-2401
213. 2402-2403
214. 2404-2405
215. 2406-2407
216. 2408-2409
217. 2410-2411
218. 2412-2413
219. 2414-2415
220. 2416-2417
221. 2418-2419
222. 2420-

[illegible]

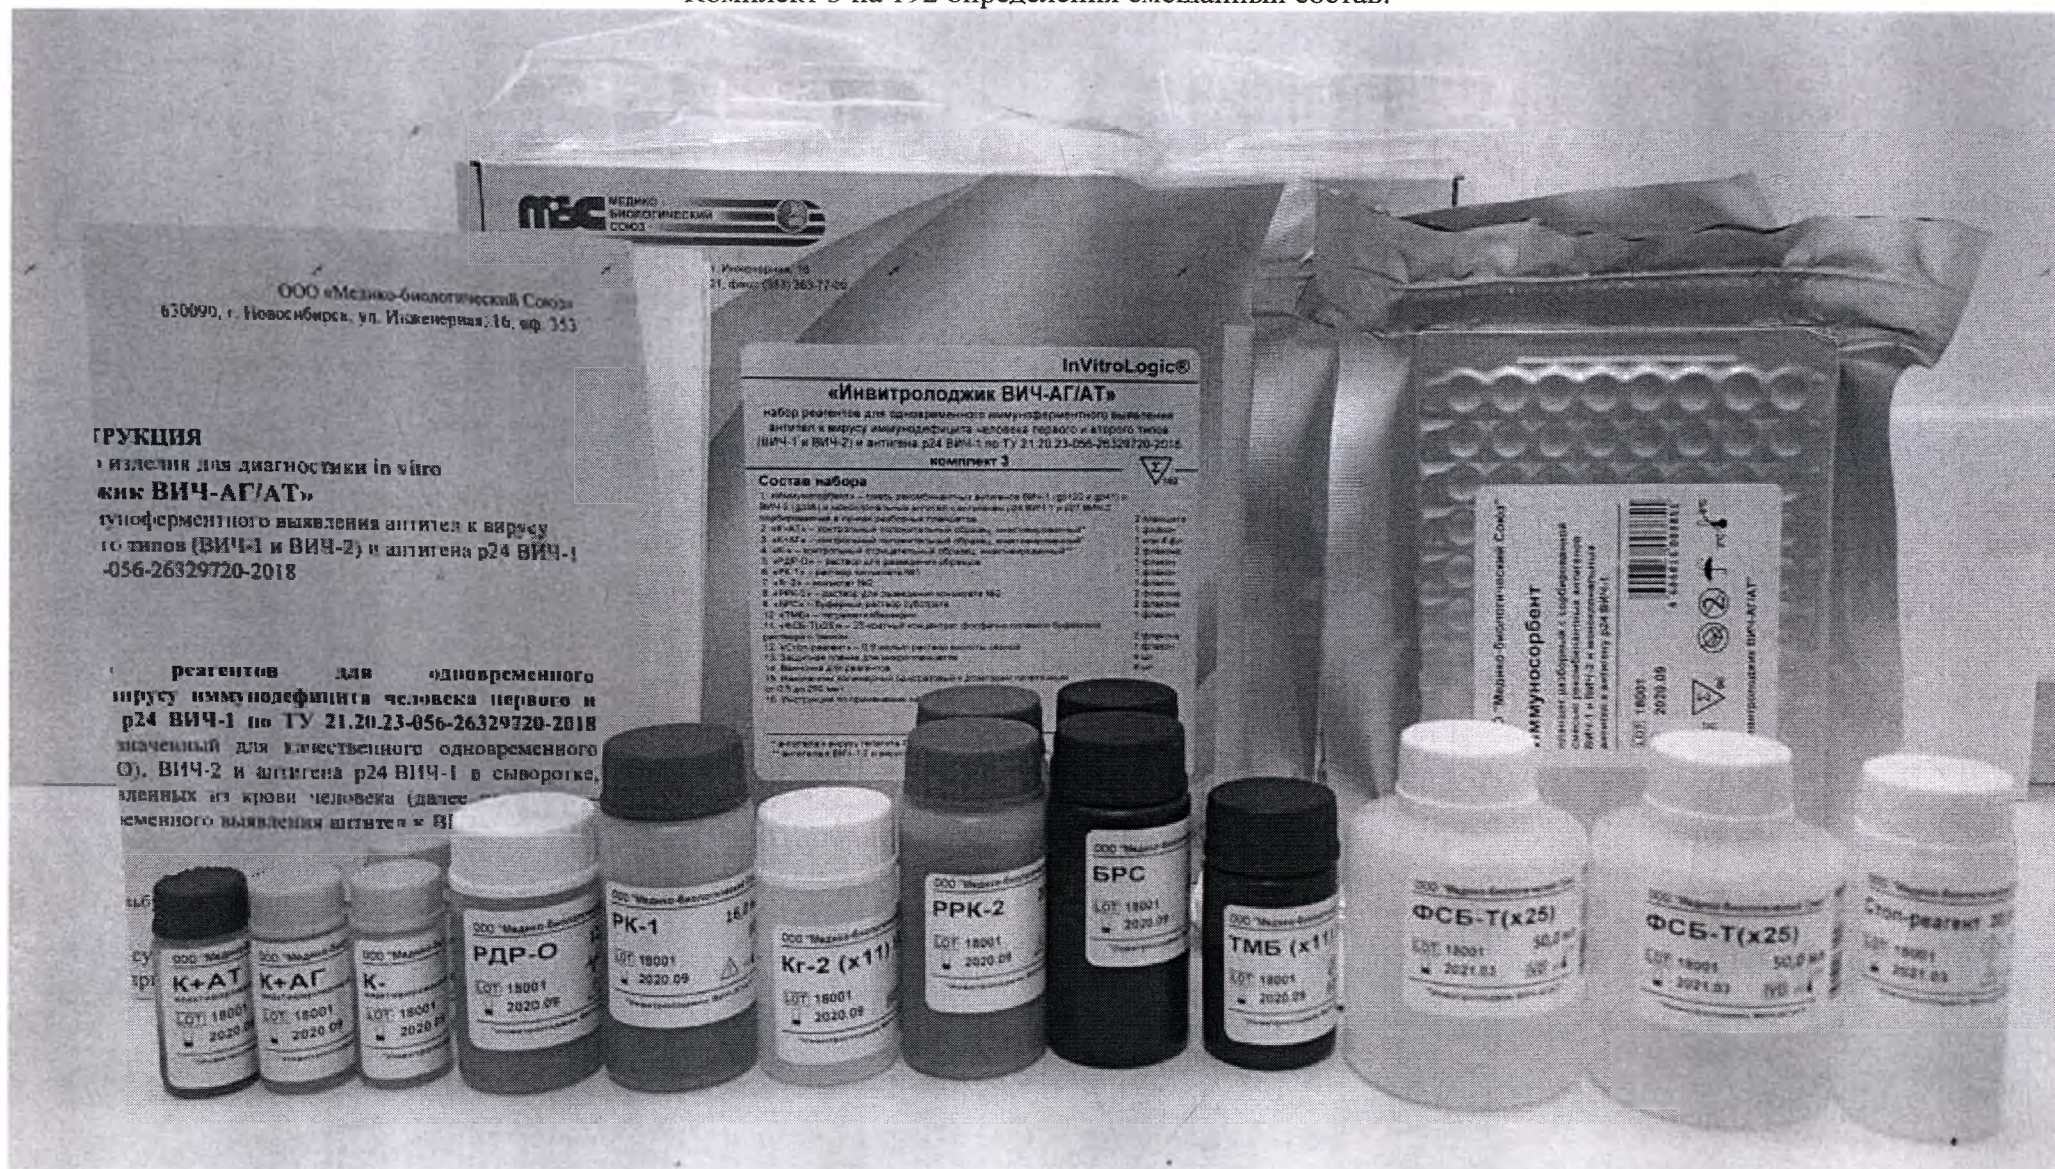

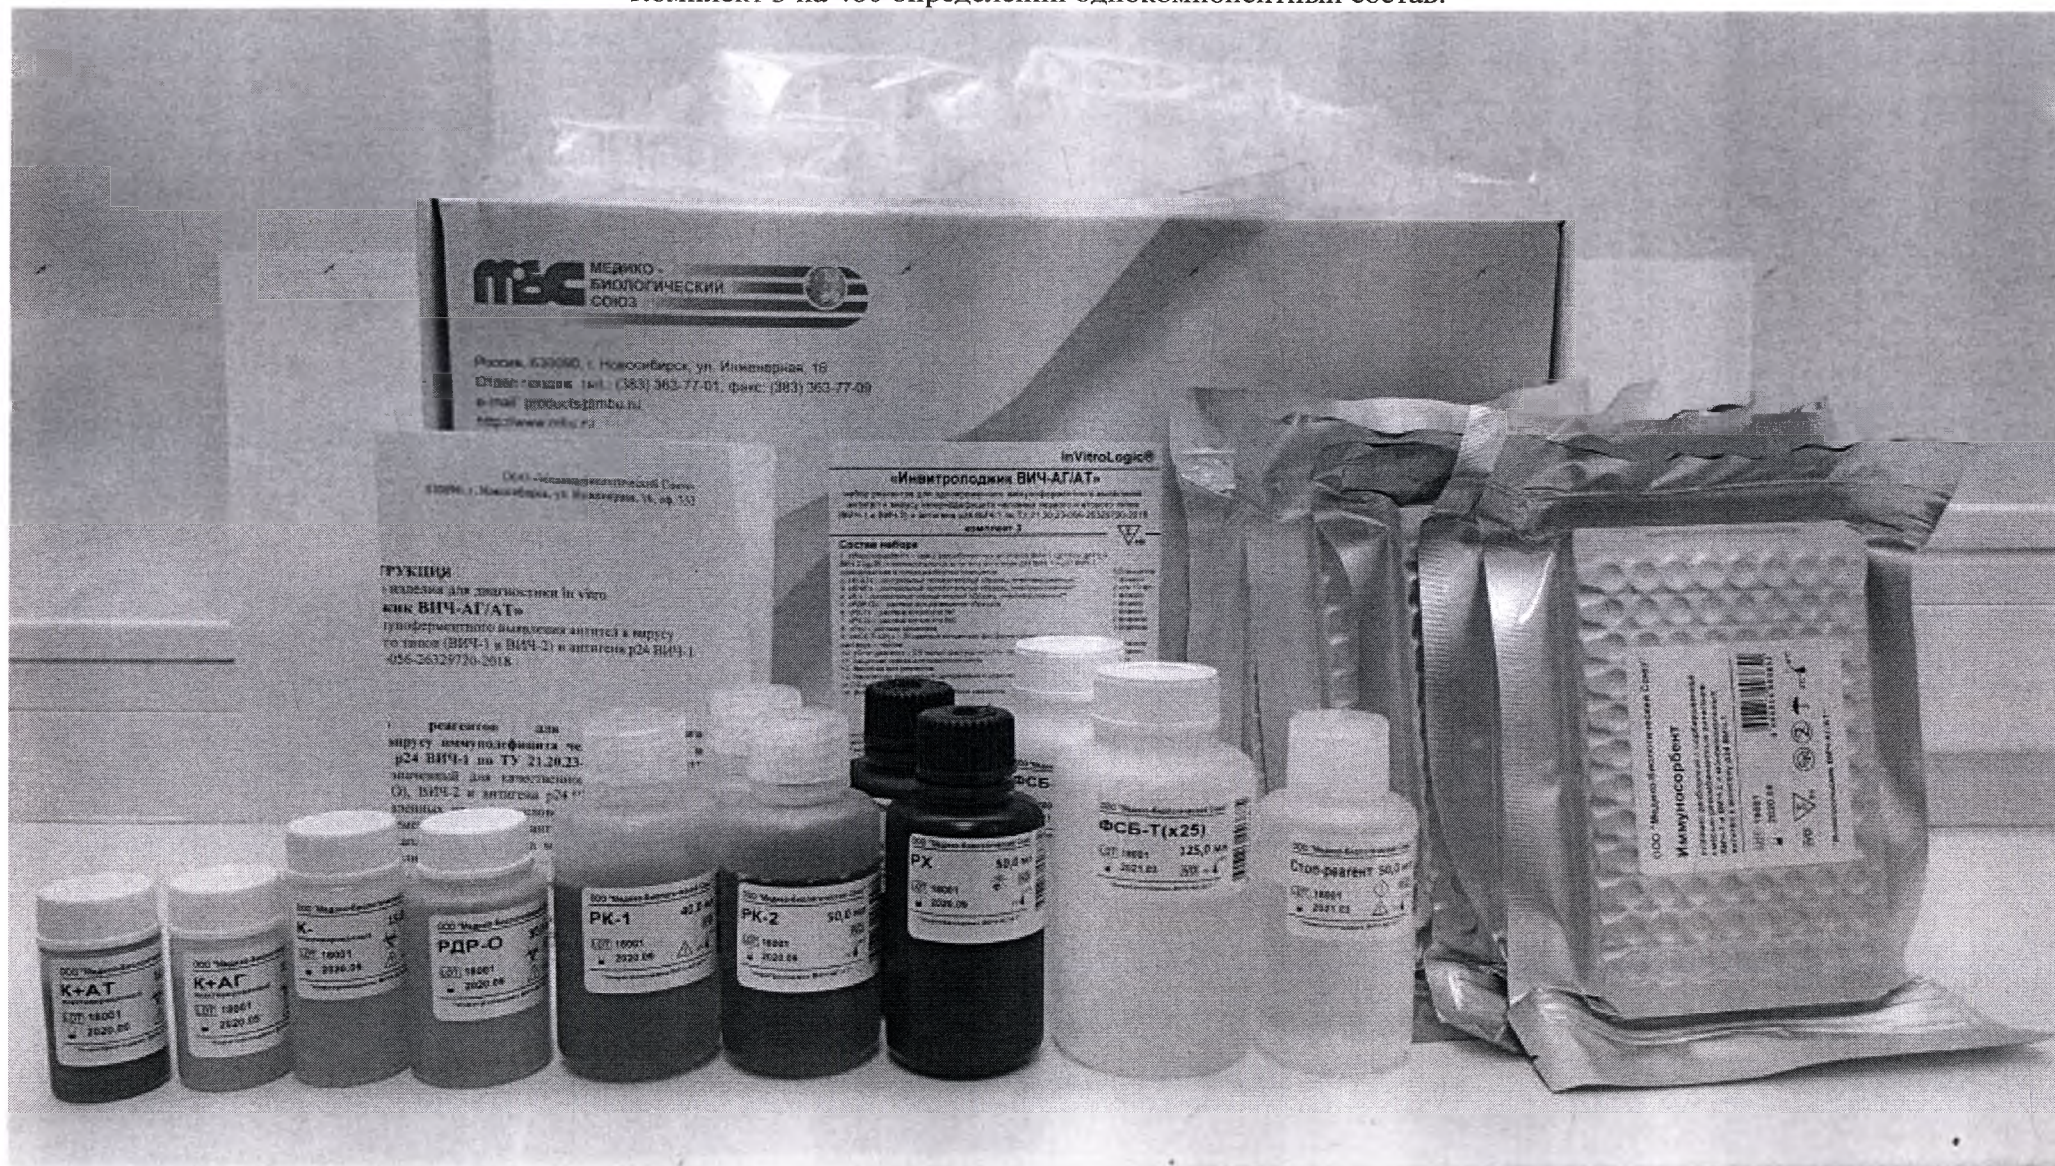

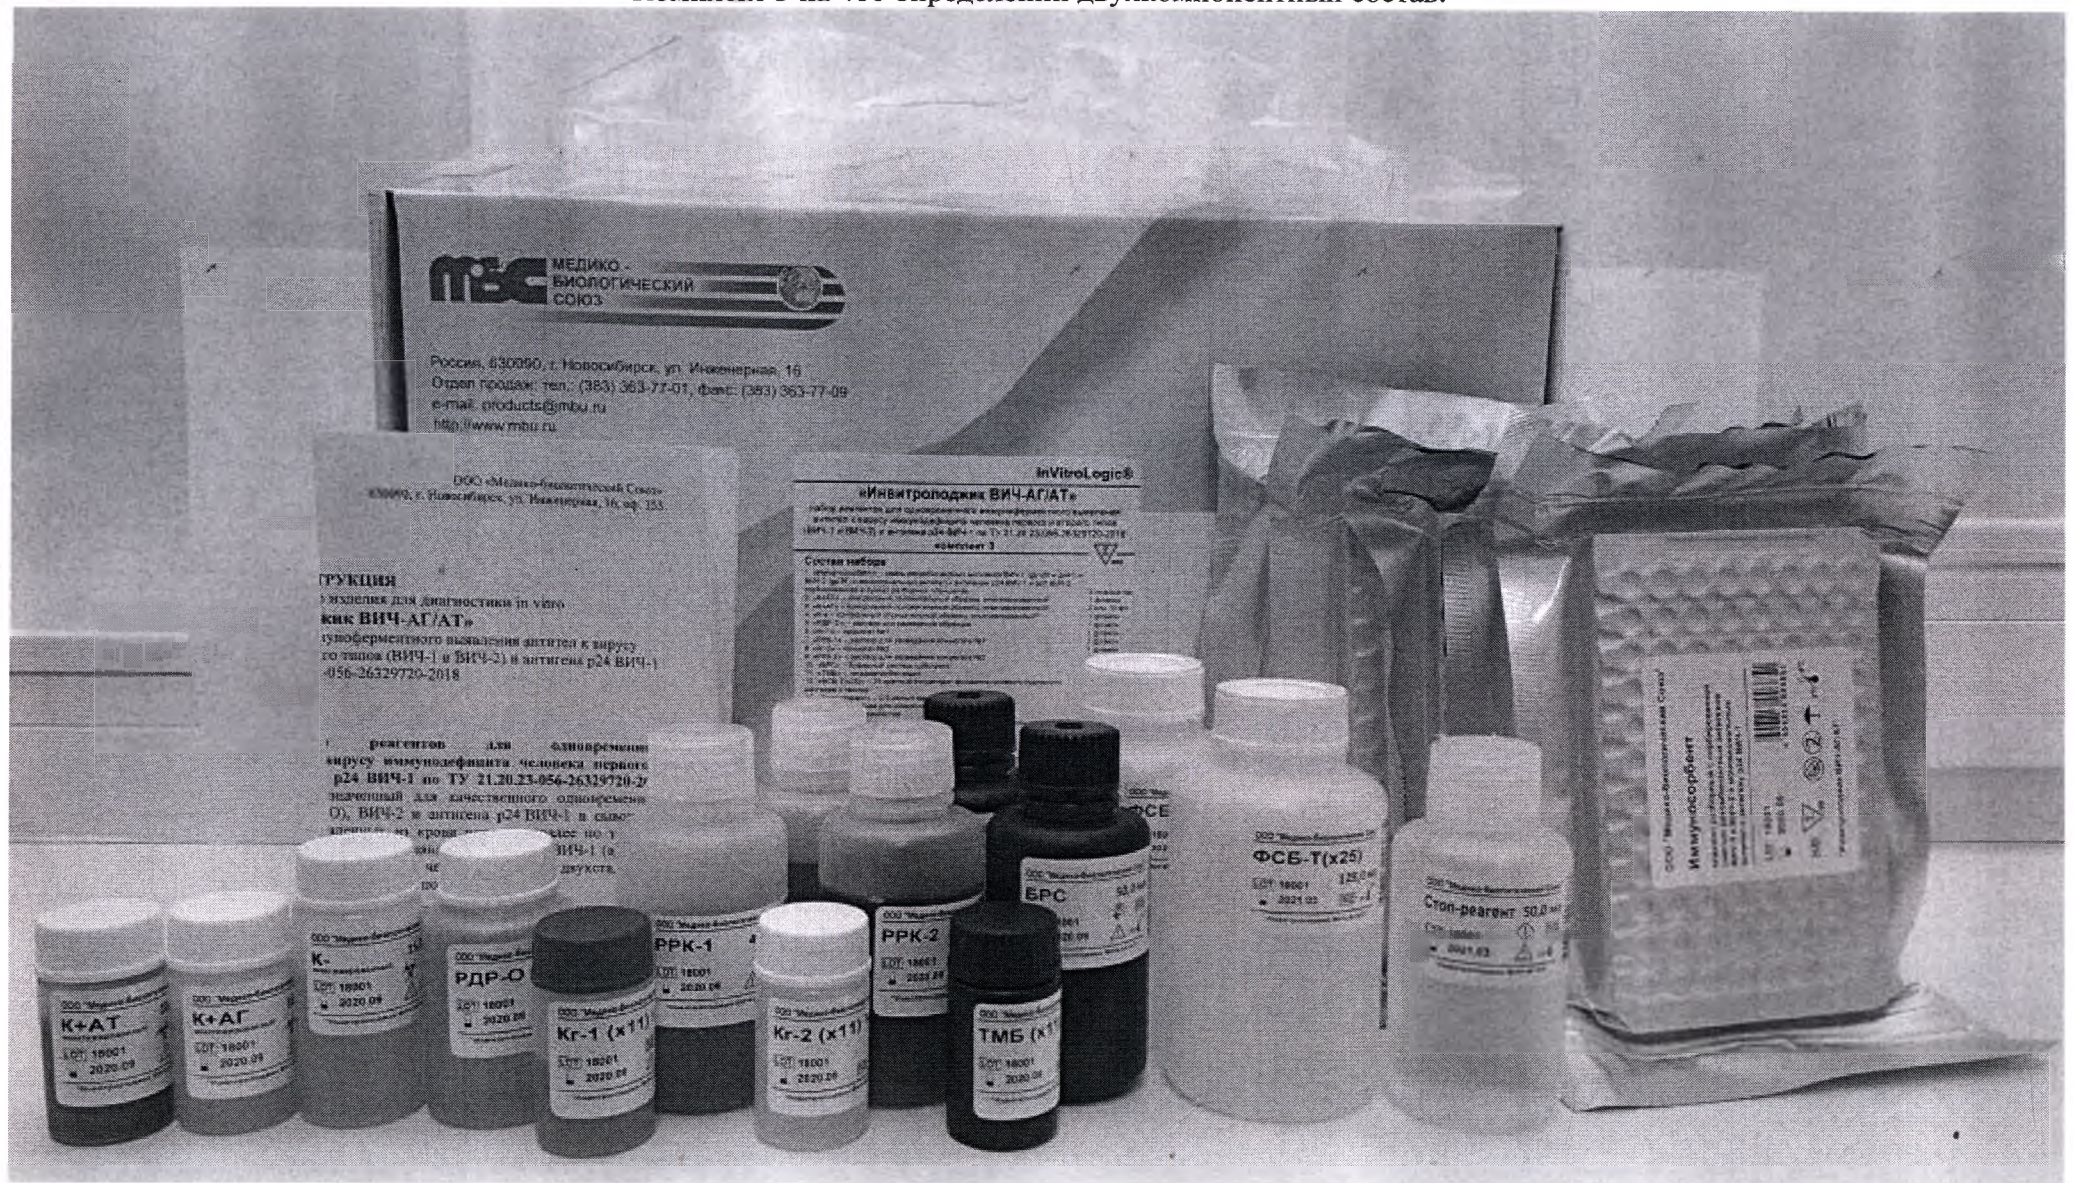

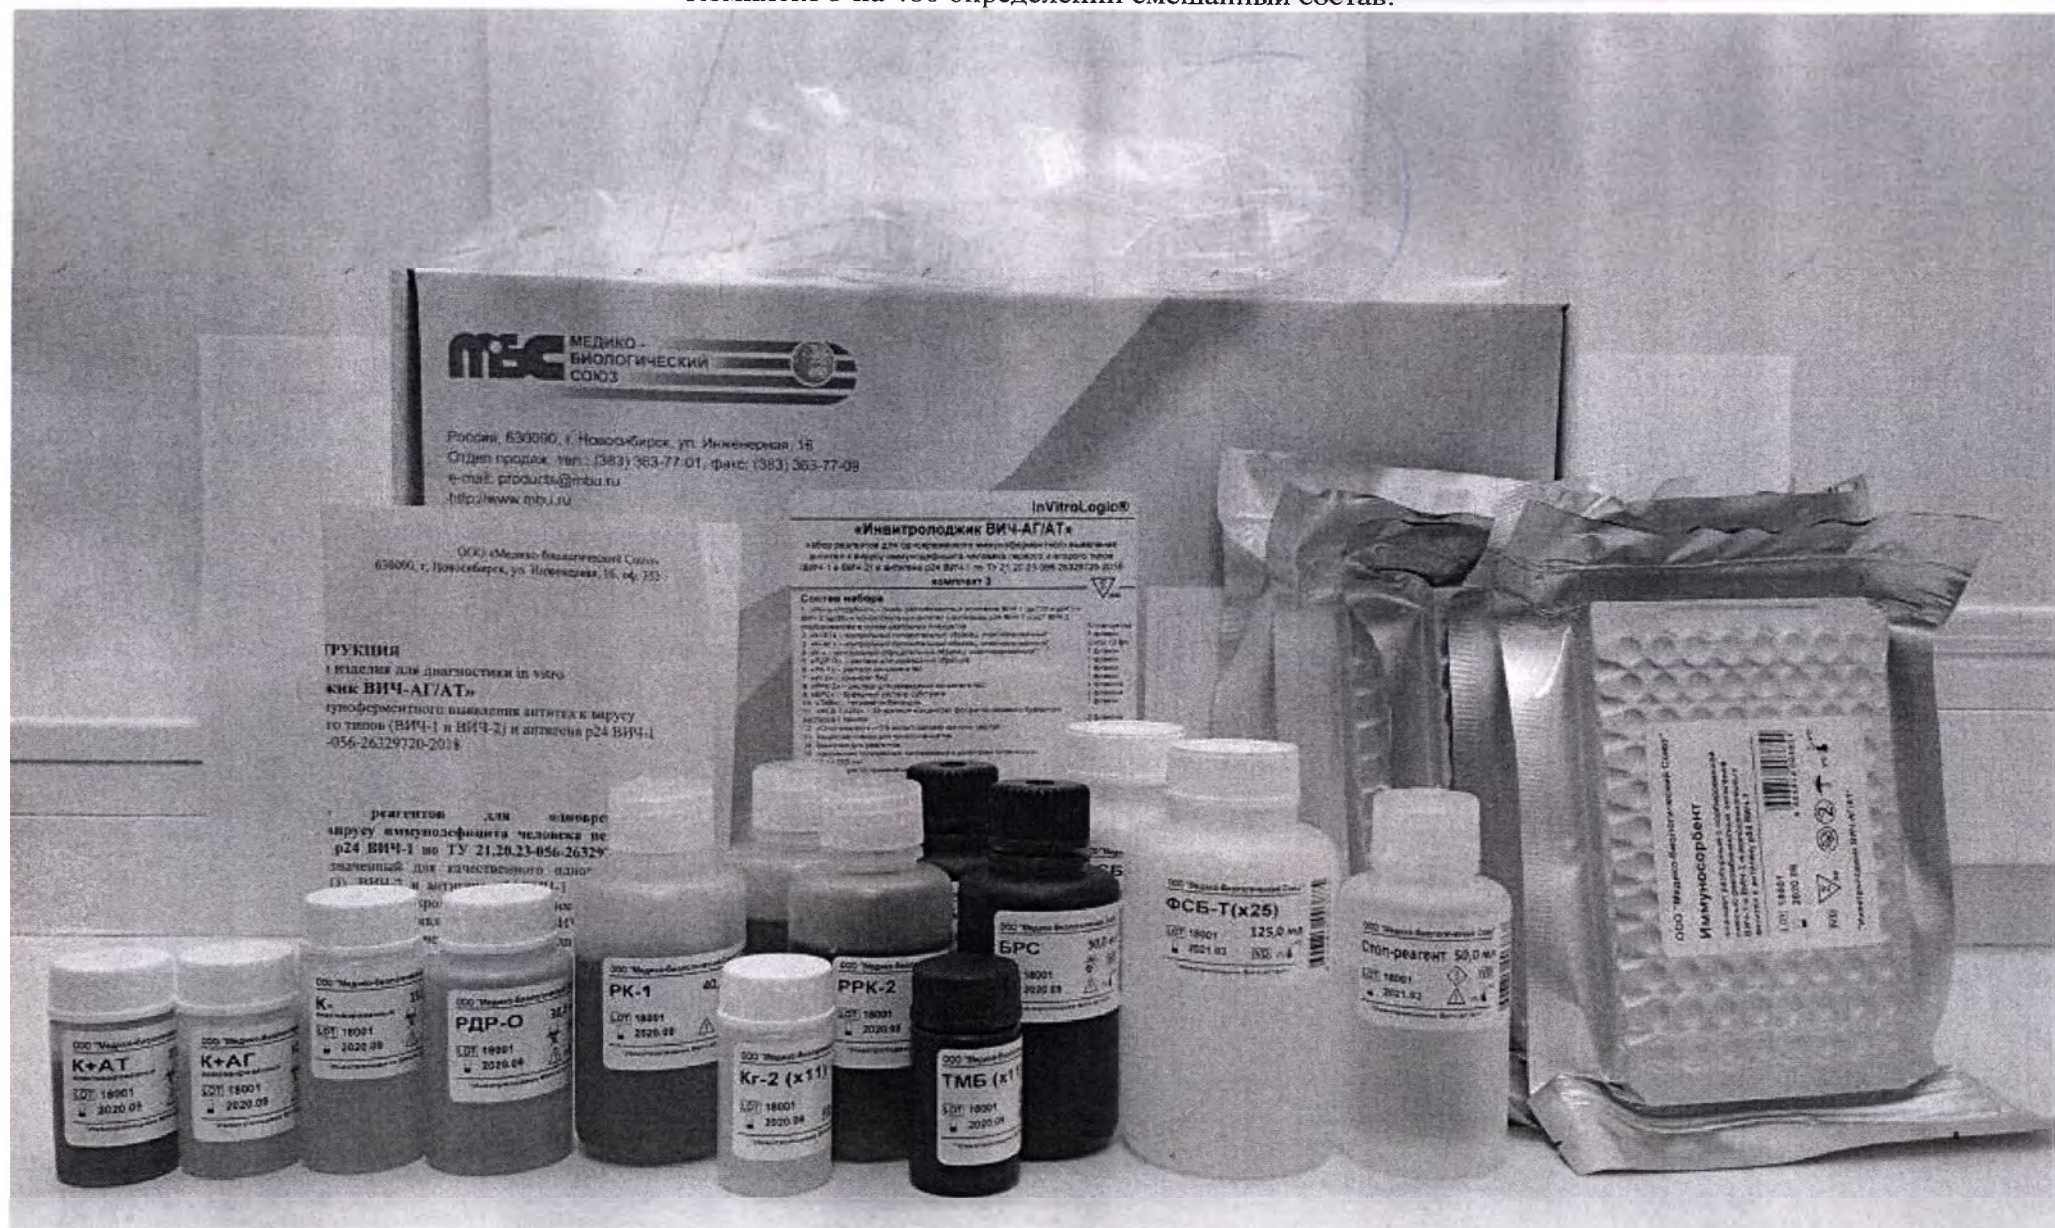



Пропито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз»
М.В.Лосев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

2018 г.




Образцы маркировки медицинского изделия

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ» набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018

Внешняя маркировка

Комплект 3 на 96 определений однокомпонентный состав:

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitoLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группу О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 1 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 1 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX  **LOT** XXXXX  XXXX.XX
Замораживание не допускается  XXXX.XX


"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена p24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018 комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 1 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX ТУ 21.20.23-056-26329720-2018 4 606816 004018

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
 антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
 (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена p24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018

комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группу O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 1 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 2 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0.5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX




ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



4 606816 004018

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018

комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 2 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 2 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 4 шт. |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт. |
| 2. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 4 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018 комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|-------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 2 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 4 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 2 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 4 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 4 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 32 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Для клинической лабораторной диагностики


Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX ТУ 21.20.23-056-26329720-2018 4 606816 004025

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|---|--------------------|
| 1. «Иммунсорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы O, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам p24 ВИЧ-1 и p27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «РК-2» – раствор конъюгата №2 | 2 фл. |
| 8. «РХ» – раствор хромогена | 2 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ПУ № XXXXXX




ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



4 606816 004032

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
 антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
 (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018

комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|--------------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группу О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «Кг-1» – конъюгат №1 | 1 фл. |
| 7. «РРК-1» – раствор для разведения конъюгата №1 | 1 фл. |
| 8. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 9. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 10. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 11. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 12. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 13. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 14. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 15. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 16. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 17. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XX-XX



LOT XXXXX



XXXX.XX

Замораживание не допускается



XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

РУ № XXXXXX




ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



4 606816 004032

Лицевая сторона:



Россия, 630080, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»

набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 21.20.23-056-26329720-2018
комплект 3



Состав набора

- | | |
|--|--------------------|
| 1. «Иммуносорбент» – смесь рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 (включая группы О, gp120 и gp41) и ВИЧ-2 (gp36) и моноклональных антител к антигенам р24 ВИЧ-1 и р27 ВИЧ-2, сорбированная в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+АТ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К+АГ» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 или 2 или 10 фл. |
| 4. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный** | 1 фл. |
| 5. «РДР-О» – раствор для разведения образцов | 1 фл. |
| 6. «РК-1» – раствор конъюгата №1 | 1 фл. |
| 7. «Кг-2» – конъюгат №2 | 1 фл. |
| 8. «РРК-2» – раствор для разведения конъюгата №2 | 2 фл. |
| 9. «БРС» – буферный раствор субстрата | 2 фл. |
| 10. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 13. Защитная пленка для микропланшетов | 10 шт. |
| 14. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 16. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

** антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики


Боковая сторона:

REF XX-XX LOT XXXXX XXXX.XX
Замораживание не допускается XXXX.XX

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ПУ № XXXXXX

ТУ 21.20.23-056-26329720-2018



Комплект 3 на 96 определений

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003851

IVD Σ 96 $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(x25)

50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-1

8,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2

20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ

20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АТ

2,0 мл

инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ

2,0 мл

инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О

6,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (xX)

X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (xX)

X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (xX)

X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К-

3,0 мл

инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ

V = X,XXX

инaktivированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент

10,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1

8,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2

20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС

20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

или

или

и

или

и

или

и

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003851

ИВД Σ 96 $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(x25)

LOT XXXXX 50,0 мл
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003975

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-1 16,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003967

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003998

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003882

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АТ 3,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003905

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ 3,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003912

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О 12,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003936

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003943

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003974

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003899

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К- 3,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003929

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ V = X,XXX
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003912

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003868

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1 16,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003950

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 003981

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС 20,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

ИВД $\text{2}^{\circ}\text{C}$

4 606816 004001

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

или

или

или

и

или

и

и

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент

планшет разборный с сорбированной смесью рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003851

IVD Σ 96 $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(x25)

LOT XXXXX 125,0 мл
XXXX.XX

4 606816 003875

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-1 40,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003967

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РК-2 50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003998

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ 50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003882

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АТ 10,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003905

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ 10,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003912

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РДР-О 30,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003936

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-1 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003943

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг-2 (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003974

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (xX) X,X мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003899

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К- 15,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003929

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+АГ V = X,XXX
инактивированный

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003912

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003868

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-1 40,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003950

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РРК-2 50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 003981

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС 50,0 мл

LOT XXXXX
XXXX.XX

4 606816 004001

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$

"Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ"

или

или

или

или

и

и

и



 ООО «Медико-биологический Союз»
Россия, 630090, г. Новосибирск
Ул. Инженерная, 16
Тел.: (383) 363-77-01
E-mail: info@mbu.ru
www.mbu.ru

«Инвитролоджик ВИЧ-АГ/АТ»



LOT XXXX
 XXXX.XX
 XXXX.XX

Срочный груз

Не бросать

Замораживание не допускается

Число потребительских упаковок в транспортной таре: XX шт.
Масса нетто транспортной тары: X,XX кг
Масса брутто транспортной тары: X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки: X,XX кг



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (14) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев