

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



05

2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«СРБ-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-070-94568735-2018**

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.11

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 100 мл

Реагент №2: 1 x 5 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

UK CRP-VITAL

R1: 1 x 100 ml

R2: 1 x 5 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT 0162



2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



40112304650162

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.11
REF B 40.41

100 мл

буфер

LOT 0162

Годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики

CE



РЕАГЕНТ 1

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.11
REF B 40.41

5 мл

антисыворотка

LOT 0162

Годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики

CE



РЕАГЕНТ 2

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

Годен до: 2025.05



CE



КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.31

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 250 мл

Реагент №2: 1 x 25 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04

Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 250 ml

R2: 1 x 25 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT 0162

2025.04

ECIREP

ENERGIC EUROPE
Prinsessegracht 22, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



40312304850162

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.31

25 мл

антисыворотка

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05



СРБ-ВИТАЛ


REF В 40.31

250 мл

буфер

LOT 0162

годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ


REF В 40.31

250 мл

буфер

LOT 0162

годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

КАЛИБРАТОР

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.41

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 100 мл


ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

Реагент №2: 1 x 5 мл

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Калибратор: 1 x 1 мл

Контроль(высокий уровень): 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каленку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 1 x 100 ml

R2: 1 x 5 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

Control high: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kalenku, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2614 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



40612304650162

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.11
REF B 40.41

РЕАГЕНТ 1

100 мл

буфер

LOT 0162

Годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

RLI B 40.11
RLI B 40.41

РЕАГЕНТ 2

5 мл

антисыворотка

LOT 0162

Годен до: 2025.04



только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

1 мл REF B 40.41

36,2 (30,8- 41,6) мг/л

ВЫСОКИЙ уровень

LOT 6328

Годен до: 2025.02



только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

КОНТРОЛЬ



REF В 40.71-1.150

СРБ-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 7,8 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 1 x 7,8 ml

Calibrator: 1 x 1ml



0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands




90712301600159



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.150

40 мл



0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.150

40 мл



0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.150

7,8 мл



0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF B 40.711-1.150

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 7,8 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 4 x 40 ml
R2: 2 x 7,8ml
Calibrator: 1 x 1 ml

IVD

LOT 0162

Vital Development Corporation
Dorogoy v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Rijnsebaanweg 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands



91712204600153



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 7,8 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 7,8 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики




КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 40.71-1.200

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом


Реагент №1: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №2: 1 x 3,8 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 1 x 20 ml

R2: 1 x 3,8ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



94072304650162




СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-1.200



РЕАГЕНТ 2

3,8 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент корпорэйшн, Россия



КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент корпорэйшн, Россия



REF B 40.711-1.200

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 20 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №2: 3 x 3,8 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 3 x 20 ml

R2: 3 x 3,8 ml

Calibrator: 2 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsesgracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 1


20 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 2

3,8 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 2

3,8 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.200



РЕАГЕНТ 2

3,8 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF В 40.71-1.300

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 52 мл

Реагент №2: 2 x 9 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 52 ml

R2: 2 x 9 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP



94082303650160



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.300

РЕАГЕНТ 2 9 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.300

РЕАГЕНТ 2 9 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



REF B 40.711-1.300

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 4 x 52 мл

Реагент №2: 4 x 9 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:

0162



Дата выпуска:

2023.04



Годен до:

2025.04

эпко для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 4 x 52 ml

R2: 4 x 9 ml

Calibrator: 2 x 1 ml

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

2025.04

EC REP



93832304650162



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CE



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CE



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300

РЕАГЕНТ 2

9 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300

РЕАГЕНТ 2

9 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300

РЕАГЕНТ 2

9 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.300

РЕАГЕНТ 2

9 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF B 40.71-1.420

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 72 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 72 ml

R2: 1 x 14 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE



90722211600157



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-1.420



РЕАГЕНТ 2 14 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

CE



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл
228,0 мг/л



LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CE



REF В 40.711-1.420

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 6 x 72 мл
Реагент №2: 3 x 14 мл
Калибратор: 2 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 6 x 72 ml
R2: 3 x 14ml
Calibrator: 2 x 1 ml

LOT 0162 Vital Development Corporation
Doroga y Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2025.04 EC/REP EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2614 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-
ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420

14 МЛ

25 ° 15C

LOT 0162

годен до: 2025.04

РЕАГЕНТ 2

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



СРБ-
ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420

14 МЛ

25 ° 15C

LOT 0162

годен до: 2025.04

РЕАГЕНТ 2

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



СРБ-
ВИТАЛ

REF В 40.711-1.420

14 МЛ

25 ° 15C

LOT 0162

годен до: 2025.04

РЕАГЕНТ 2

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1 МЛ

228,0 мЛл

25 ° 15C

LOT 6554

годен до: 2025.05

CE



Витал Девелопмент
Корпорация, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1 МЛ

228,0 мЛл

25 ° 15C

LOT 6554

годен до: 2025.05

CE



Витал Девелопмент
Корпорация, Россия

только для in vitro диагностики



REF В 40.71-1.600

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 68 мл

Реагент №2: 2 x 8,5 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 68 ml

R2: 2 x 8,5ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230




СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия




СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.600

РЕАГЕНТ 2

8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-1.600

РЕАГЕНТ 2

8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF B 40.711-1.600

СРБ-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 6 x 68 мл
Реагент №2: 6 x 8,5 мл
Калибратор: 2 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK CRP-VITAL
R1: 6 x 68 ml
R2: 6 x 8,5 ml
Calibrator: 2 x 1 ml
IVD LOT 0162 Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia
2025.04 ECEP EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



407111501802120230

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-1.600

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF В 40.71-2.200

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом


ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 35 мл

Реагент №2: 1 x 7 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 5Б, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 35 ml

R2: 1 x 7 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



CE



407111501802120230




СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ- ВИТАЛ

REF В 40.71-2.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CE



REF B 40.71-2.300

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 35 мл

Реагент №2: 1 x 8 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 35 ml

R2: 1 x 8 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Pruissengracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



98232204600153



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-2.300

РЕАГЕНТ 2

8 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF B 40.711-2.300

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 4 x 35 мл

Реагент №2: 1 x 16 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0162



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 4 x 35 ml

R2: 1 x 16 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



983311501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

35 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-2.300

РЕАГЕНТ 2

16 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

Годен до: 2025.05



только для in vitro диагностики



REF В 40.71-3.400.24

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 12 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0162



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 1 x 12 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230



КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-3.400.24

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0162

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-3.400.24

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0162

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-3.400.24

РЕАГЕНТ 2

12 мл



LOT

0162

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 40.71-3.400.36

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 25 мл
Реагент №2: 1 x 8 мл
Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 25 ml
R2: 1 x 8 ml
Calibrator: 1 x 1 ml

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A, 194355
St. Petersburg, Russia

2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

25 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

25 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-3.400.36

РЕАГЕНТ 2

8 мл

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл


228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

CE



REF В 40.71-5.240

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 20 мл

Реагент №2: 1 x 8 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 20 ml

R2: 1 x 8 ml

Calibrator: 1 x 1 ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

ECIREP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-5.240

РЕАГЕНТ 1 20 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-5.240

РЕАГЕНТ 1 20 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-5.240

РЕАГЕНТ 2 8 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 1 мл

228,0 мг/л



LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF В 40.711-5.240

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 66 мл

Реагент №2: 2 x 10 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 66 ml

R2: 2 x 10 ml

Calibrator: 1 x 1ml

IVD

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsesseplein 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



CE



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-5.240

РЕАГЕНТ 1

66 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-5.240

РЕАГЕНТ 1

66 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-5.240

РЕАГЕНТ 2

10 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-5.240

РЕАГЕНТ 2

10 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



CE



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



CE



REF B 40.71-6.200

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 44 мл

Реагент №2: 2 x 8 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 44 ml

R2: 2 x 8 ml

Calibrator: 1 x 1ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EVERGEO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



CE



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-6.200

РЕАГЕНТ 2

8 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-6.200

РЕАГЕНТ 2

8 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF B 40.71-7.600

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 54 мл
Реагент №2: 1 x 8,5 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK CRP-VITAL

R1: 1 x 54 ml
R2: 1 x 8,5 ml
Calibrator: 1 x 1ml

LOT 0162

2025.04

EC REP

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2214 AP
The Hague, The Netherlands




407111501802120230

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-7.600

РЕАГЕНТ 1

54 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-7.600

РЕАГЕНТ 2

8,5 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF В 40.71-8.480

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 4 x 28 мл
Реагент №2: 2 x 8,5 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 4 x 28 ml
R2: 2 x 8,5 ml
Calibrator: 1 x 1ml

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194355
St. Petersburg, Russia

2025.04



EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

1 28 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

1 28 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

1 28 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

1 28 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

2 8,5 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.71-8.480

2 8,5 мл

РЕАГЕНТ



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF B 40.711-8.480

СРБ-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 4 x 34 мл

Реагент №2: 2 x 11 мл

Калибратор: 1 x 1 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:

0162



Дата выпуска:

2023.04



Годен до:

2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

CRP-VITAL

R1: 4 x 34 ml

R2: 2 x 11 ml

Calibrator: 1 x 1ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.04



EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230




СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 1

34 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 1

34 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 1

34 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 1

34 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 2 11 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.711-8.480

РЕАГЕНТ 2 11 мл



LOT

0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л



LOT

6554

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF B 40.721-8.480

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 4 x 53 мл
Реагент №2: 4 x 7,5 мл
Калибратор: 2 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0162 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL


R1: 4 x 53 ml
R2: 4 x 7,5 ml
Calibrator: 2 x 1 ml

LOT 0162 Vite Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2025.04 EVERGO EUROPE
Pruissengracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

ECIREP



407111501802120230

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 1

53 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 1

53 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 1

53 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 1

53 мл 2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР СРБ-ВИТАЛ

1 мл 2°C 8°C

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР СРБ-ВИТАЛ

1 мл 2°C 8°C

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 2 7,5 мл

2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 2 7,5 мл

2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 2 7,5 мл

2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.721-8.480

РЕАГЕНТ 2 7,5 мл

2°C 8°C

LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 40.71-9.8000

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019

Реагент №1: 2 x 65 мл

Реагент №2: 2 x 10 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162Дата выпуска:
2023.04Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 2 x 65 ml

R2: 2 x 10 ml

Calibrator: 1 x 1ml

IVD

LOT 0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194355
St. Petersburg, Russia

2025.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



407111501802120230



СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-9.8000

РЕАГЕНТ 1

65 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-9.8000

РЕАГЕНТ 1

65 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-9.8000

РЕАГЕНТ 2

10 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF B 40.71-9.8000

РЕАГЕНТ 2

10 мл



LOT 0162

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

1 мл

228,0 мг/л

LOT 6554

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



REF В 40.711-9.8000

СРБ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом


Реагент №1: 6 x 79 мл

Реагент №2: 6 x 12 мл

Калибратор: 3 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

РЗН 2019/8537 от 24.06.2019



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0162



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 6 x 79 ml

R2: 6 x 12 ml

Calibrator: 3 x 1ml

LOT

0162



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Phinsestraat 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD



407111501802120230




СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 1

79 мл



LOT 0162

годен до:2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

REF В 40.711-9.8000

РЕАГЕНТ 2
12 МЛ  2°C / 8°C
[LOT] 0162
годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР
1 МЛ
228,0 мг/л  2°C / 8°C
[LOT] 6554
годен до: 2025.05



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР
1 МЛ
228,0 мг/л  2°C / 8°C
[LOT] 6554
годен до: 2025.05



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

СРБ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР
1 МЛ
228,0 мг/л  2°C / 8°C
[LOT] 6554
годен до: 2025.05



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего _____

листа(ов)

Ген. директор

Исехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов




2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом**

«СРБ-ВИТАЛ»,

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018

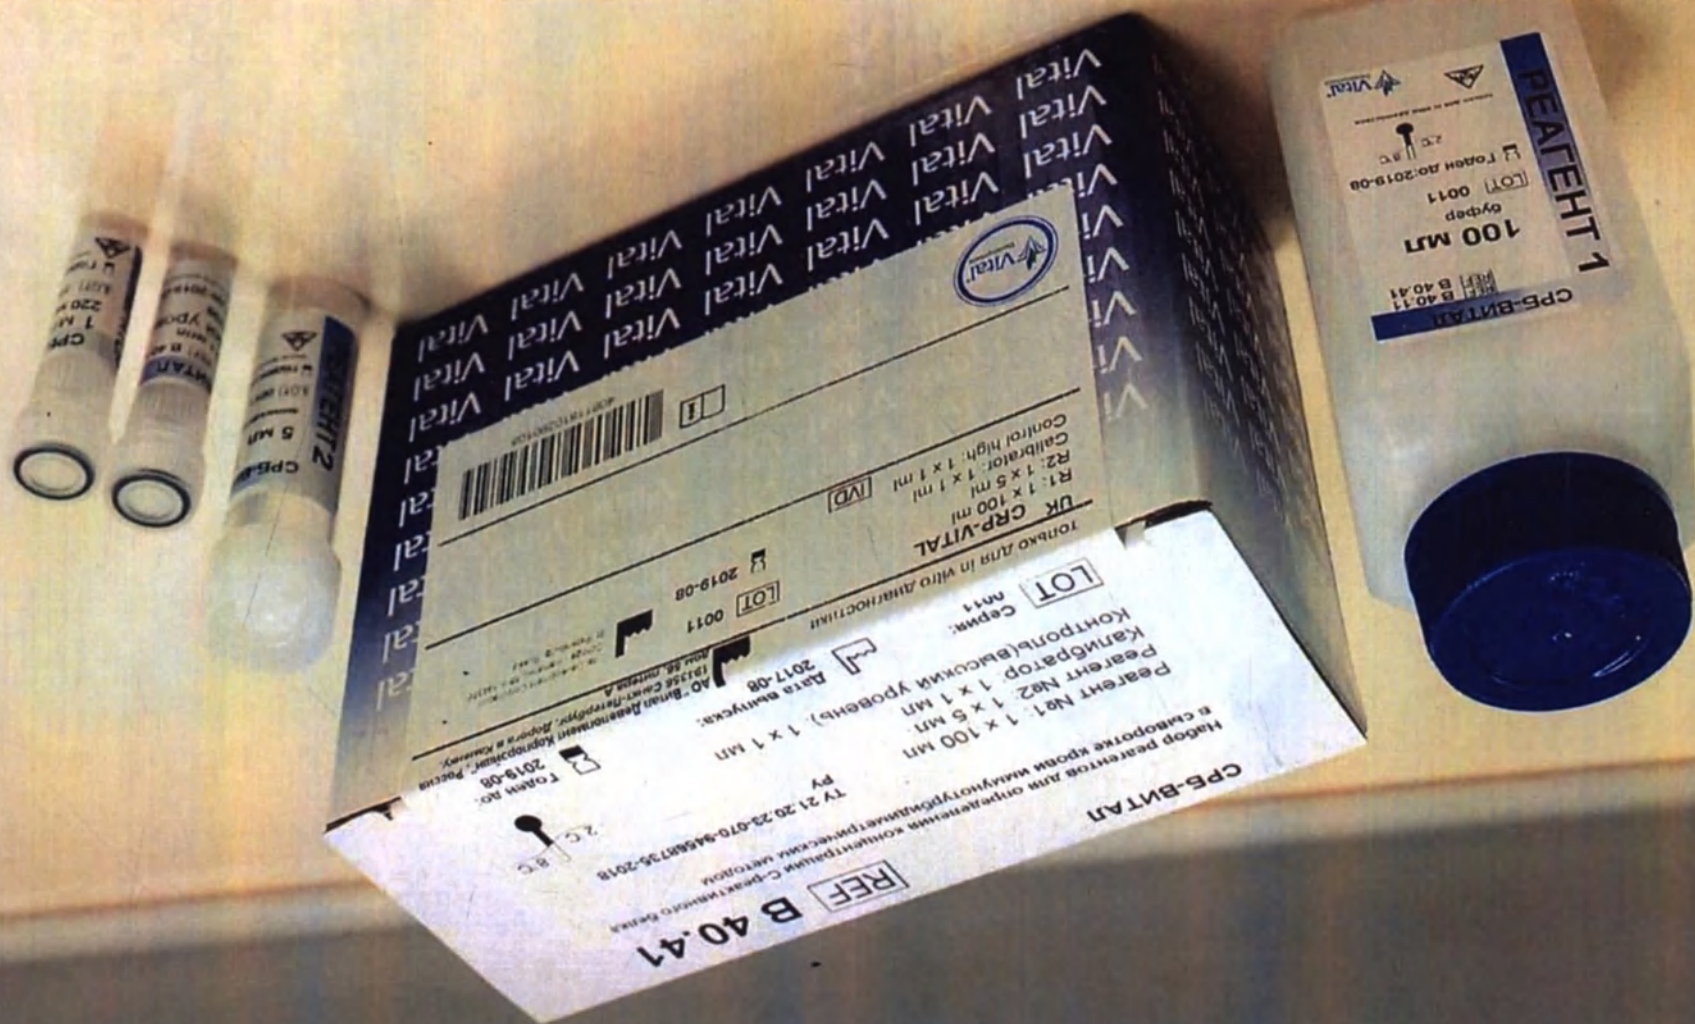

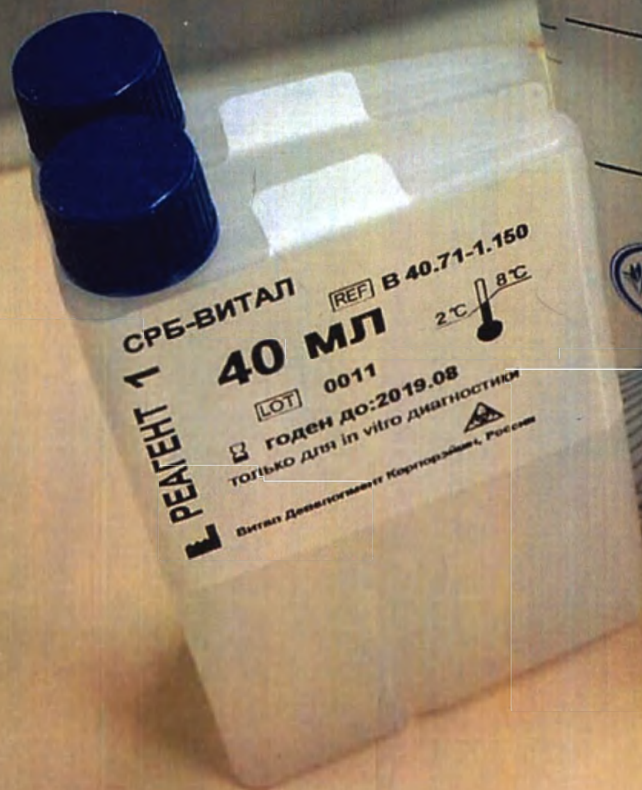

REF В 40.71-1.200
СРБ-ВИТАЛ
 Набор реагентов для определения концентрации
 С-реактивного белка в сыворотке крови
 иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 20 мл
 Реагент №2: 1 x 3,8 мл
 Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94568735-2018
 RU

LOT 0011
 только для in vitro диагностики

Дата выпуска: 2017.08
Годен до: 2019.08

UK CRP-VITAL
 R1: 1 x 20 ml
 R2: 1 x 3,8 ml
 Calibrator: 1 x 1 ml

IVD

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
 191356 Санкт-Петербург, Дорога в Каленку,
 дом 56, литера А

Исключительный представитель
 ООО "Сирми" в России
 125040 Москва, ул. Мясницкая, д. 24

REF В 40.71-1.200
СРБ-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
3,8 МЛ
LOT 0011
 годен до: 2019.08
 только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия


REF В 40.71-1.200
СРБ-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1
20 МЛ
LOT 0011
 годен до: 2019.08
 только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



КАЛИБРАТОР




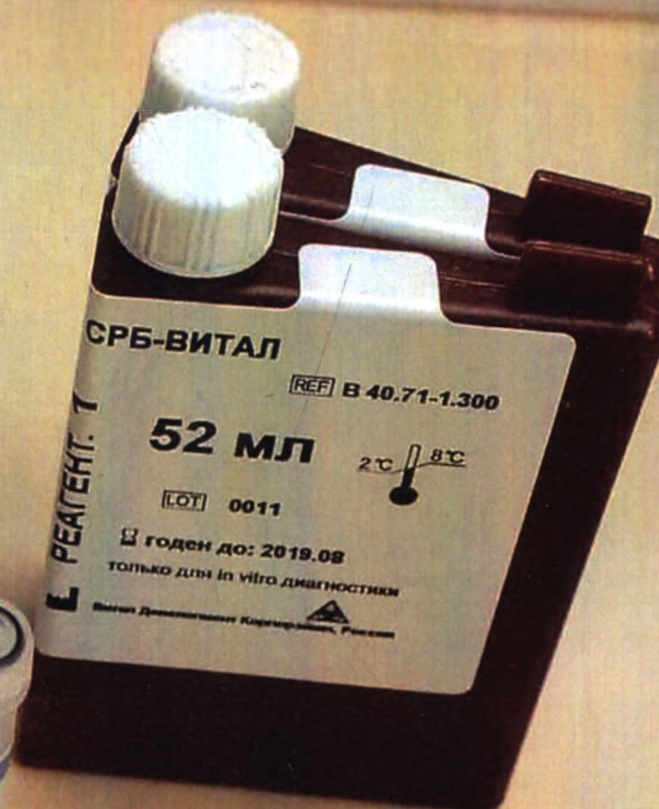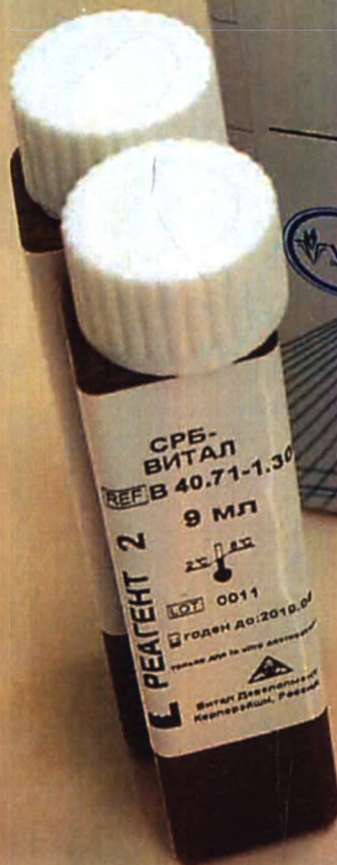
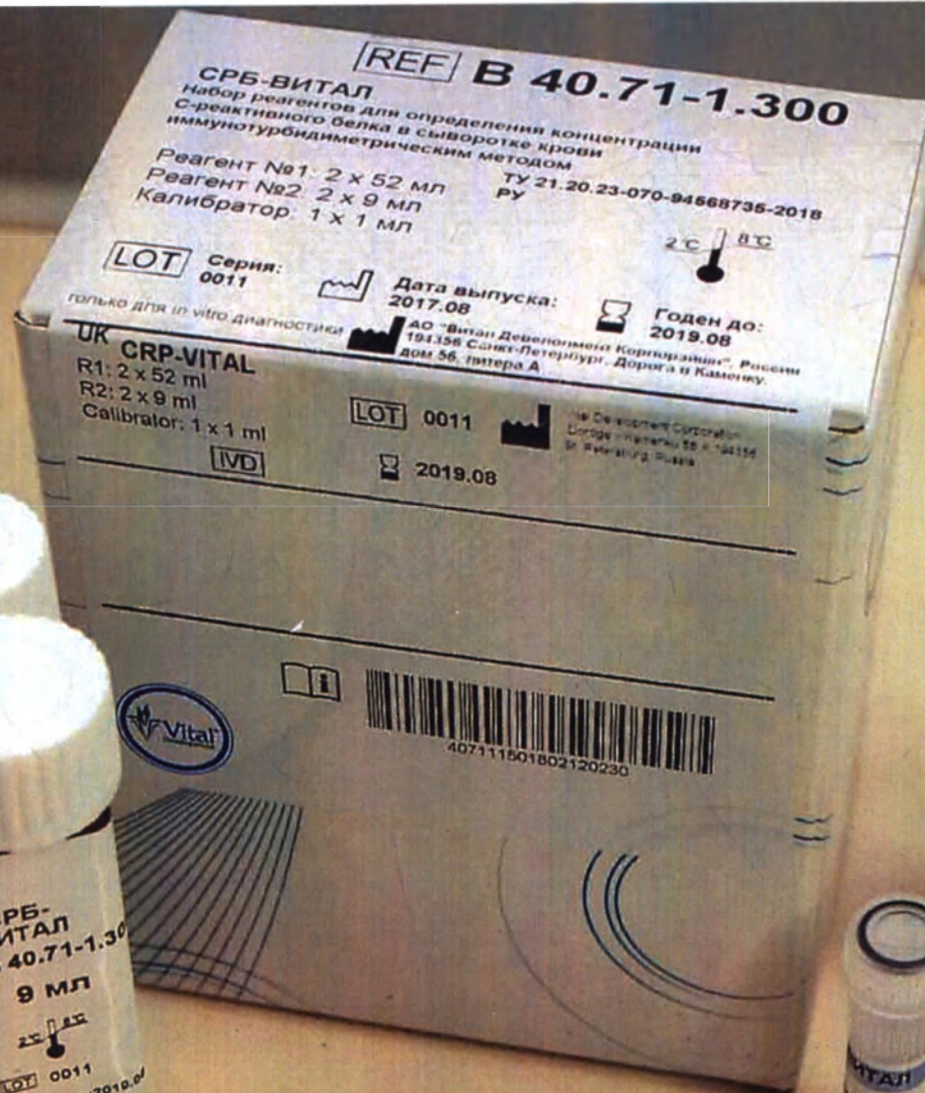


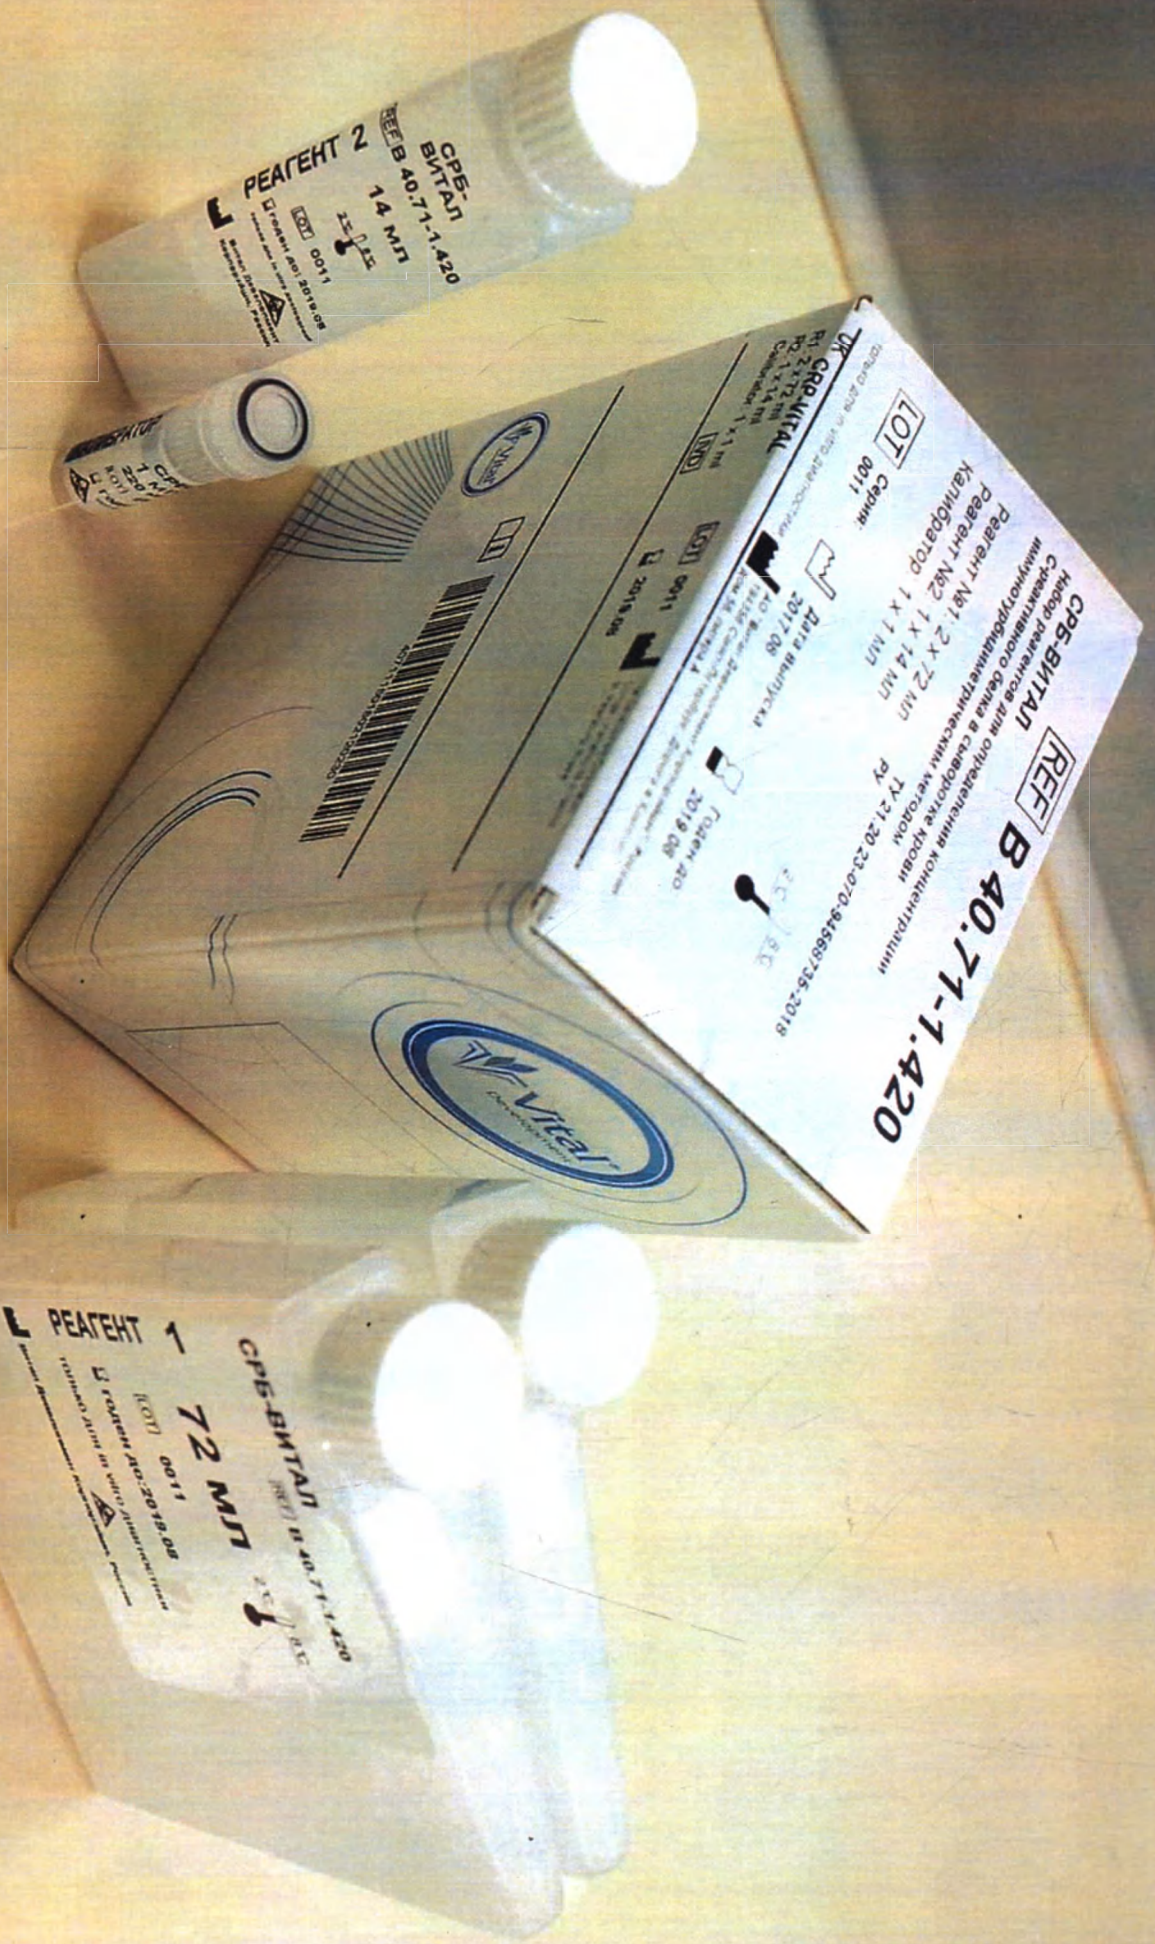



7

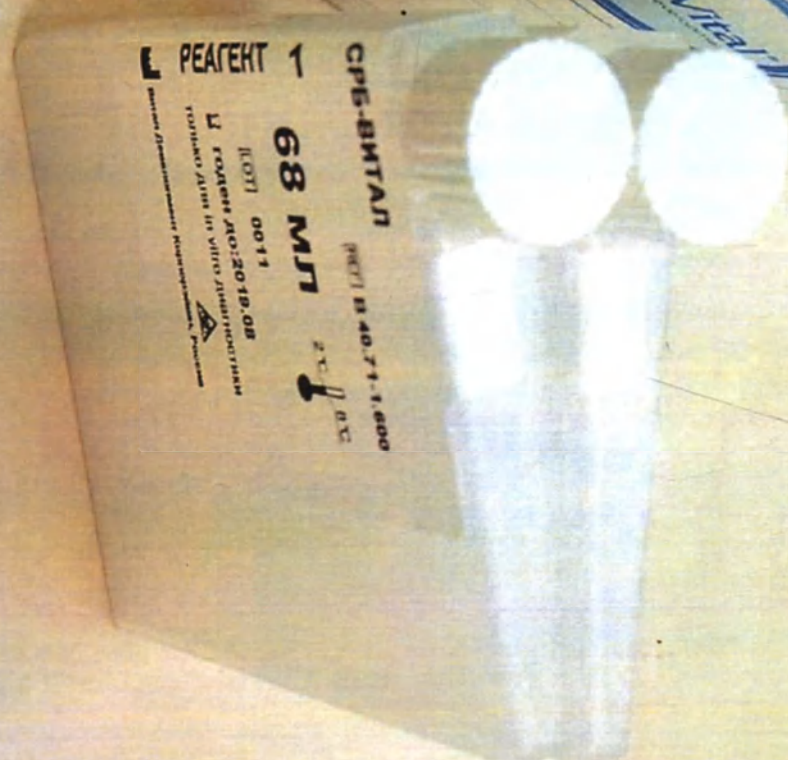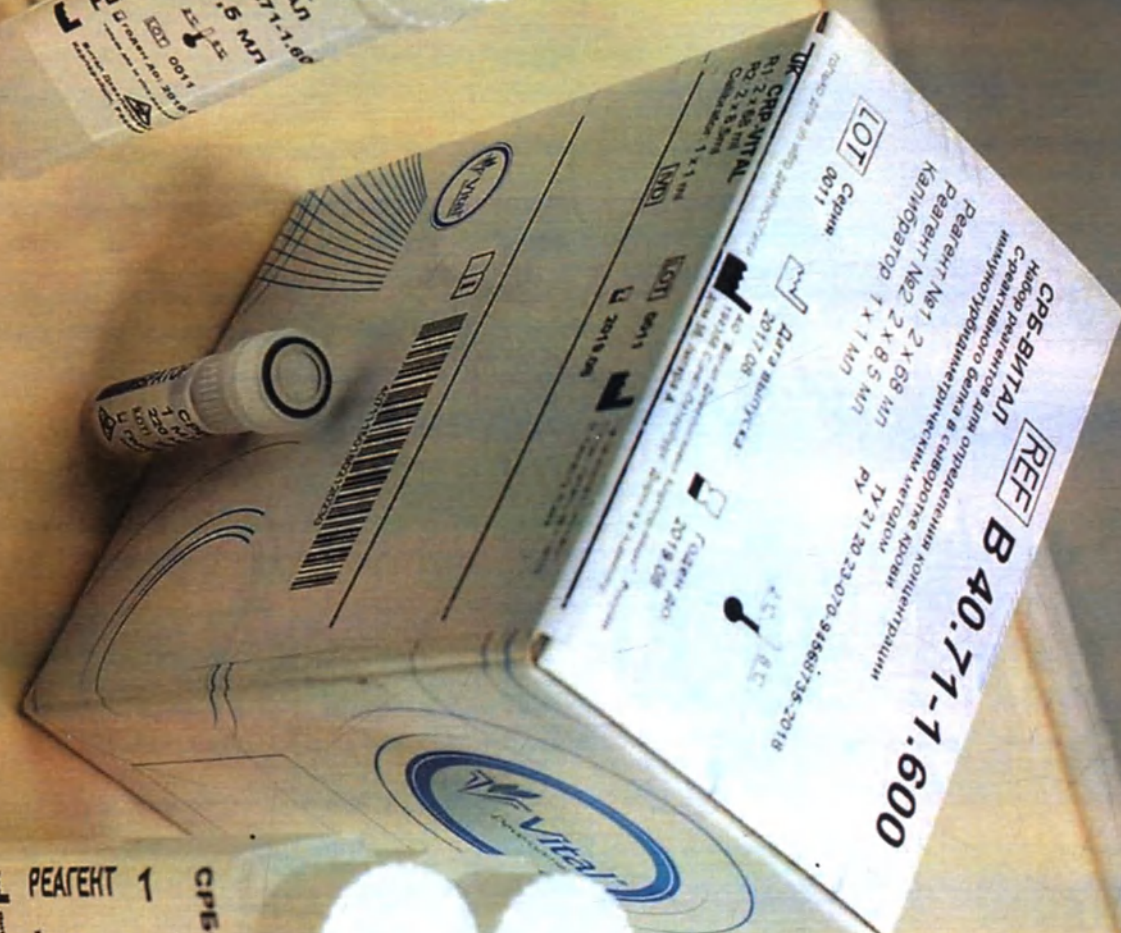

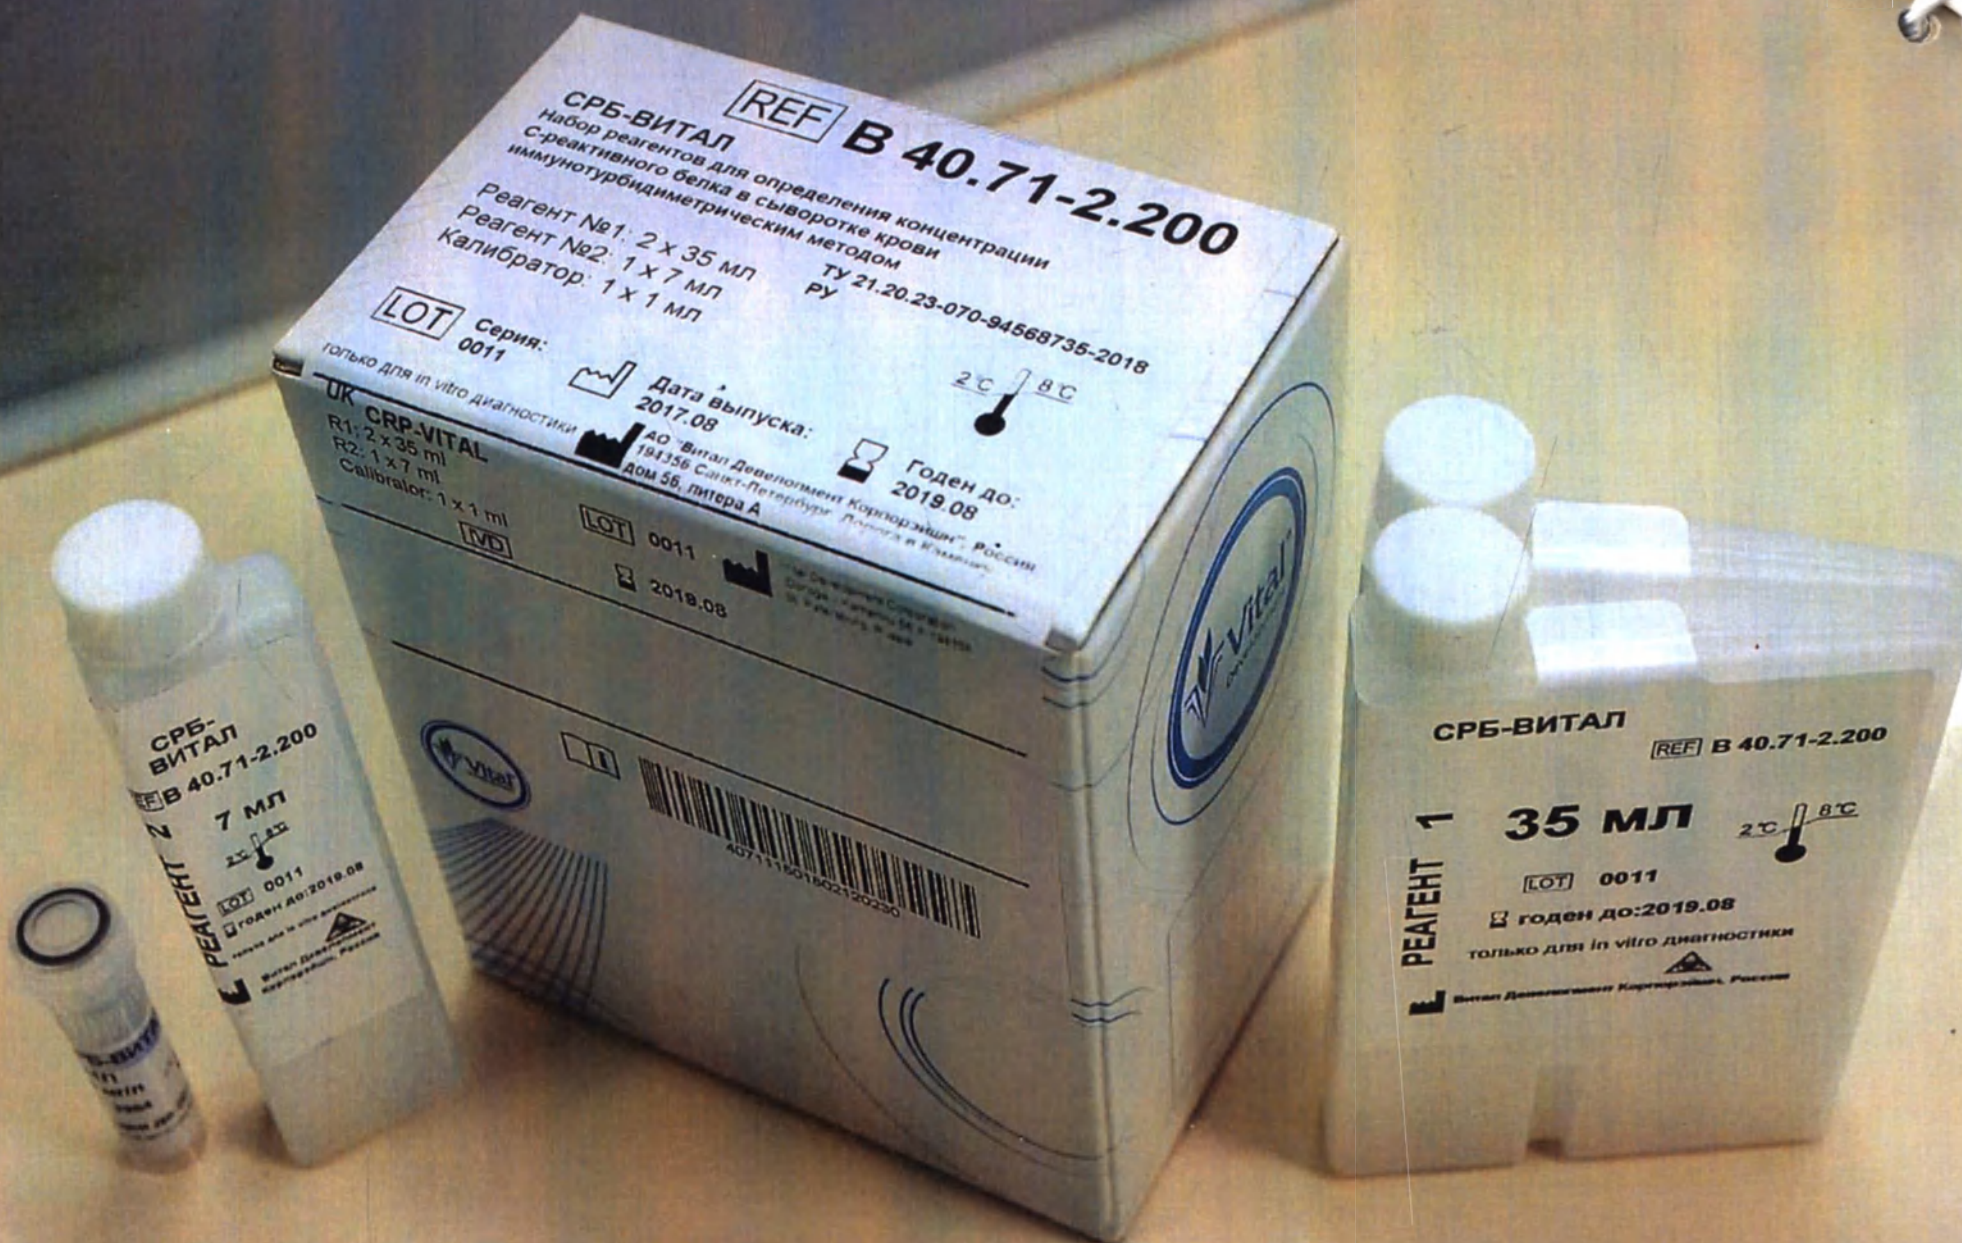


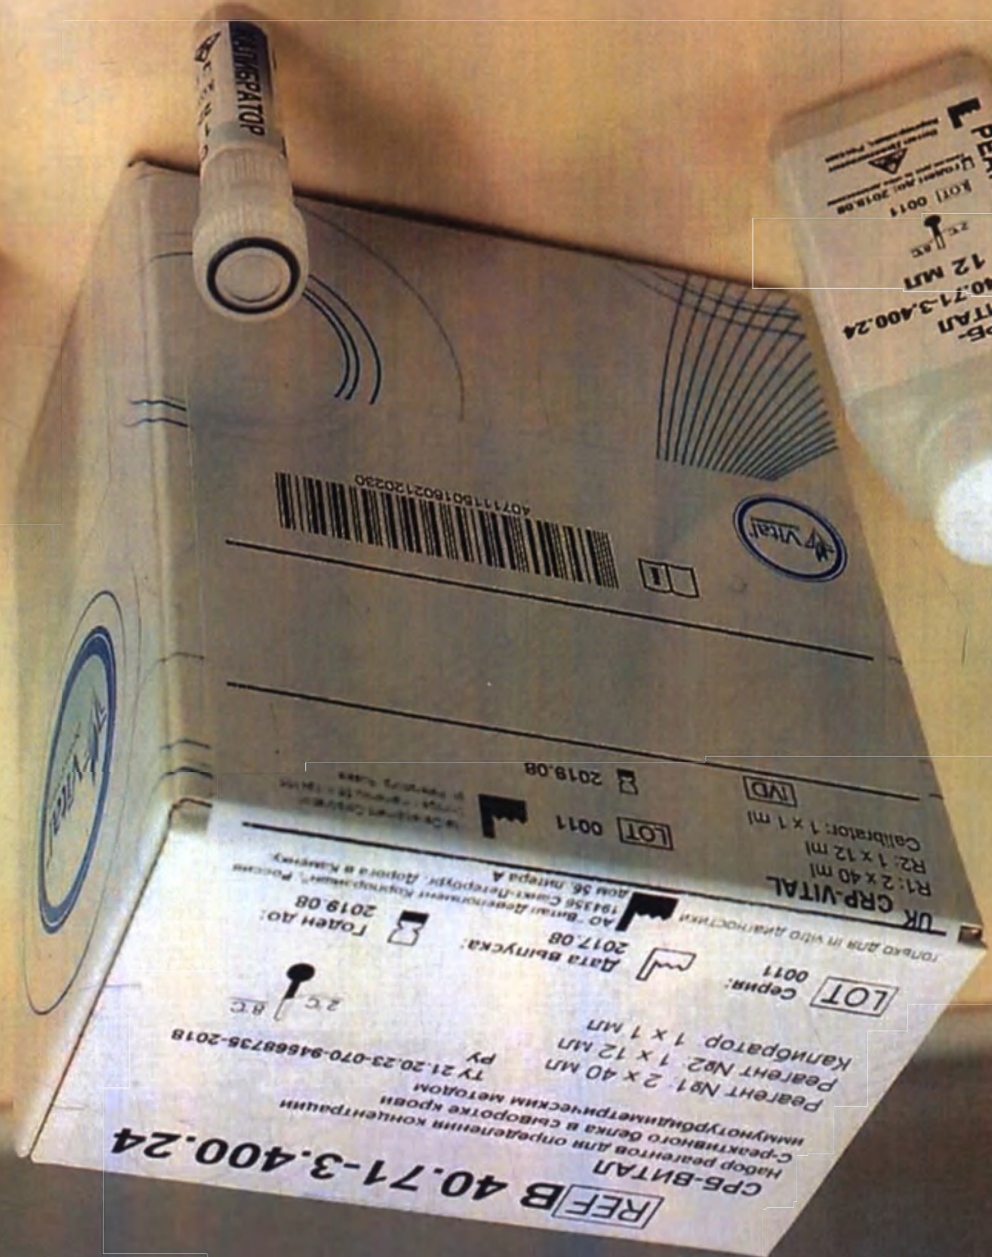
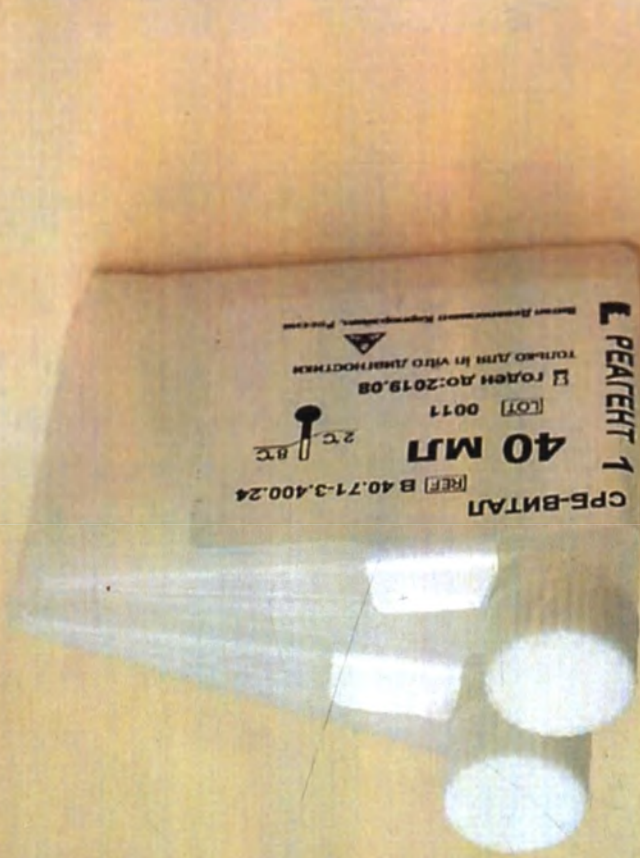


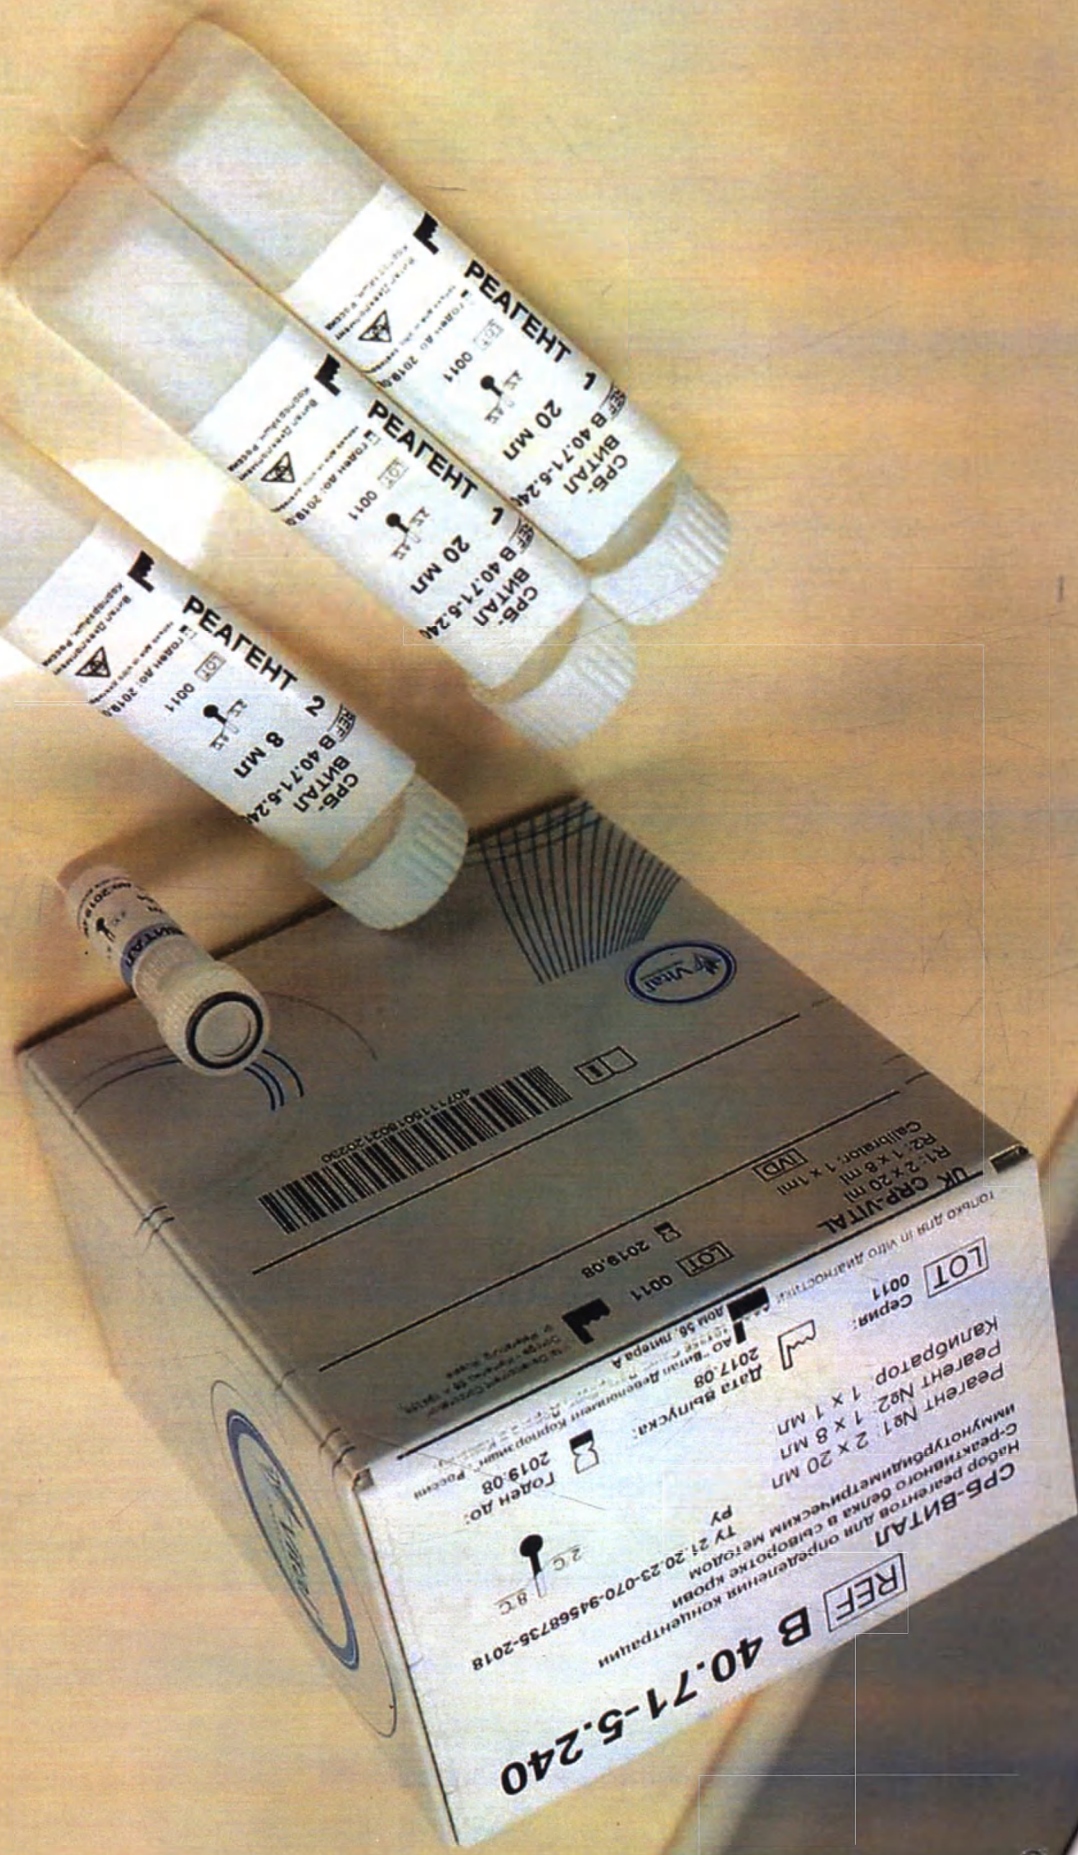


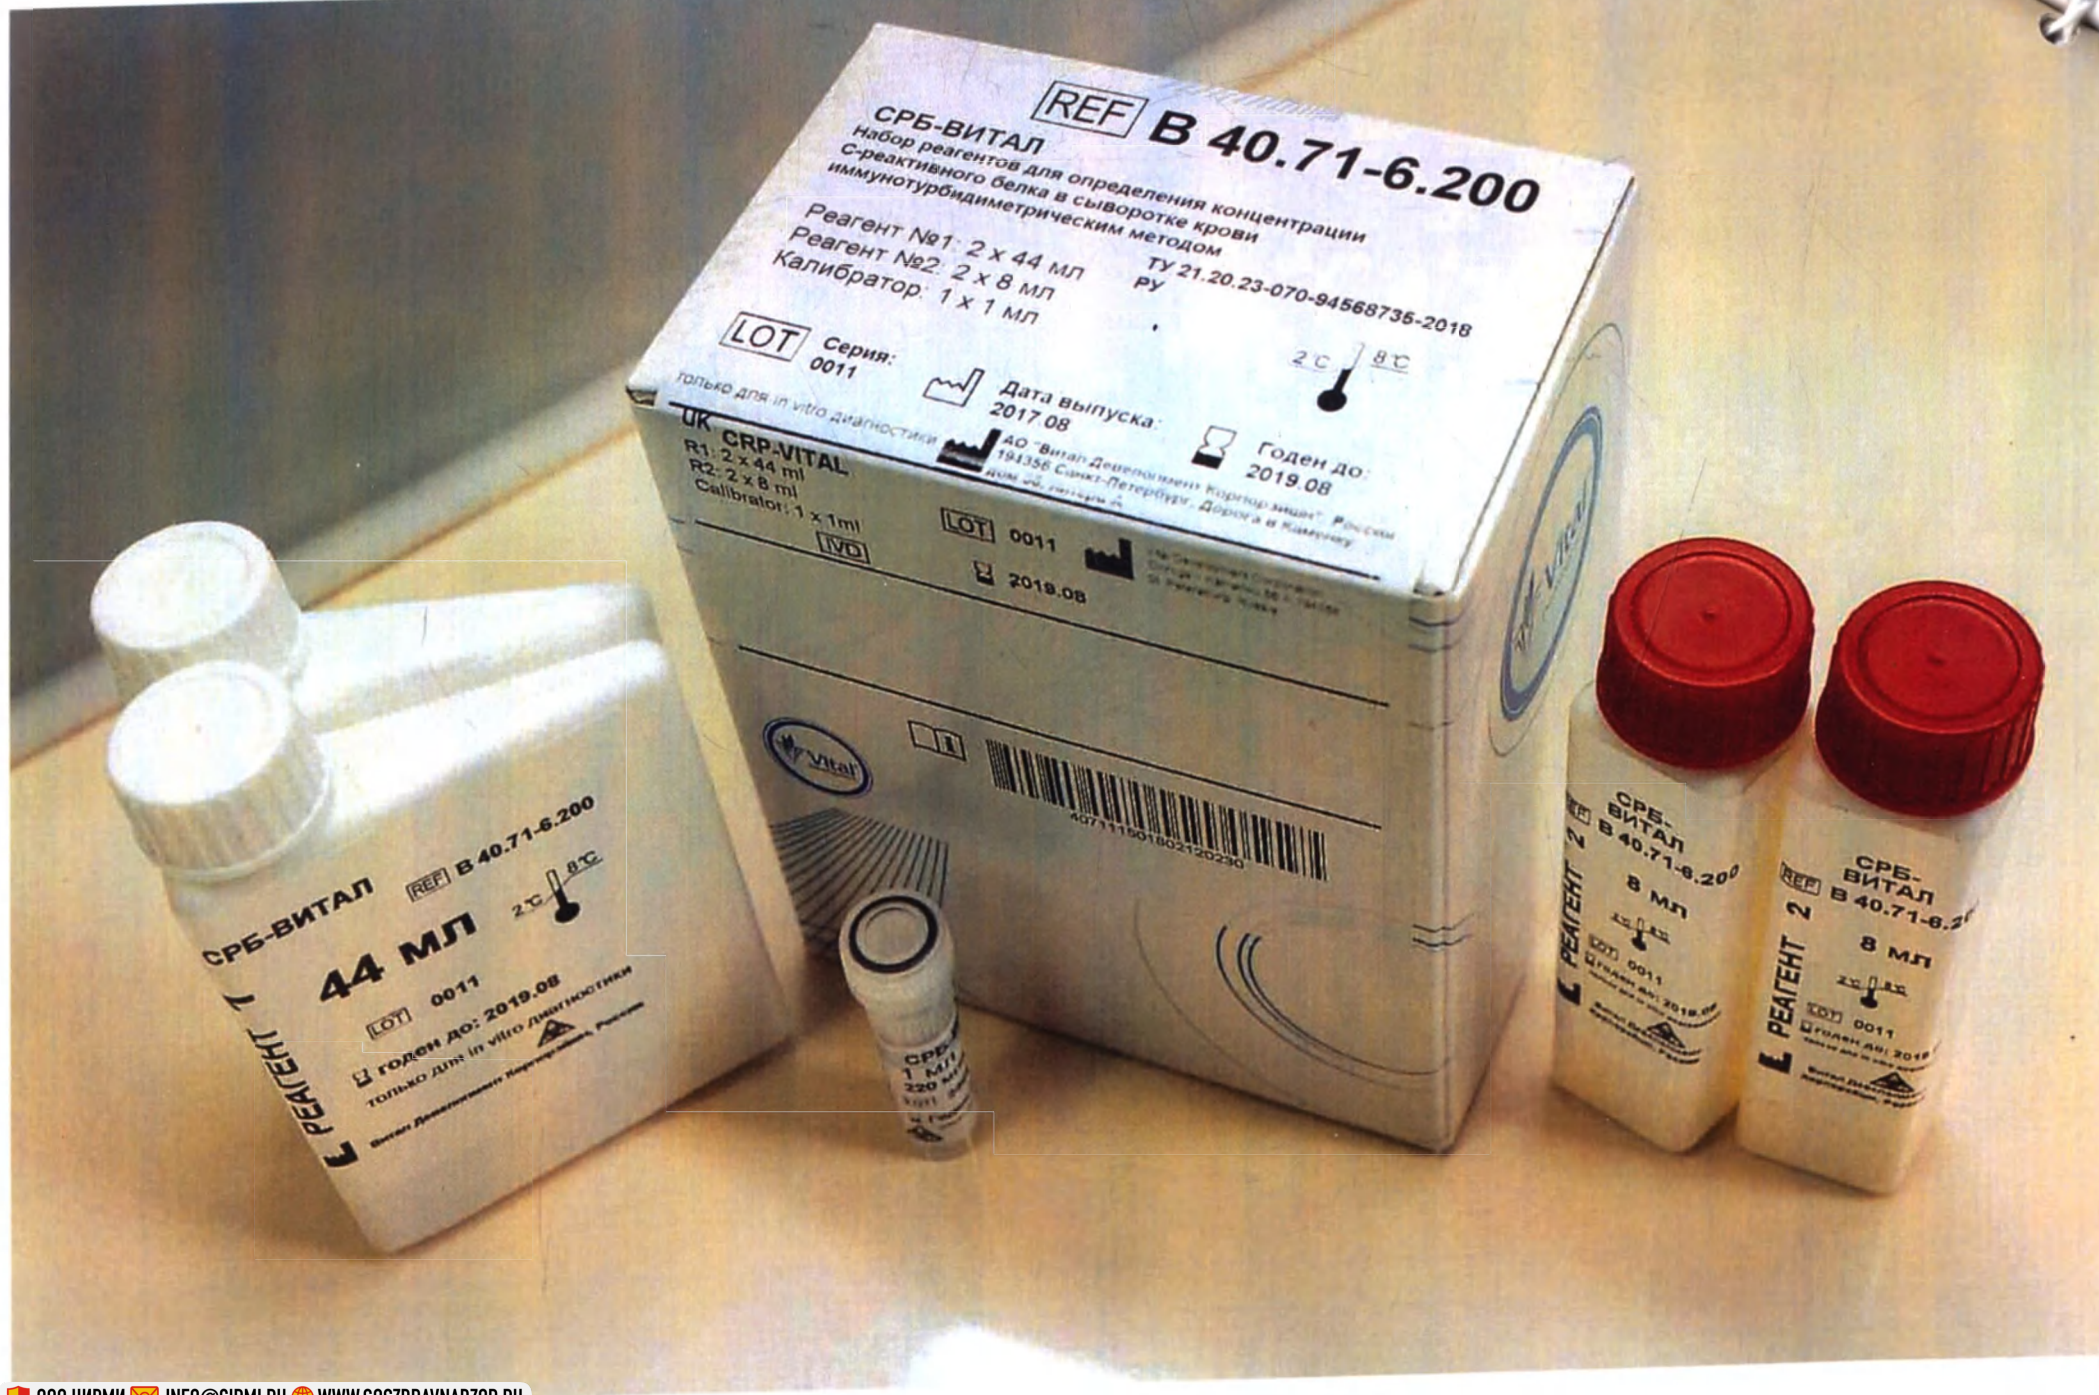





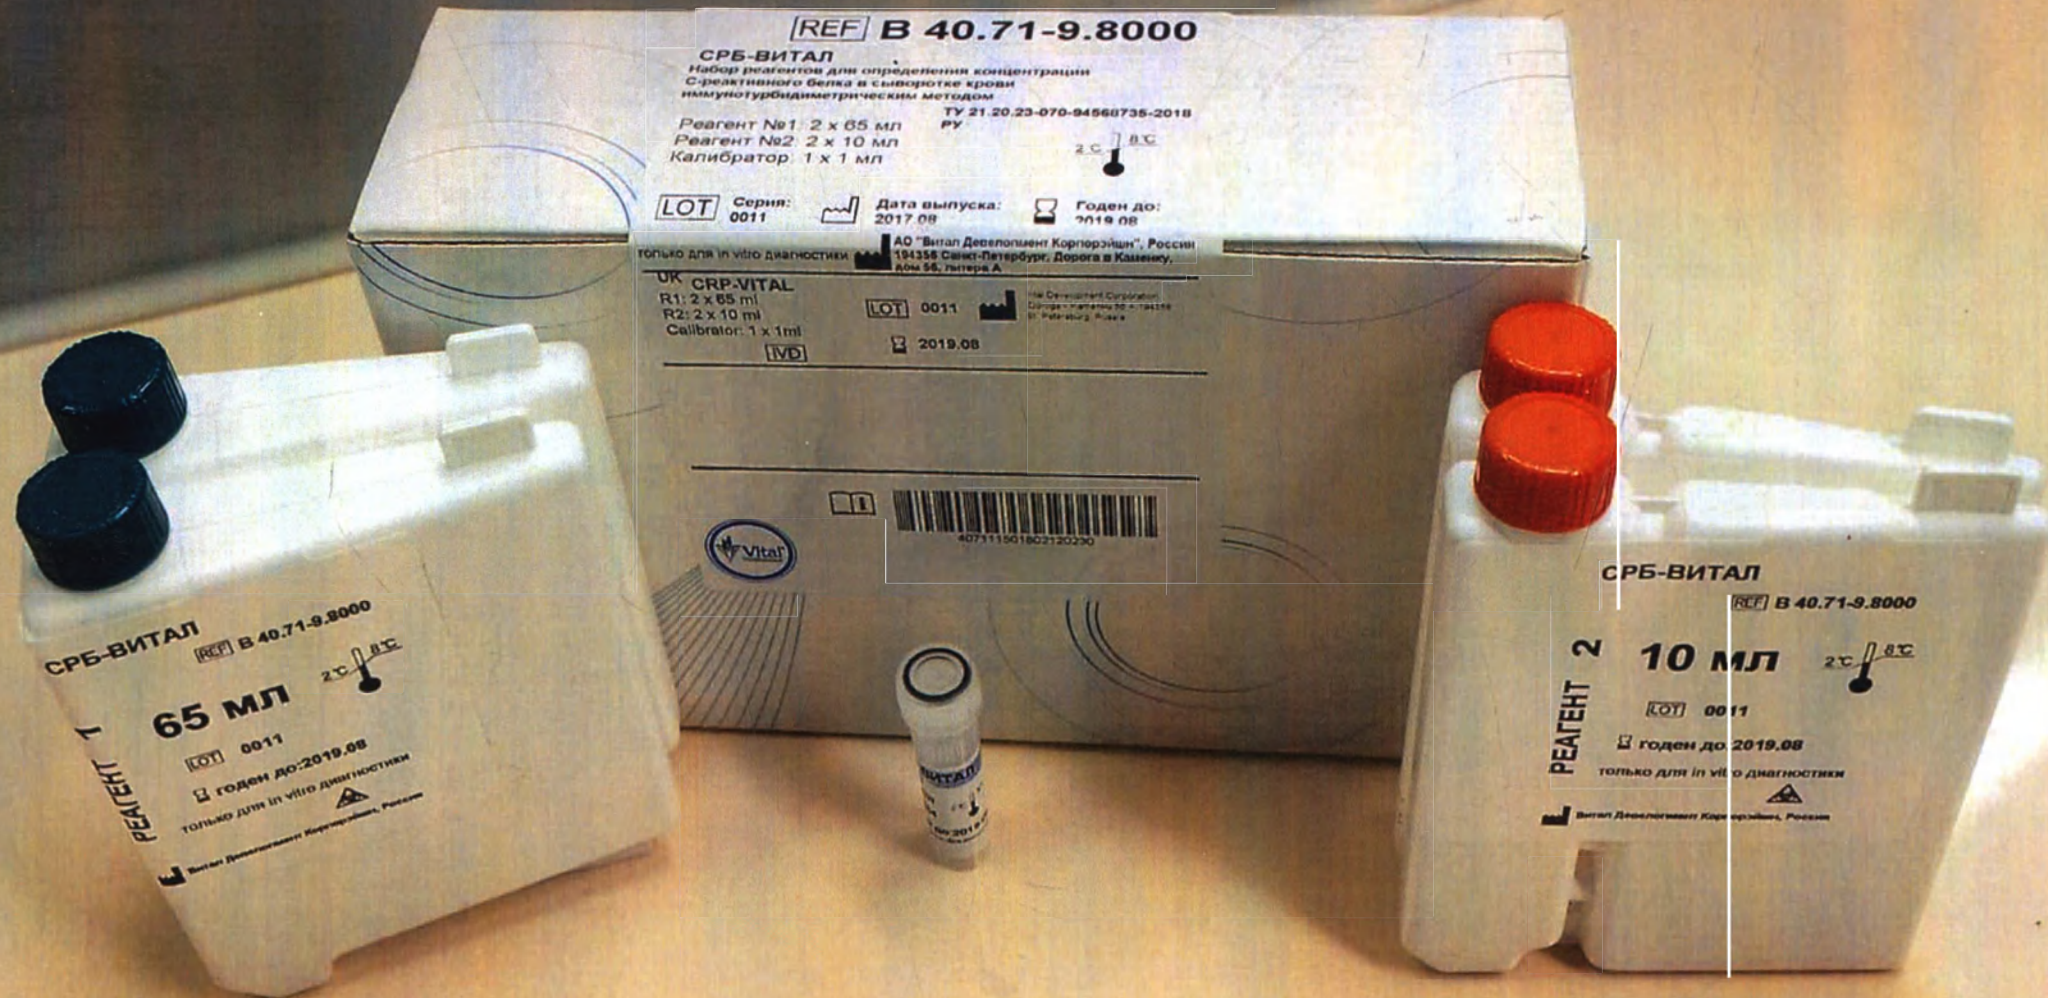

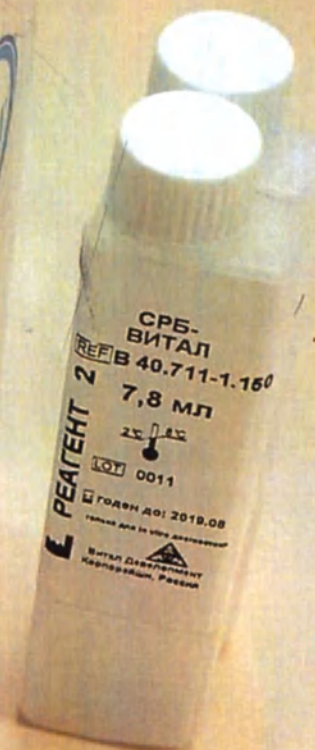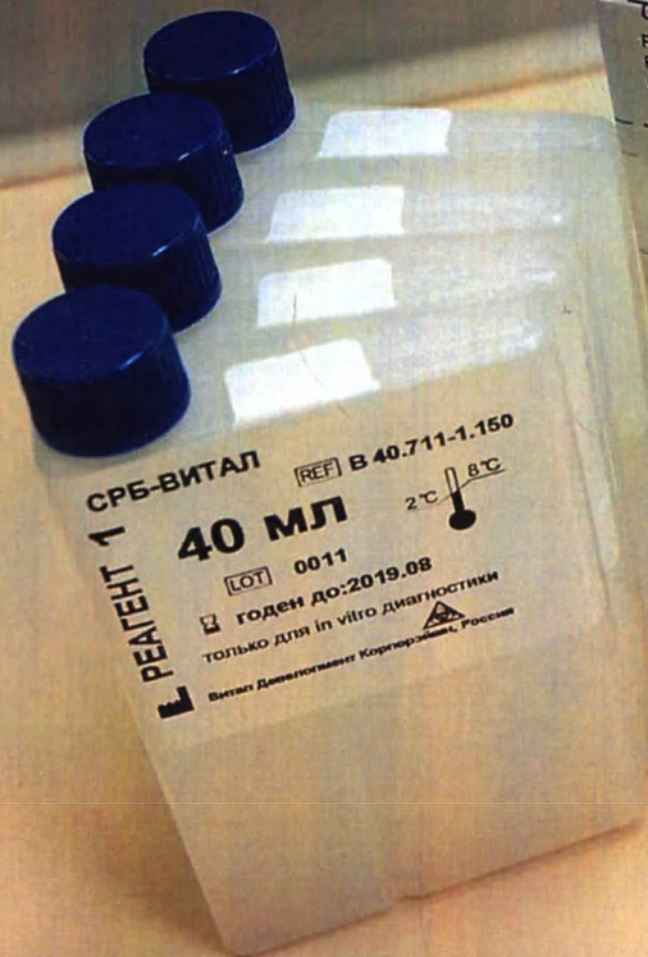

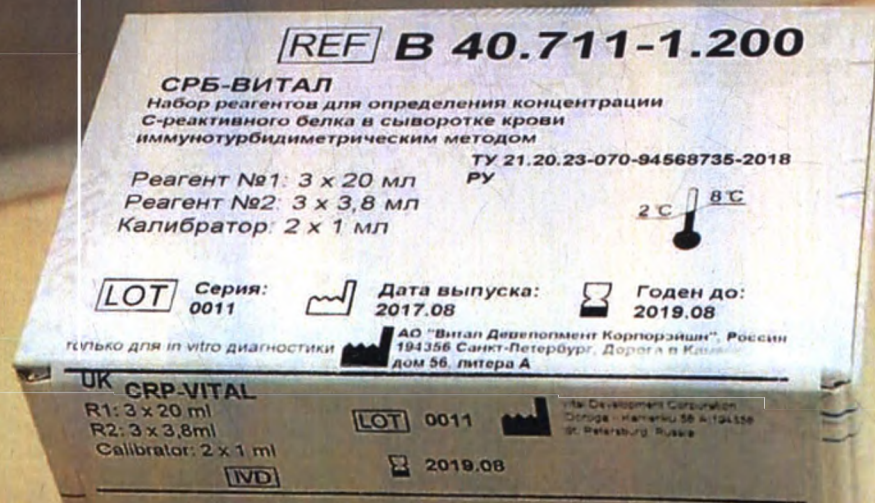

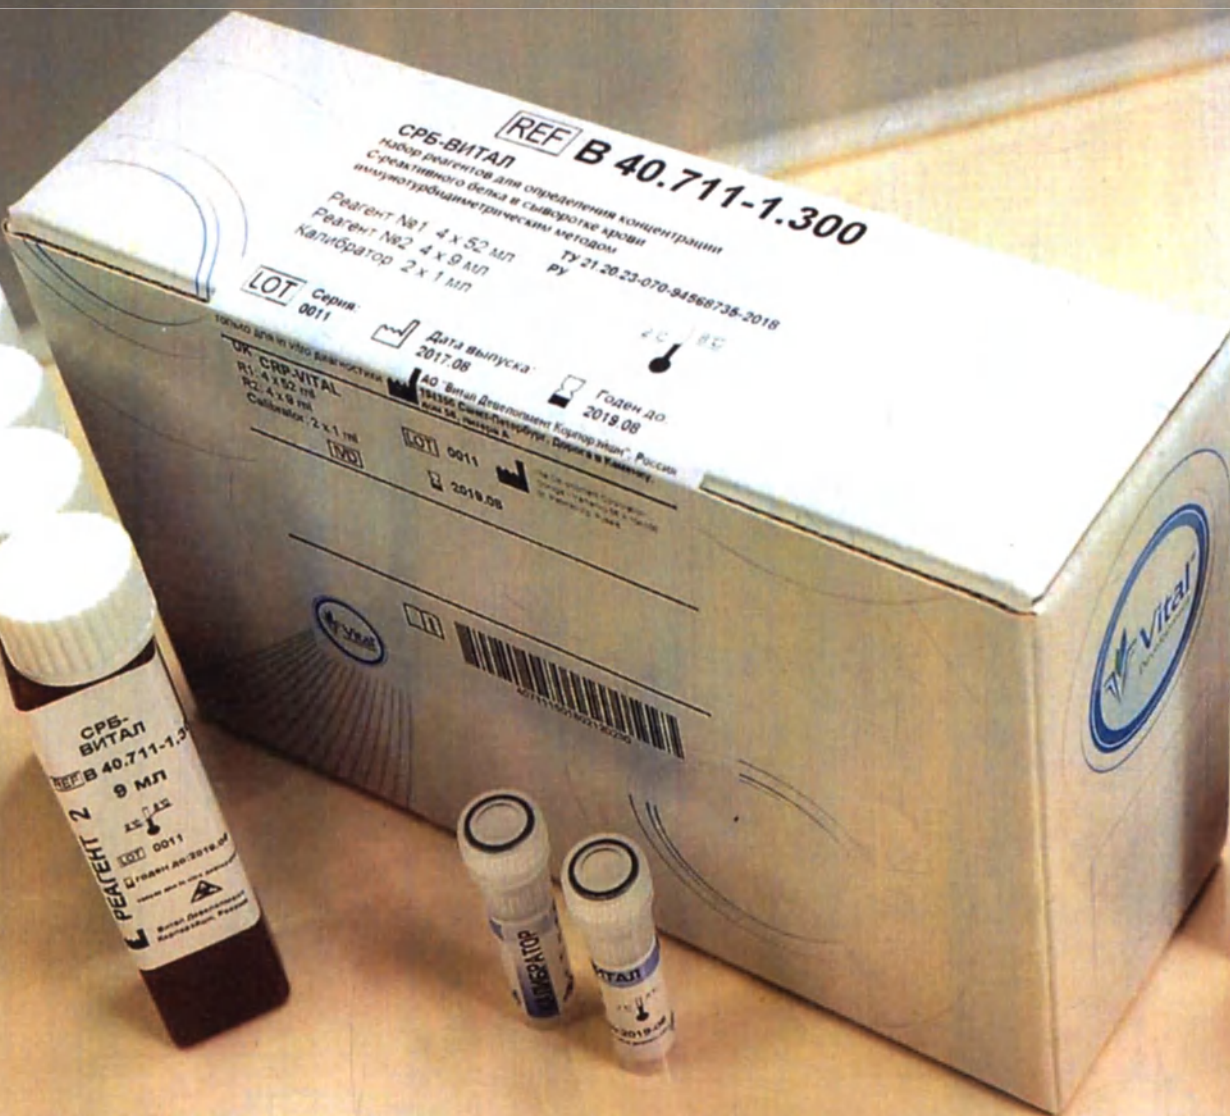

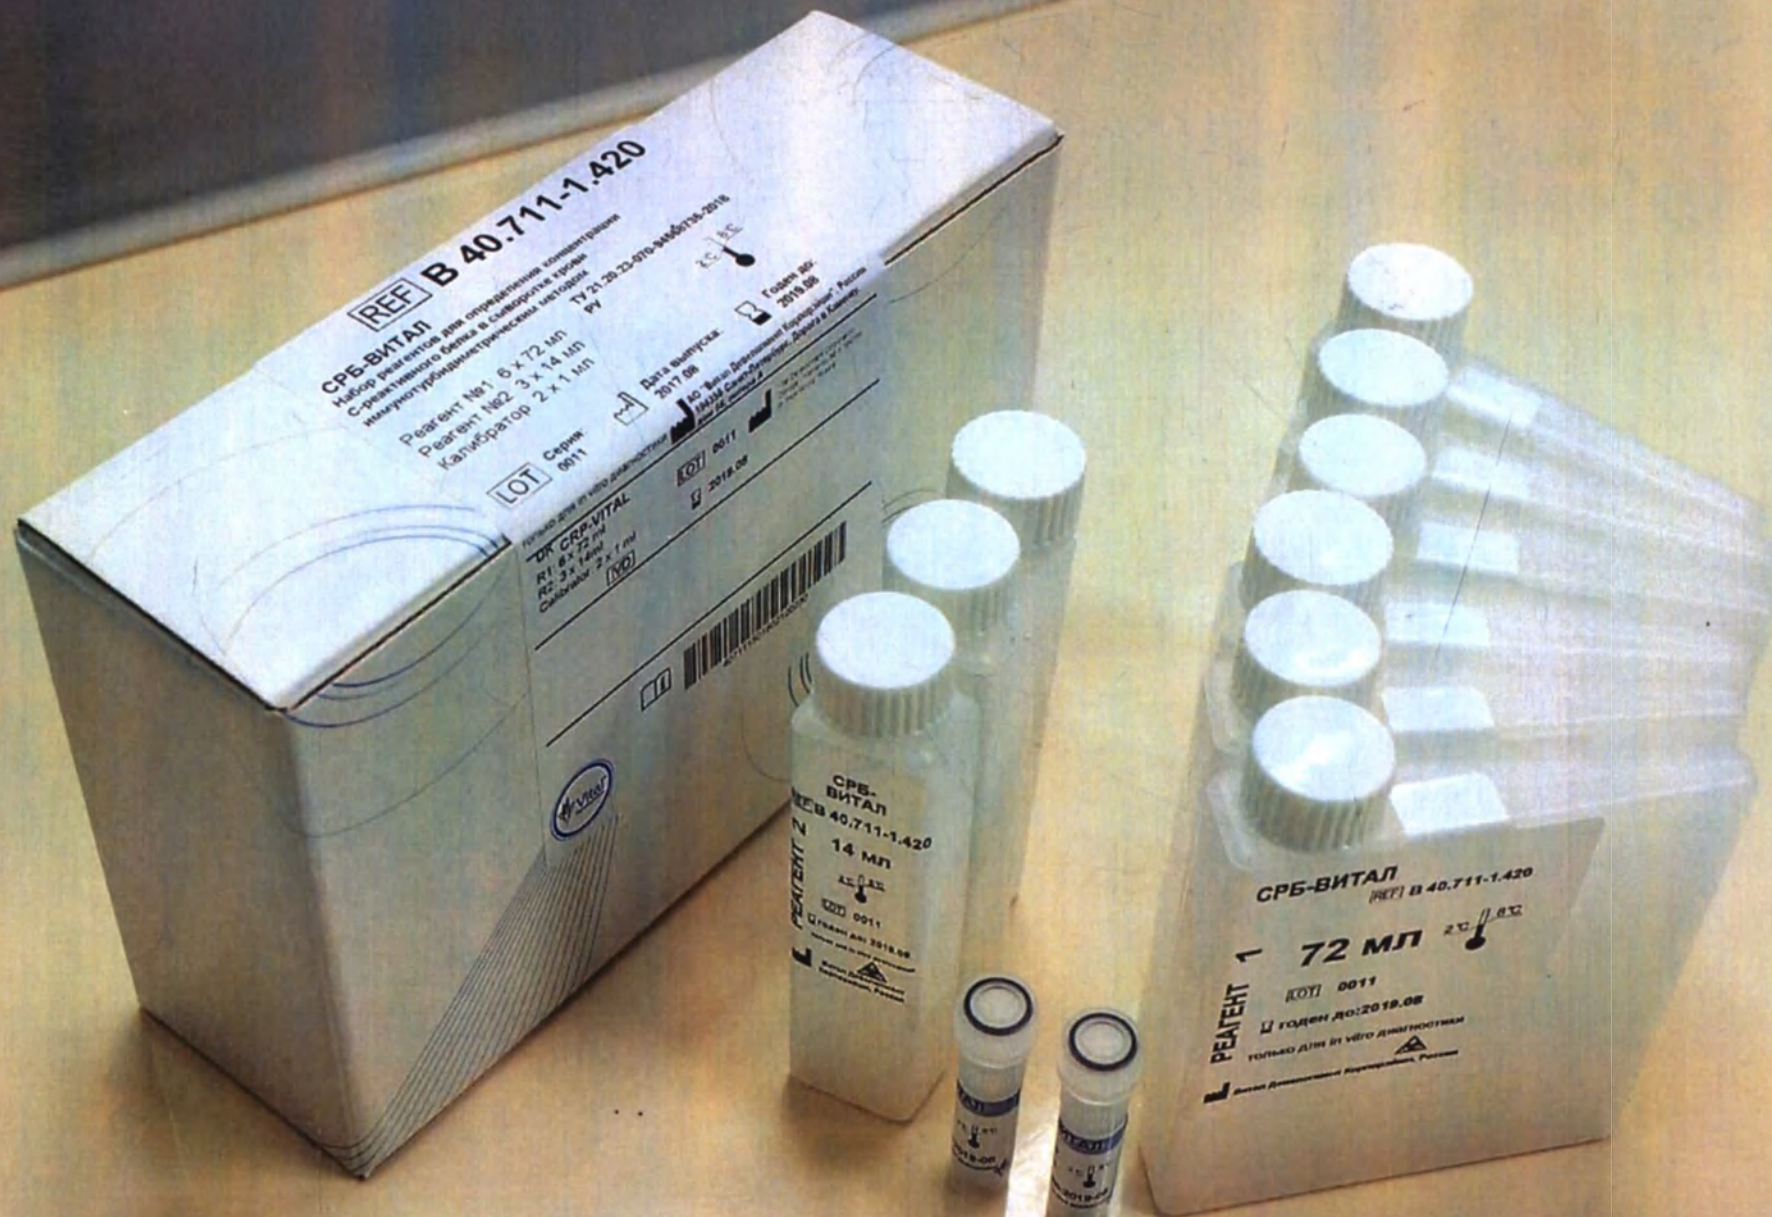

REF B 40.711-1.420

СРБ-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунофлуориметрическим методом

Реагент №1 6 x 72 мл
Реагент №2 3 x 14 мл
Калибратор 2 x 1 мл

LOT Серийный
0011

ГОТОВОСТЬ ДЛИТЬ ВРЕМЯ ДИАГНОСТИКИ
DK CRP-VITAL
R1: 6 x 72 мл
R2: 3 x 14 мл
Calibrator 2 x 1 мл
(NIST)



Дата выпуска
2017.08

Годен до
2019.08


ИЗДАНИЕ
2018.08

СРБ-ВИТАЛ
REF B 40.711-1.420
14 мл
LOT 0011
Годен до: 2019.08

СРБ-ВИТАЛ
REF B 40.711-1.420
14 мл
LOT 0011
Годен до: 2019.08

СРБ-ВИТАЛ
REF B 40.711-1.420
14 мл
LOT 0011
Годен до: 2019.08



СРБ-ВИТАЛ
REF B 40.711-1.420
72 мл
LOT 0011
Годен до: 2019.08

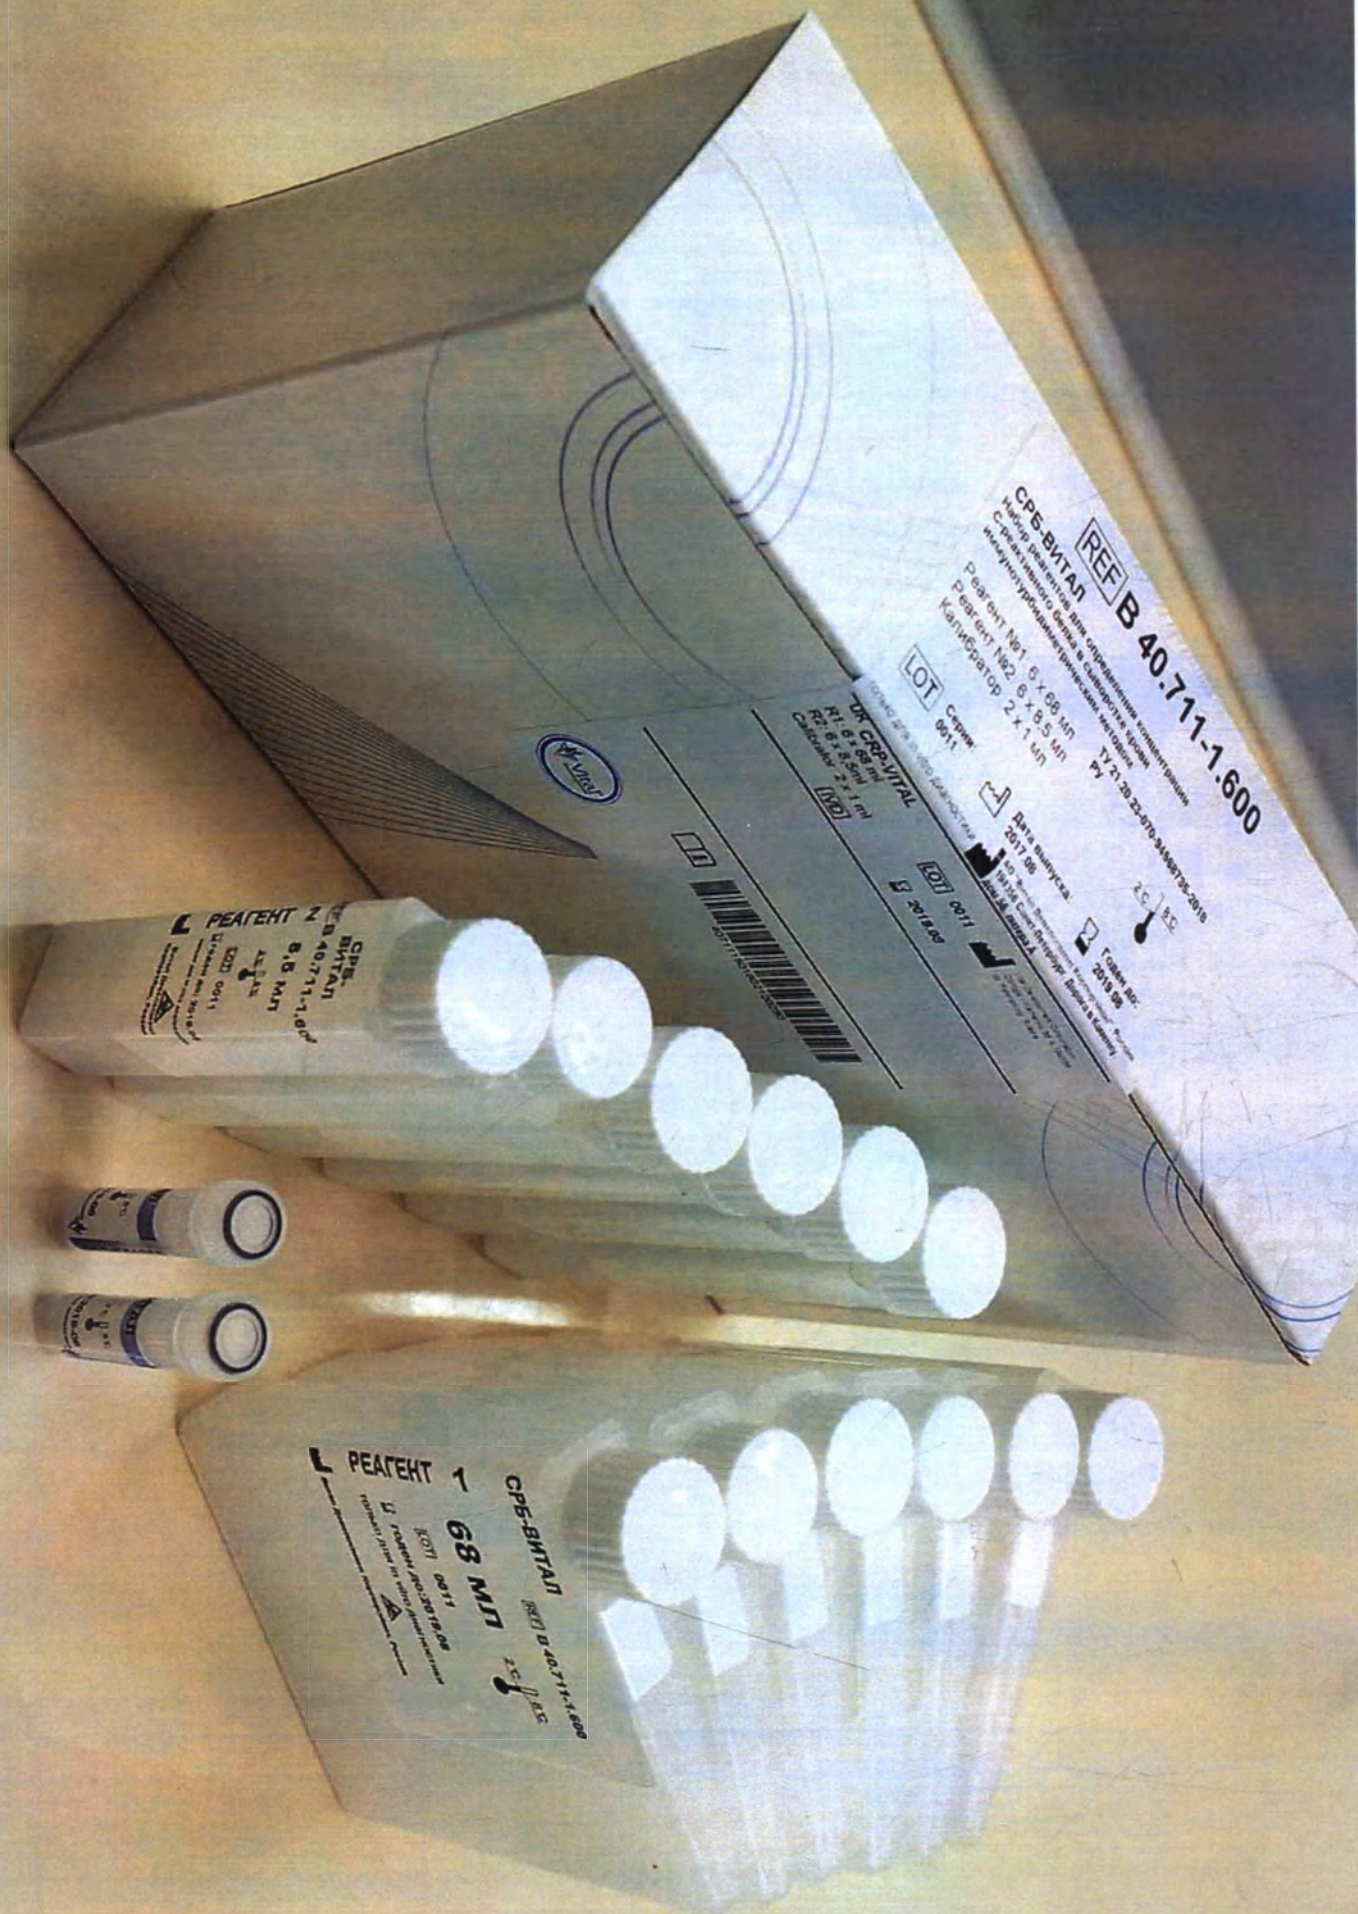

СРЕ-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1
35 МЛ
REF B 40.711-2.300
ГОДЕН ДО: 2019.08
LOT 0011
20°C / 8°C

СРЕ-ВИТАЛ
REF B 40.711-2.300
РЕАГЕНТ №1: 4 X 35 МЛ
КАЛИБРАТОР: 1 X 1 МЛ
ГОДЕН ДО: 2019.08
LOT 0011
20°C / 8°C
Дата выпуска: 2017.08
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
191356 Санкт-Петербург, д/корп. 4 в Кантеку
191356 Санкт-Петербург, д/корп. 4 в Кантеку
191356 Санкт-Петербург, д/корп. 4 в Кантеку

СРЕ-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
16 МЛ
REF B 40.711-2.300
ГОДЕН ДО: 2019.08
LOT 0011
20°C / 8°C

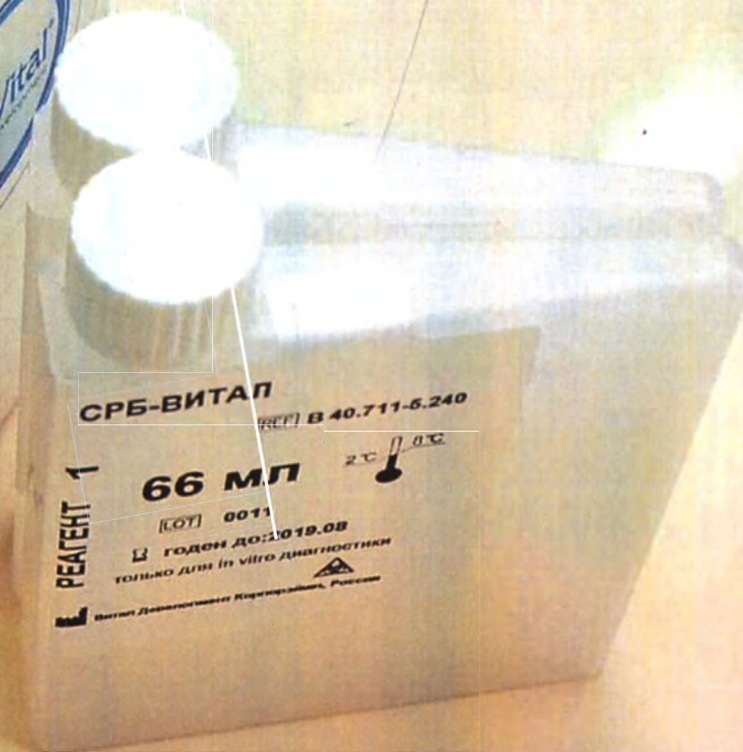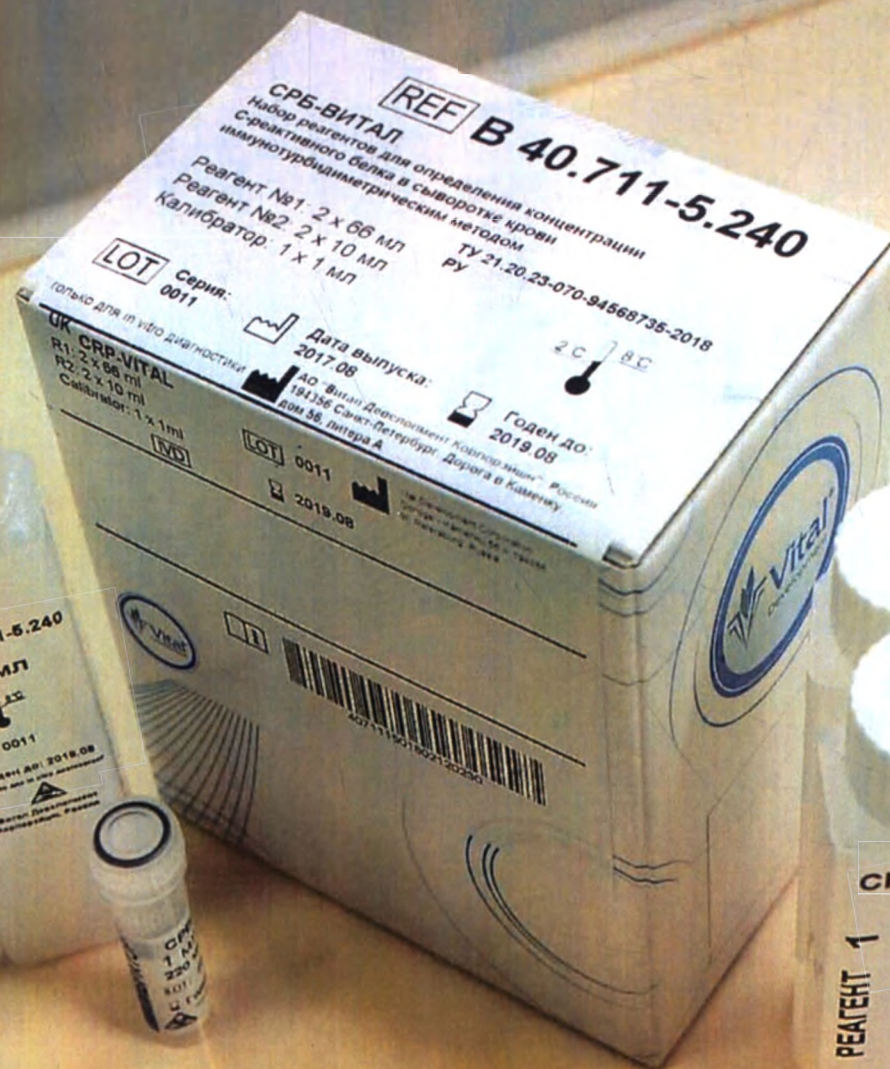



REF B 40.721-8.480

СРЕ-ВИТАЛ

Набор реактивов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
иммунофлуориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 53 мл

Реагент №2: 4 x 7,5 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 21.20.23-070-94868736-2018

2018

LOT Серия: 0011

Дата выпуска: 2017.08

Годен до: 2019.08

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
141354, Московская область, г. Серпухов, Дорога в Коледино,
дом 94, литера А

UK CRP-VITAL

R1: 4 x 53 ml

R2: 4 x 7.5 ml

Calibrator: 2 x 1 ml



LOT 0011

2019.08



СРЕ-ВИТАЛ
REF B 40.721-8.480
2018
LOT 0011
Годен до: 2019.08
L REAGENT 1
53 ML



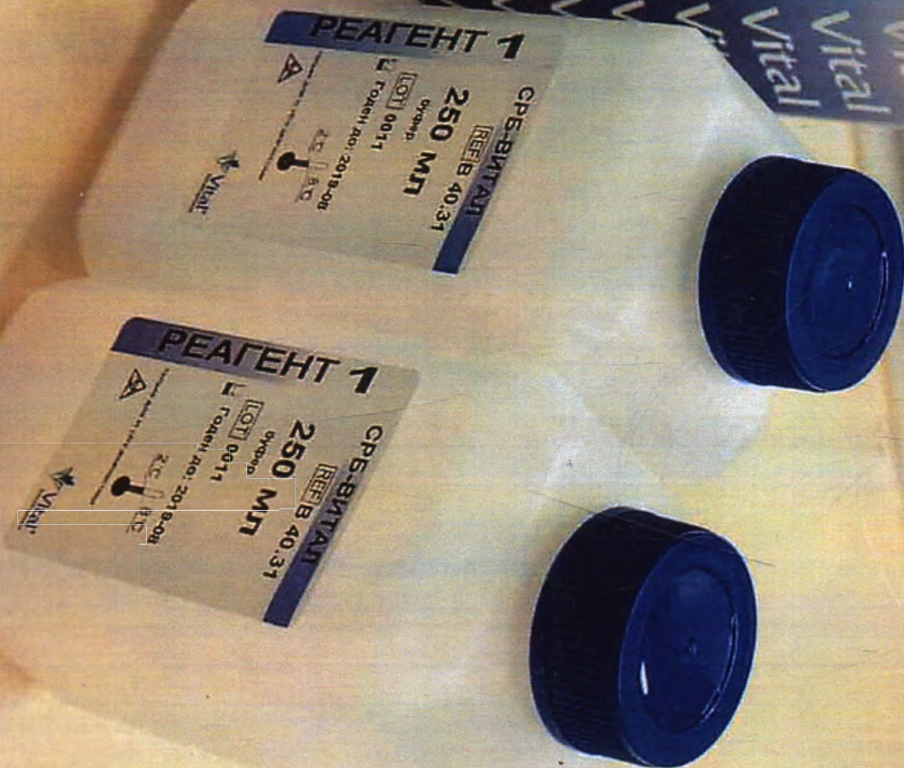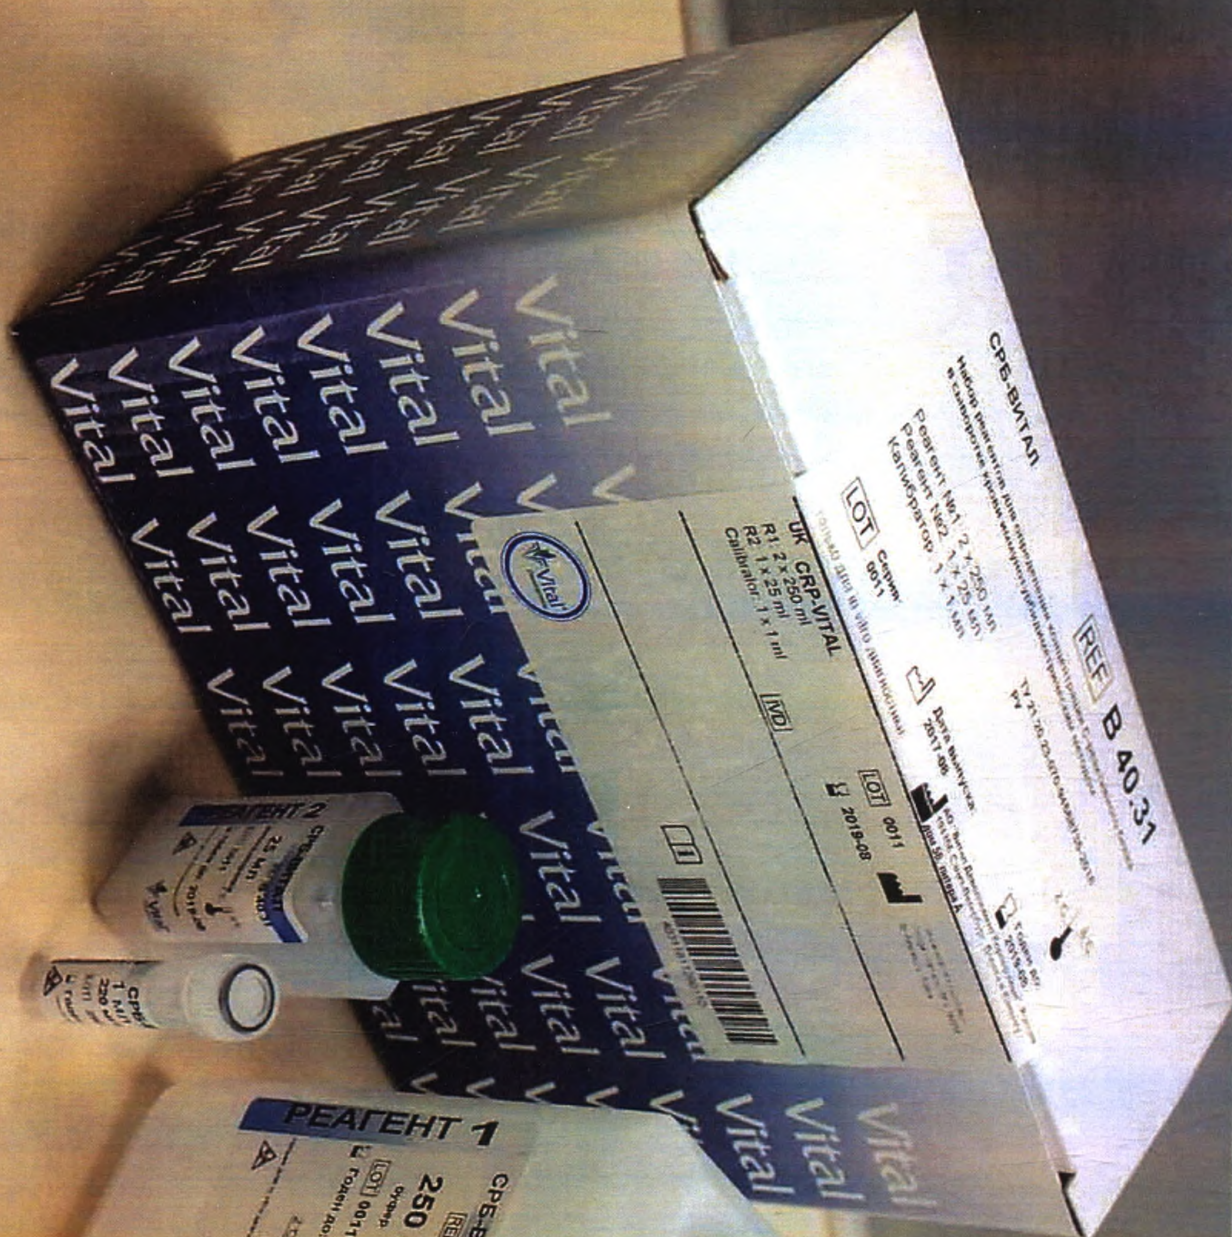

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

28 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.