


«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
В.В. Малеев
2017 г.

Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® FiloA-скрин-FL
формы комплектации 1 до вскрытия упаковки

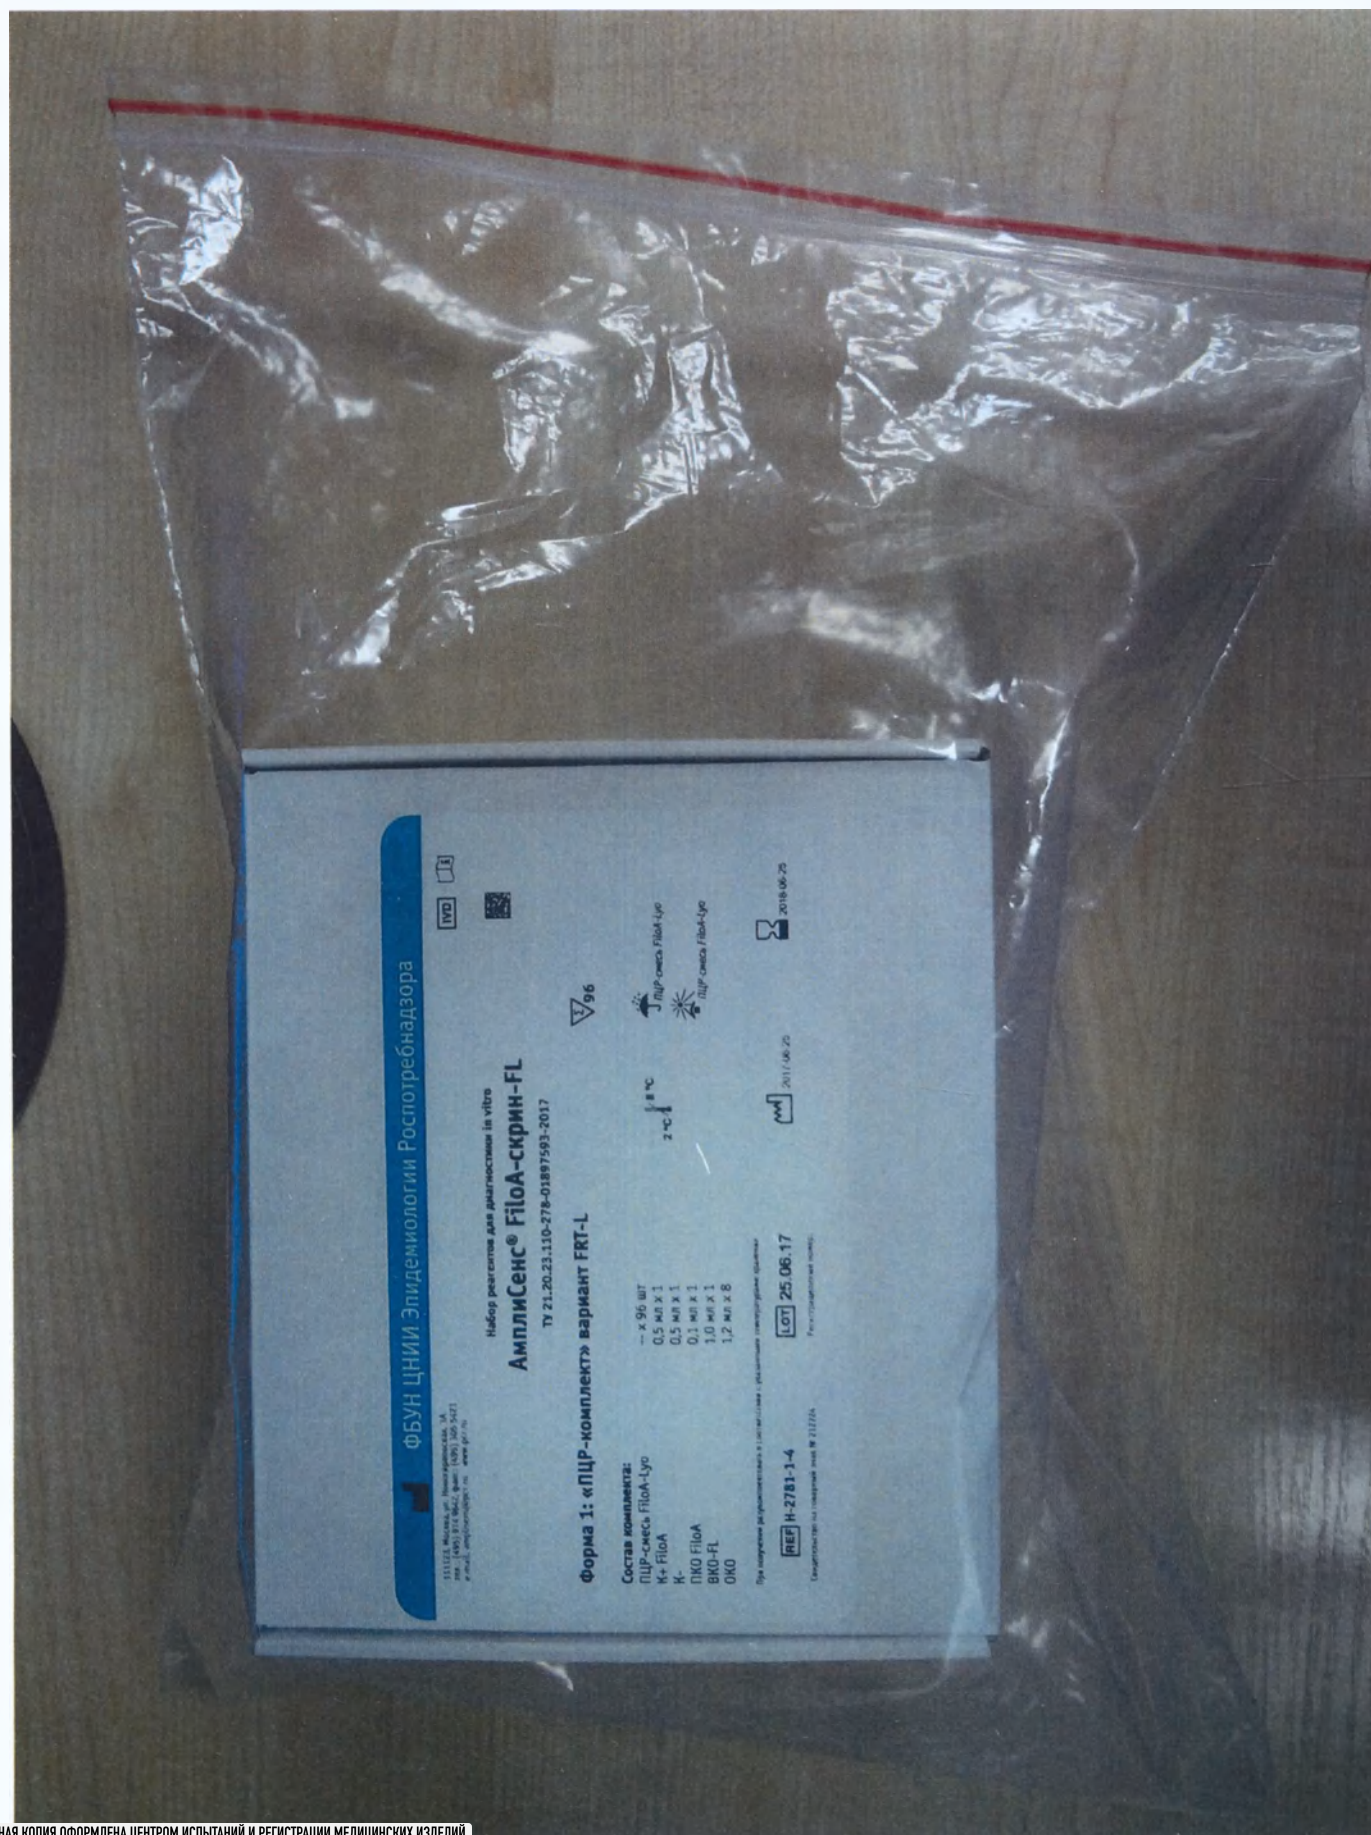

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев

«21» 07 2017 г.

Набор реагентов АмплиСенс® FiloA-скрин-FL после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 1)


1. ПЦР-смесь FiloA-I.ю (96 пробирок);
2. К+ FiloA (1 пробирка);
3. ПКО FiloA (1 пробирка);
4. ВКО-FL (1 пробирка);
5. К- (1 пробирка);
6. ОКО (8 пробирок).



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора ФБУН Ц
Эпидемиологии Роспот
В.В.
«24/» _____ 201

Набор реагентов АмплиСенс® FiloA-скрин-FL (последняя упаковка)
с указанием компонентов изделия (Форма 1)

1. ПЦР-смесь FiloA-Lyo (96 пробирок); 2. К+ FiloA (1 пробирка); 3. ПКО FiloA (1 пробирка); 4. ВКО-FL (1 пробирка); 5. К- (1 пробирка); 6. ОКО (8 пробирок).

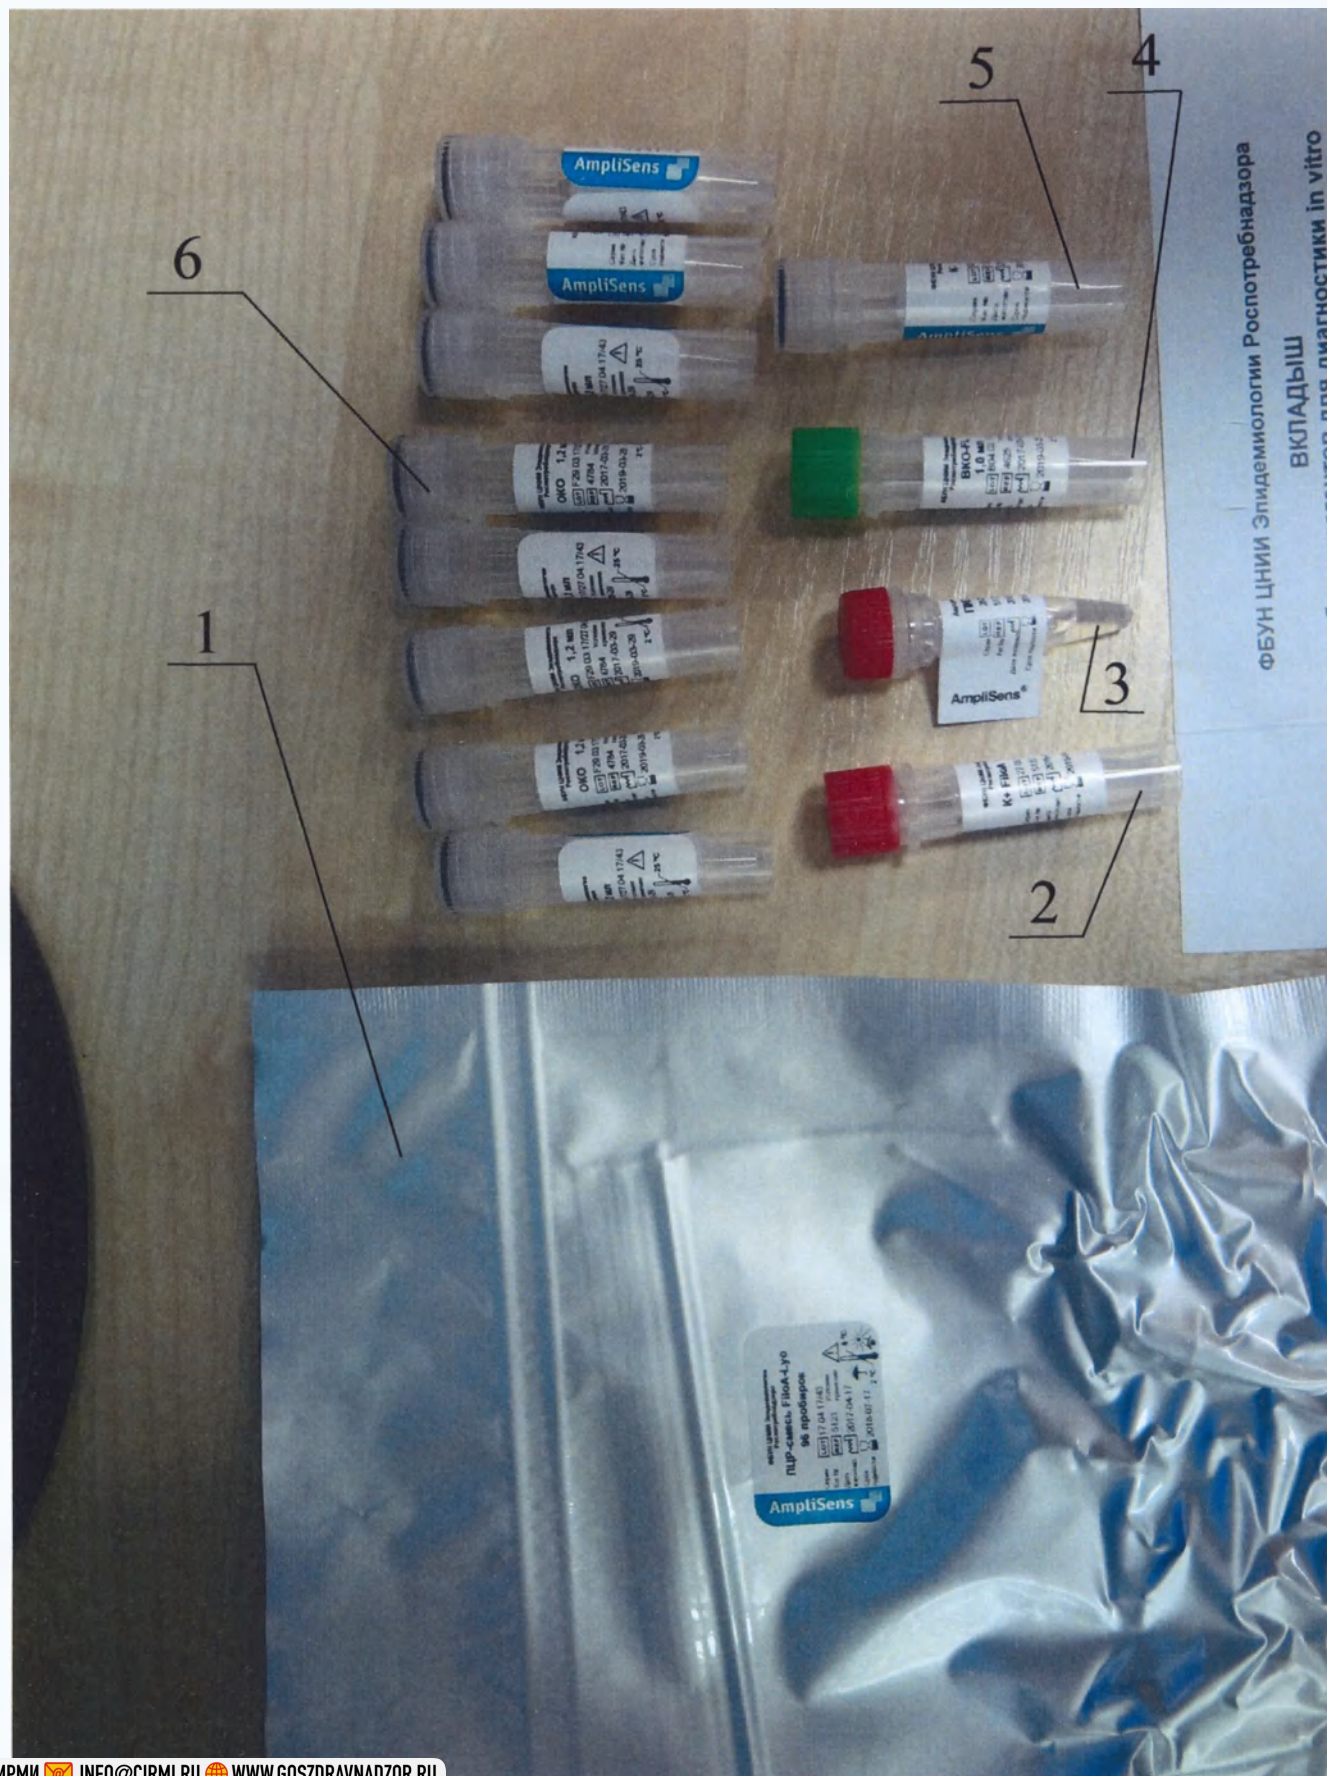

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев

2017 г.



Фотография реагентов, входящих в ПЦР-смесь FiloA-Lyo набора
АмплиСенс® FiloA-скрин-FL формы комплектации 1, после вскрытия
вакуумного пакета