

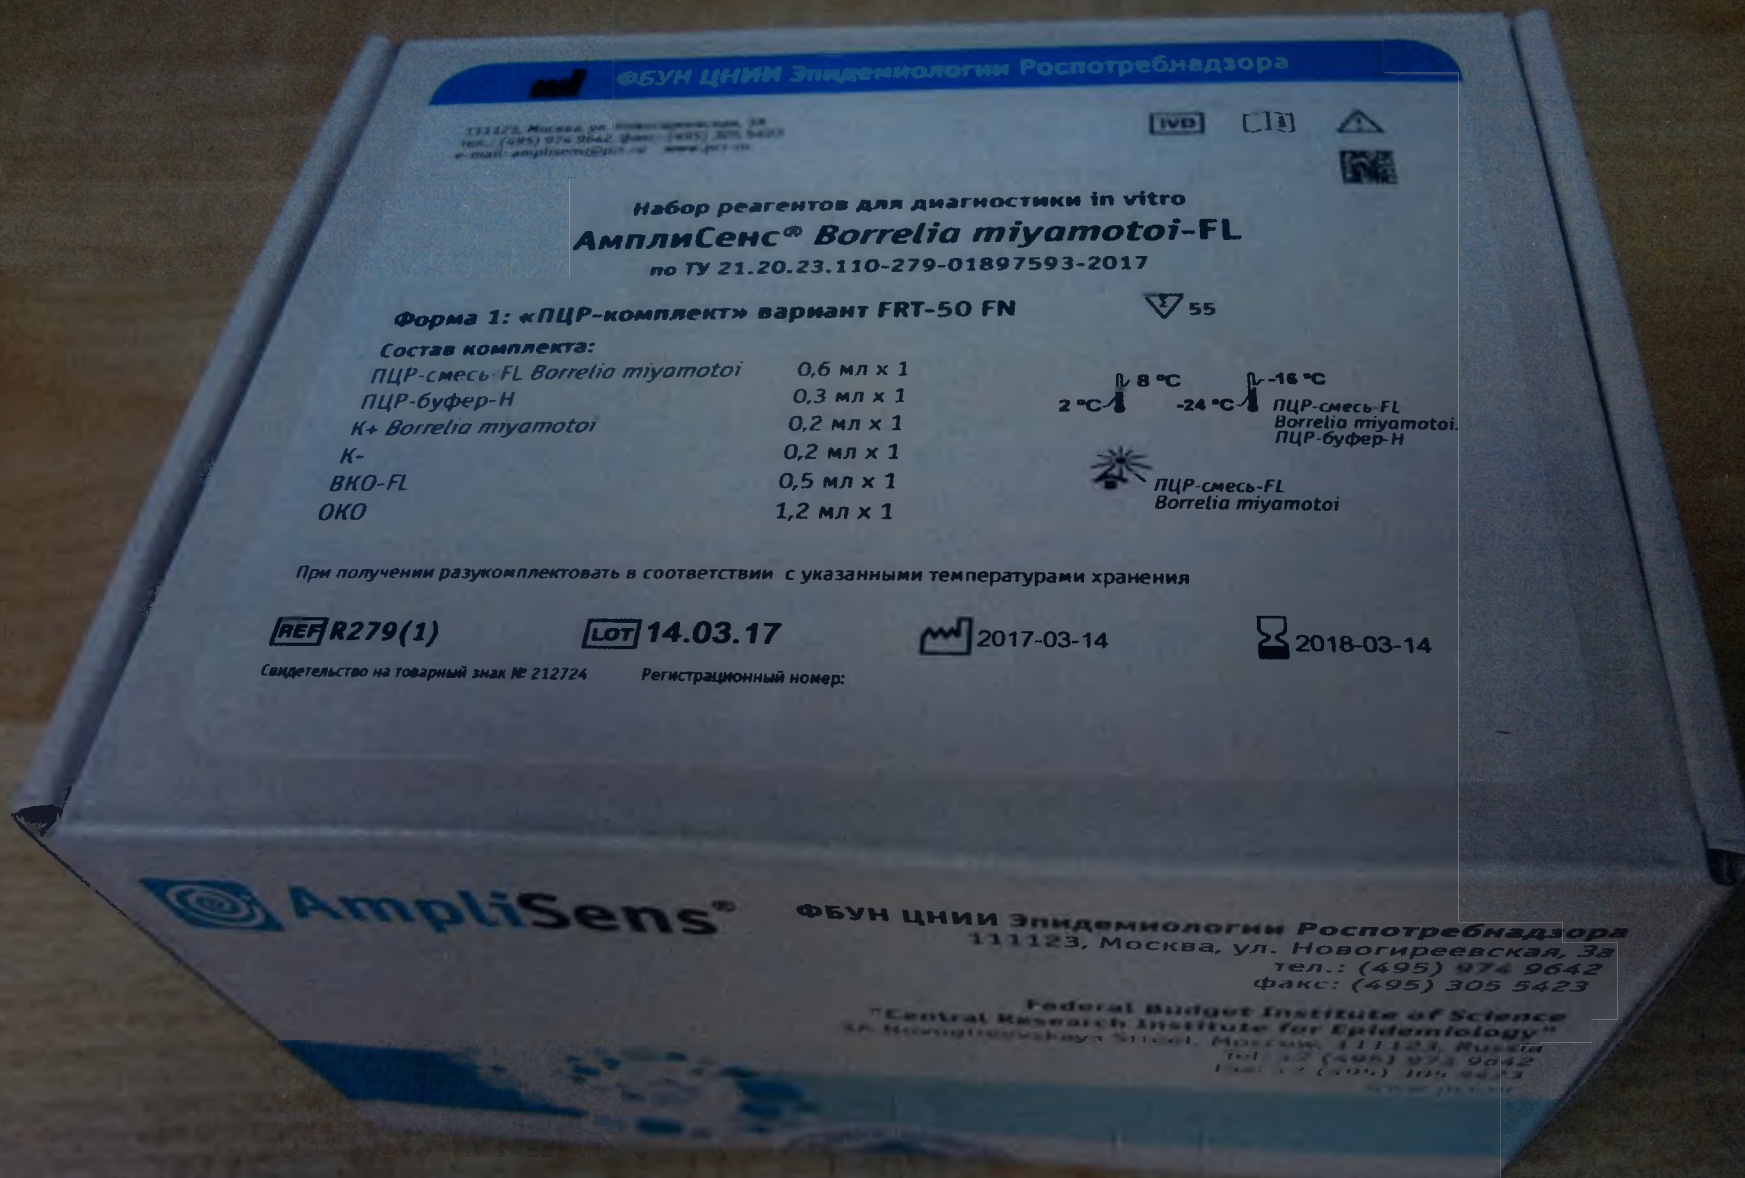
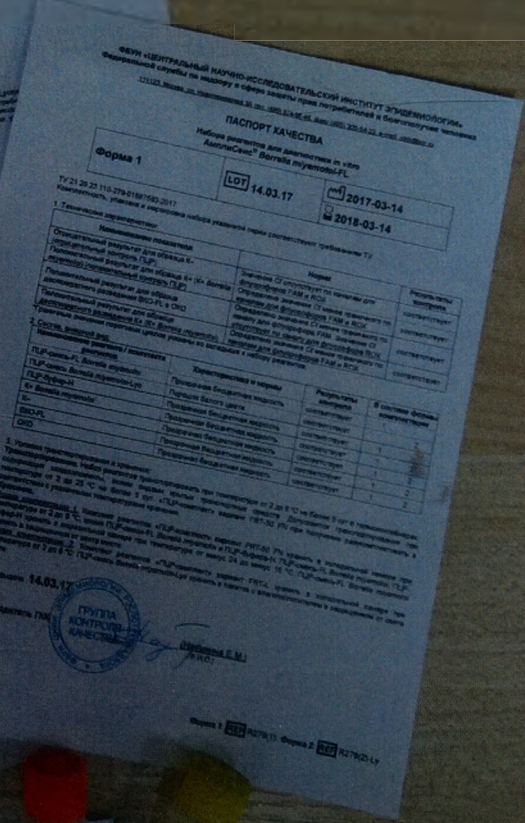


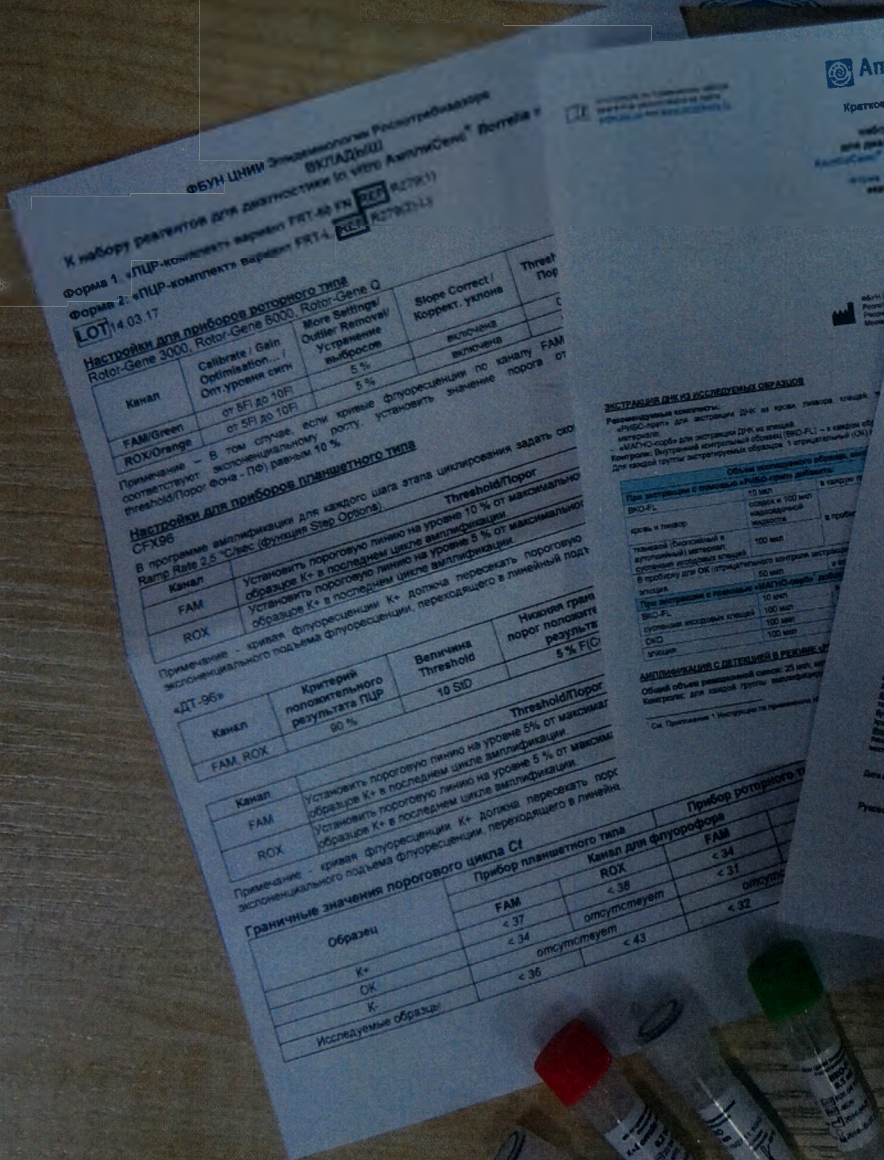

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
В.В. Майсеев
2017 г.

В.В. Малеев
2017 г.

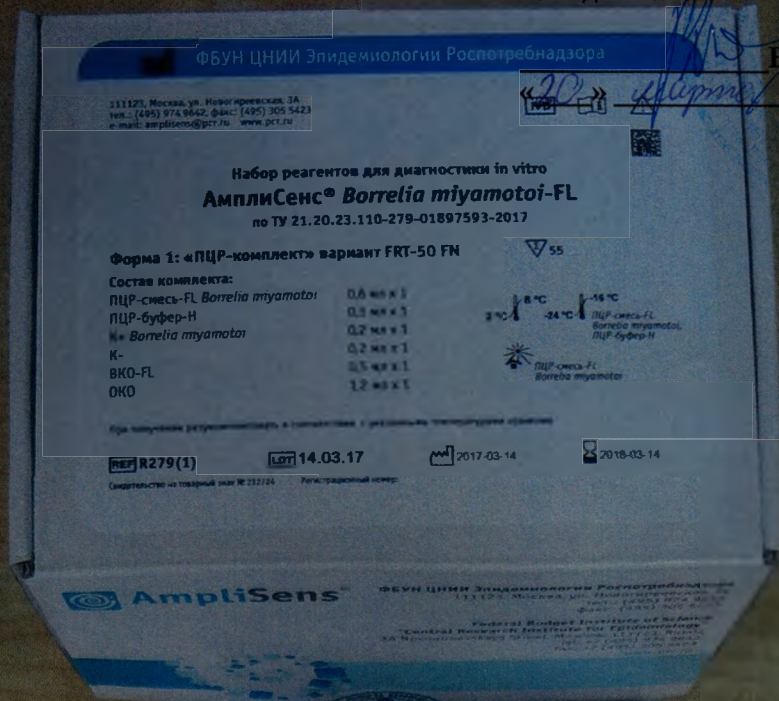

В.В. Малеев
«20» марта 2017 г.


03.17
ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ГРУППА
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
ИНИИП НКРФ

Форма 1: **REF** R279(1): 4

Прибор планшетного типа		Прибор роторного
Канал для флуорофора		FAM
ROX		< 34
< 38		< 31
отсутствует		отсут
FAM	< 37	< 32
< 34	отсутствует	
< 43		
< 36		




 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

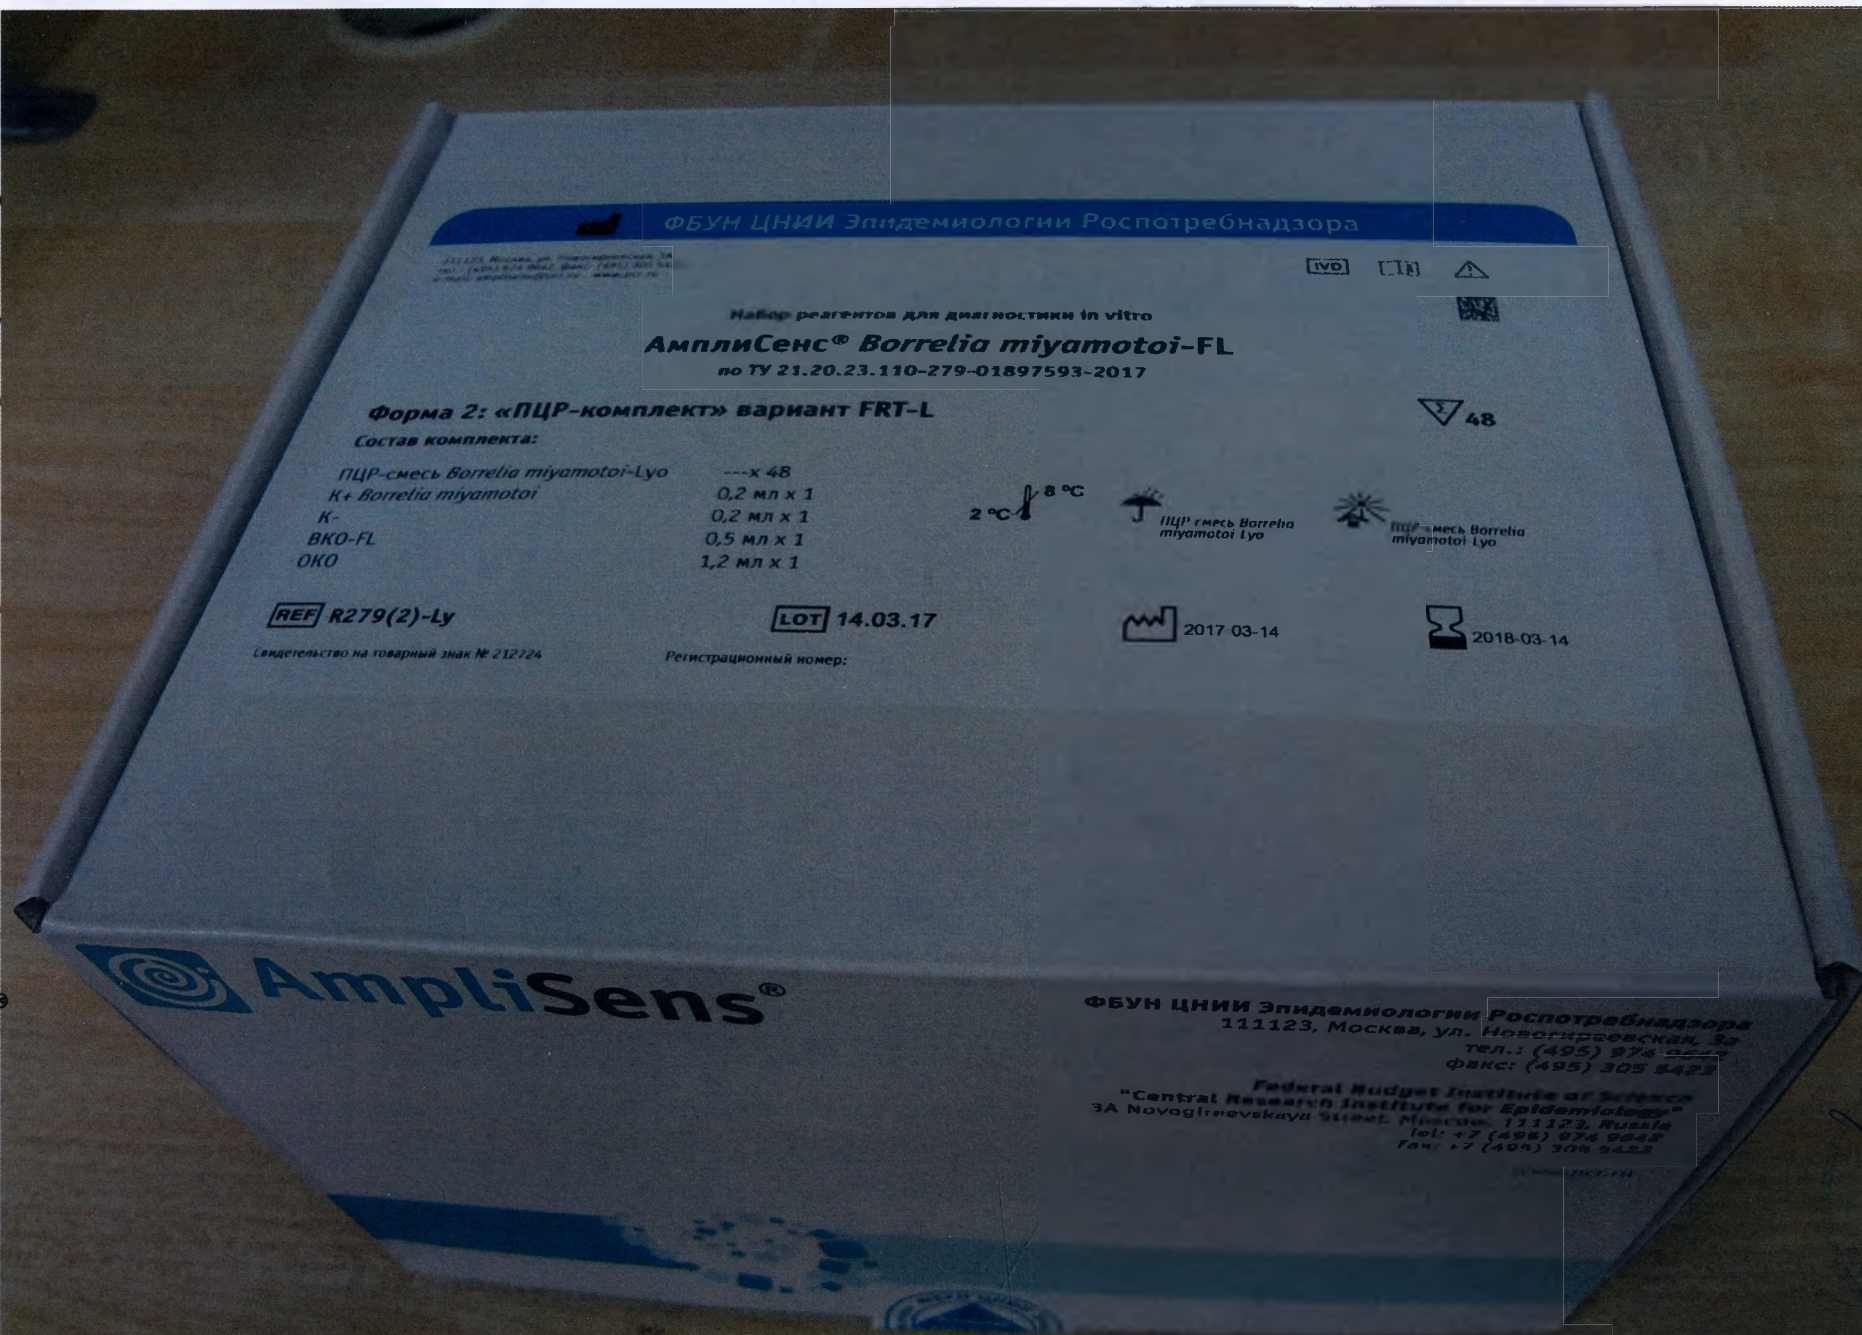

«УТВЕРЖАЮ»
Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В. Малеев
2017 г.

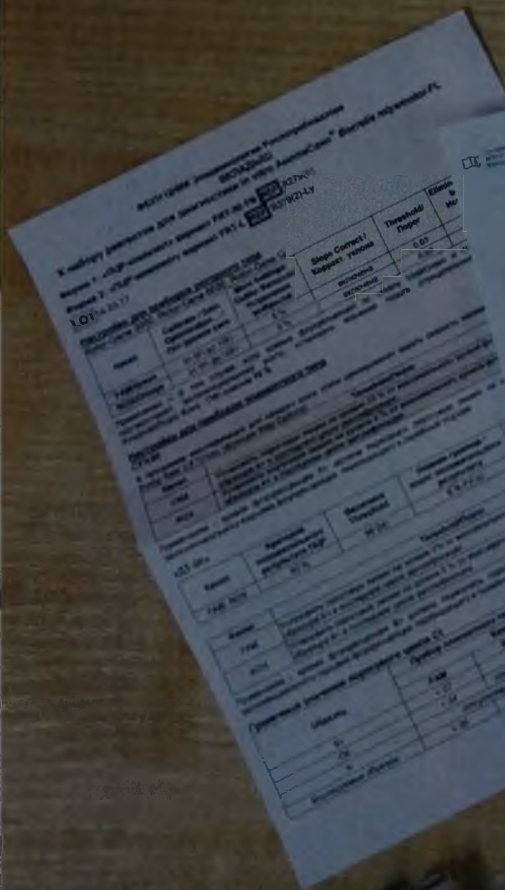

Фотография набора реагентов АмплиСенс® *Borrelia miyamotoi*-FL

«УТВЕРЖДАЮ»
 Зам. директора ФБУН ЦНИИ
 Эпидемиологии Роспотребнадзора
 В.В. Малеев
 2017 г.



Фотография реагентов, входящих в ПЦР-смесь *Borrelia miyamotoi*-Lyo
 набора АмплиСенс® *Borrelia miyamotoi*-FL