


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

И.И.Покровский

«20» 10 2014 г.

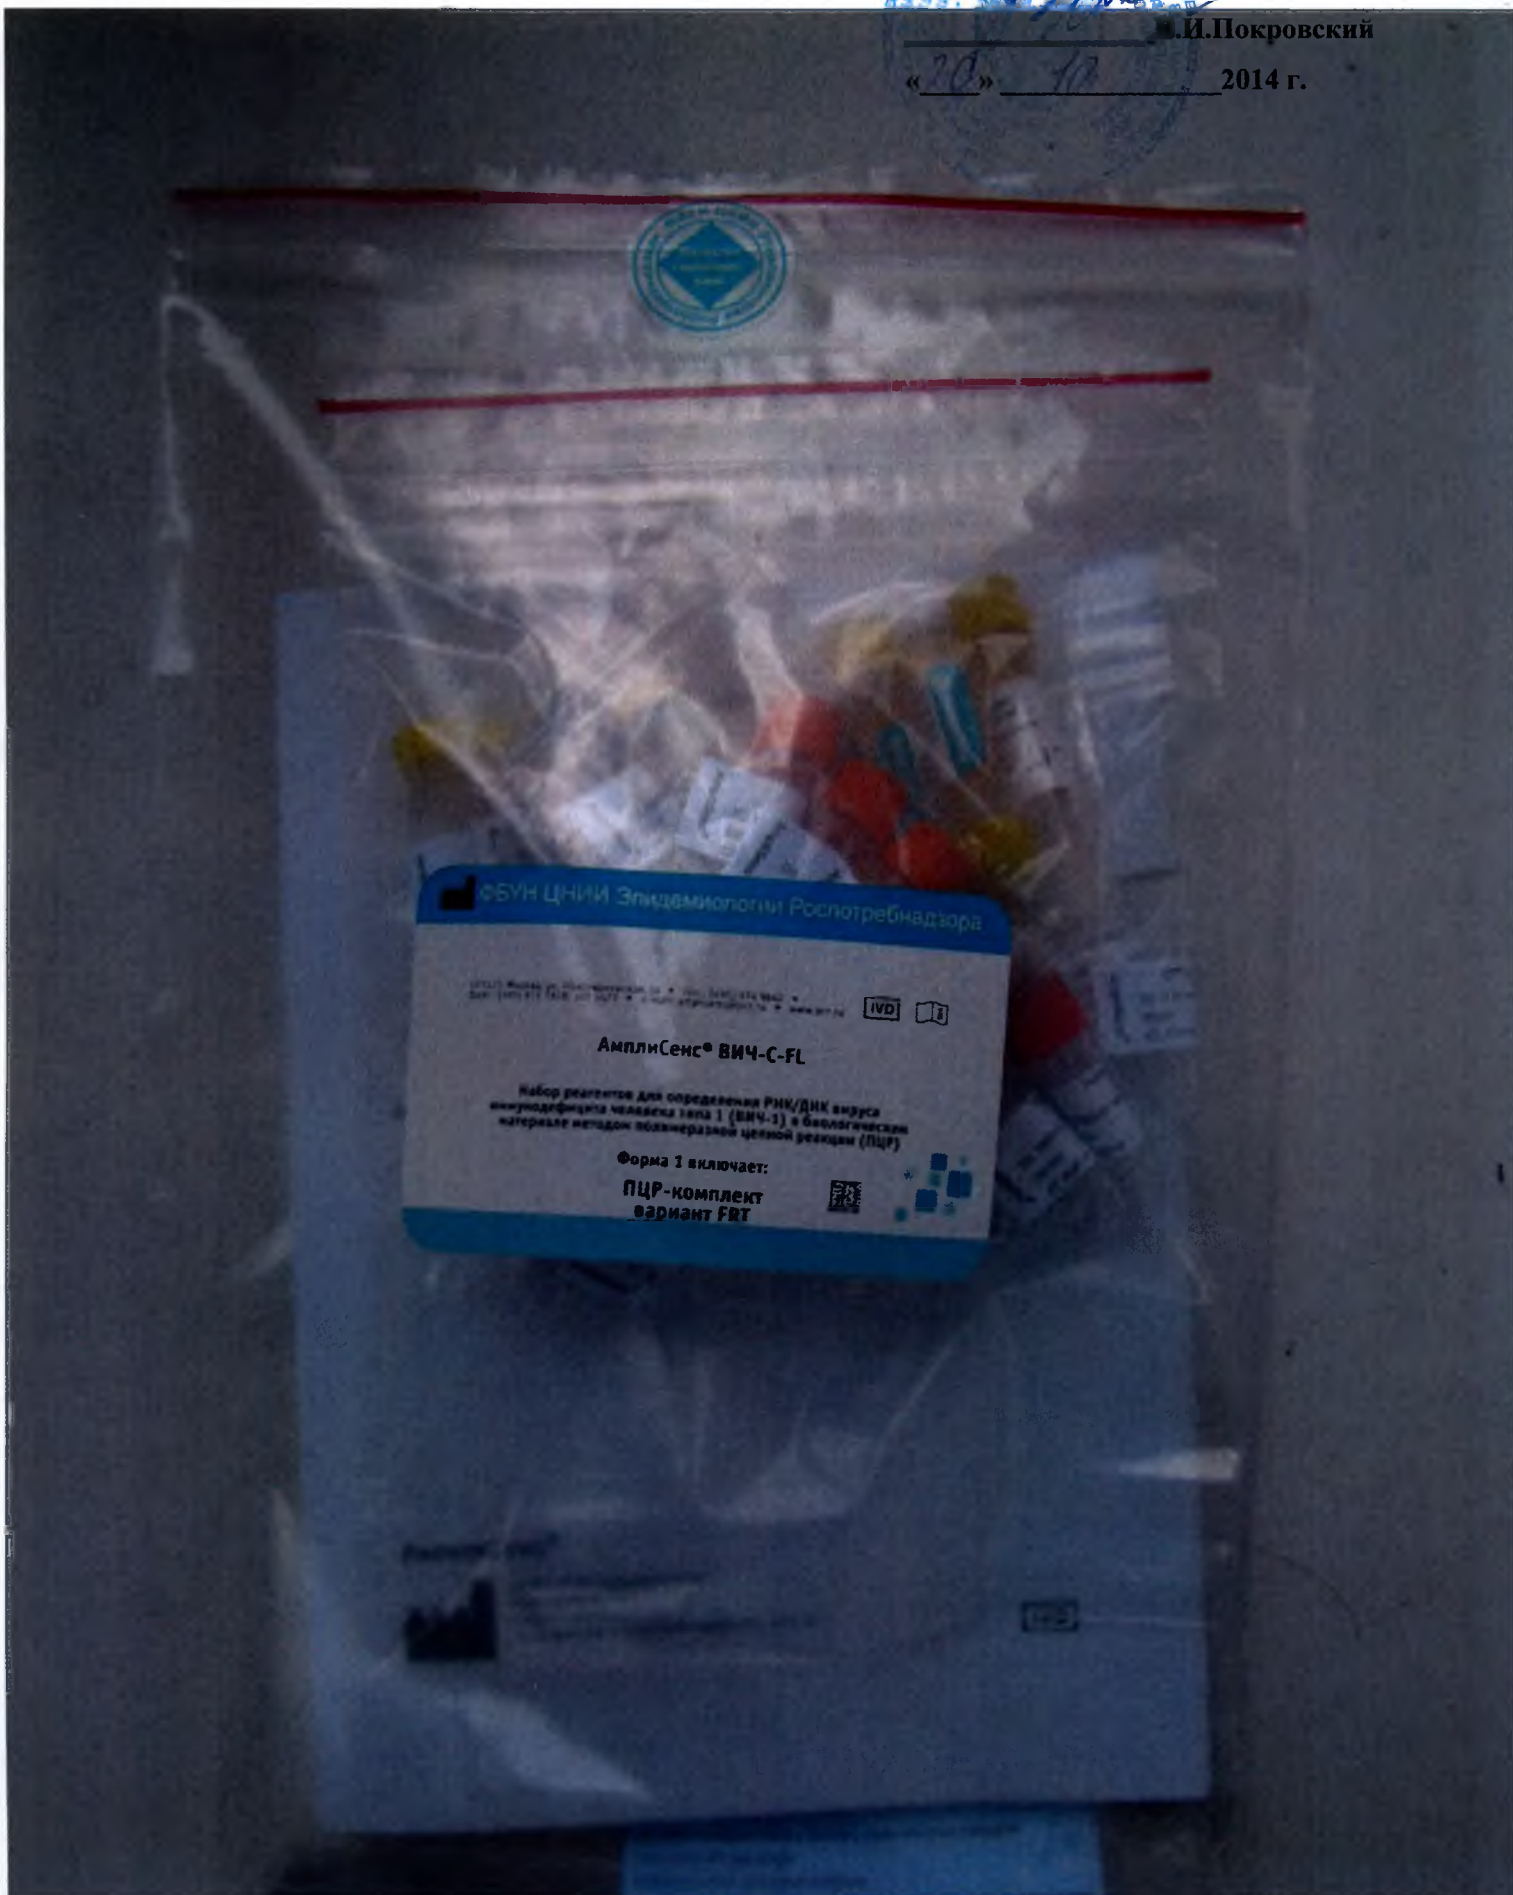


Фотография общего вида набора реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-С-FL»

формы комплектации 1



 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

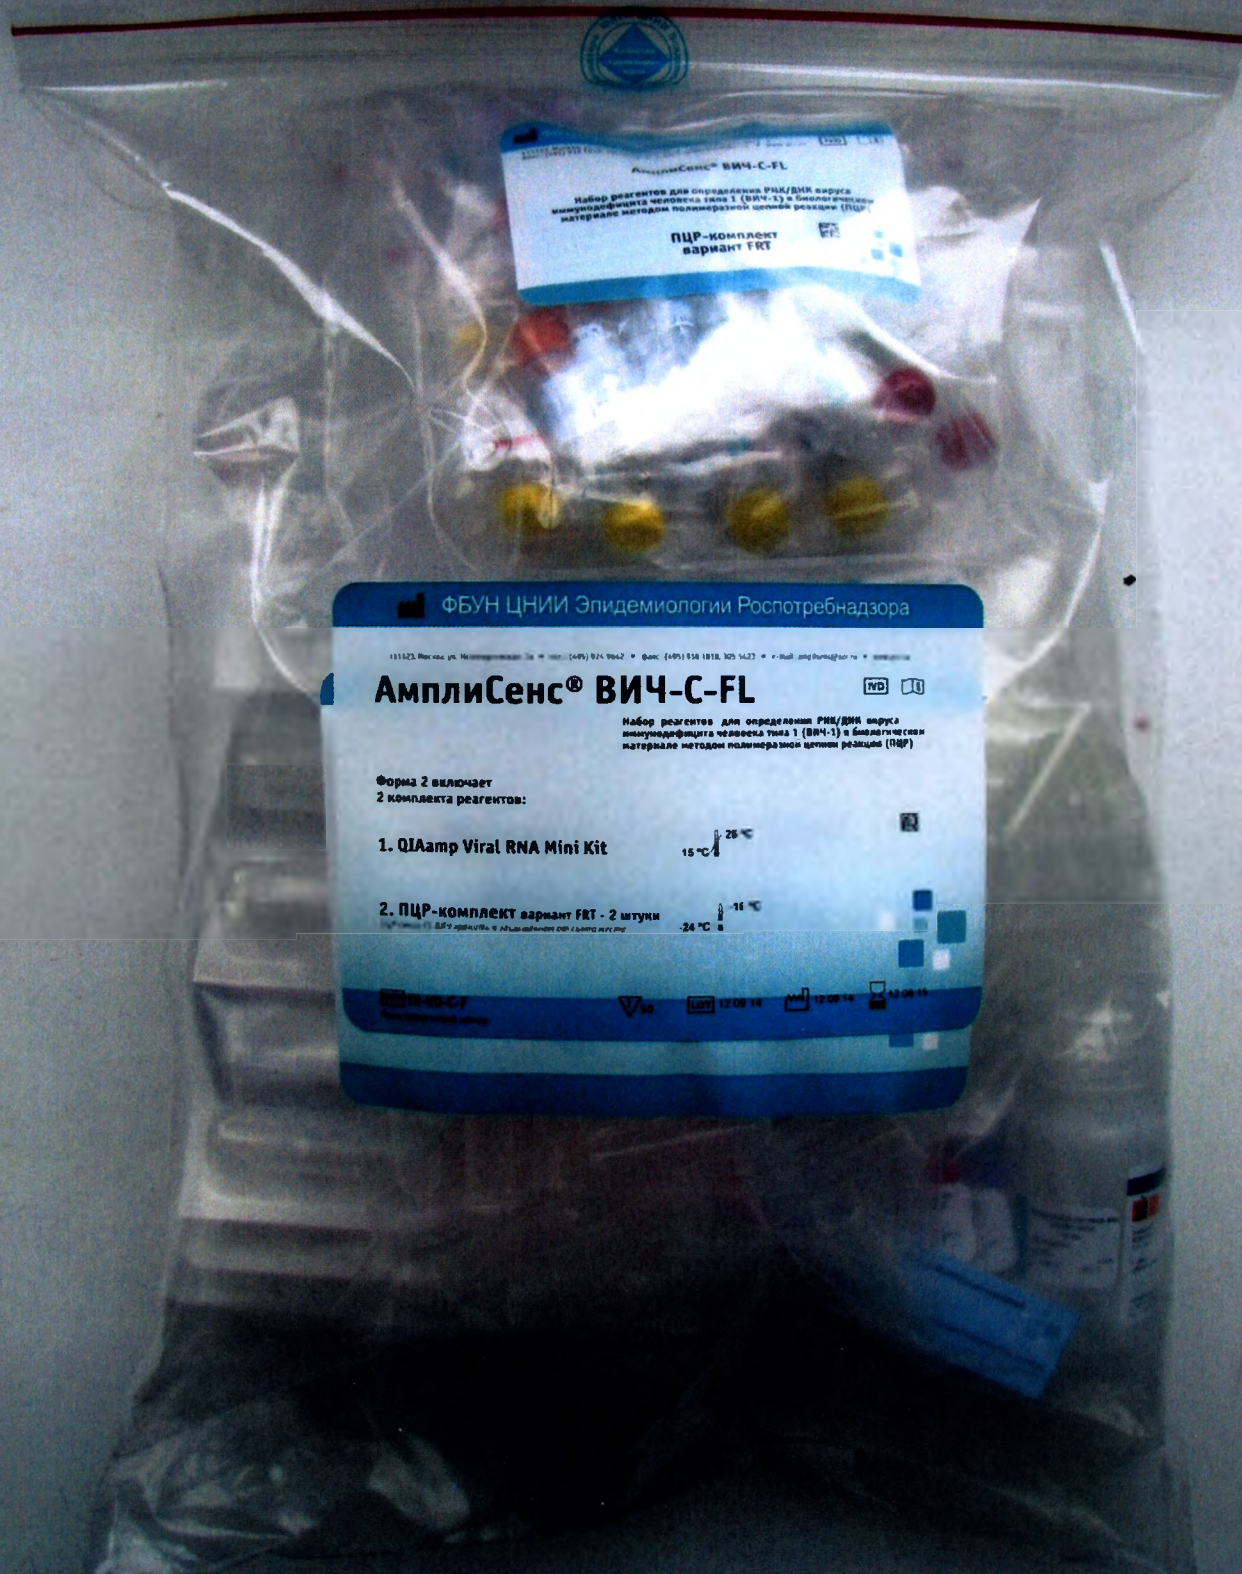

Фотография общего вида набора реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-С-FL»

формы комплектации 2



Фотография комплекта реагентов «QIAamp Viral RNA Mini Kit», входящего в состав набора реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-С-FL» формы комплектации 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

В.И.Покровский

2014 г.



Фотография реагентов, входящих в два «ПЦР-комплекта» вариант FRT набора реагентов


«АмплиСенс® ВИЧ-С-FL» формы комплектации 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

В.И.Покровский

2014

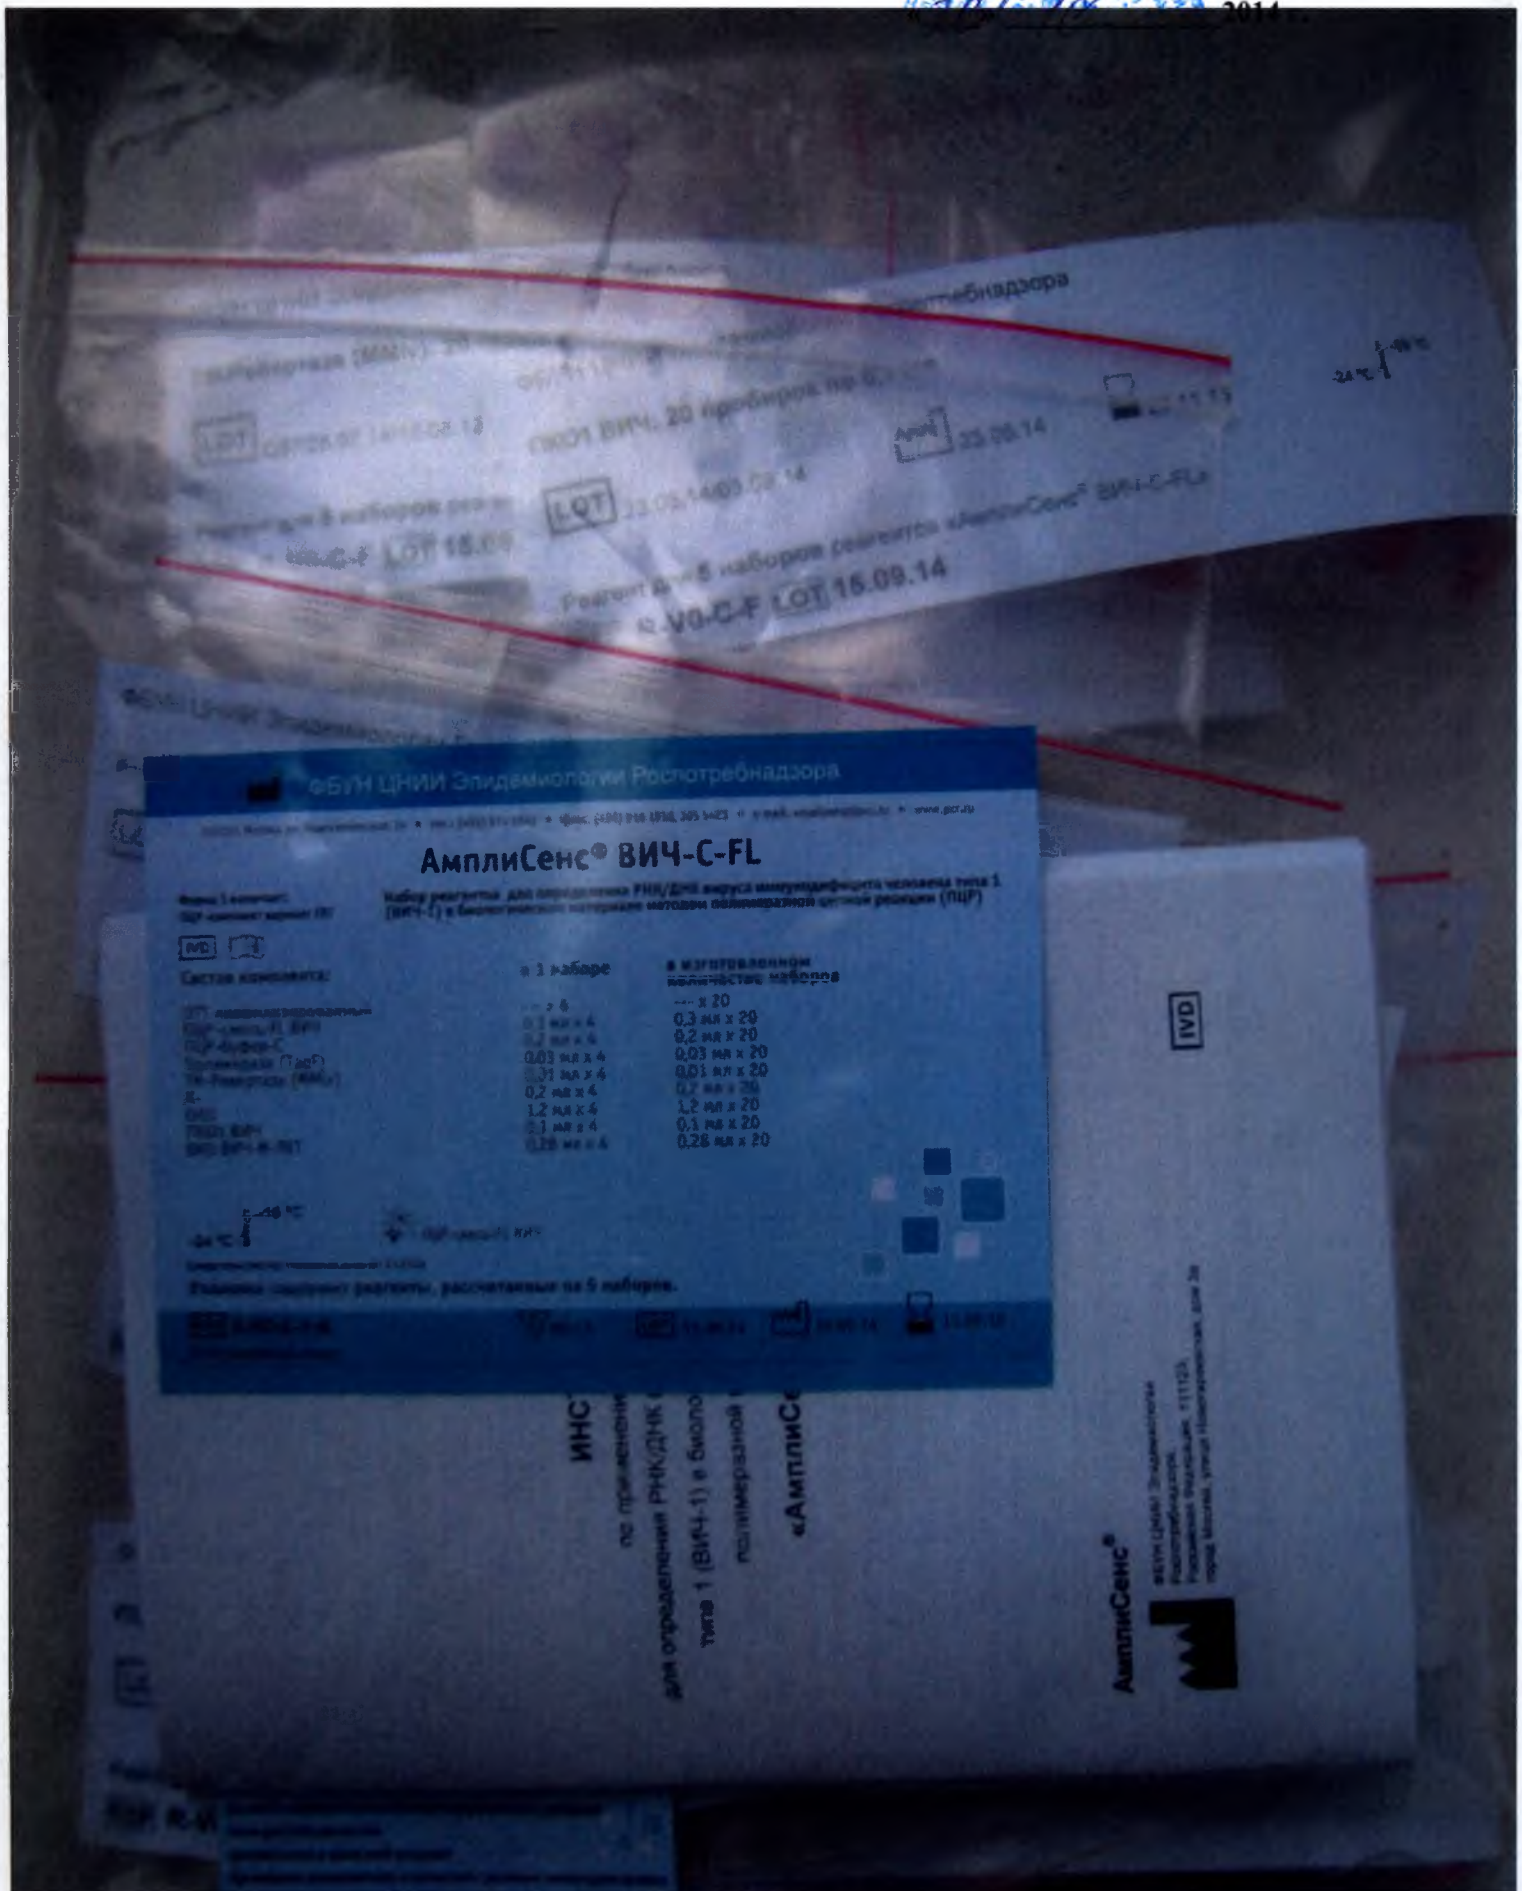

Фотография общего вида набора реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-С-FL»

формы комплектации 3



Фотография набора реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-С-FL»

формы комплектации 3 после вскрытия внешней упаковки набора