

Фотографии медицинского изделия:

«Инкубатор реанимационный для новорожденных IT-158-TS с принадлежностями»

производство: «ФАНЕМ ЛТДА», Бразилия / FANEM LTDA, Brazil.


1. Инкубатор реанимационный для новорожденных IT-158-TS, общий вид.
2. Каталка транспортная.
3. Датчик температуры кожи.
4. Датчик температуры воздуха.
5. Порт овальный.
6. Порт типа «ирис».
7. Втулка изолирующая для шлангов и кабелей.
8. Стойка вертикальная для в/в инфузий.
9. Полка поворотная.
10. Фильтр воздушный.
11. Пластырь для фиксации датчика температуры кожи.
12. Рукав порта овального для манипуляций.
13. Рукав порта типа «ирис».
14. Резервуар увлажнителя.
15. Подушка неонатальная для фиксации головы.
16. Шлем акриловый с кислородным клапаном.
17. Плата съемная электронная управления узлами инкубатора.
18. Блок съемный электронный контролирующий для инкубатора.
19. Баллон для кислорода.
20. Редуктор с флоуметром для кислородного баллона.
21. Баллон для воздуха.
22. Редуктор с флоуметром для воздушного баллона.
23. Устройство приемное для фиксации инкубатора в автомобиле СМП.
24. Крепление инкубатора к устройству приемному.
25. Аппарат искусственной вентиляции легких Babyruff.
26. Шланг высокого давления (воздух).
27. Шланг высокого давления (кислород).

Коммерческий директор ООО «РИПЛ»
(должность)

(подпись и печать Заявителя)

В.В. Пометун
(И.О.Фамилия)



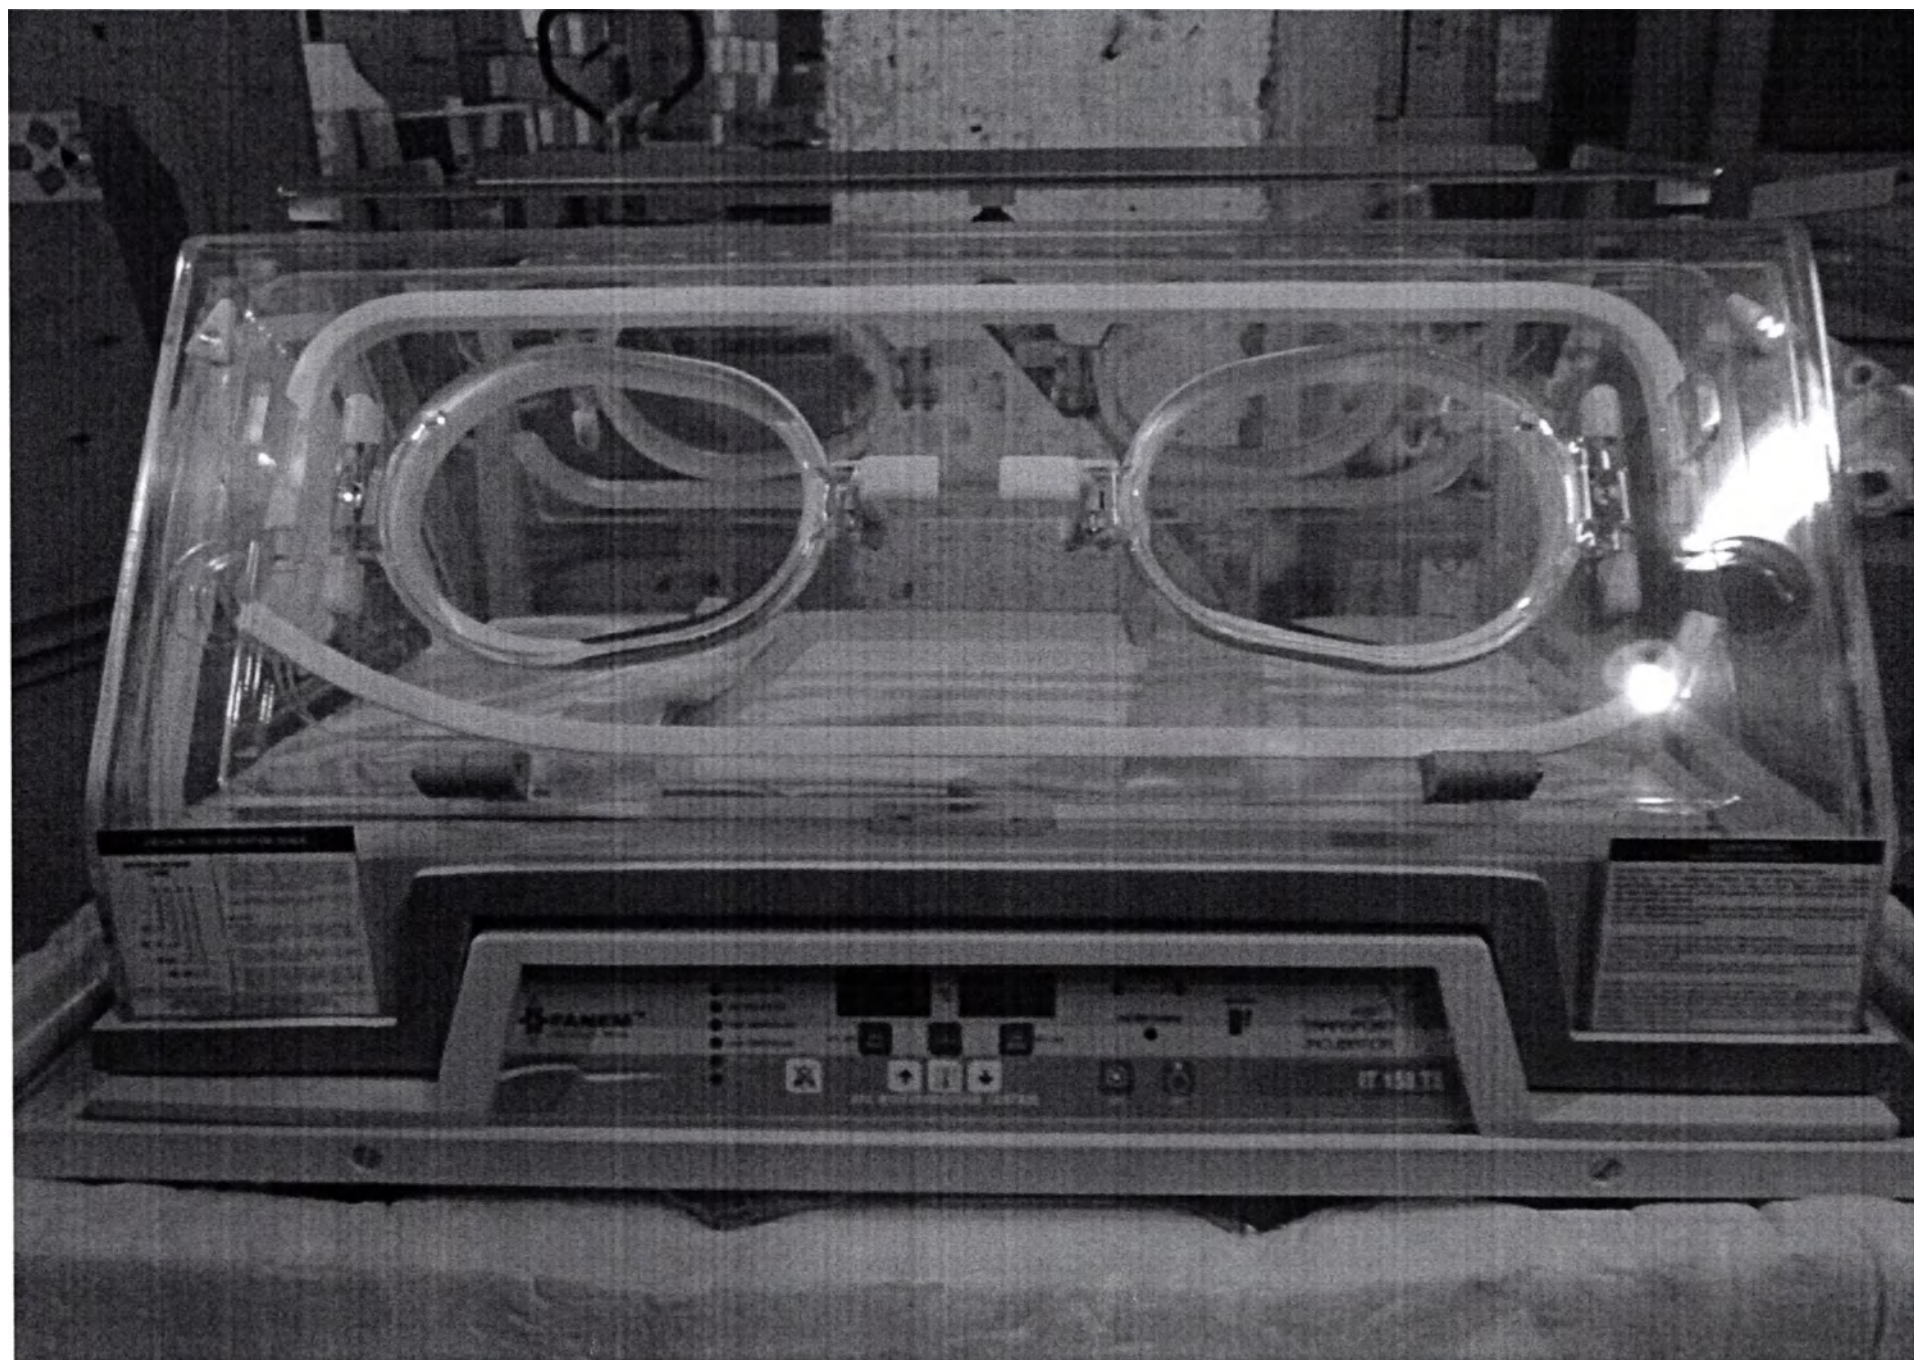

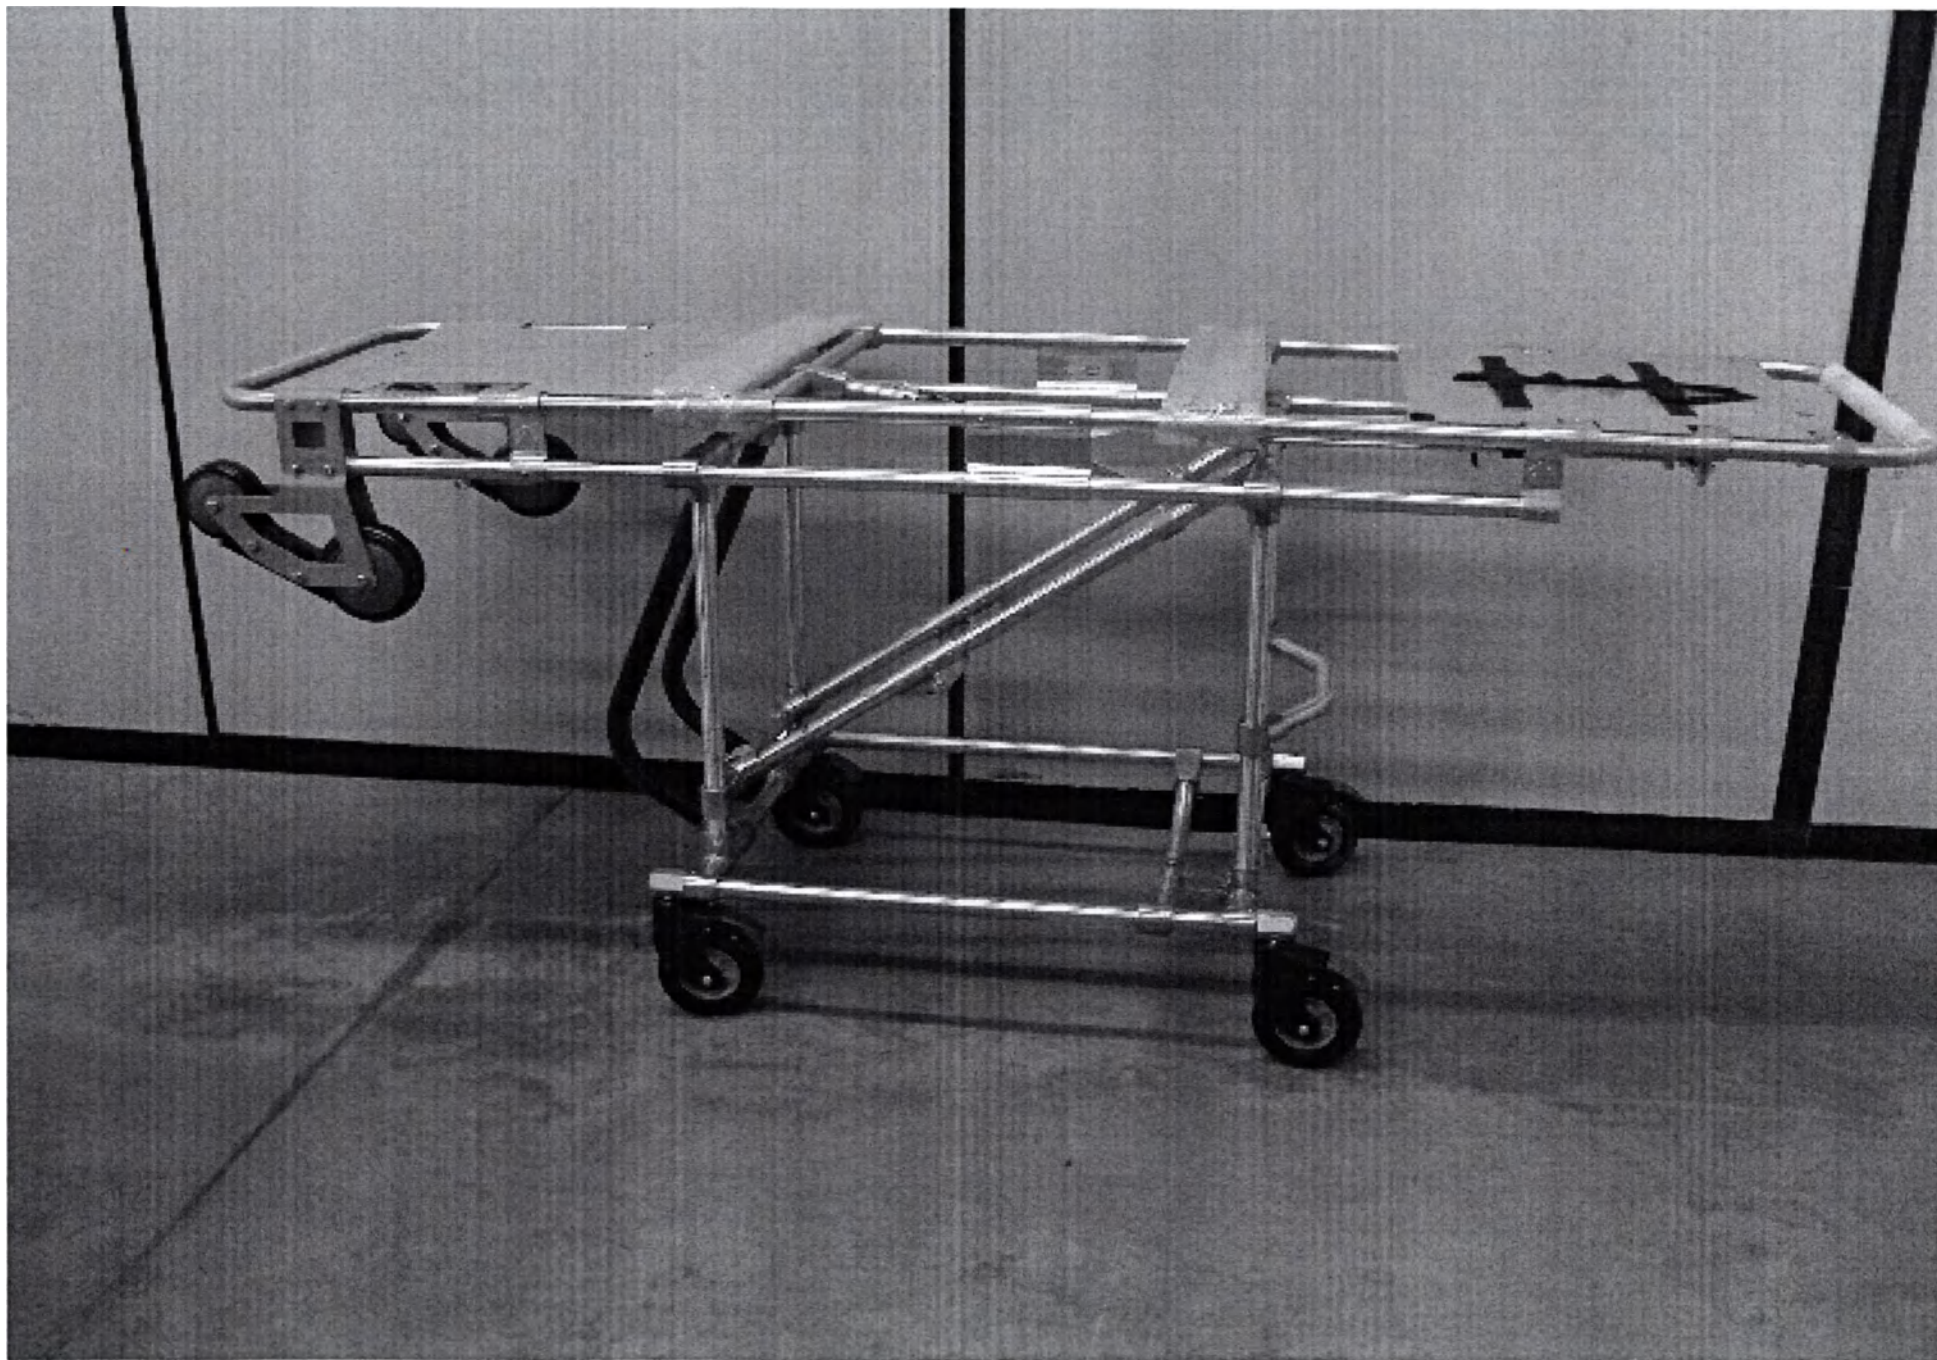


Рис. 2. Каталка транспортная.



Рис. 3. Датчик температуры кожи.



Рис. 4. Датчик температуры воздуха.

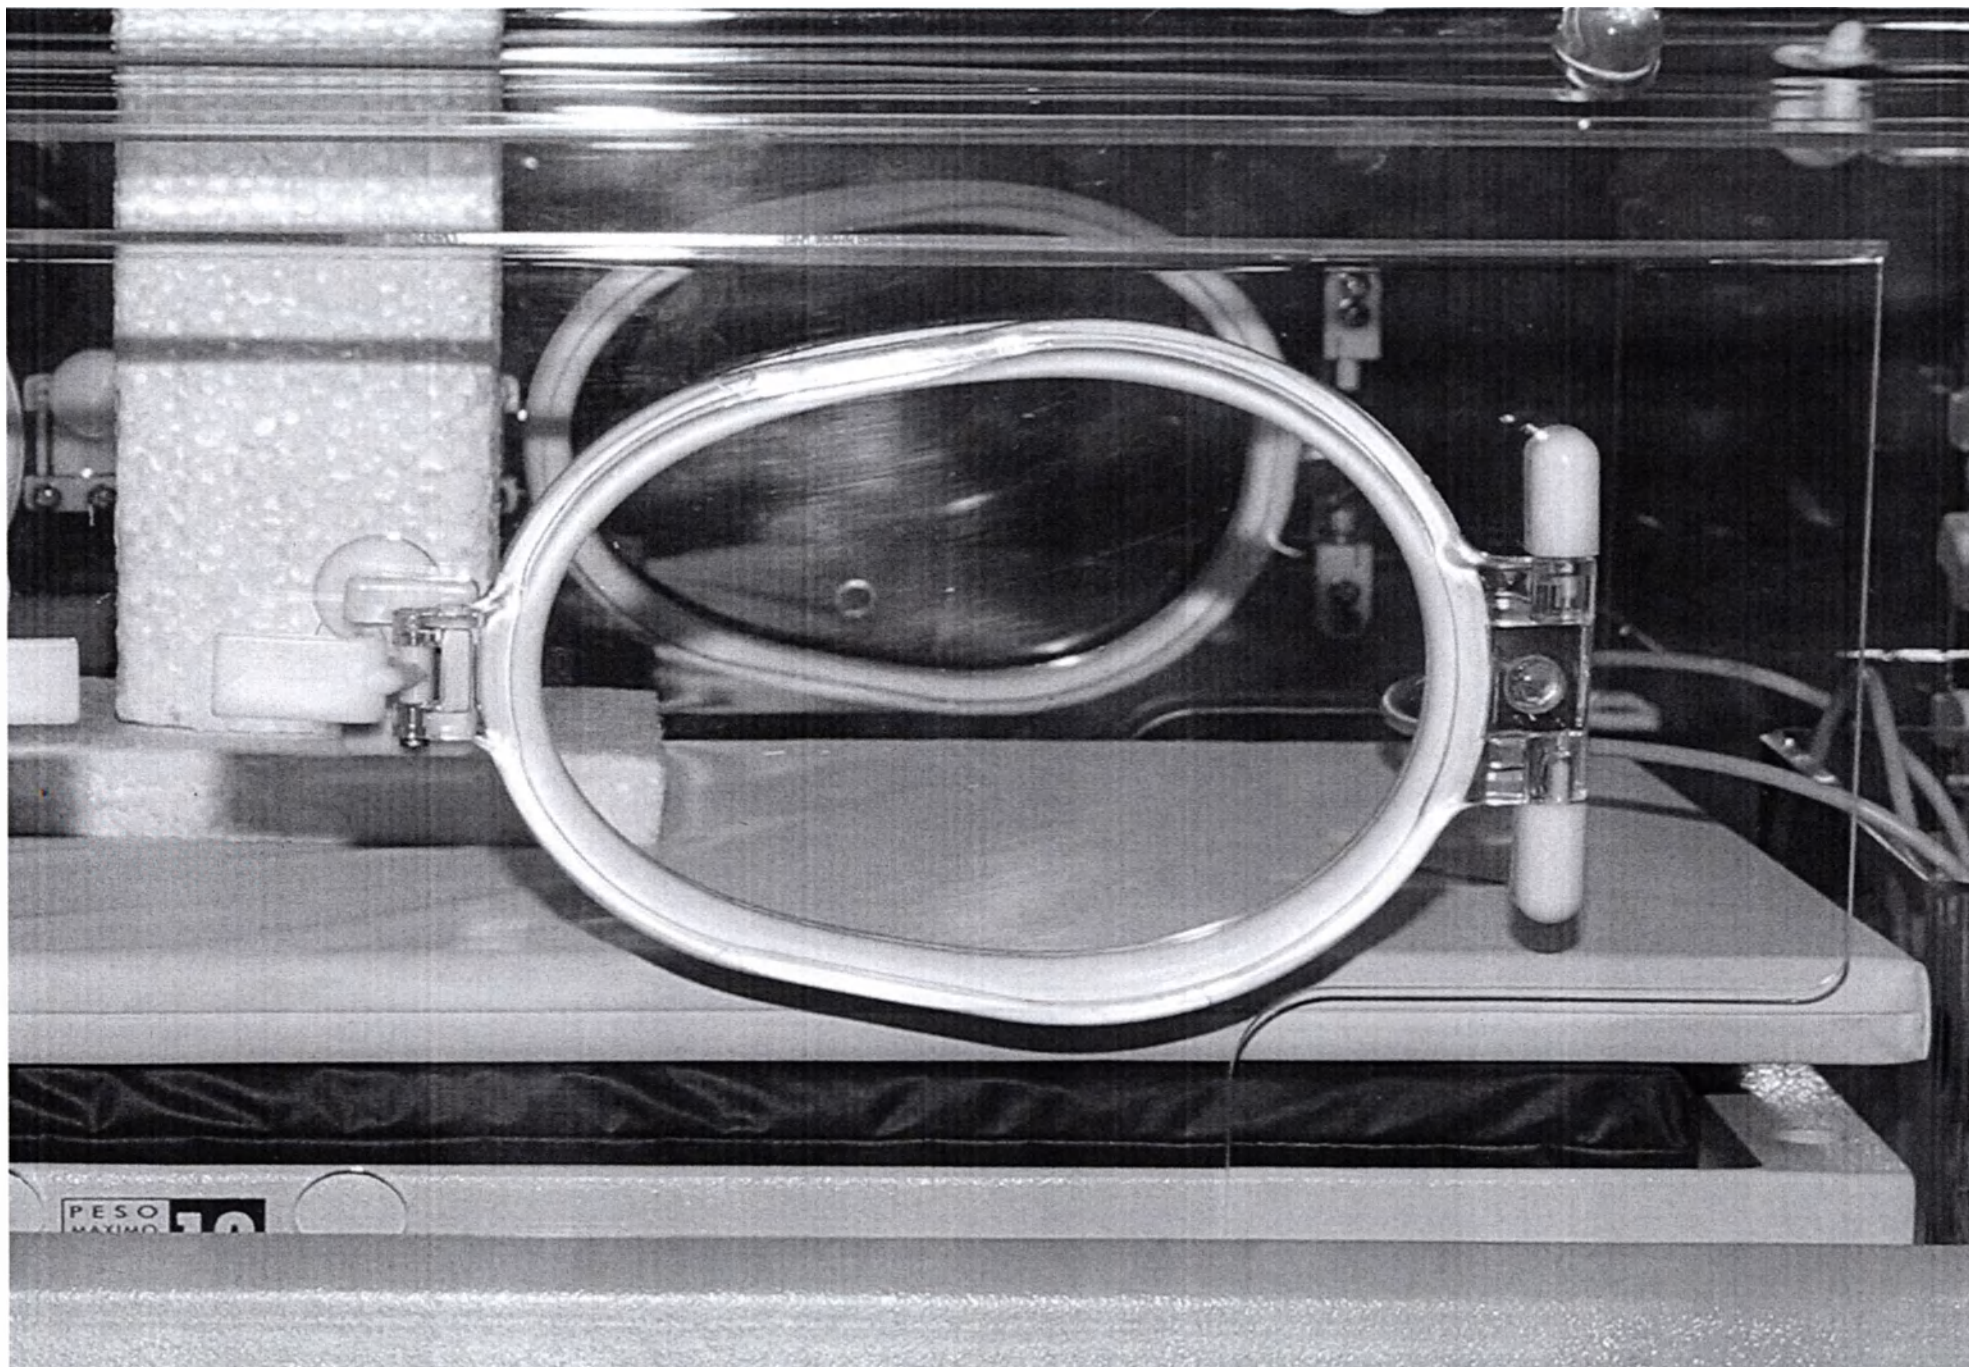
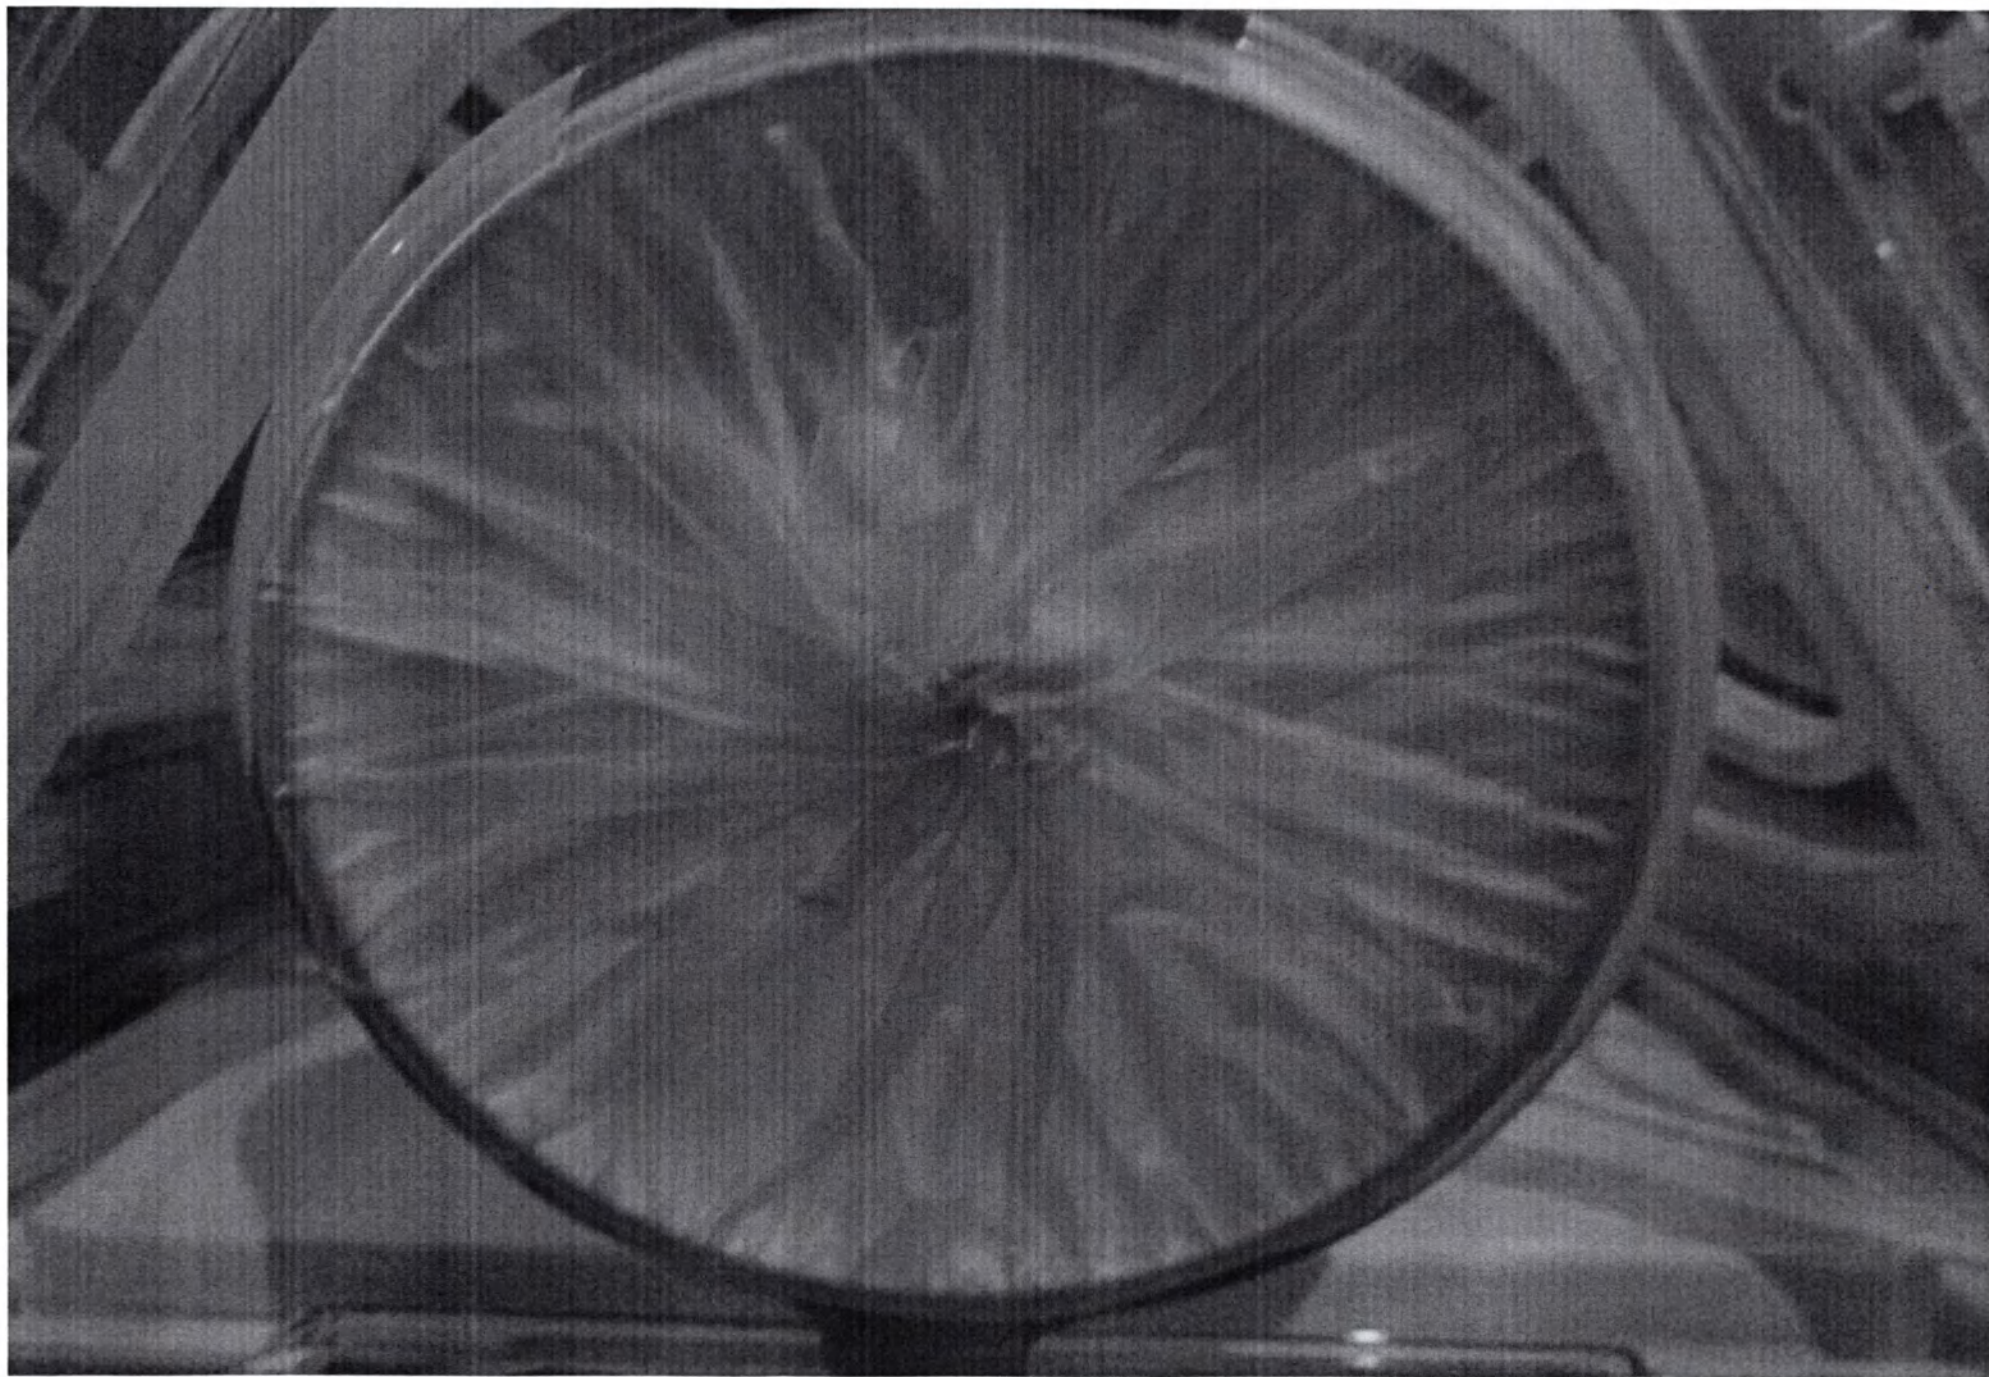


Рис. 5. Порт овальный.



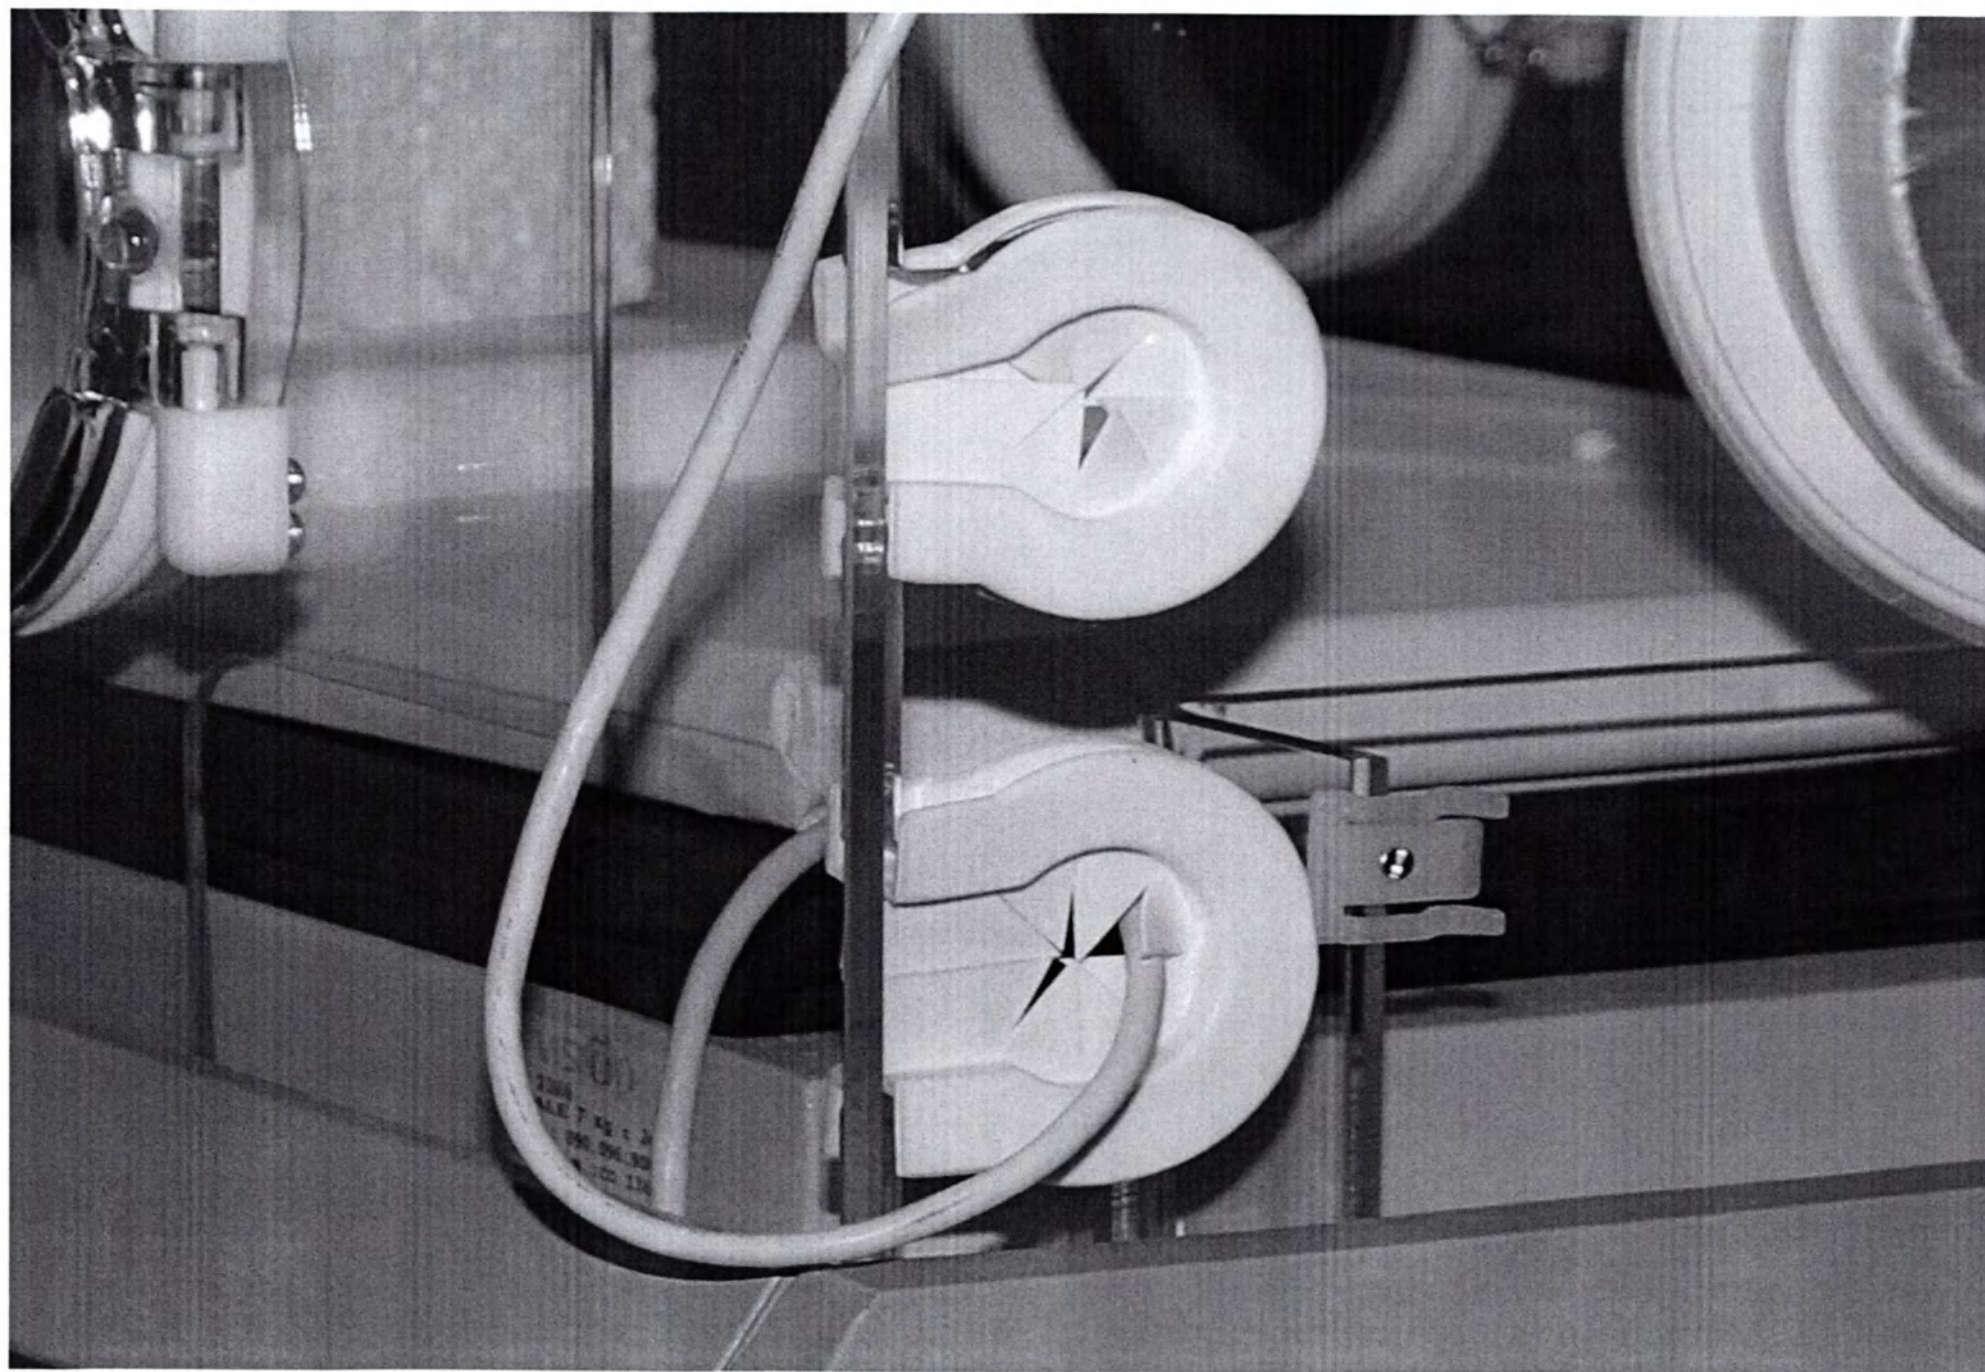


Рис. 7. Втулка изолирующая для шлангов и кабелей.

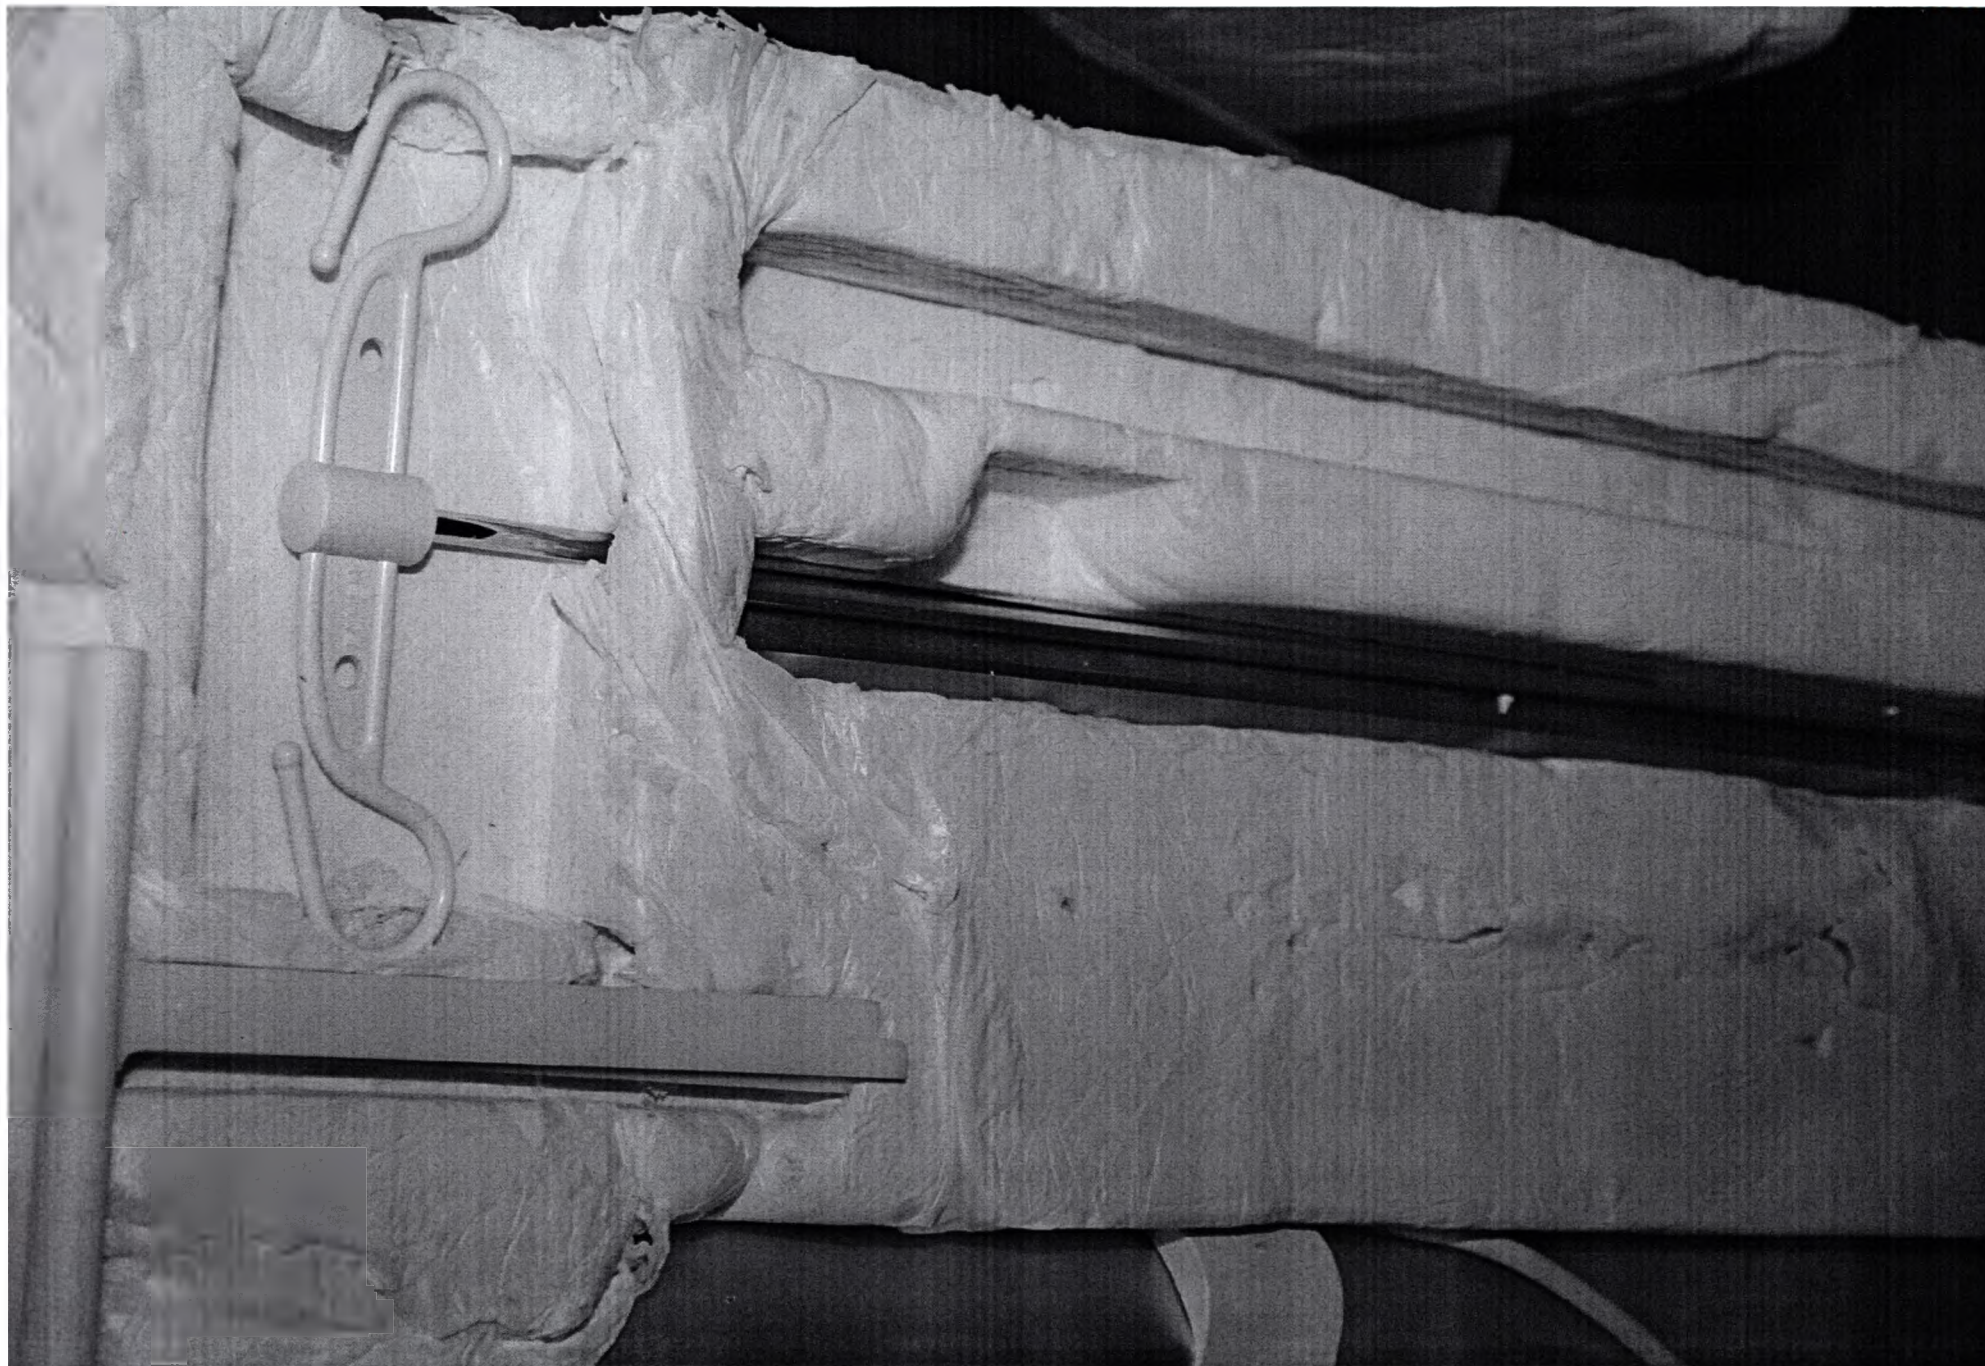




Рис. 9. Полка поворотная.

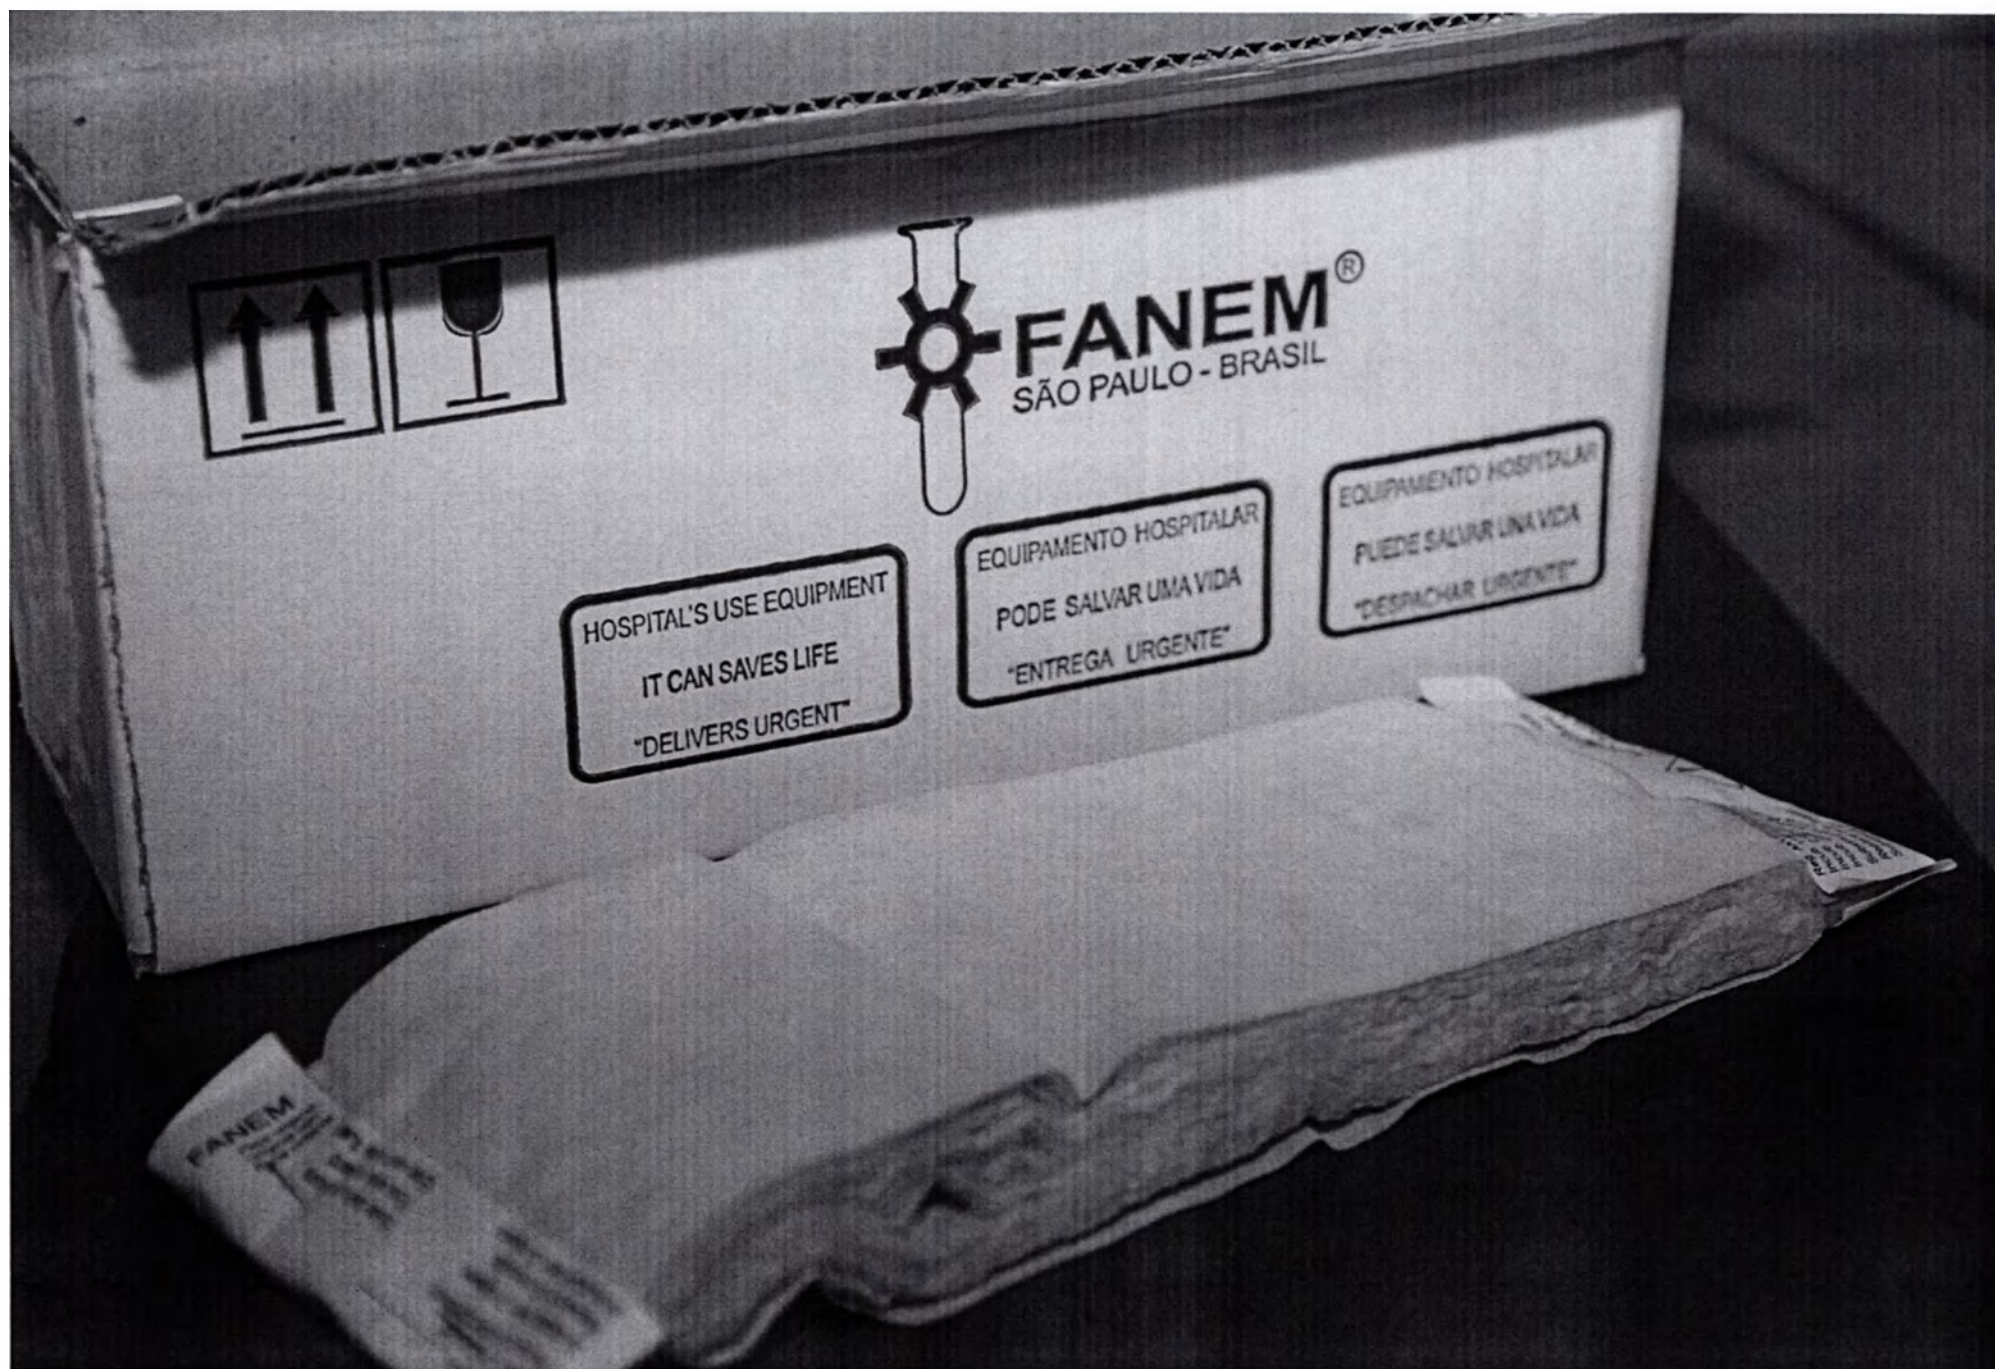
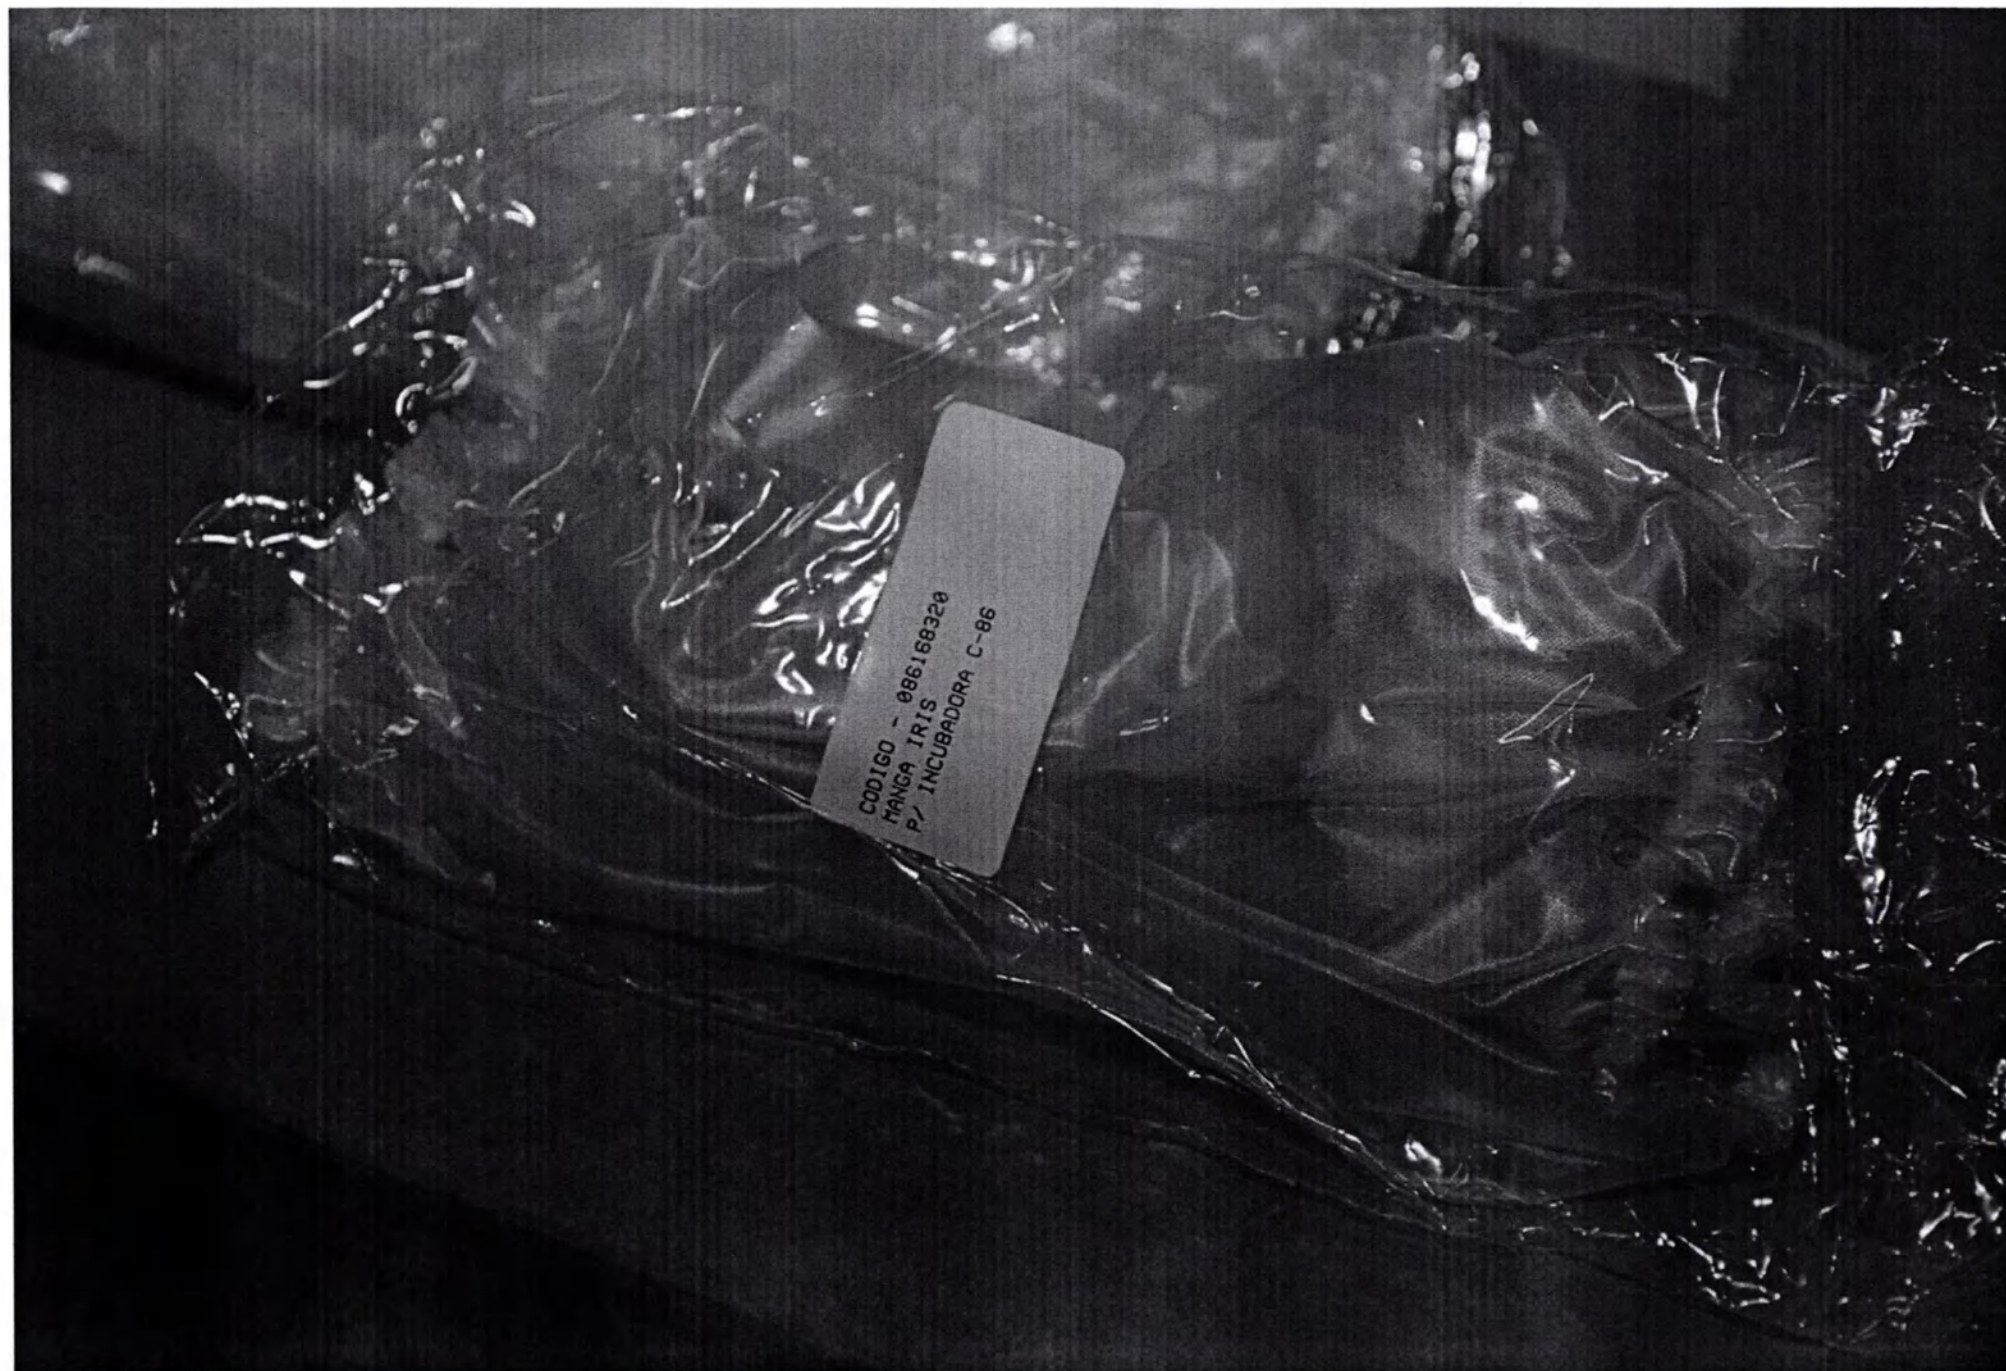


Рис. 10. Фильтр воздушный.







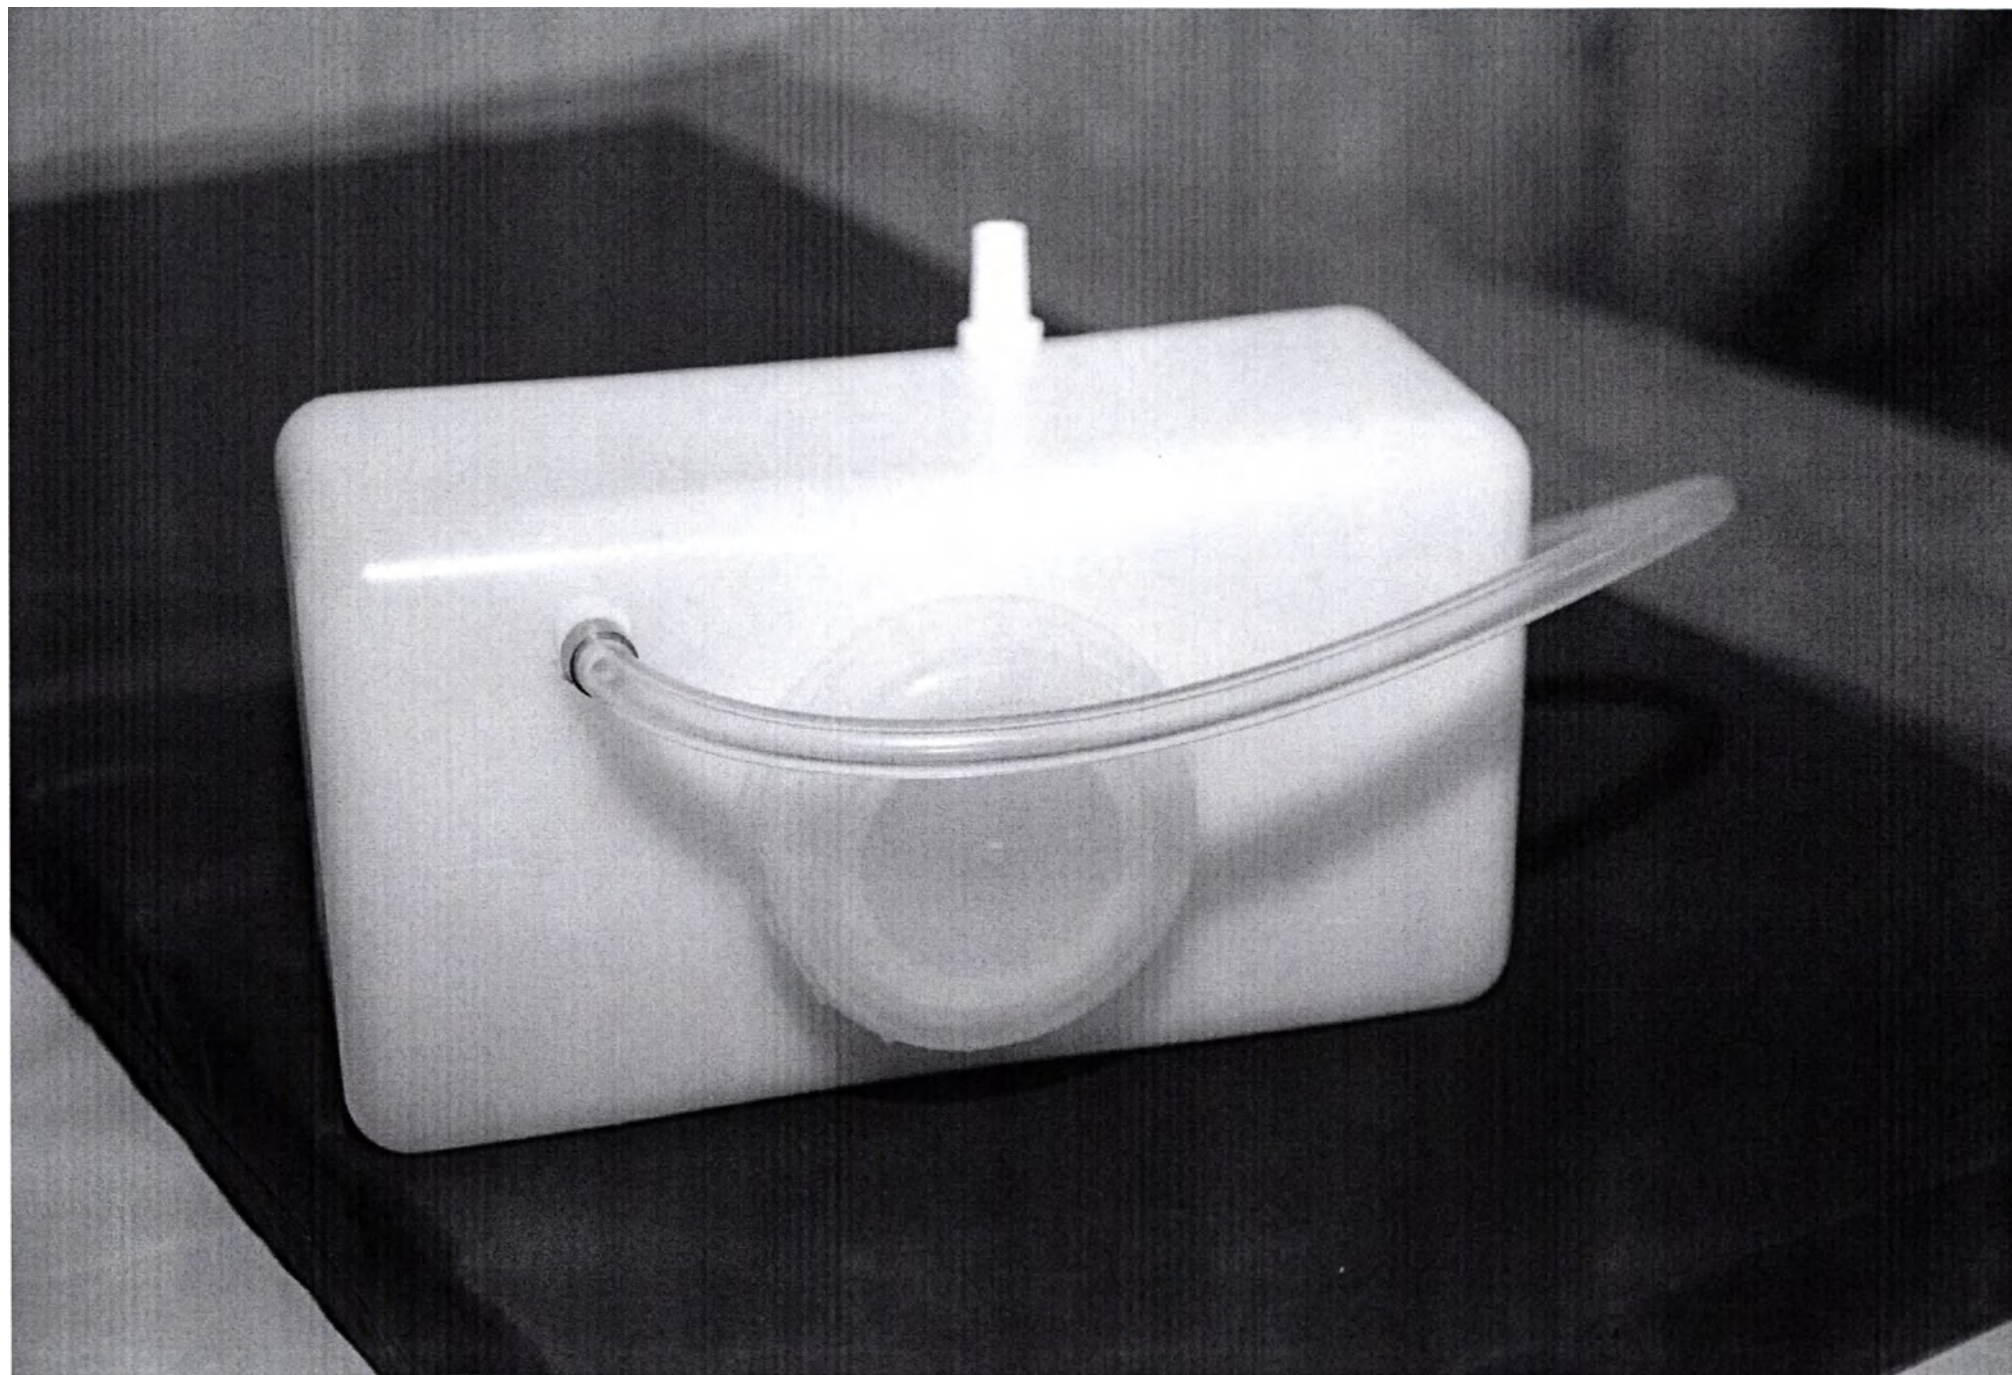


Рис. 14. Резервуар увлажнителя.



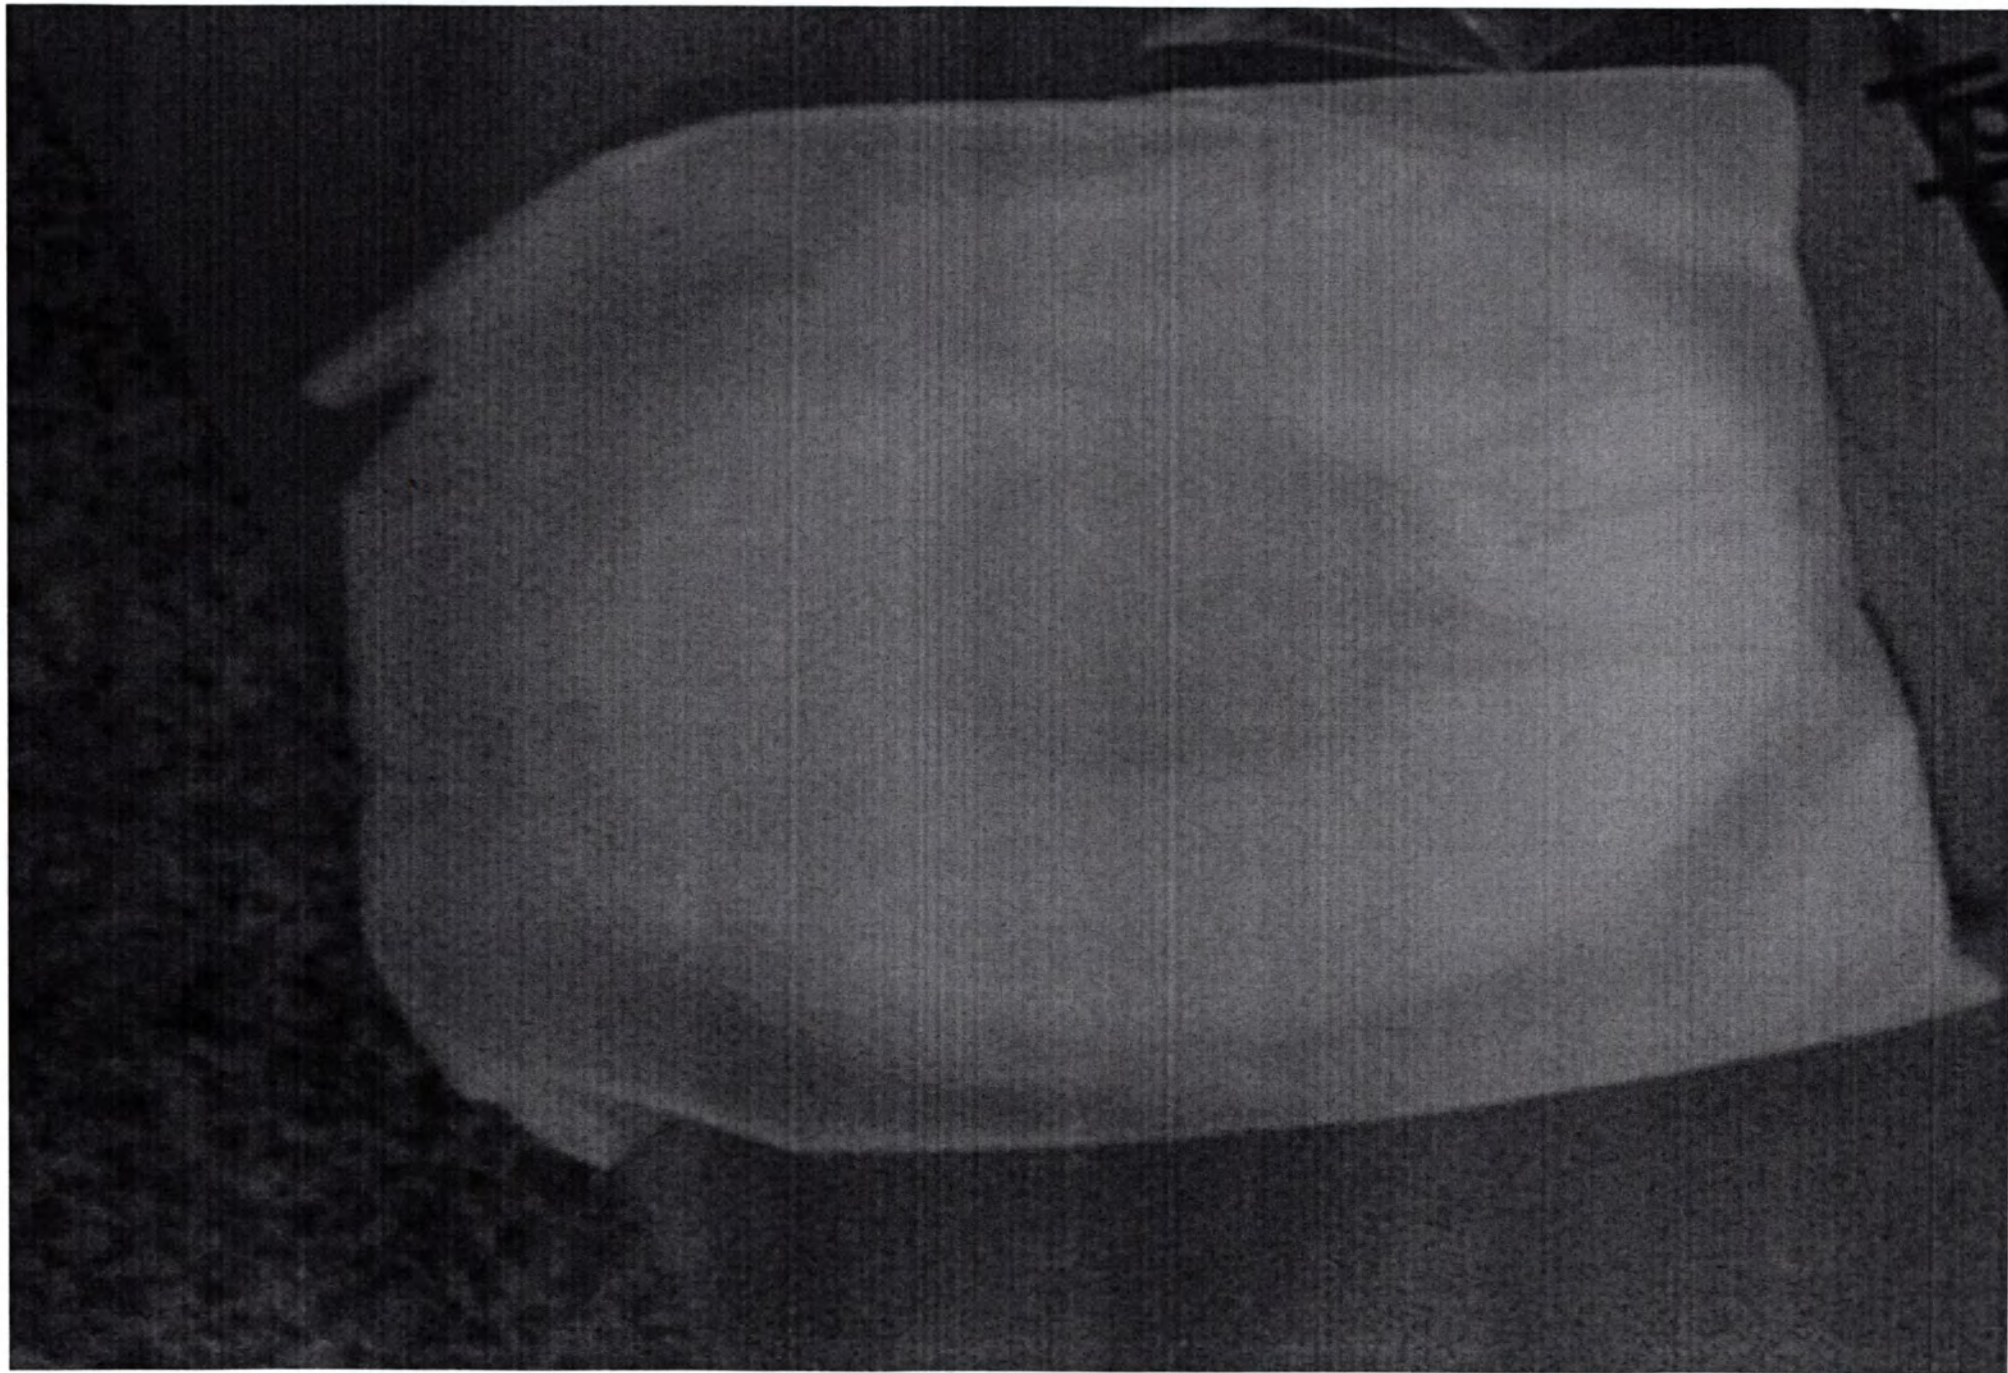


Рис. 15. Подушка неонатальная для фиксации головы.



Рис. 16. Шлем акриловый с кислородным клапаном.

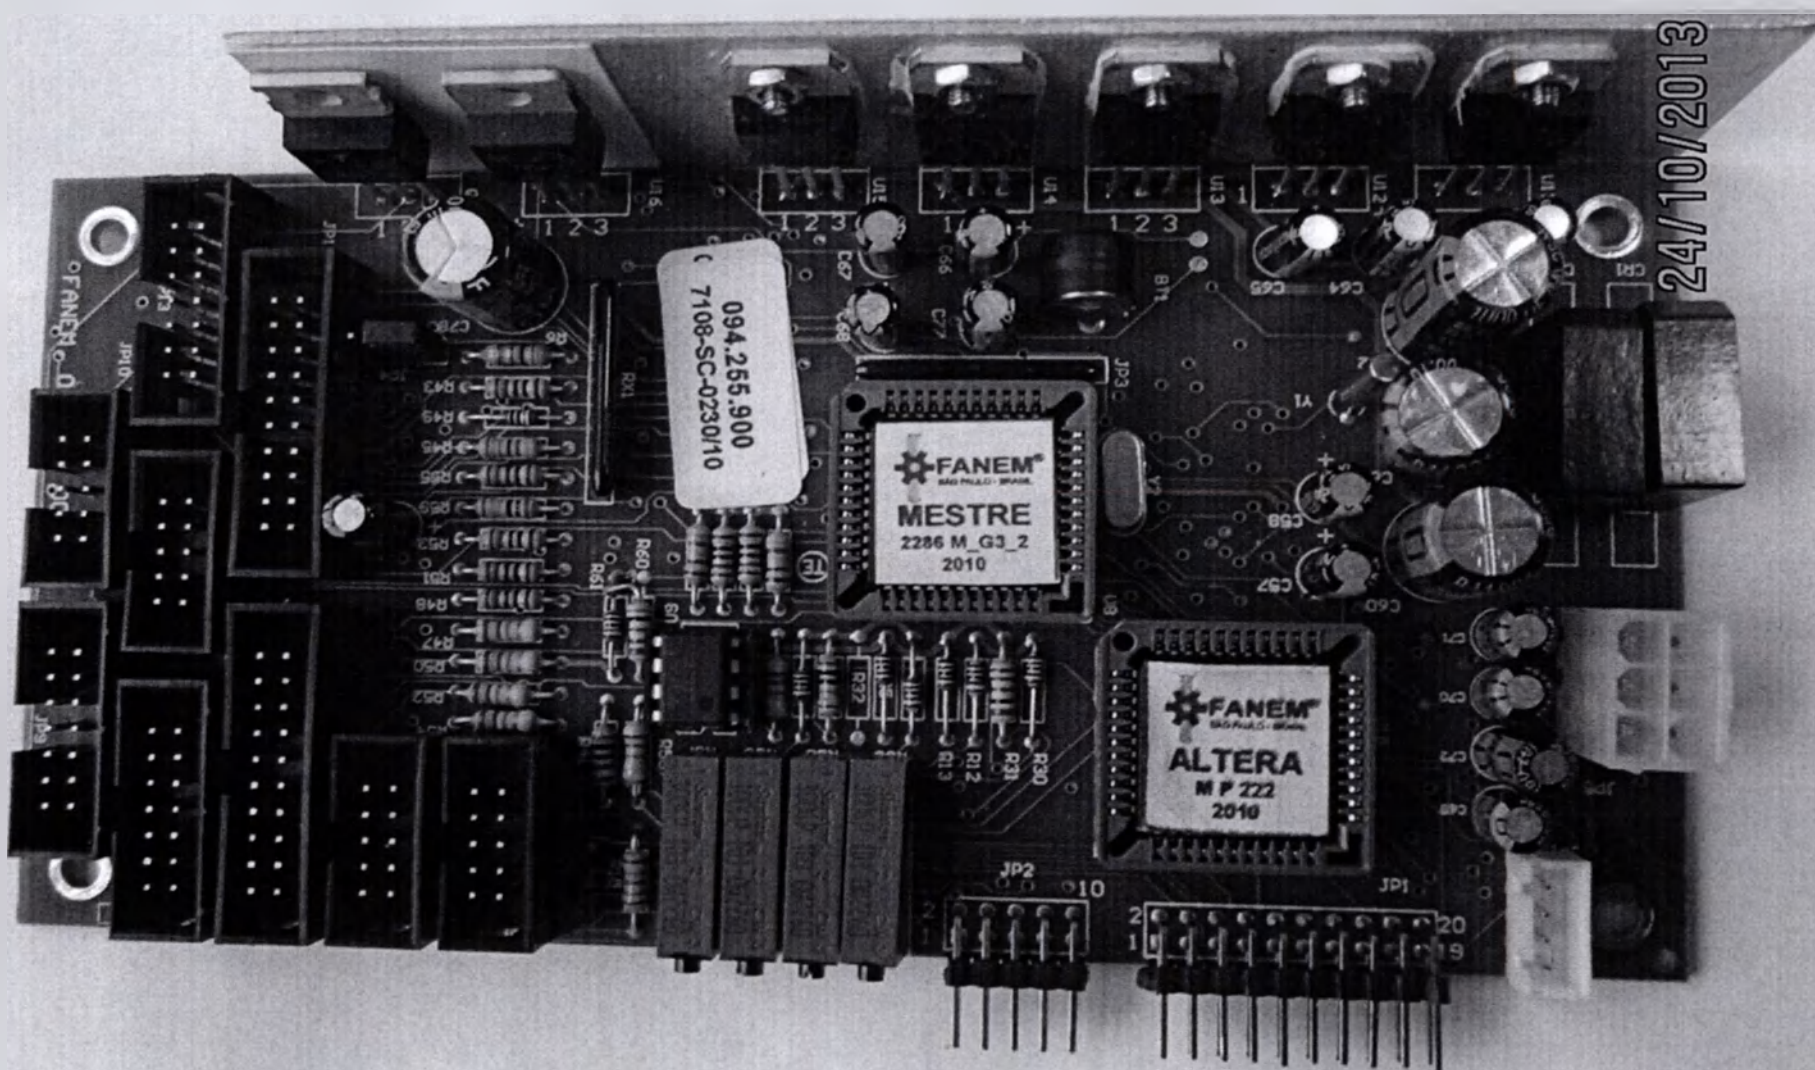

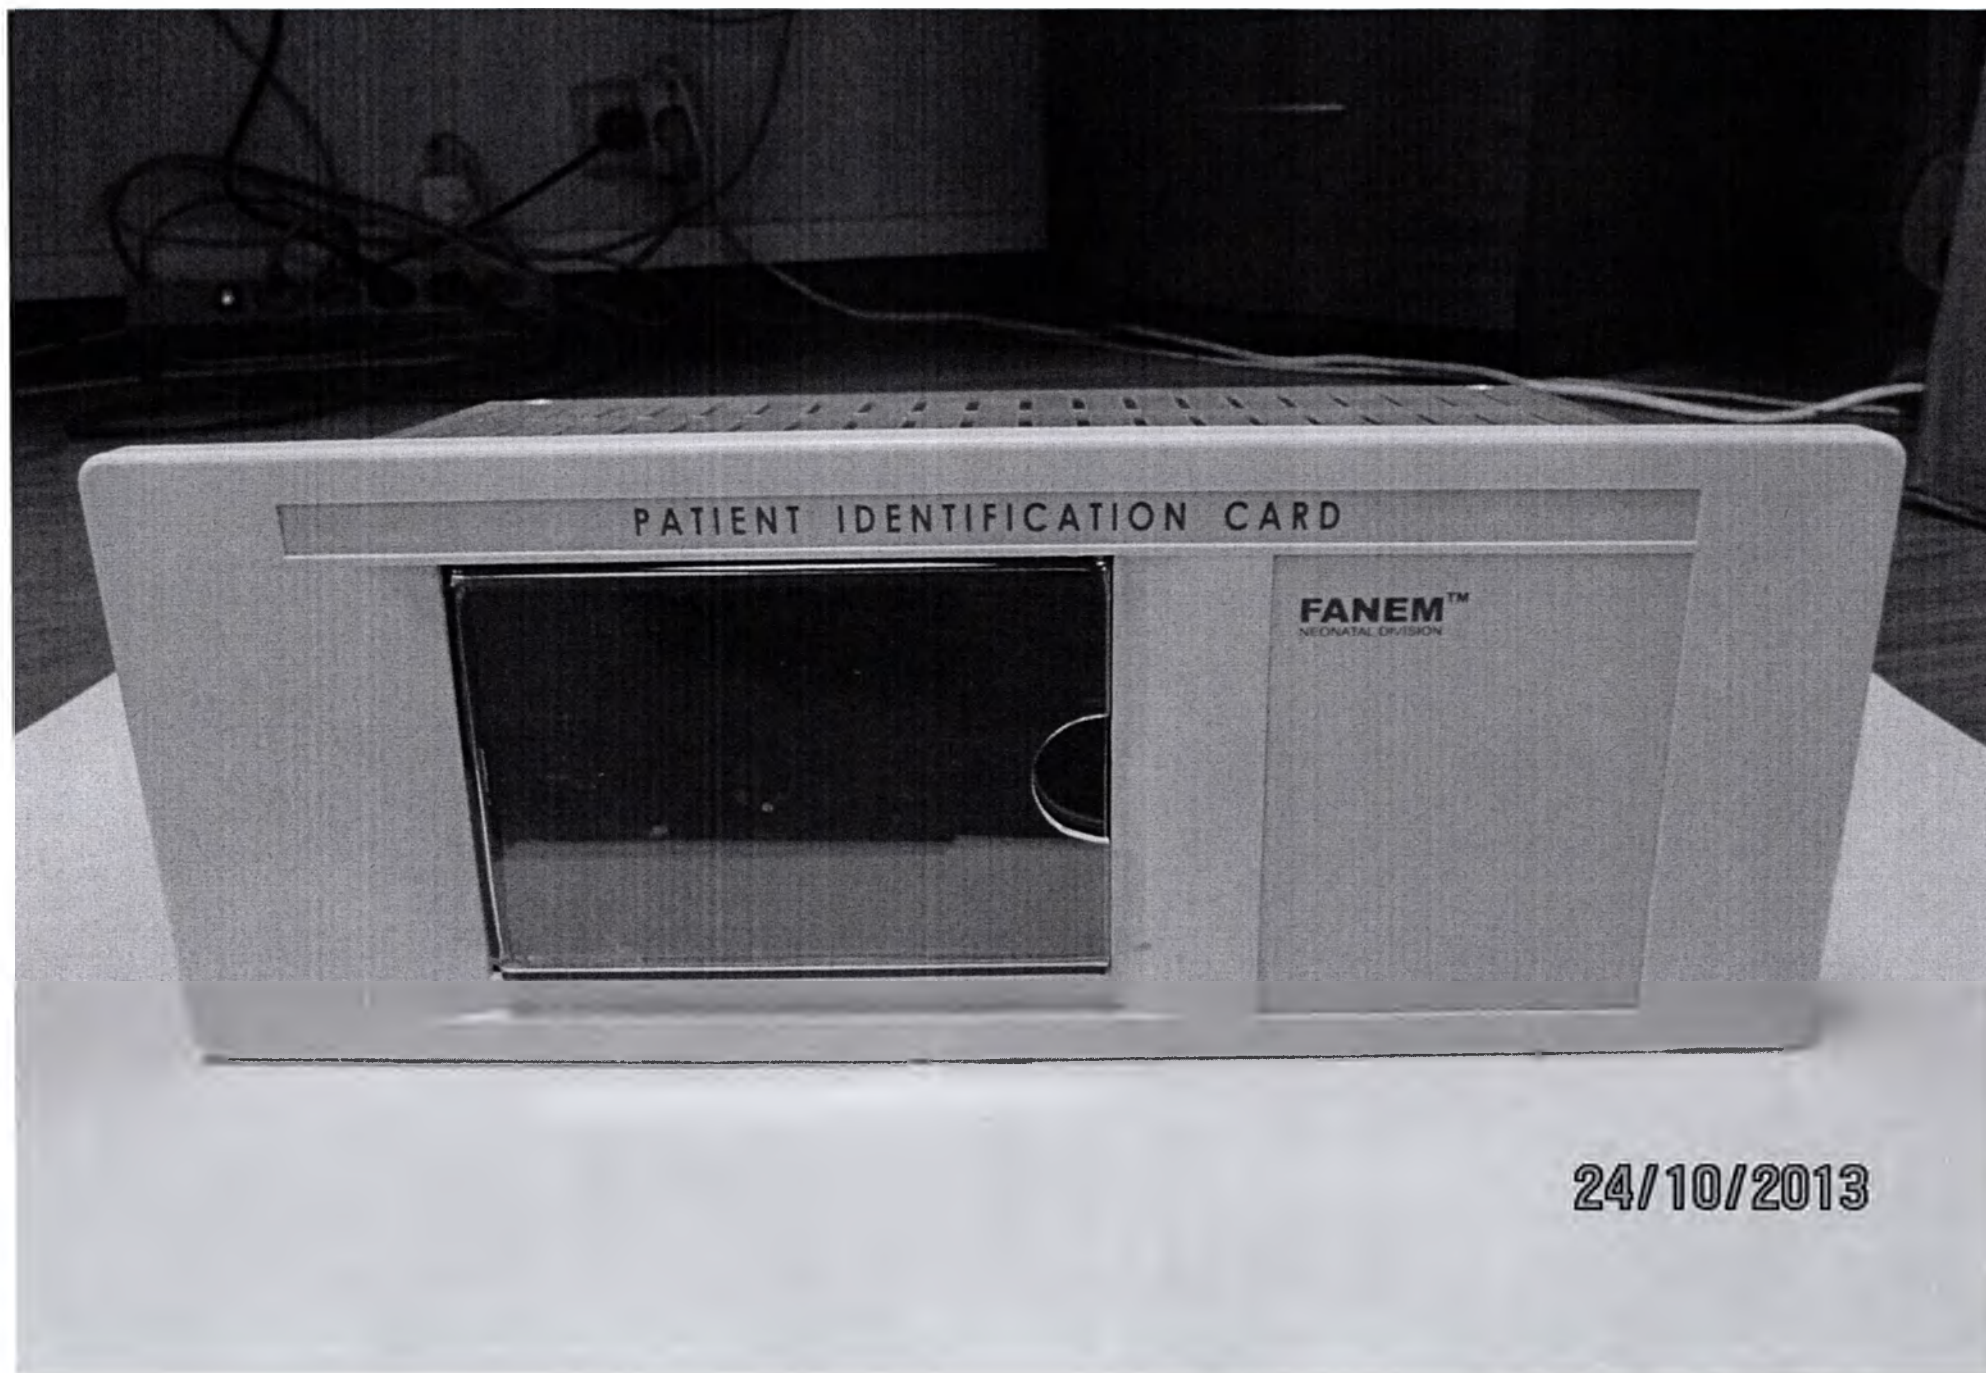

24/10/2013

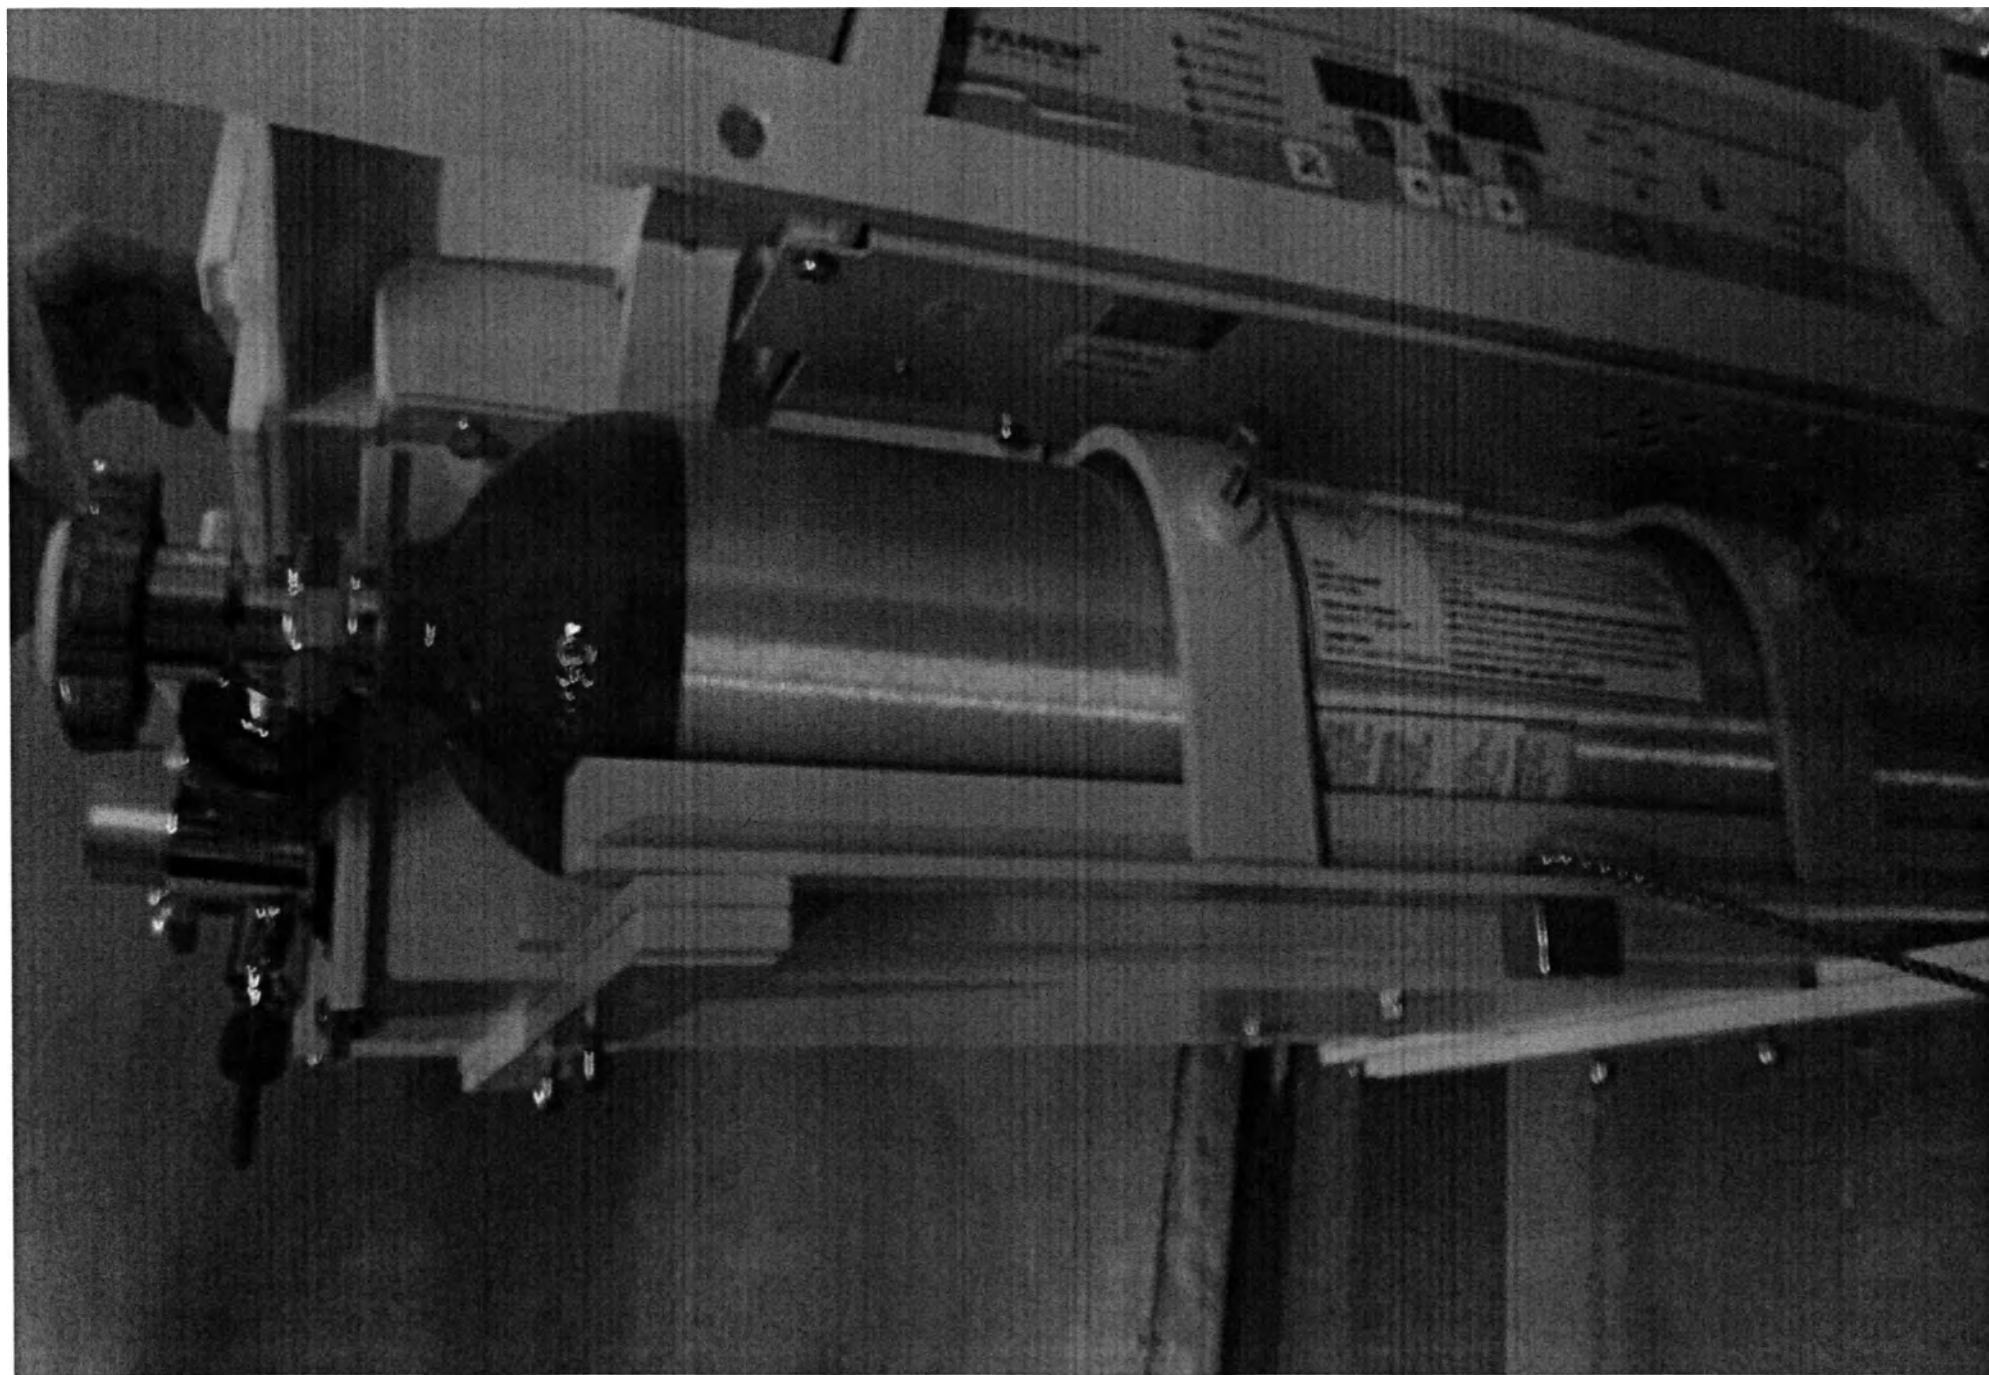
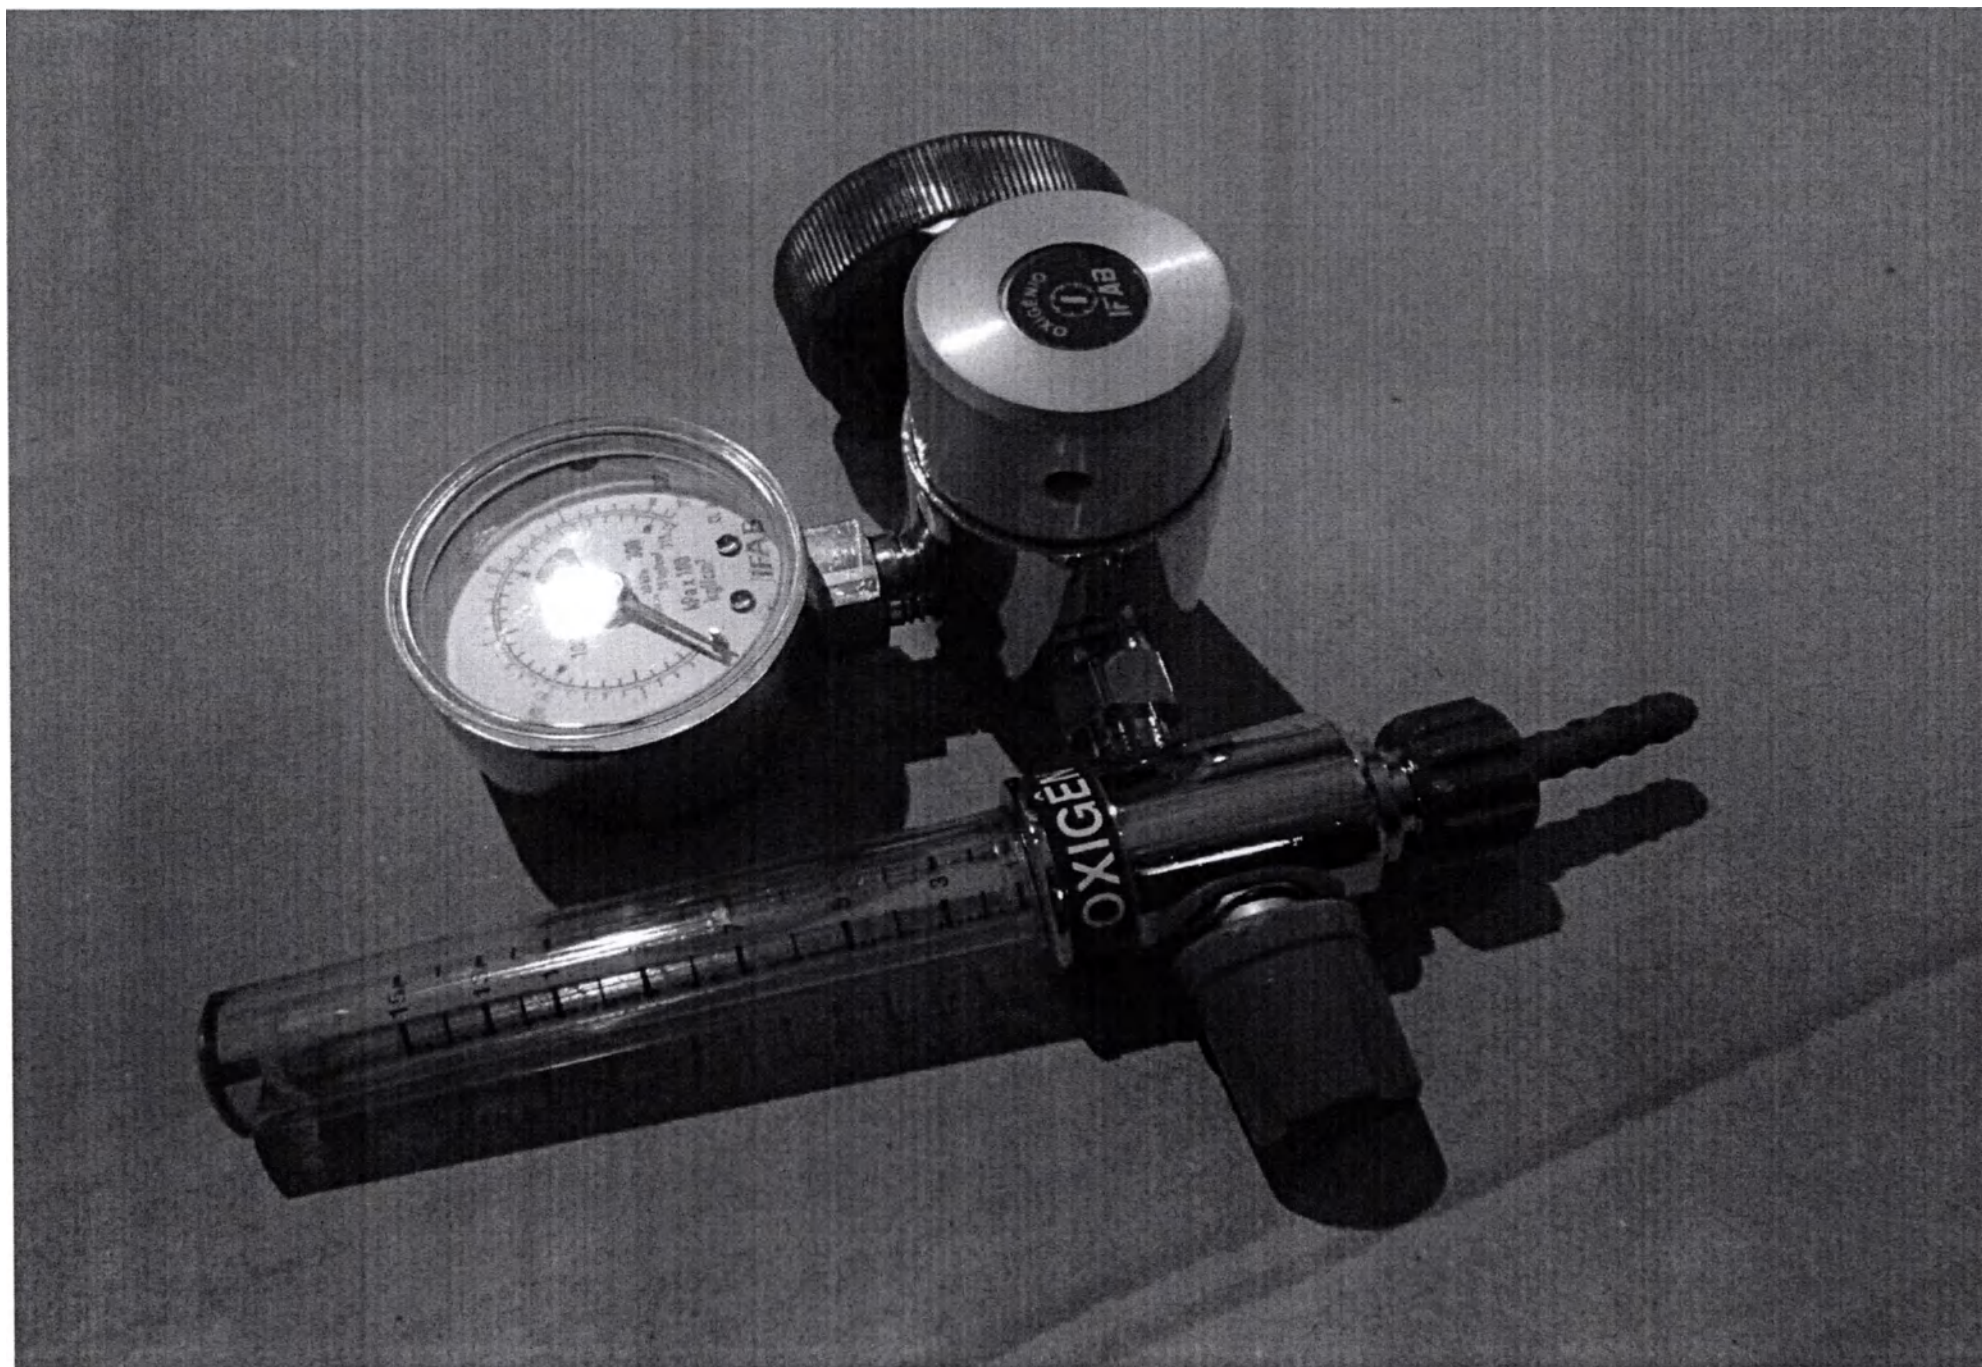


Рис. 19. Баллон для кислорода.



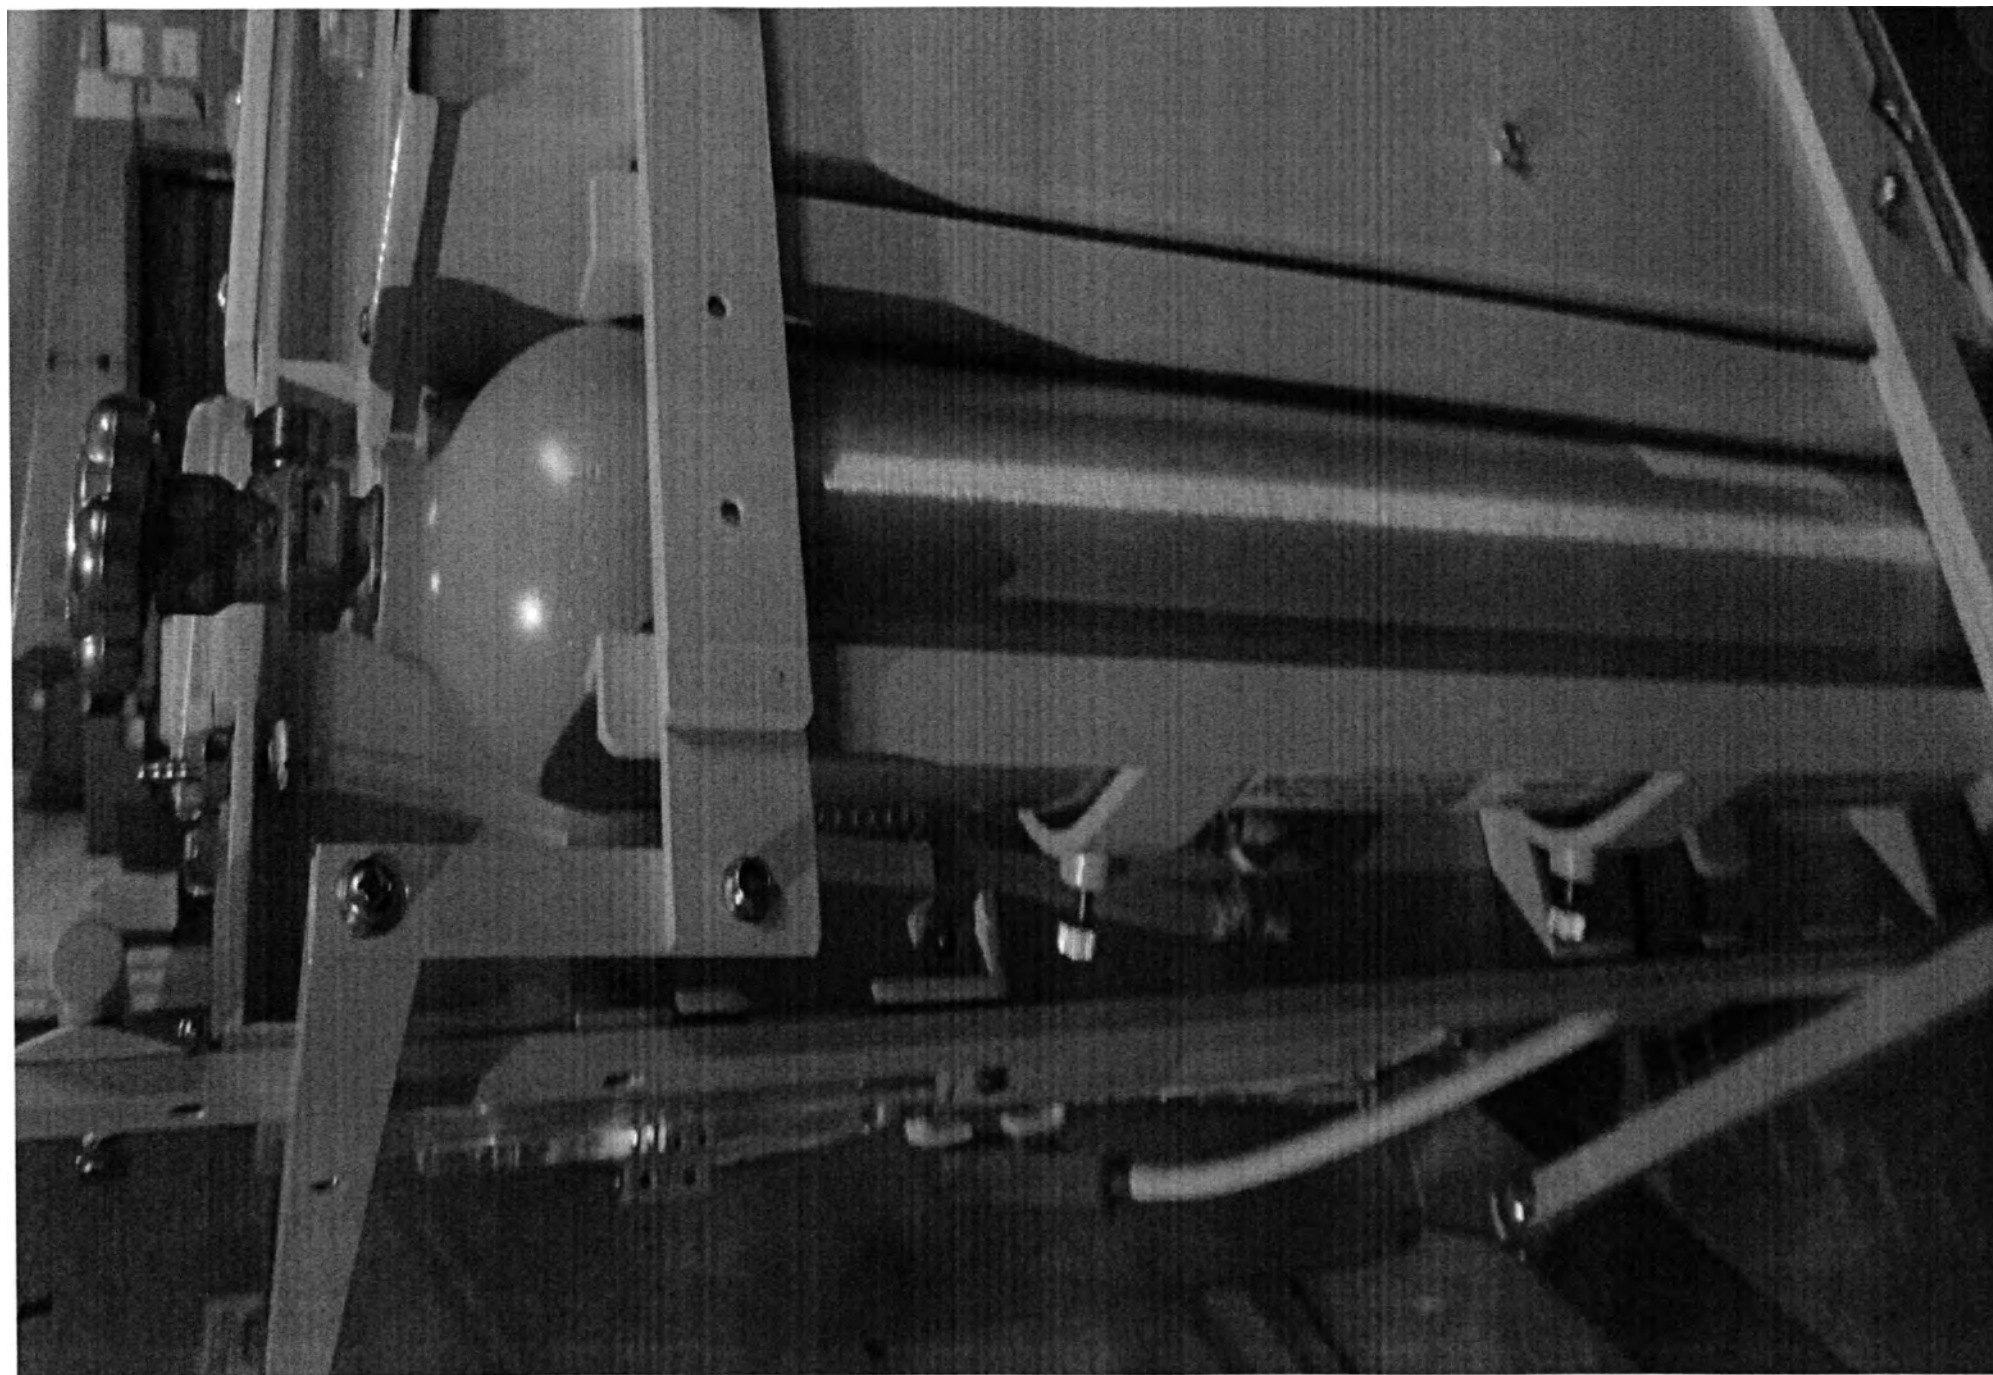


Рис. 21. Баллон для воздуха.

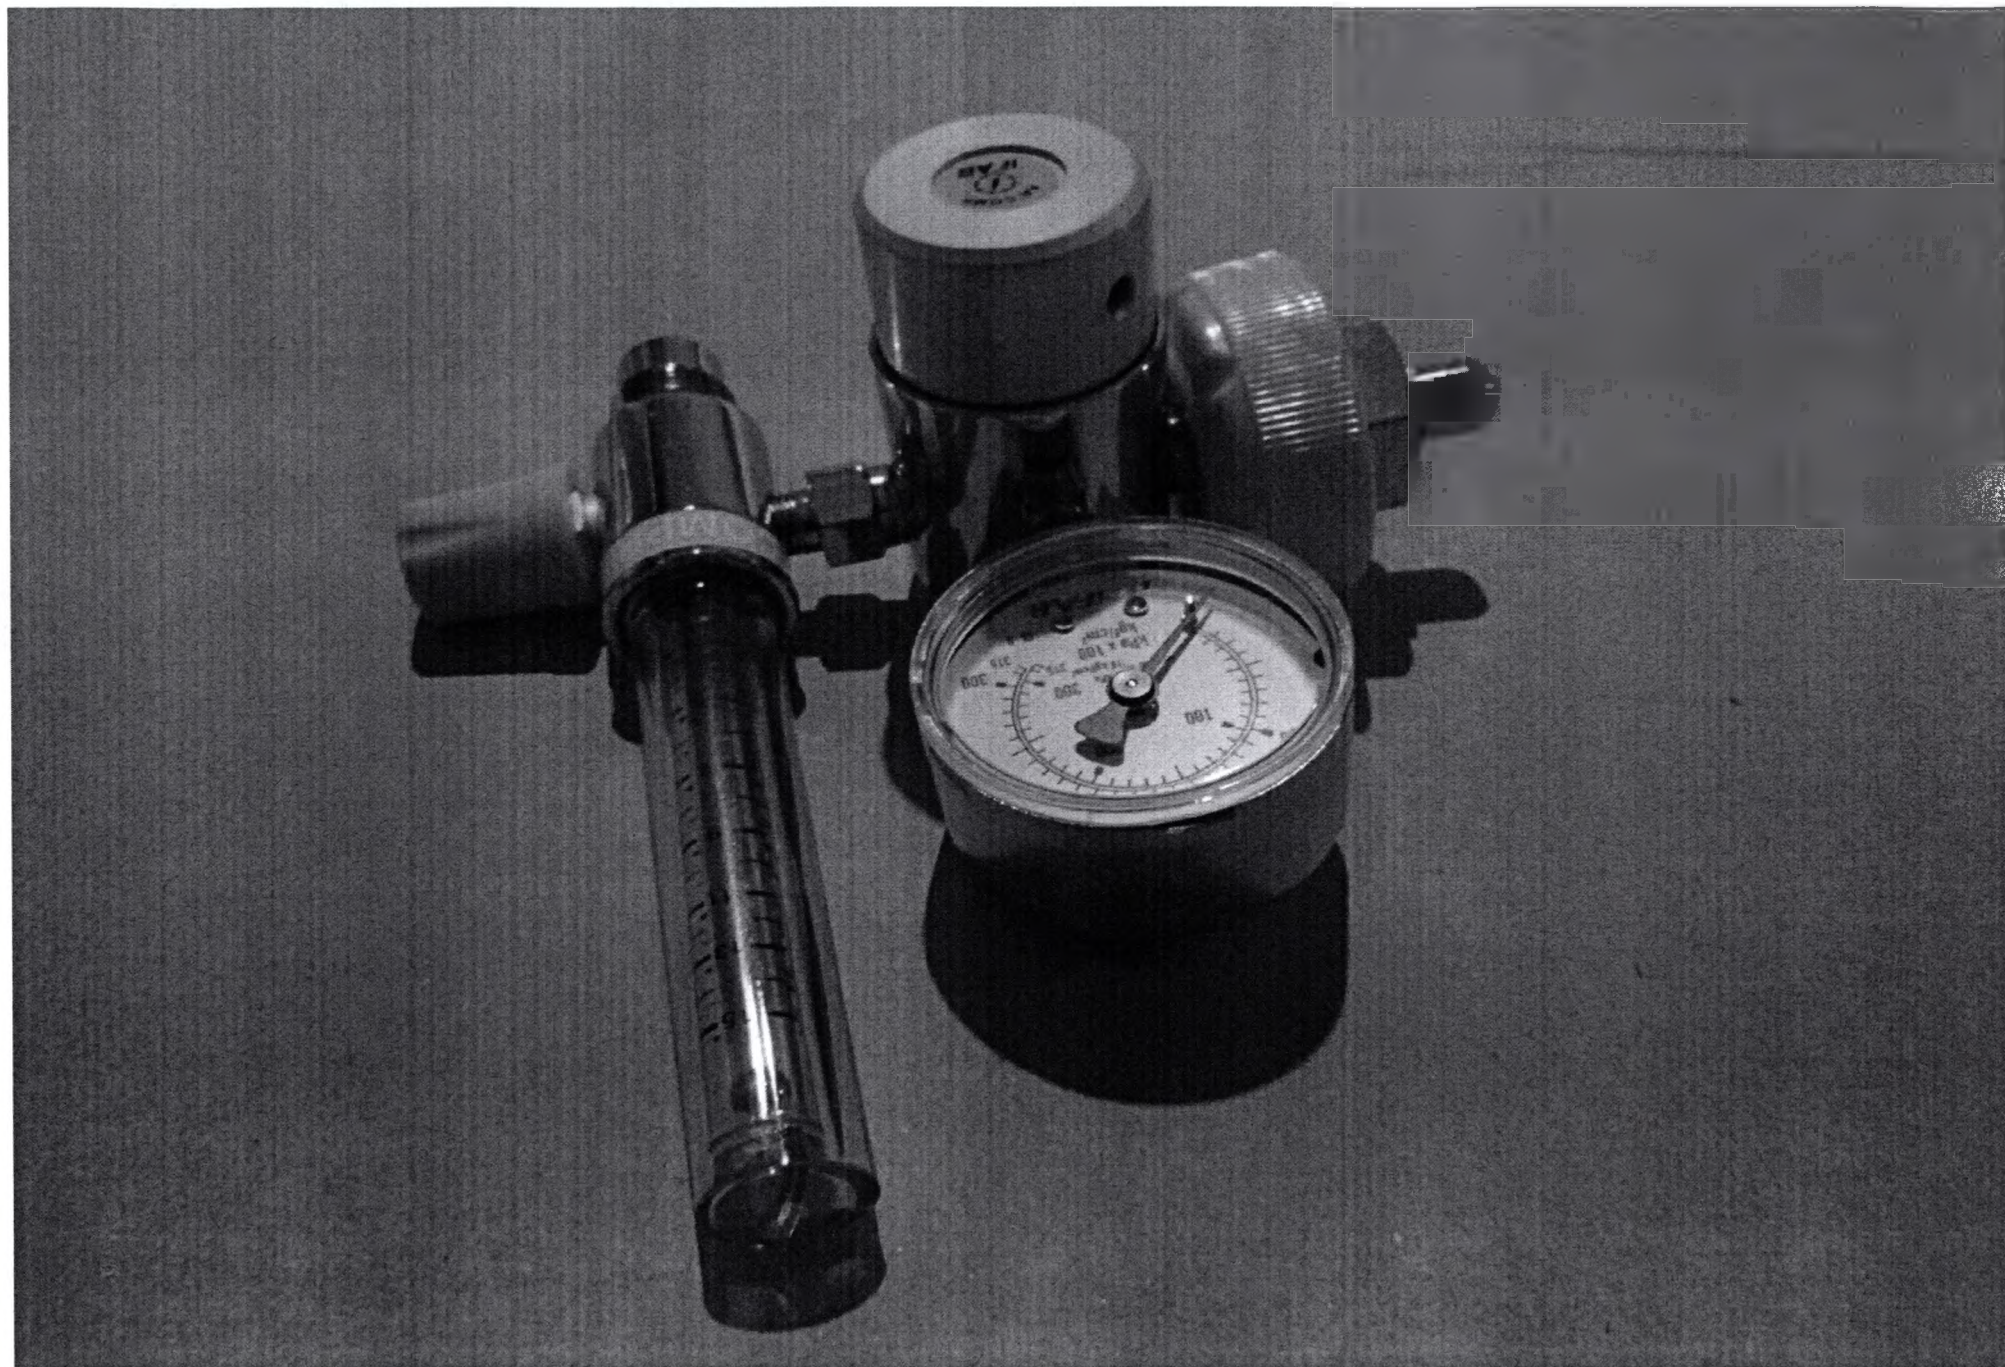
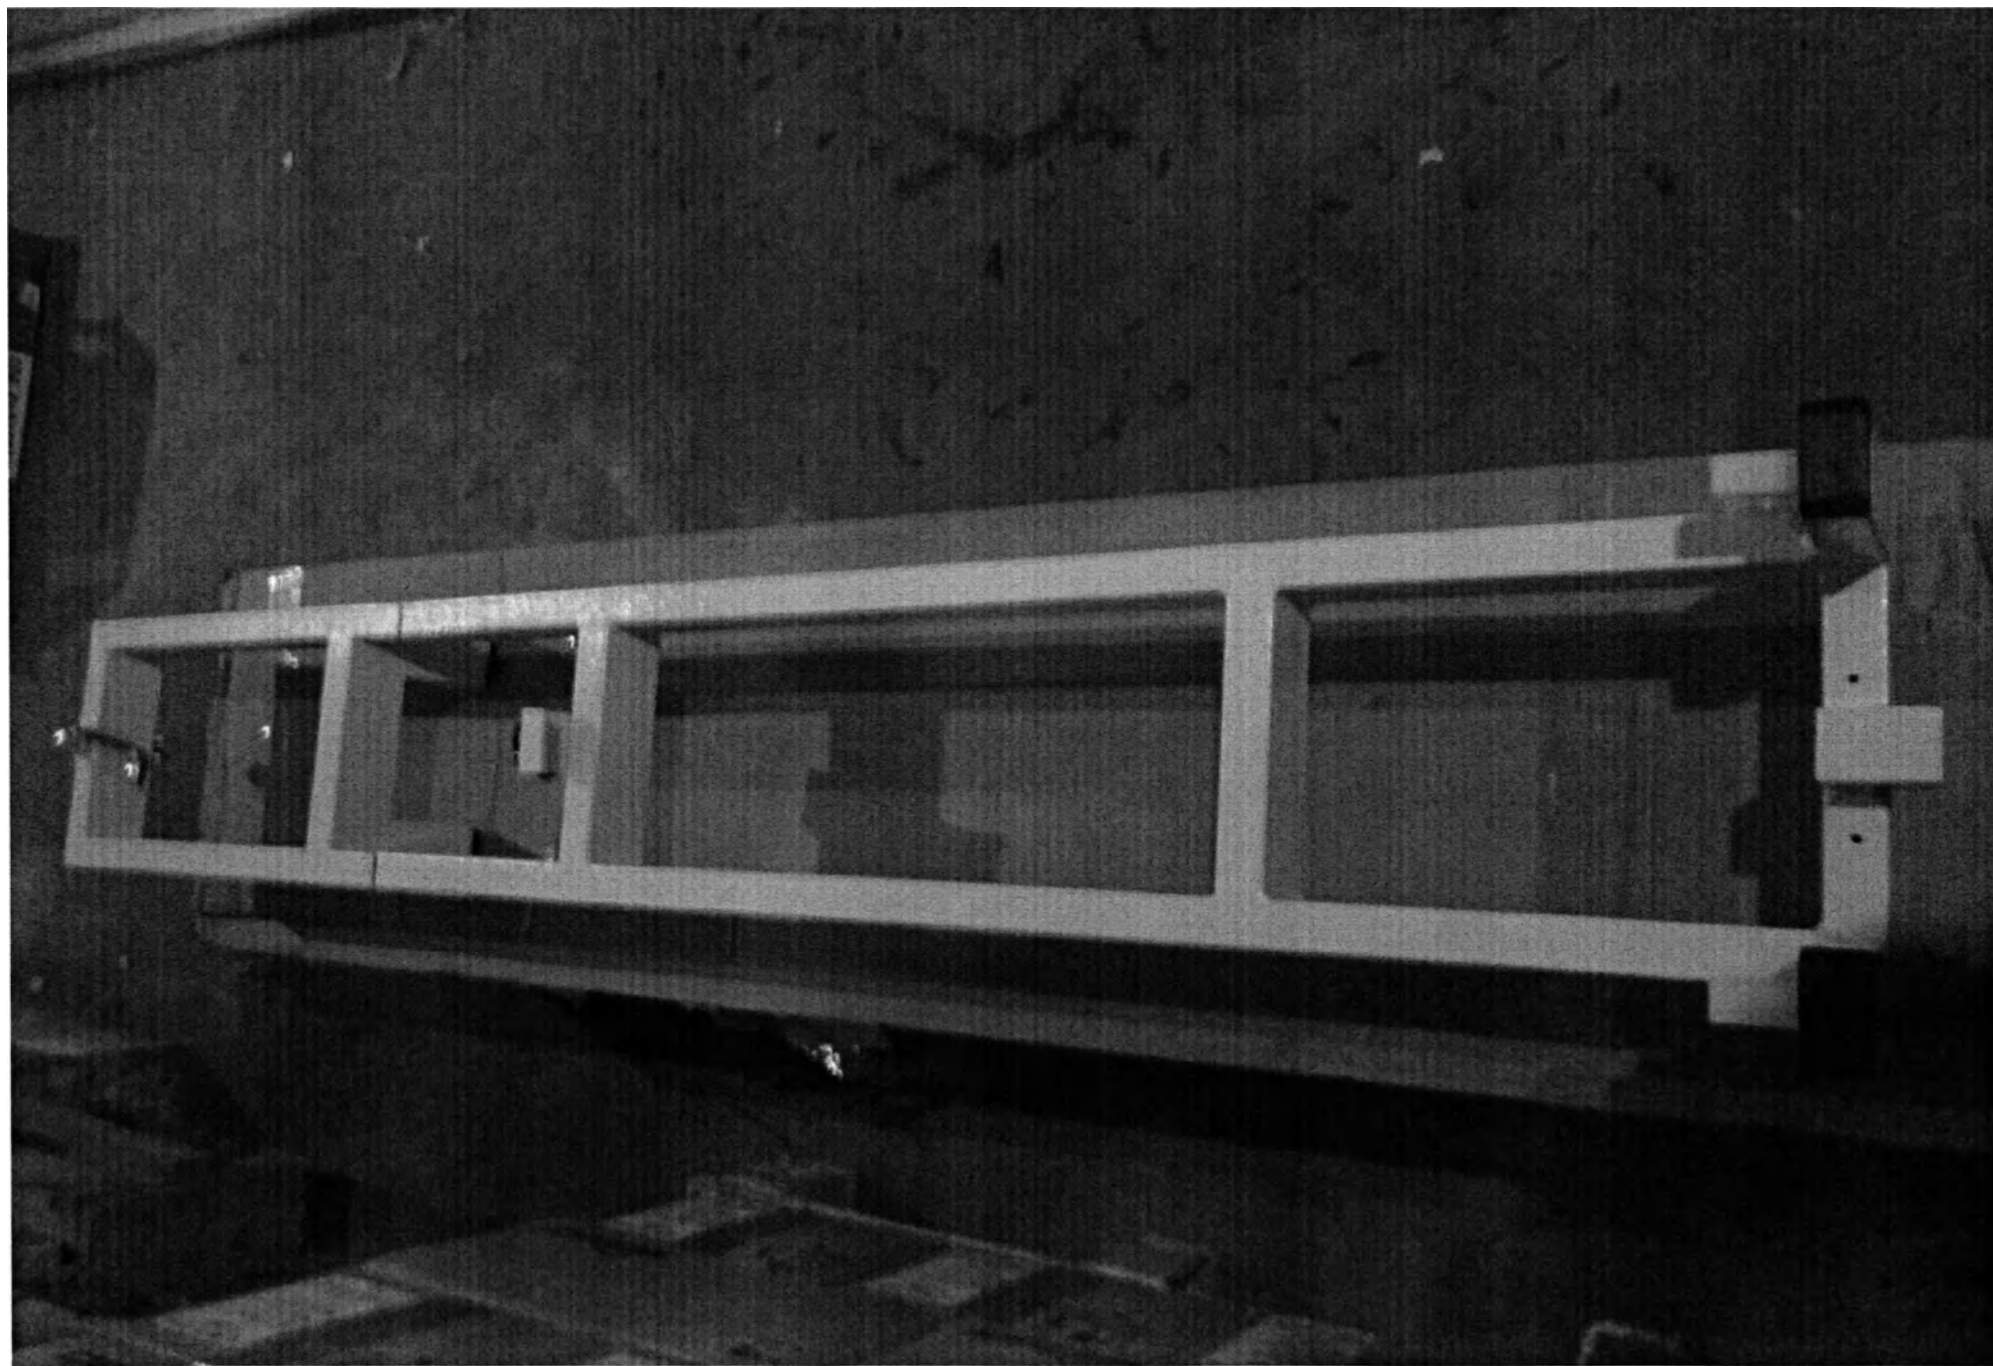


Рис. 22. Редуктор с флоуметром для воздушного баллона.



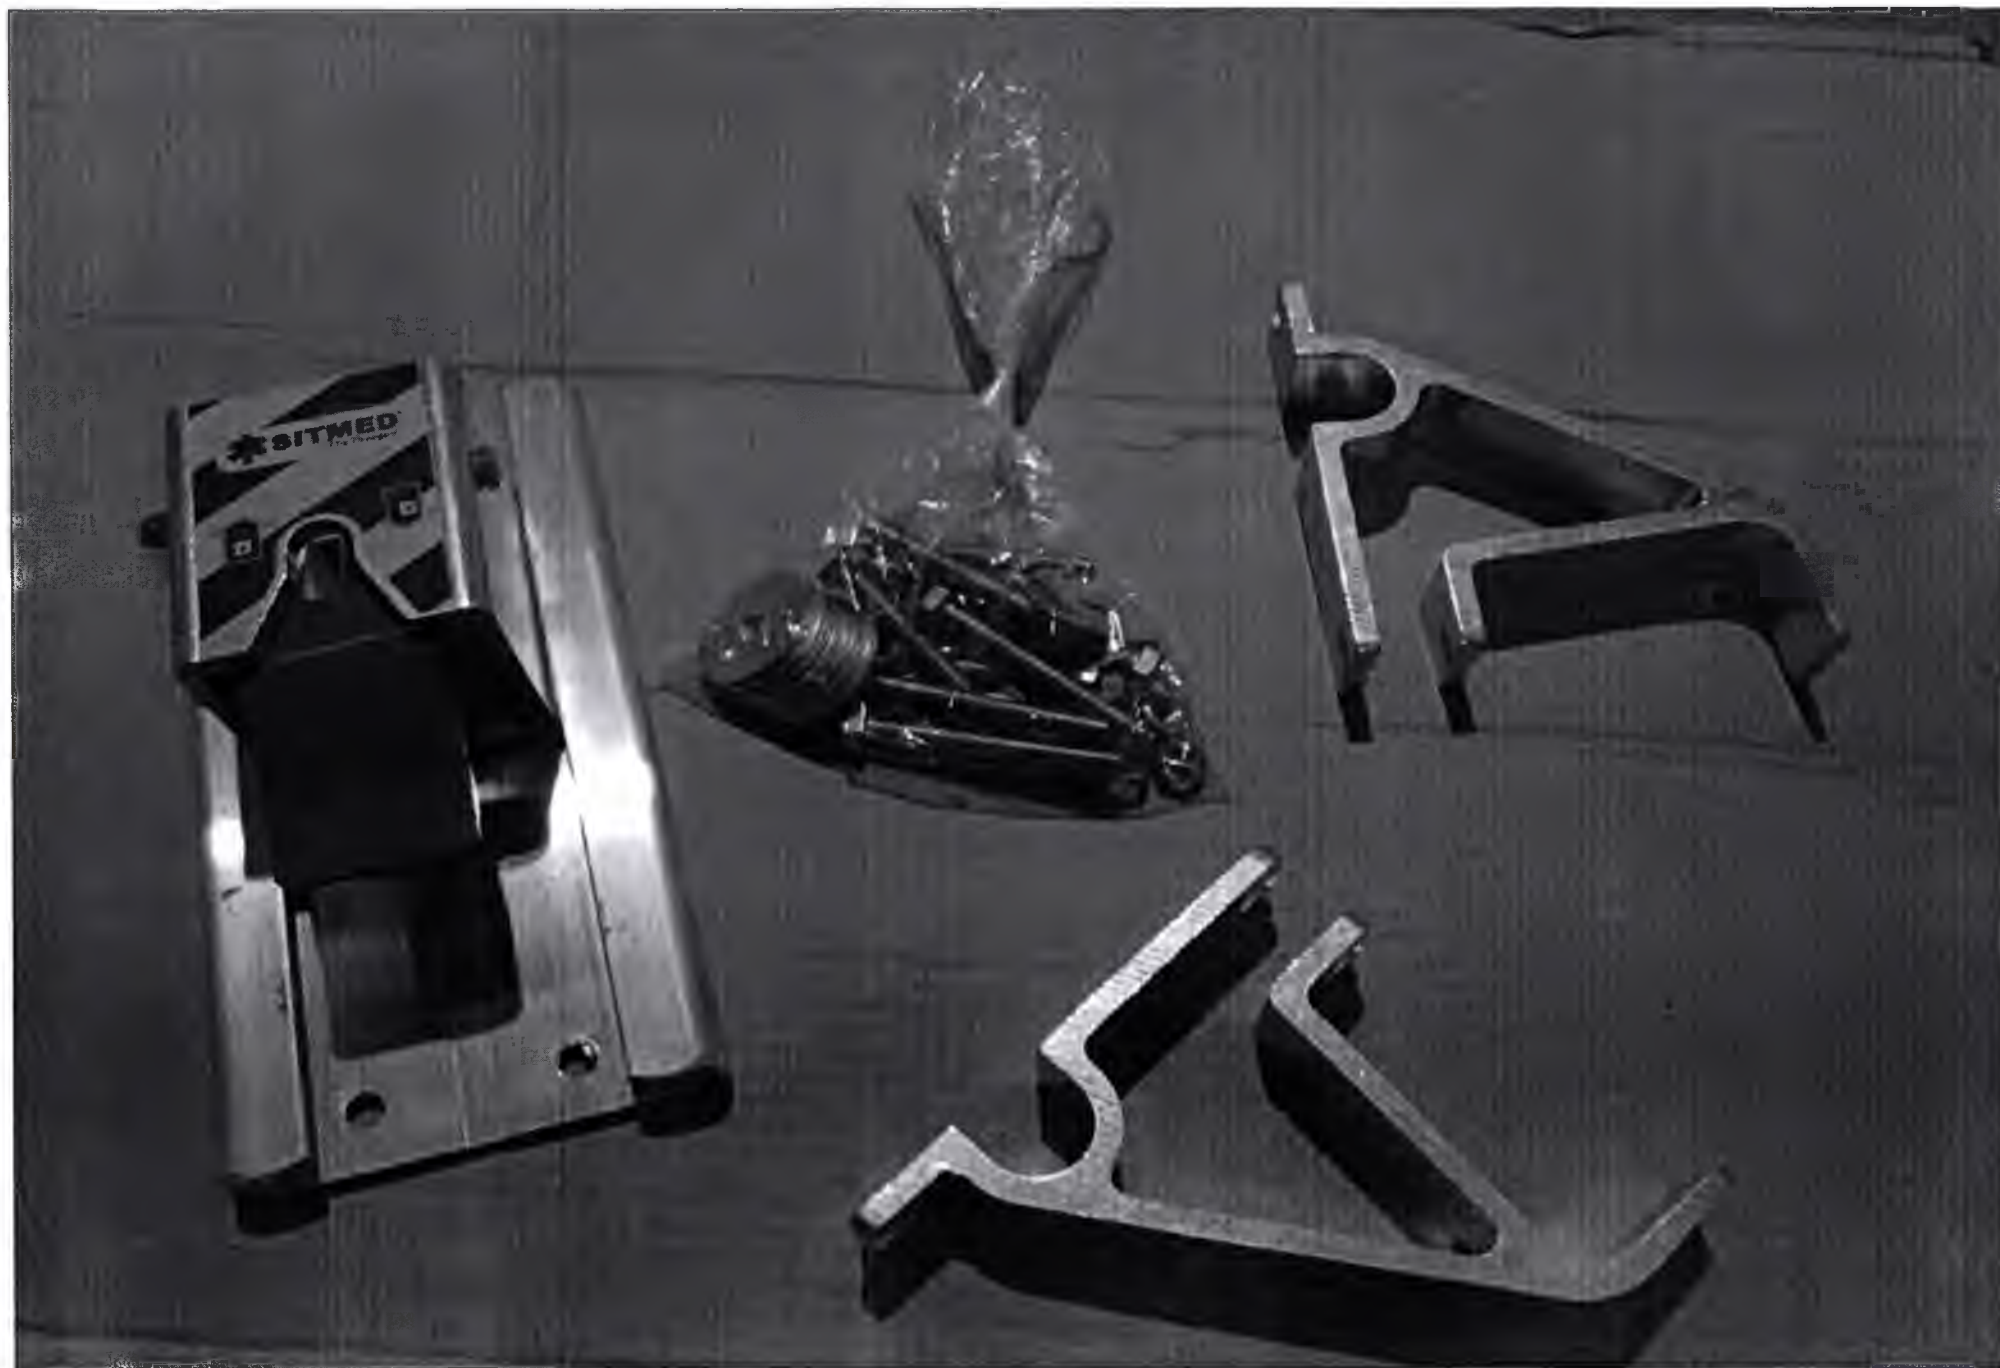


Рис. 24. Крепление инкубатора к устройству приемному.





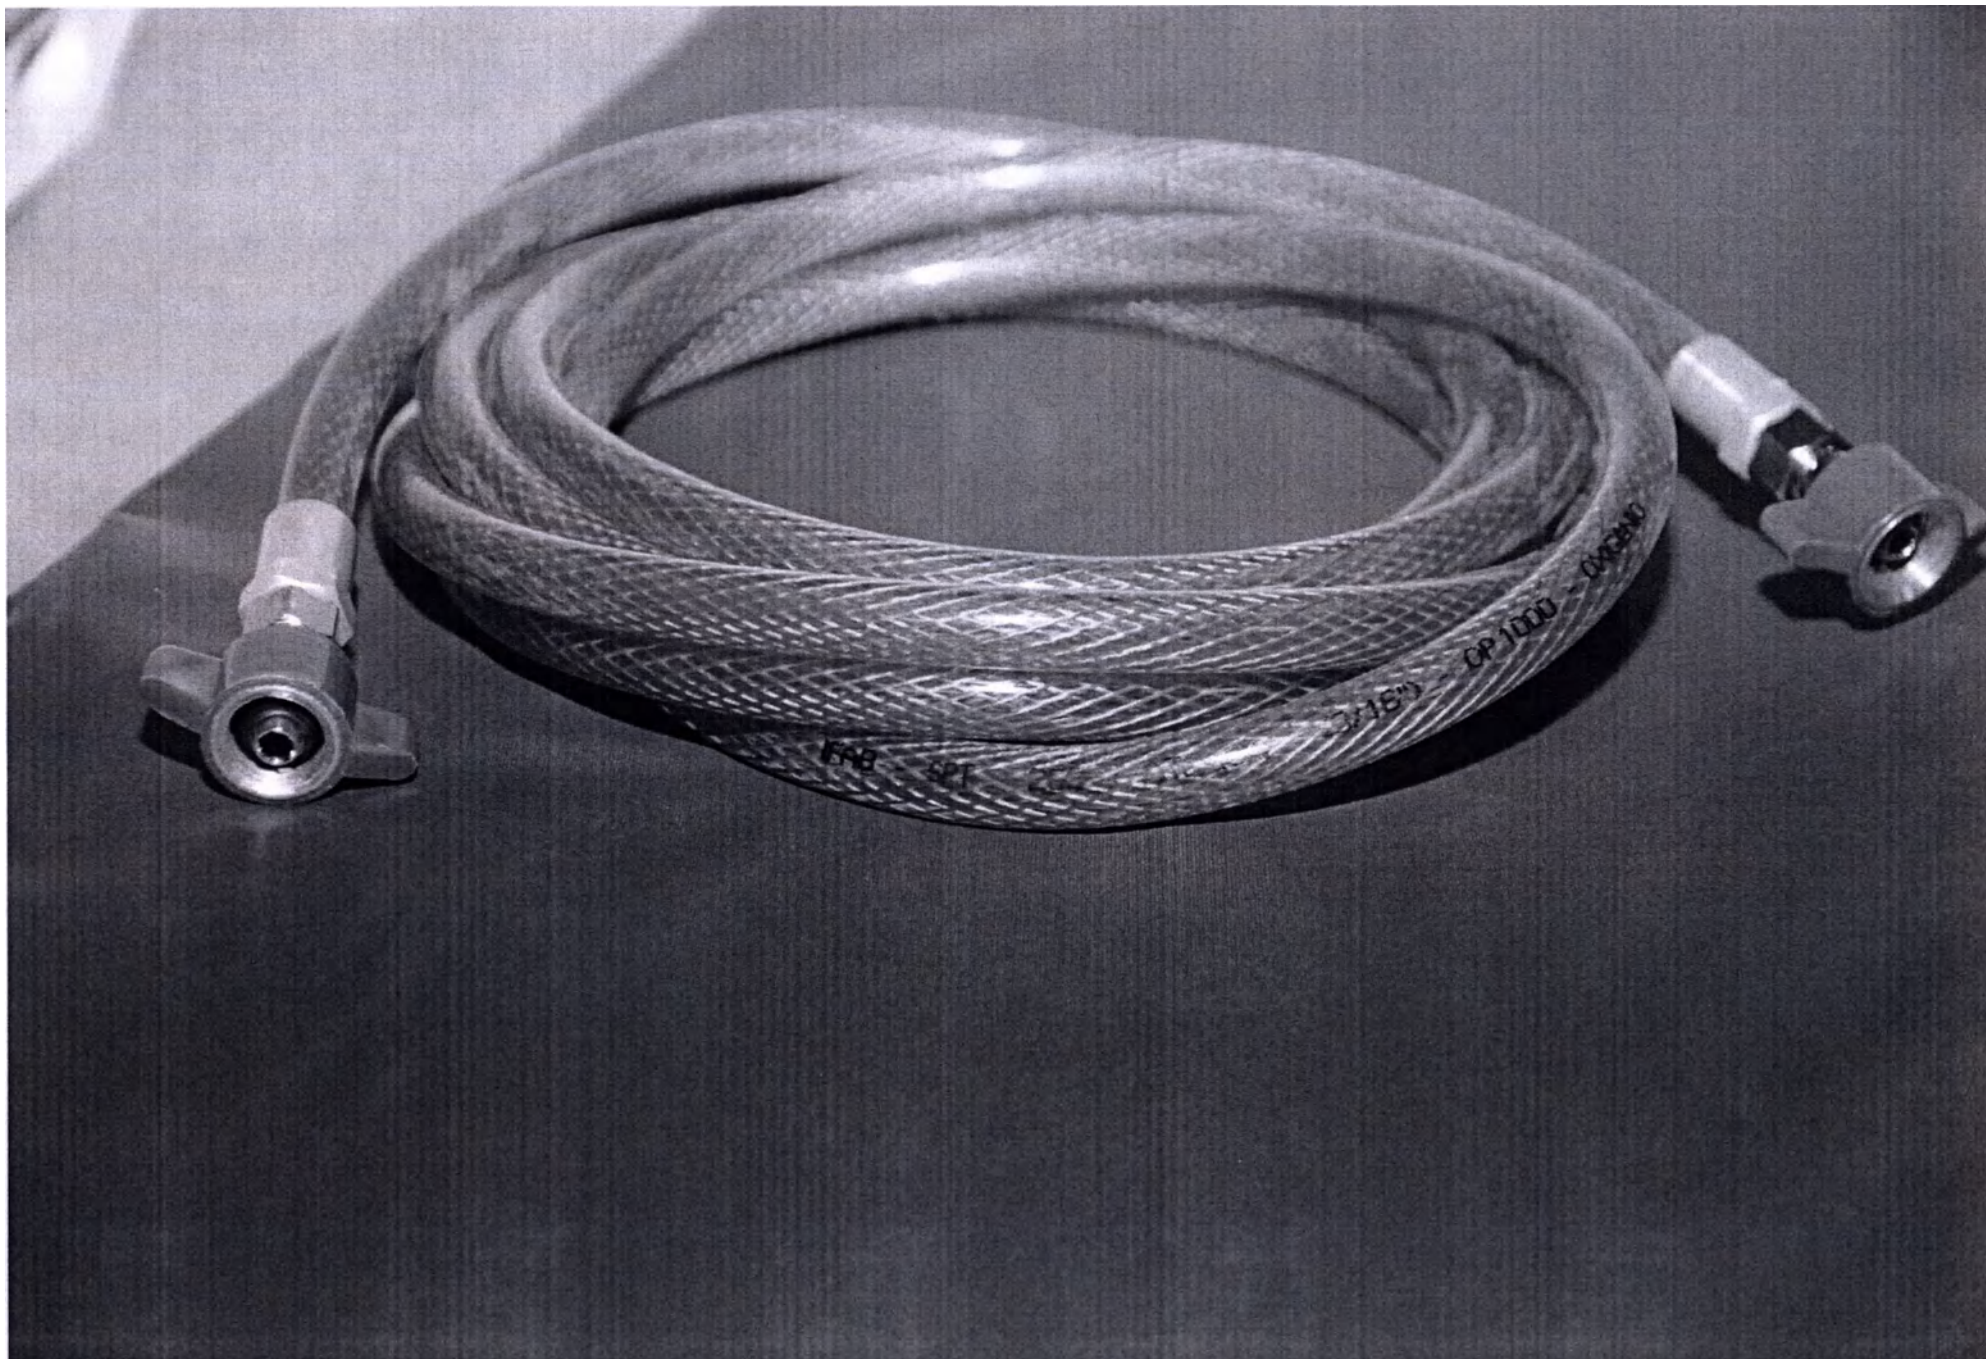


Рис. 27. Шланг высокого давления (кислород).

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

28 листов

ООО «РИПЛ»

Коммерческий директор

Пометун В.В.

