


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДИОСКИН»

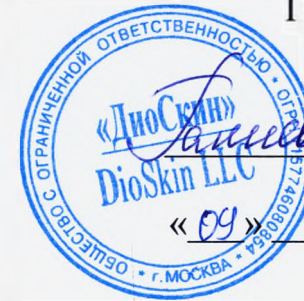

И.М. Галиева

«09» июль 20 19 г.

Фотографические изображения маркировок медицинского изделия: «АППАРАТ
ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ Multisystems DioSkin по ТУ 26.60.13-001-29136172-2017 в
составе с принадлежностями», производства ООО «Бином»

АППАРАТ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
Multisystems Dioskin



ТУ 26.60.13-001-29136172-2017

$P_{max}=650$ ВА

~220 В, 50 Гц

зав.№ 7080001


дата выпуска 08.2017



IP20

ООО БИНОМ
Сделано в России


Шильдик

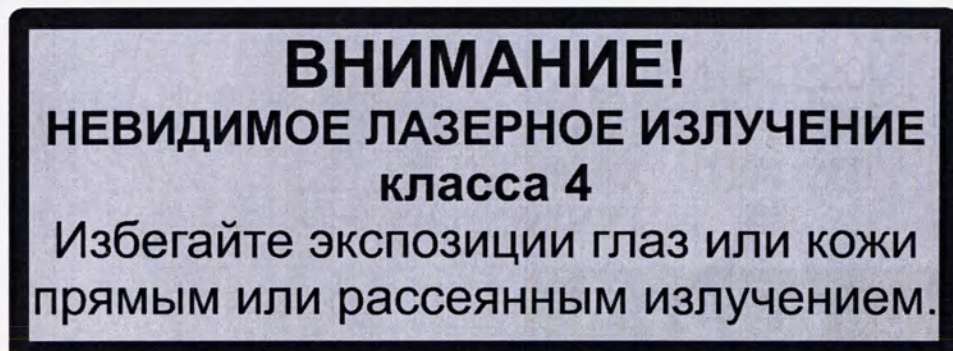


Табличка маркировки класса лазера



Знак экстренного выключения

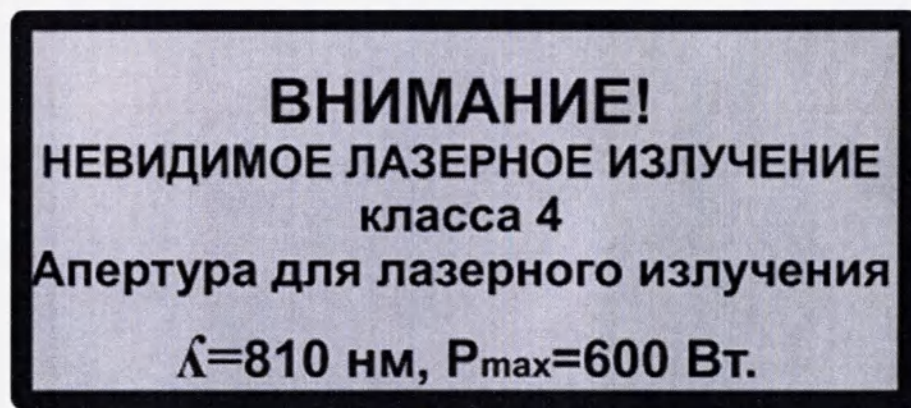

Предупреждающая надпись на выносном блоке излучения

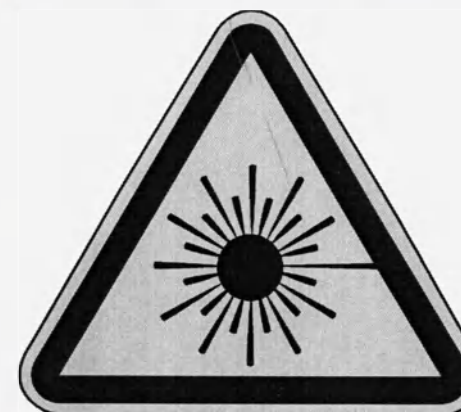

Педаль ножная

HRF-HD3

AC-15 10A 220V
DC-13 5A 125V
MAX ~15A 250V
IP21

COM
белый

NC
чёрный

NO
красный

Тип-1

AWG14


KACON

Сделано в КНР

Маркировка педали



Маркировка педали

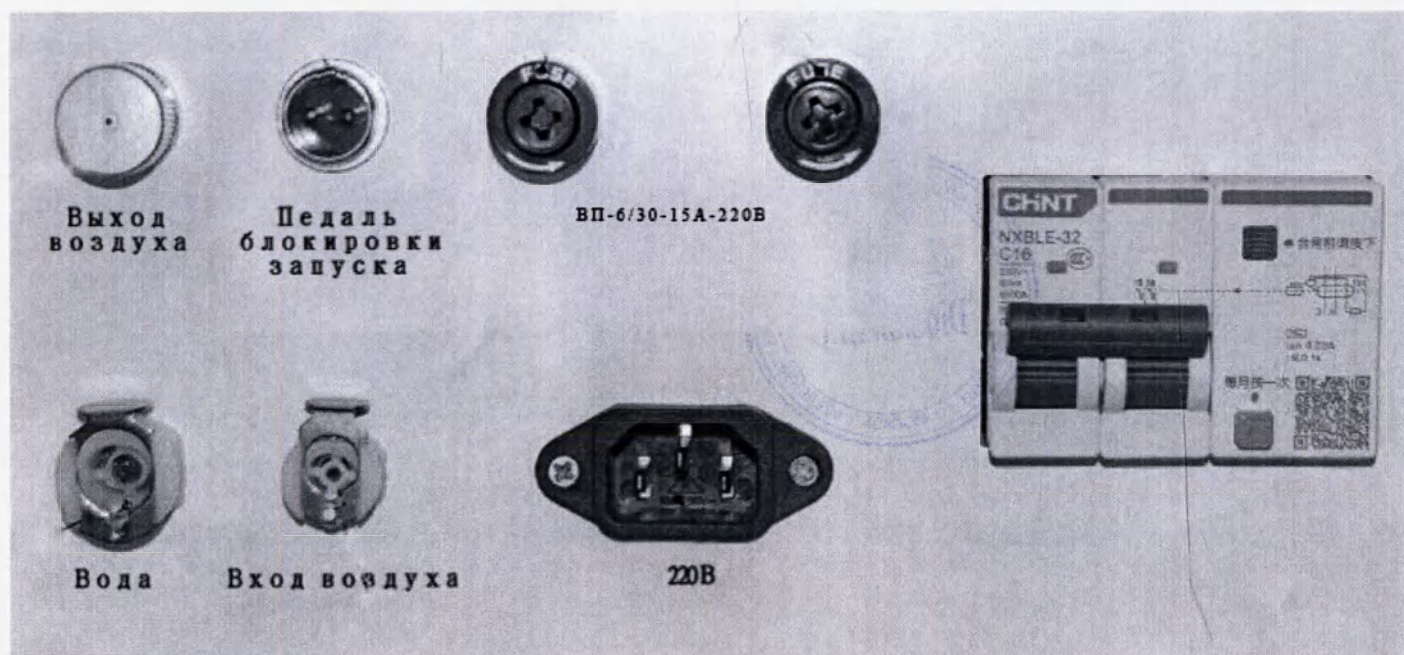

Панель подключения аппарата

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на

(5/пяти) листах

Генеральный директор

ООО «ДИОСКИН»



Галиева И.М.