

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

АО «ГРПЗ» — филиал

«Касимовский приборный завод»

В.М. Караваев

25 » 12 2018 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ

по ТУ 9451-032-41457390-2010

в вариантах исполнения




Фотографическое изображение 1. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008

Вид спереди




Фотографическое изображение 2. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008
Вид сбоку (слева)

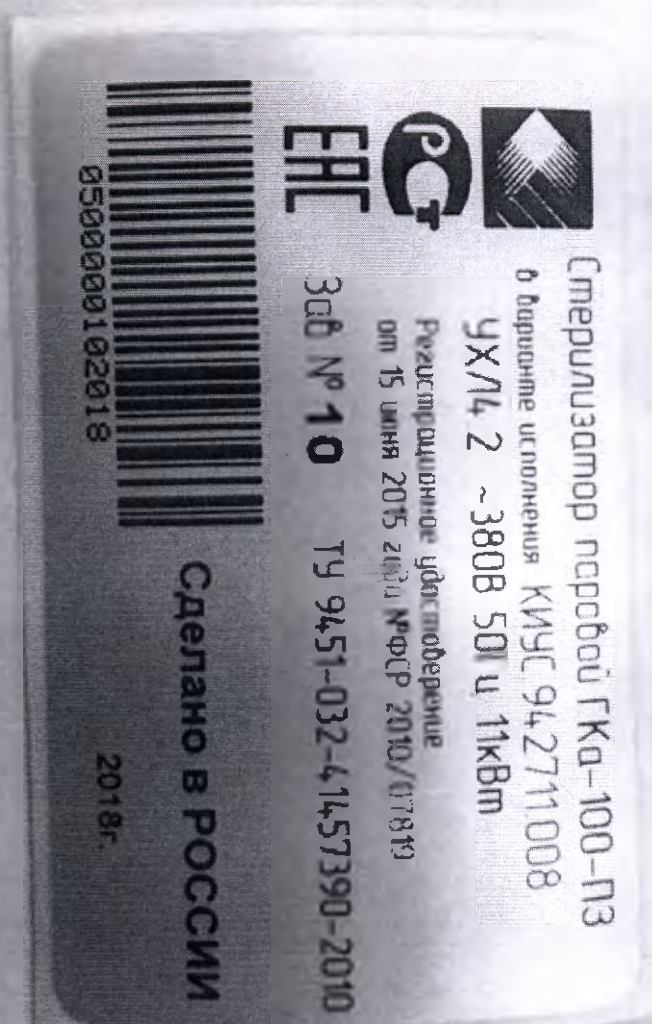


Фотографическое изображение 3. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008
Маркировочная табличка



Фотографическое изображение 4. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-01
Вид спереди

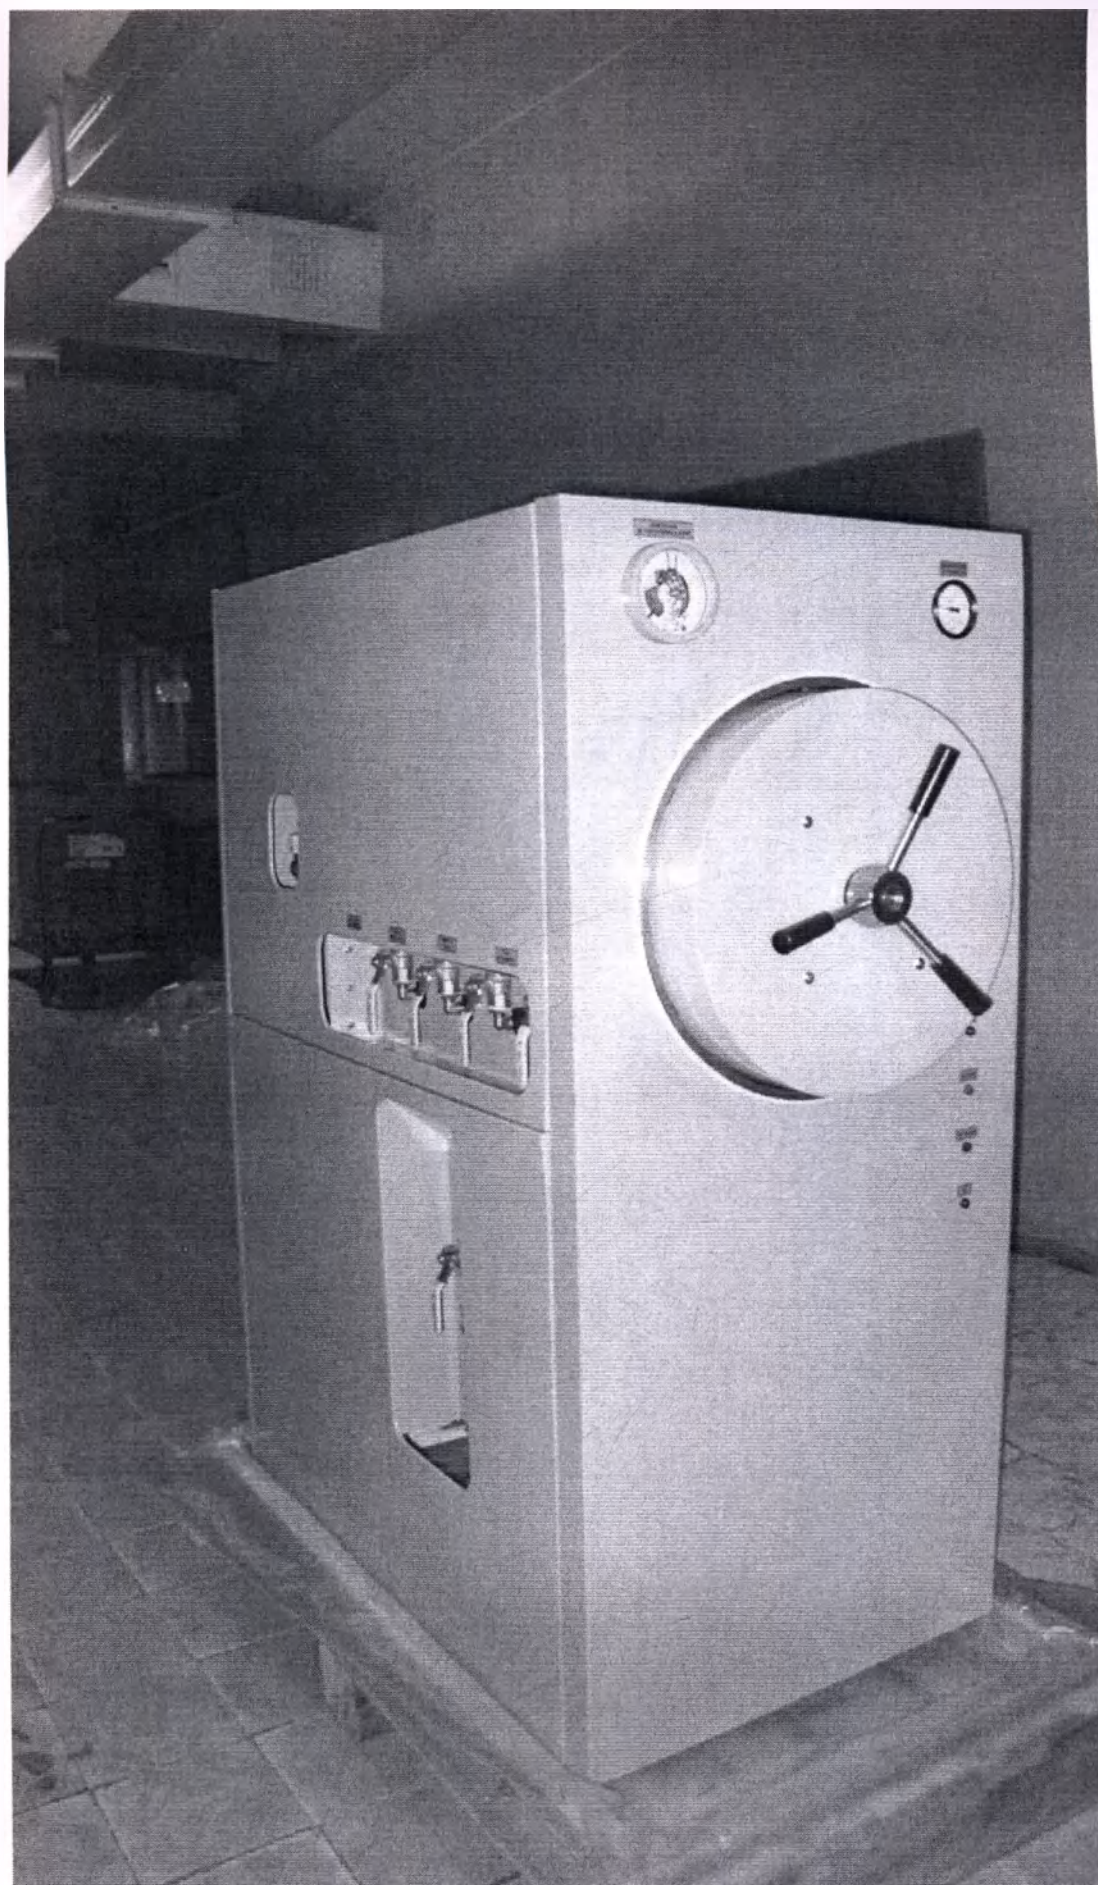

Фотографическое изображение 5. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-01
Вид сбоку (слева)

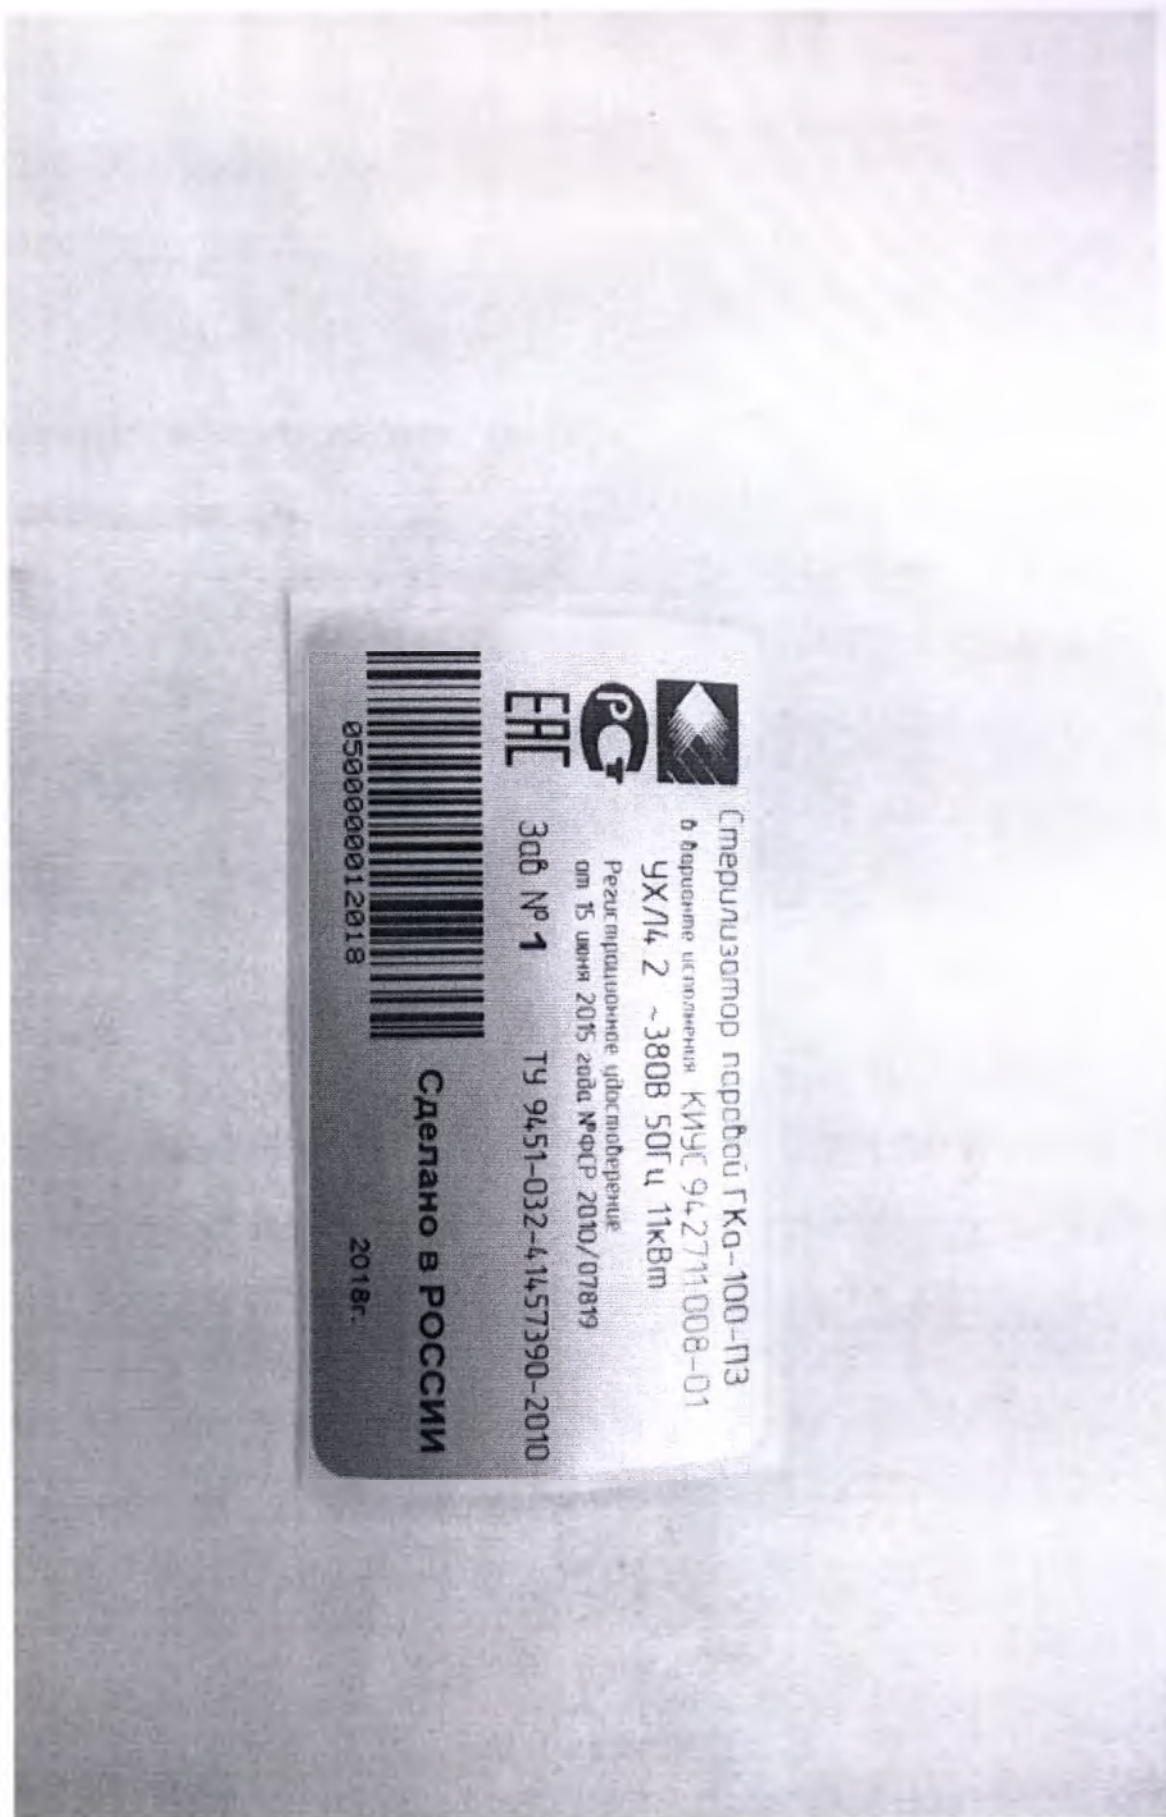


Фотографическое изображение 6. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-01
Маркировочная табличка



Фотографическое изображение 7. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-02
Вид спереди



Фотографическое изображение 8. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-02
Вид сбоку (слева)

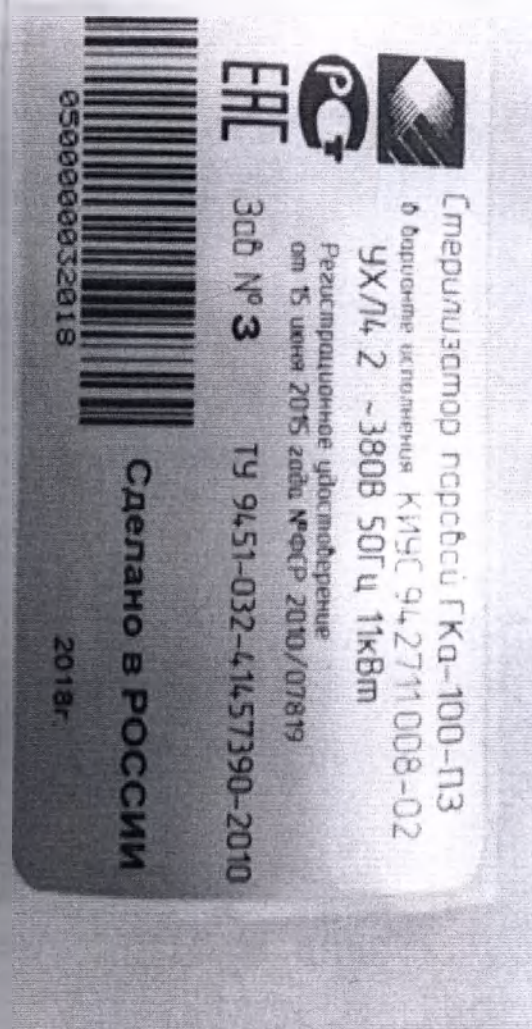


Фотографическое изображение 9. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-02

Маркировочная табличка




Фотографическое изображение 10. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-03

Вид спереди

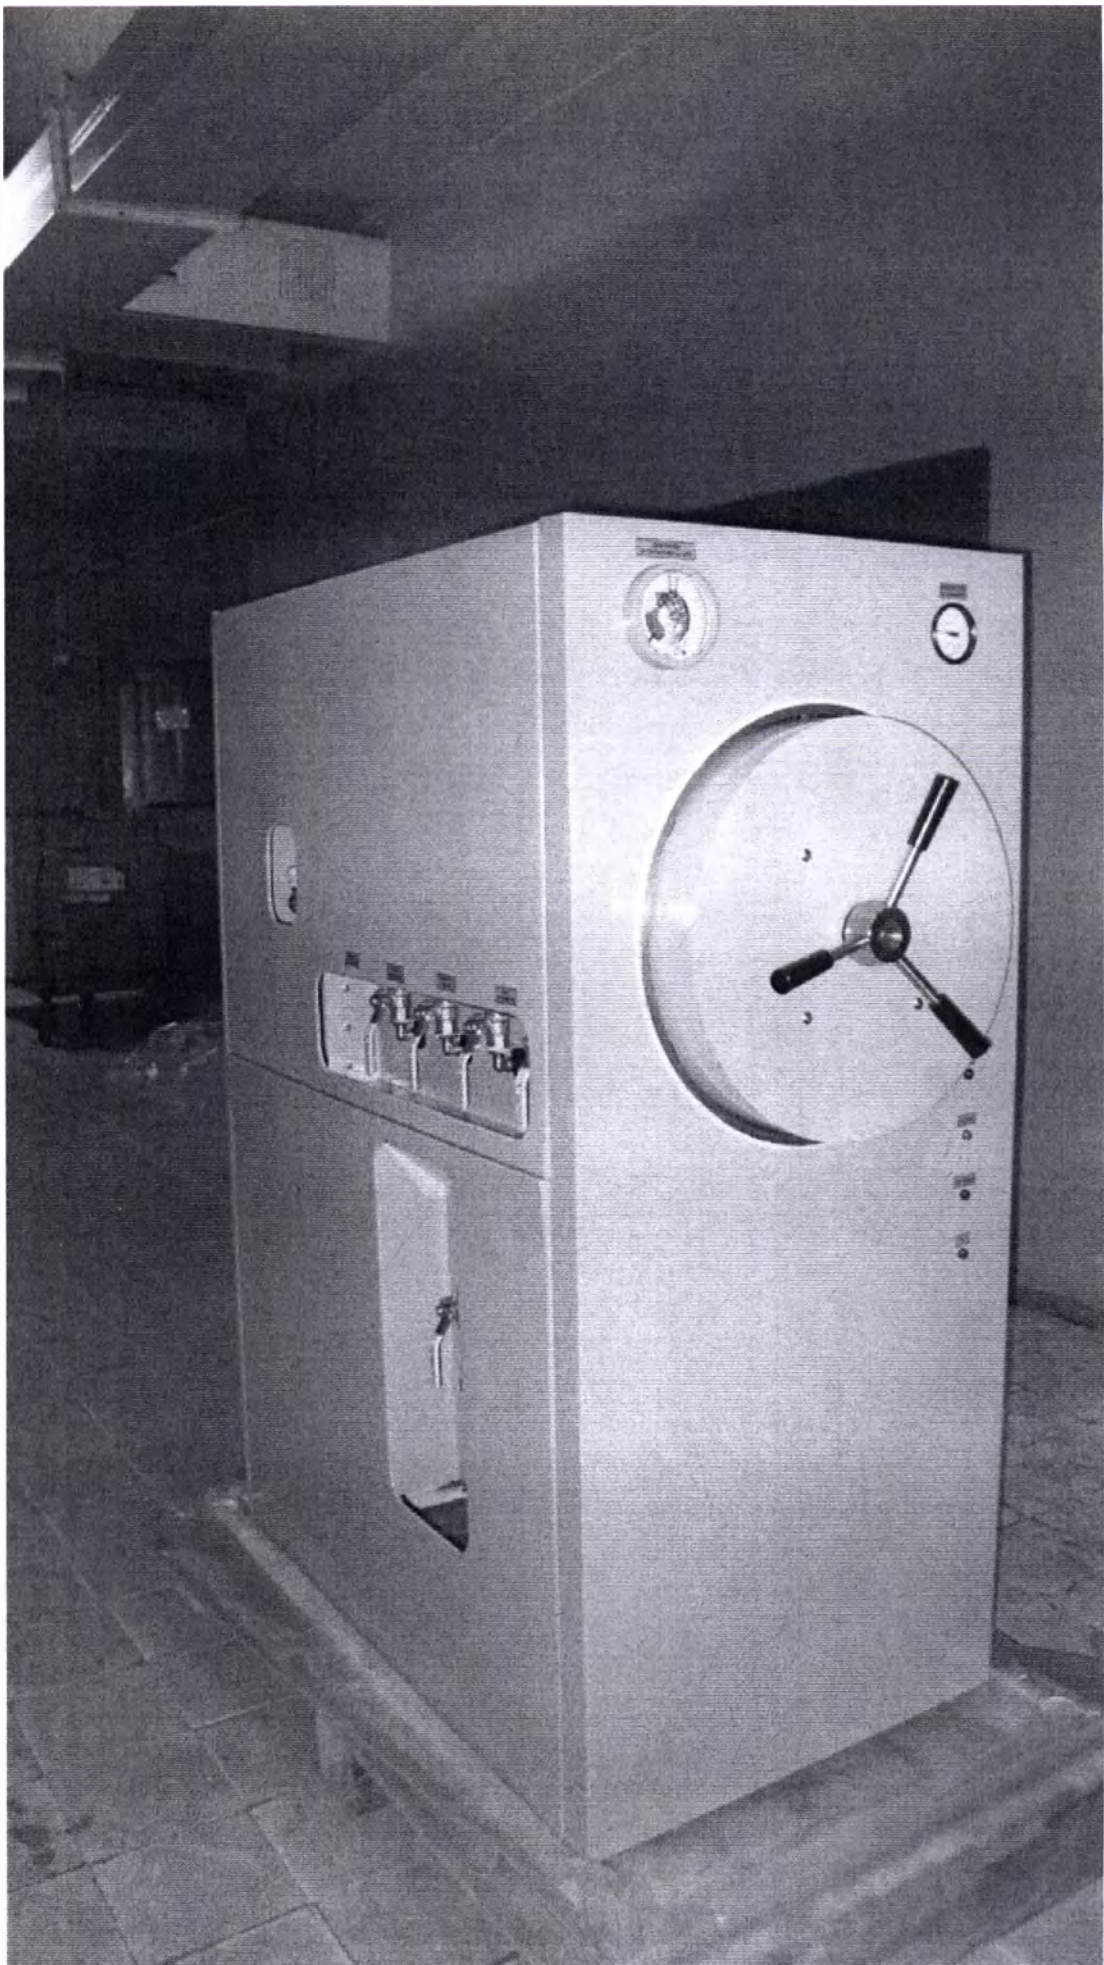

Фотографическое изображение 11. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-03

Вид сбоку (слева)

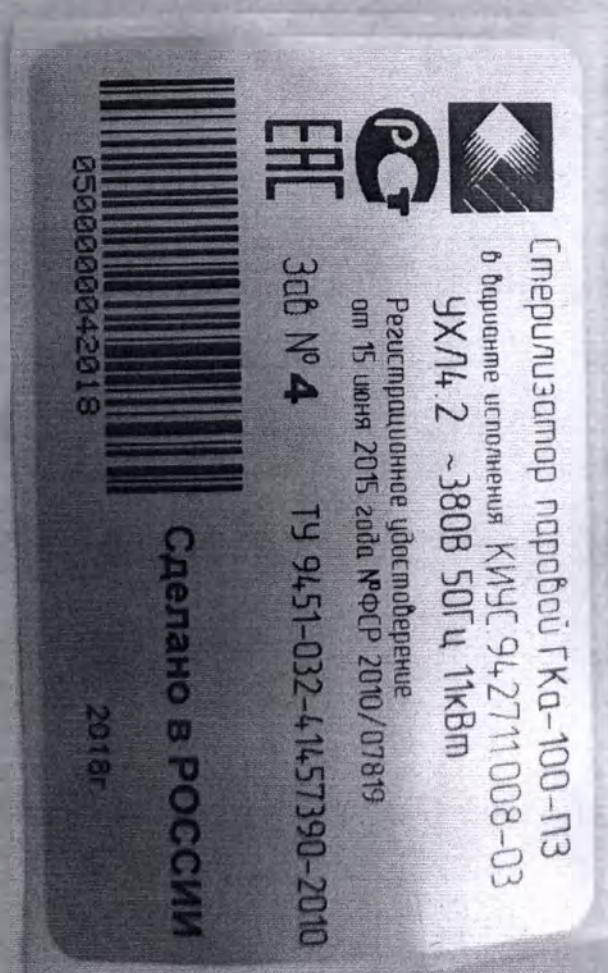


Фотографическое изображение 12. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-03
Маркировочная табличка




Фотографическое изображение 13. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-04
Вид спереди




Фотографическое изображение 14. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-04
Вид сбоку (слева)

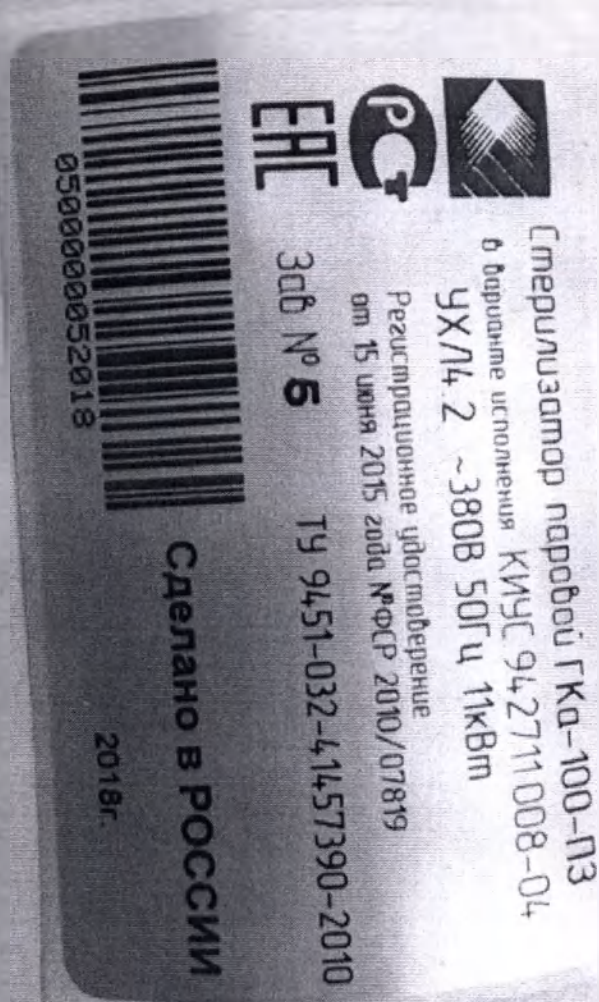


Фотографическое изображение 15. Стерилизатор паровой ГКа-100-ПЗ КИУС.942711.008-04
Маркировочная табличка

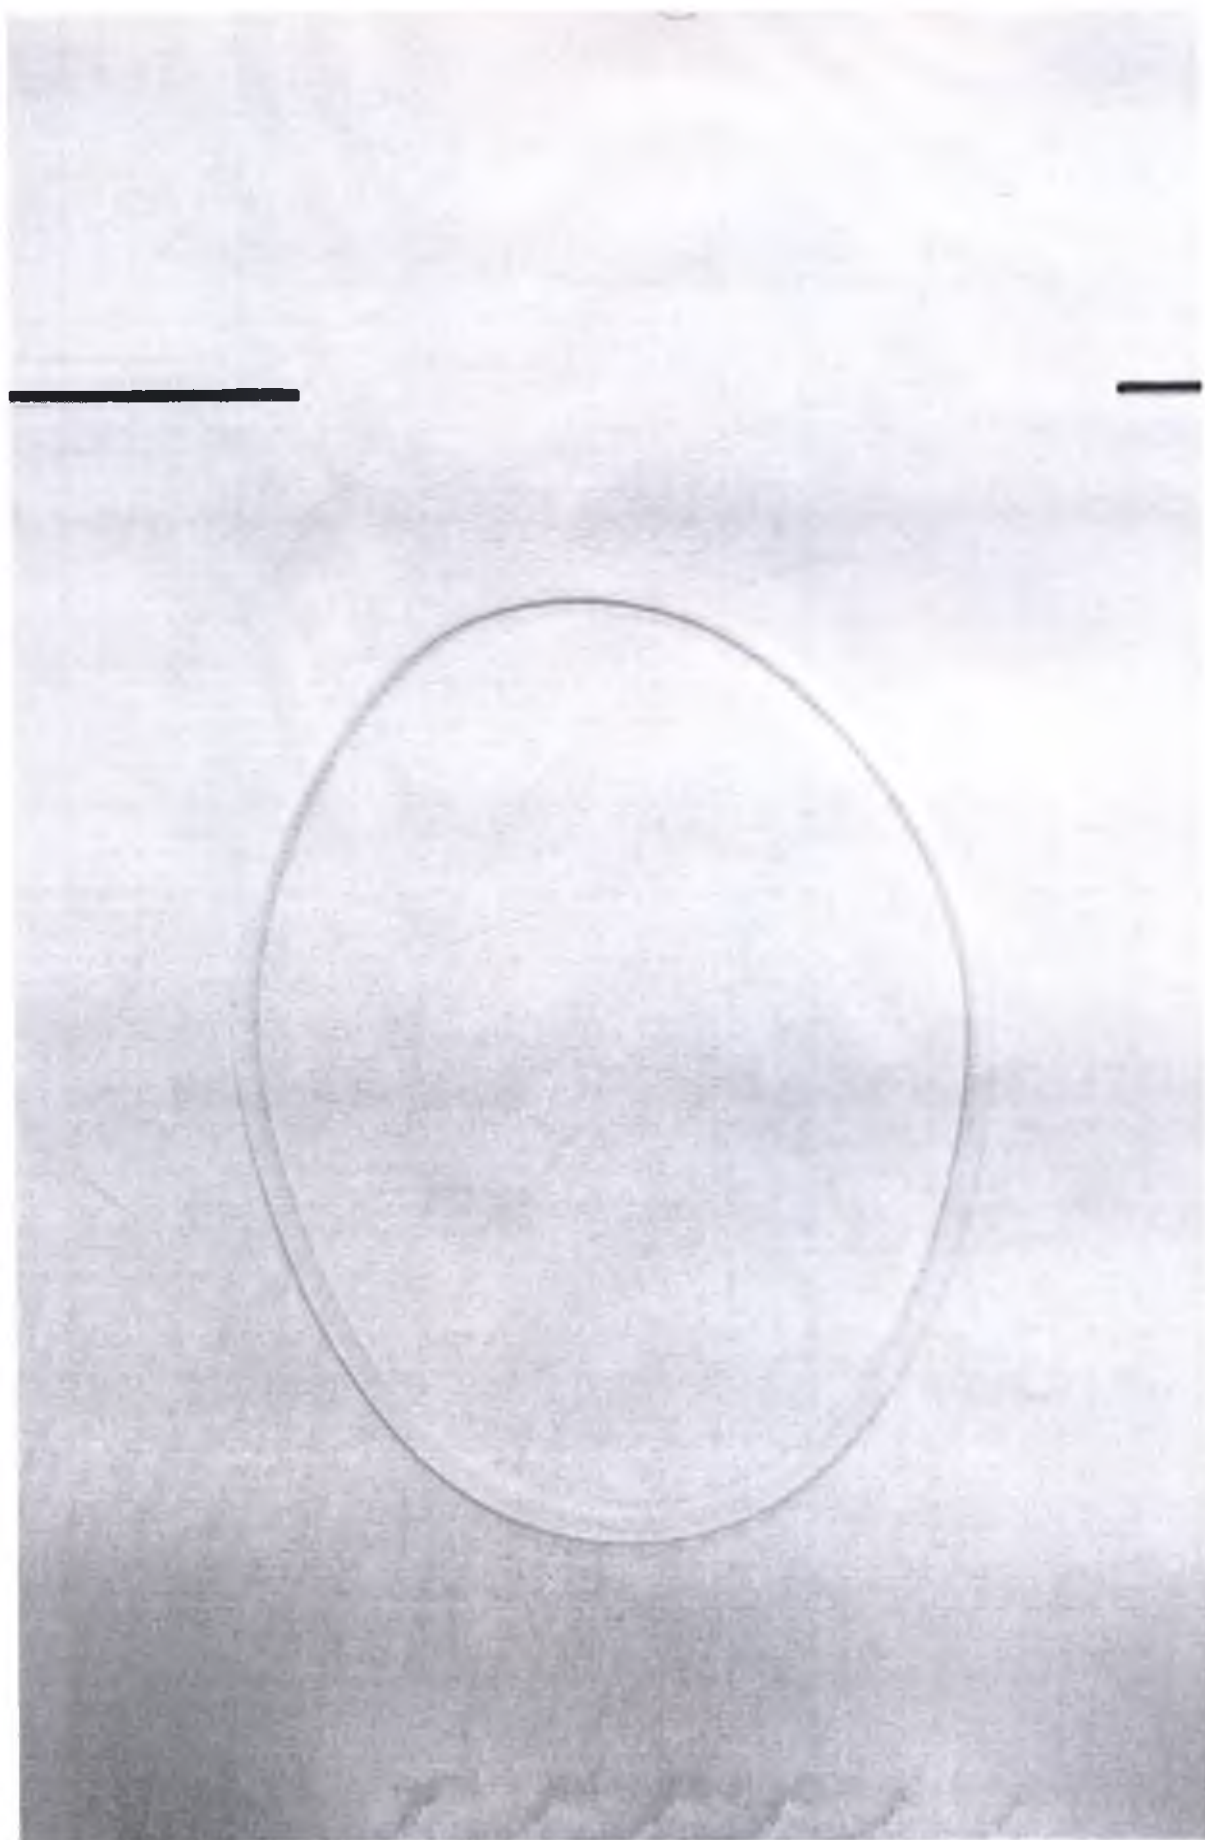


Фотографическое изображение 16. Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001

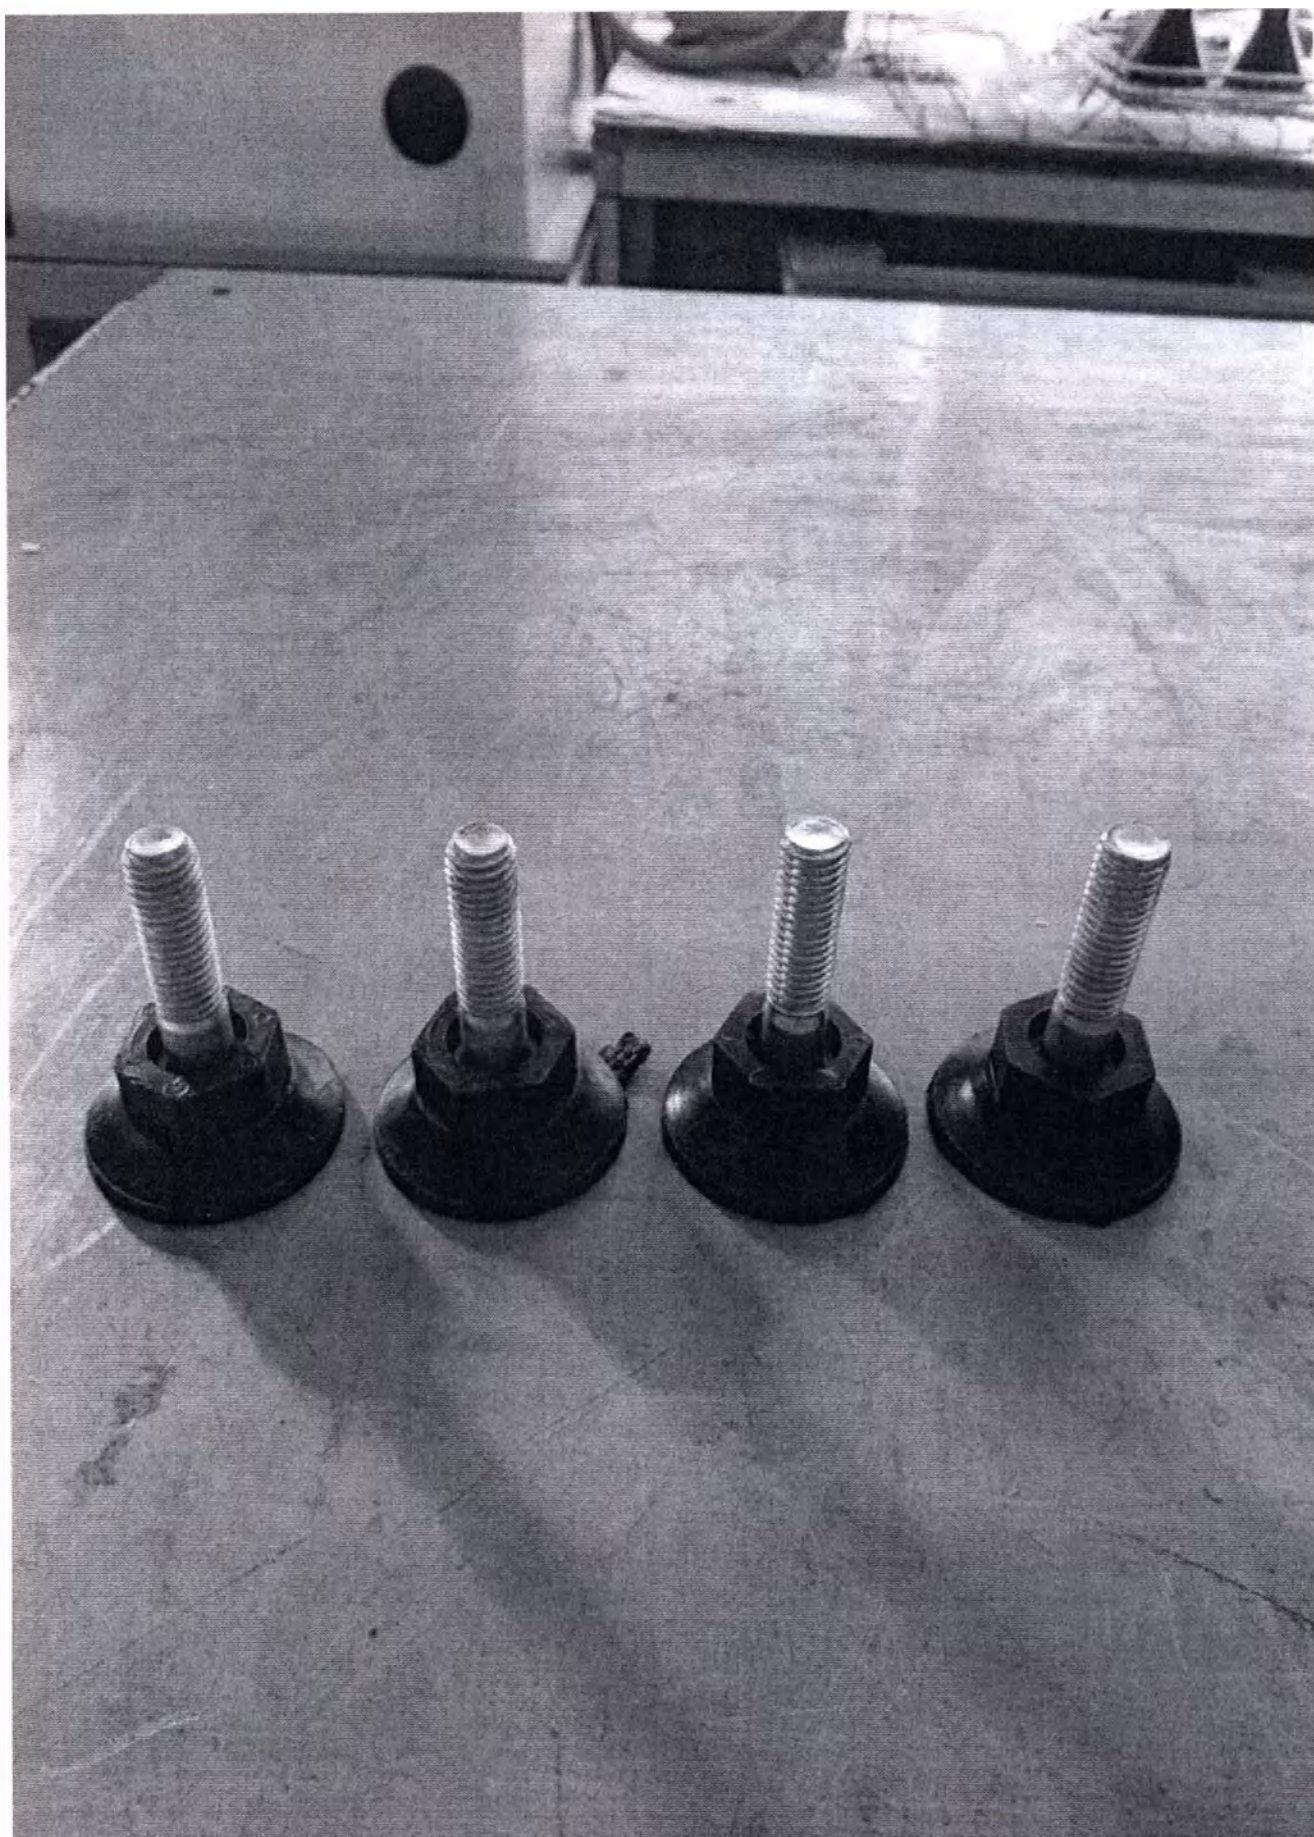


Фотографическое изображение 17. Опора в виде четырёх ввинчивающихся ножек

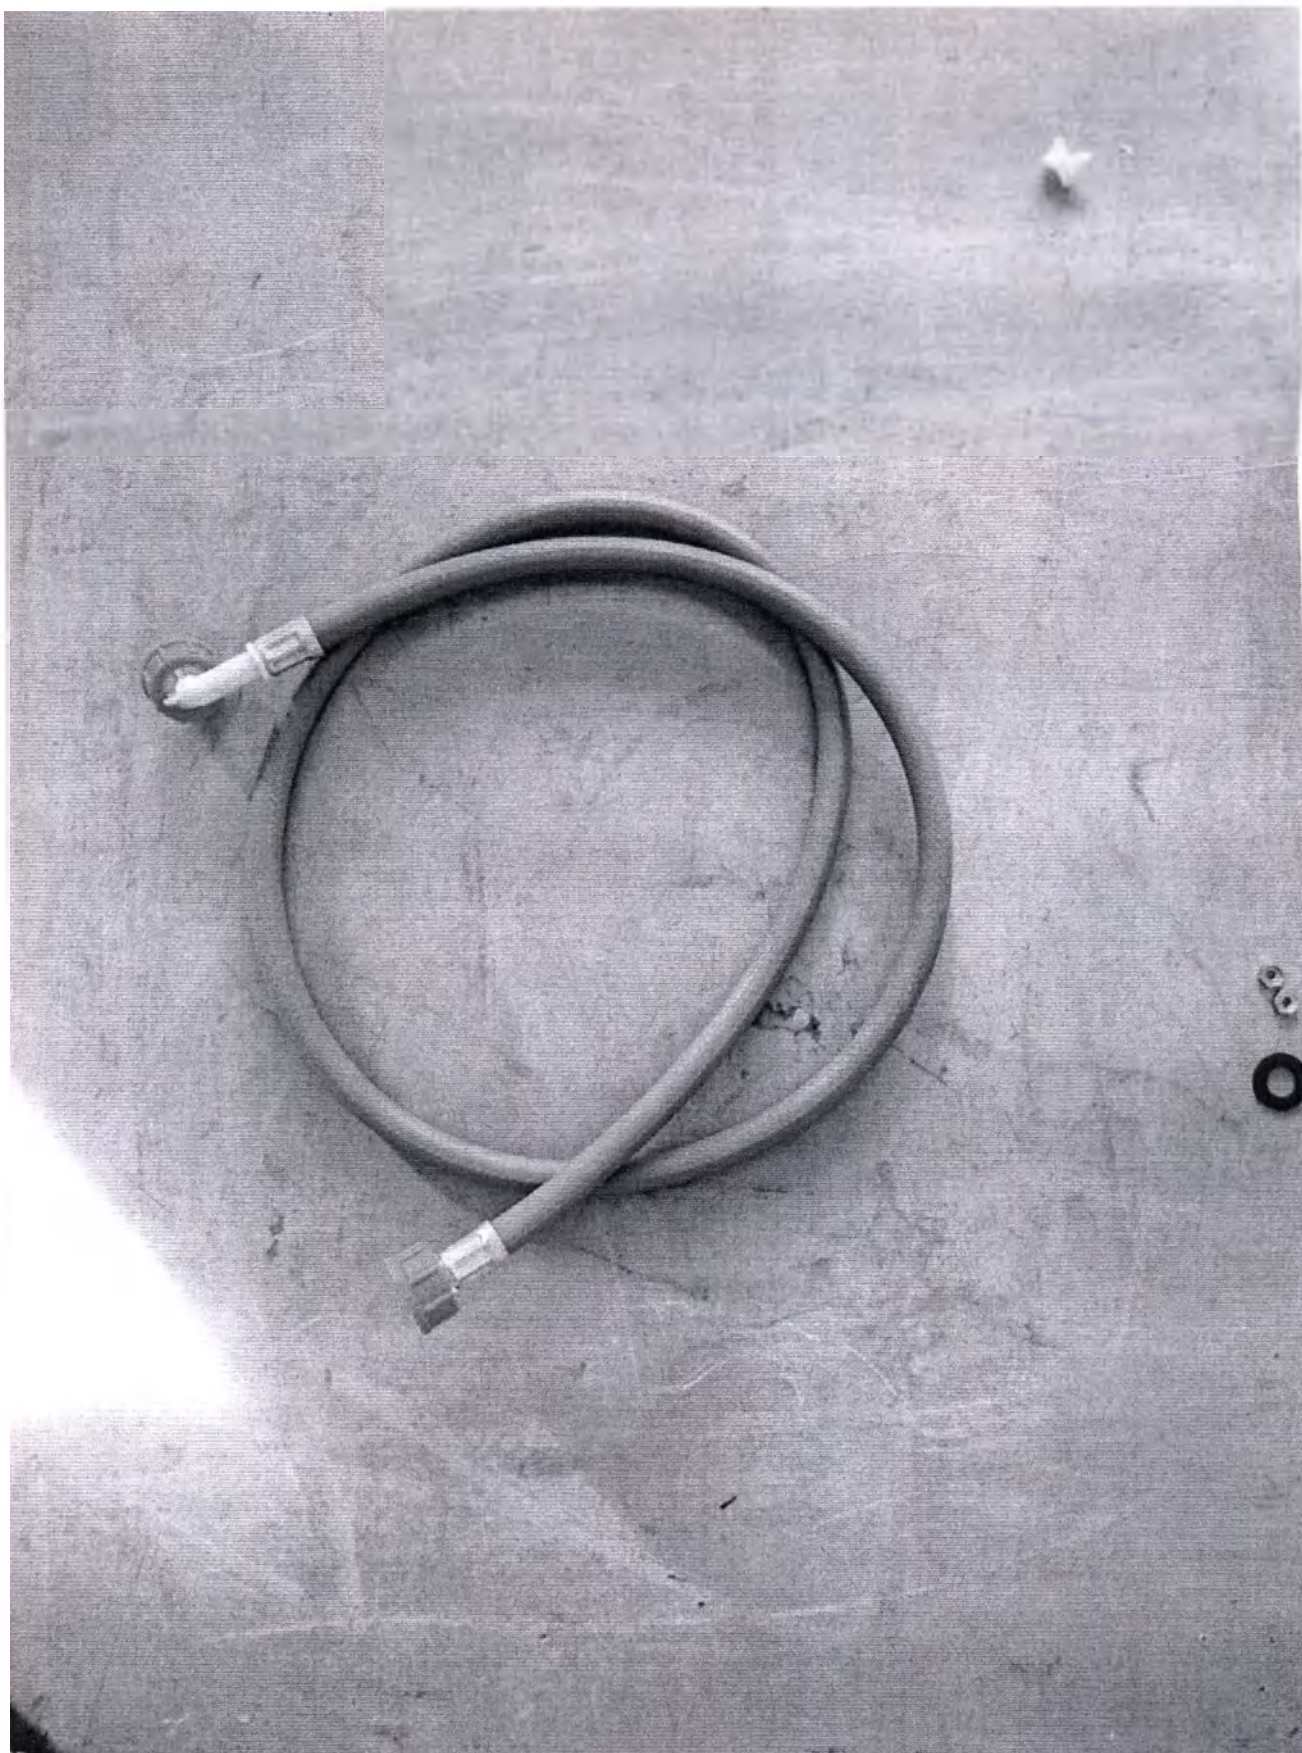

Фотографическое изображение 18. Шланг наливной

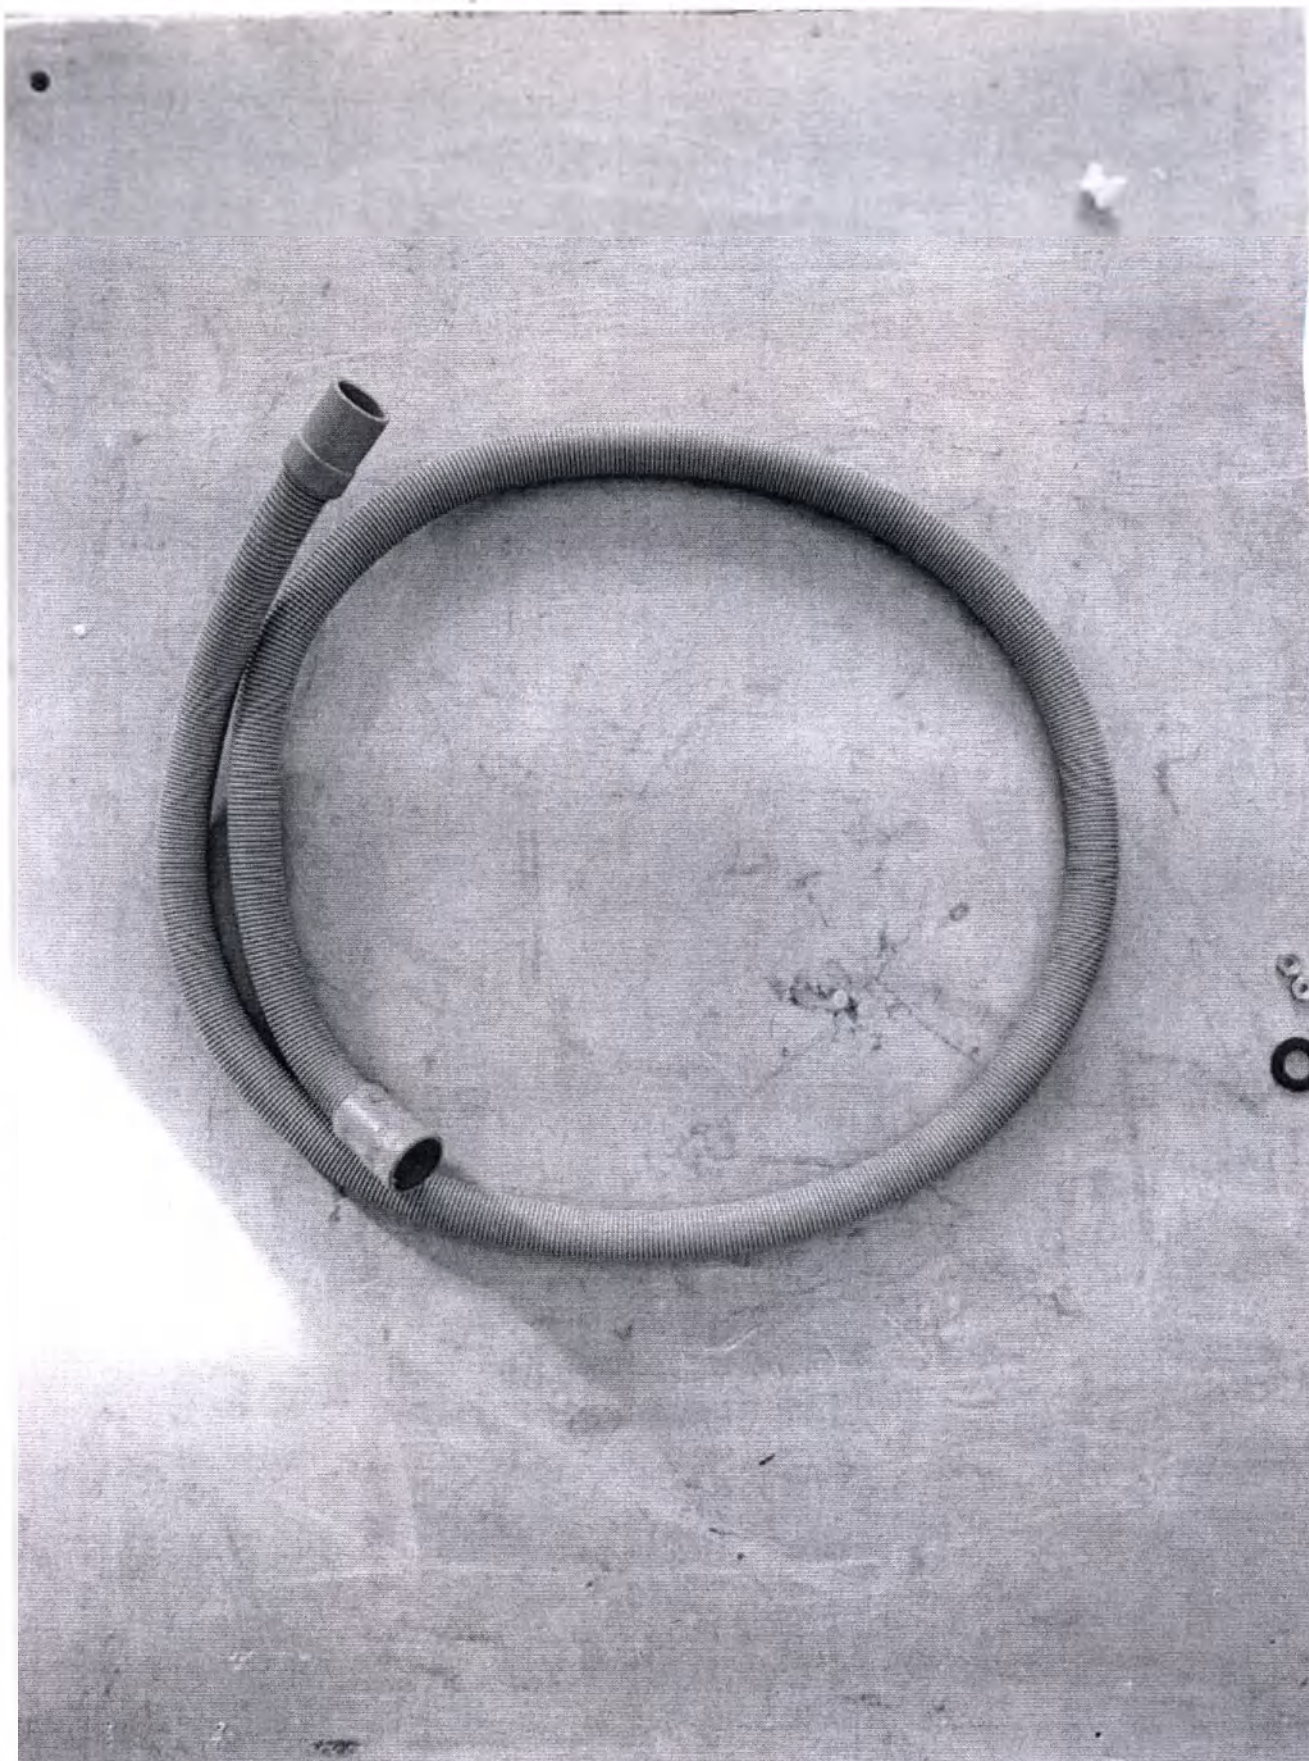


Фотографическое изображение 19. Шланг сливной

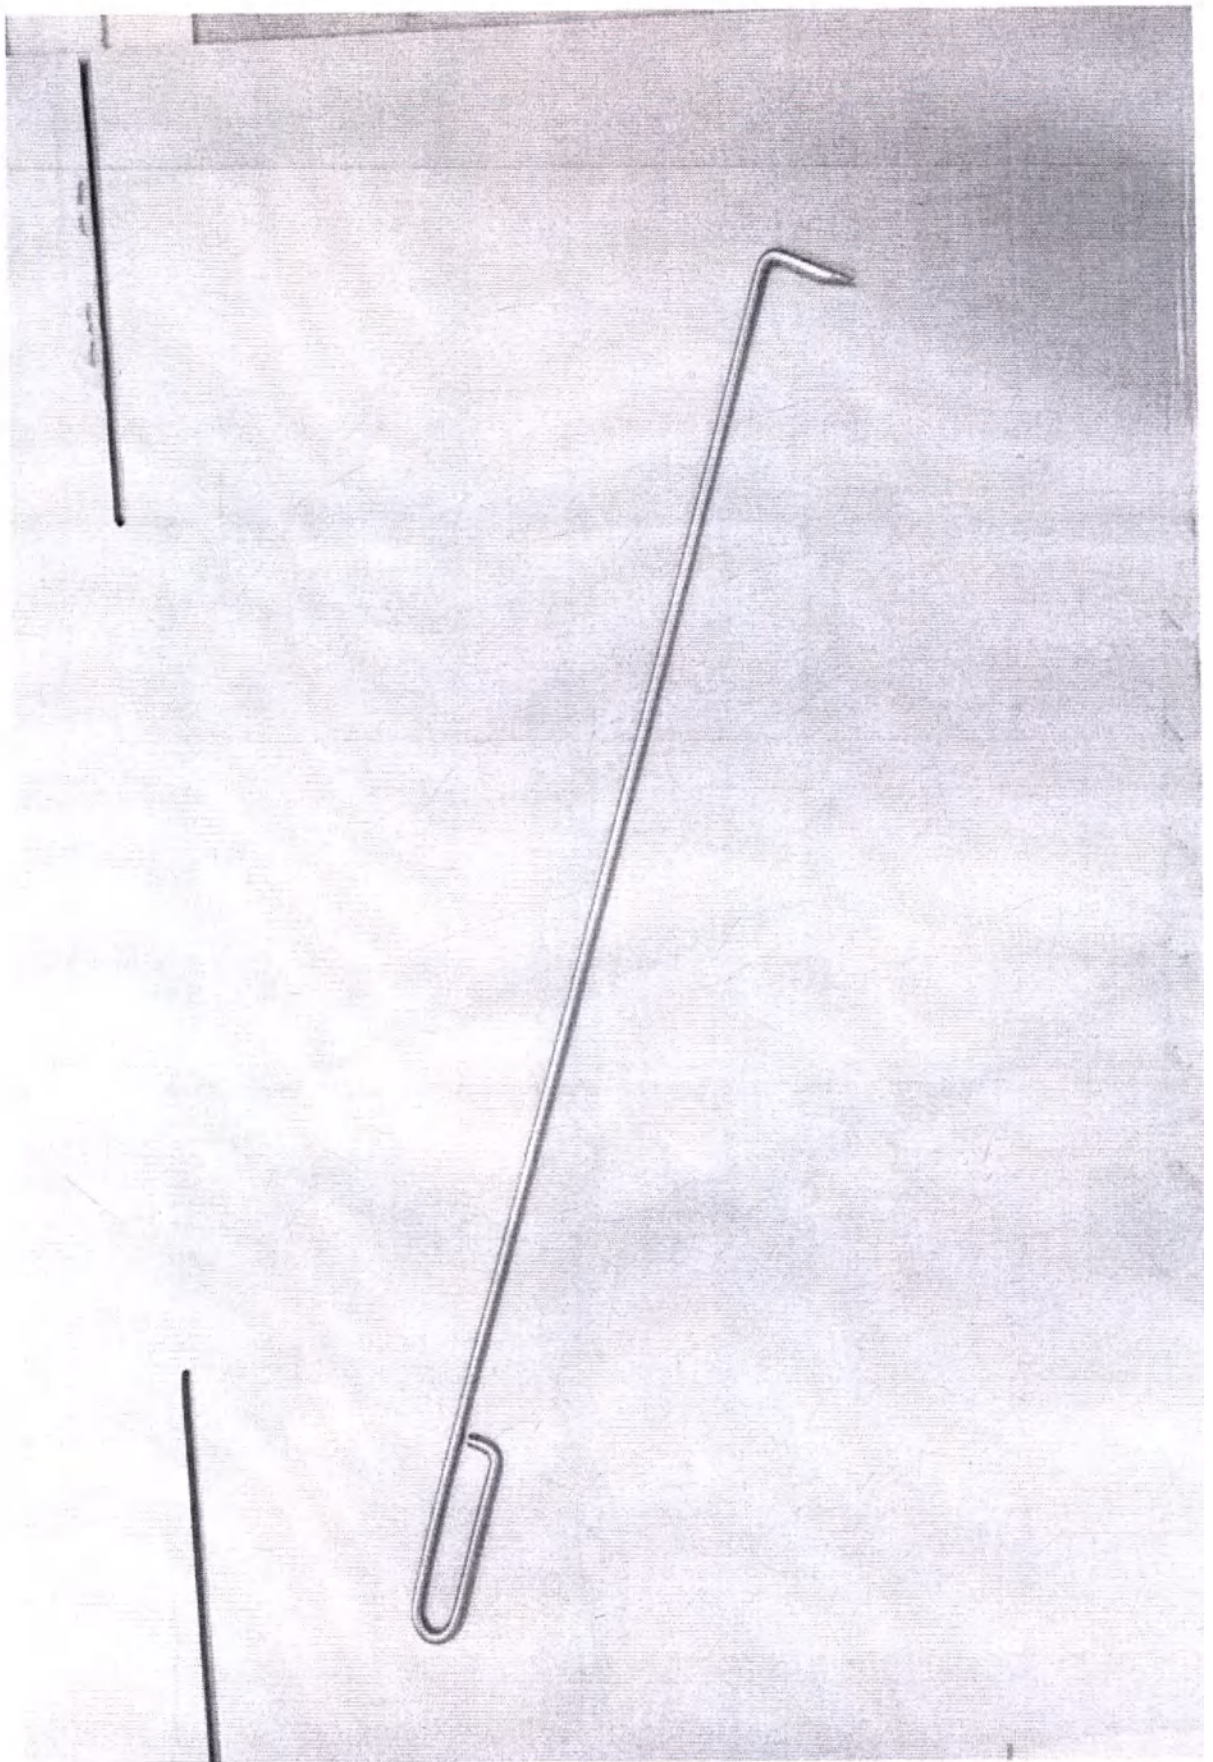


Фотографическое изображение 20. Захват КИУС.484135.001




Фотографическое изображение 21. Тележка КИУС.324156.002*

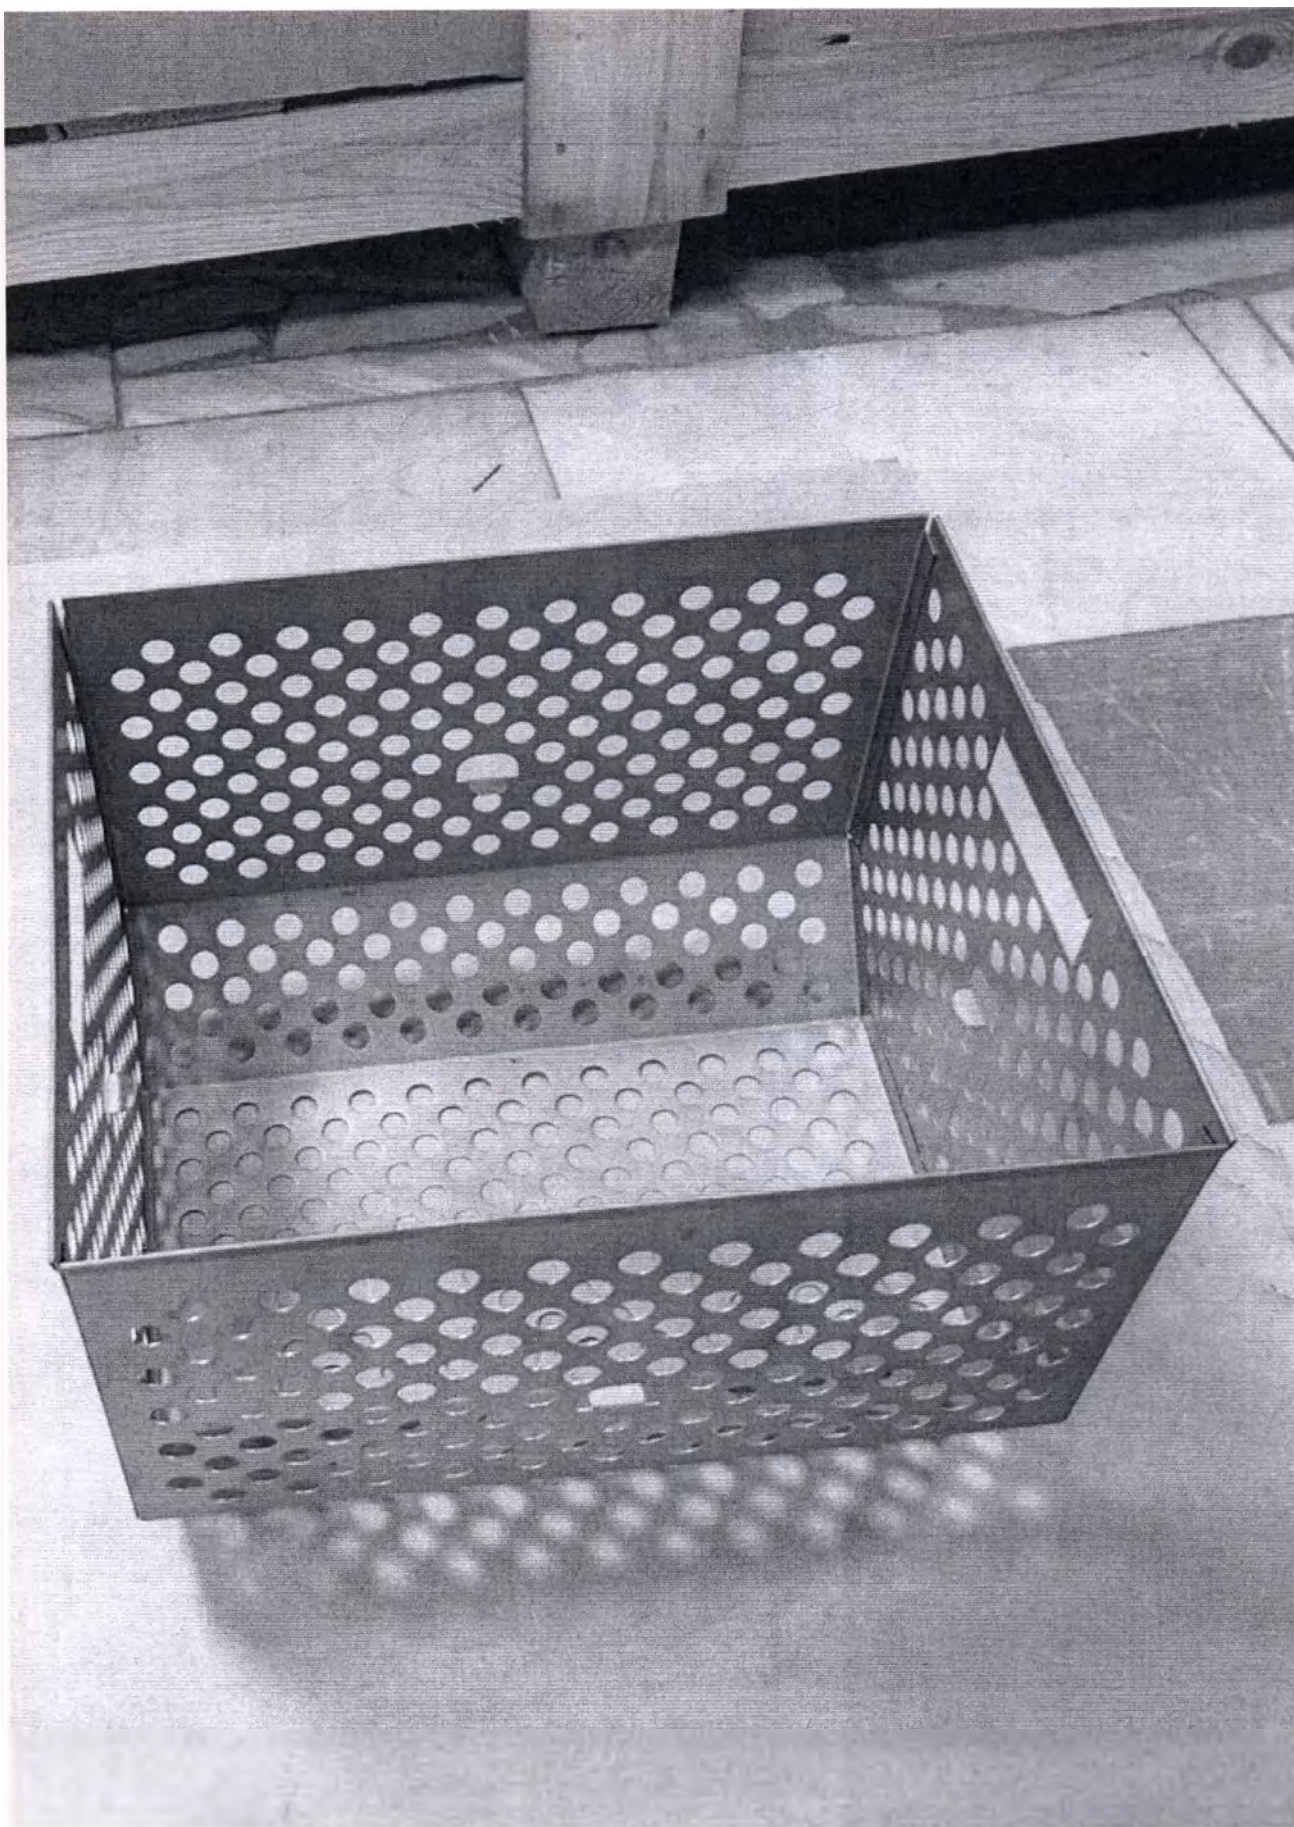

Фотографическое изображение 22. Корзина КИУС.321541.017-01

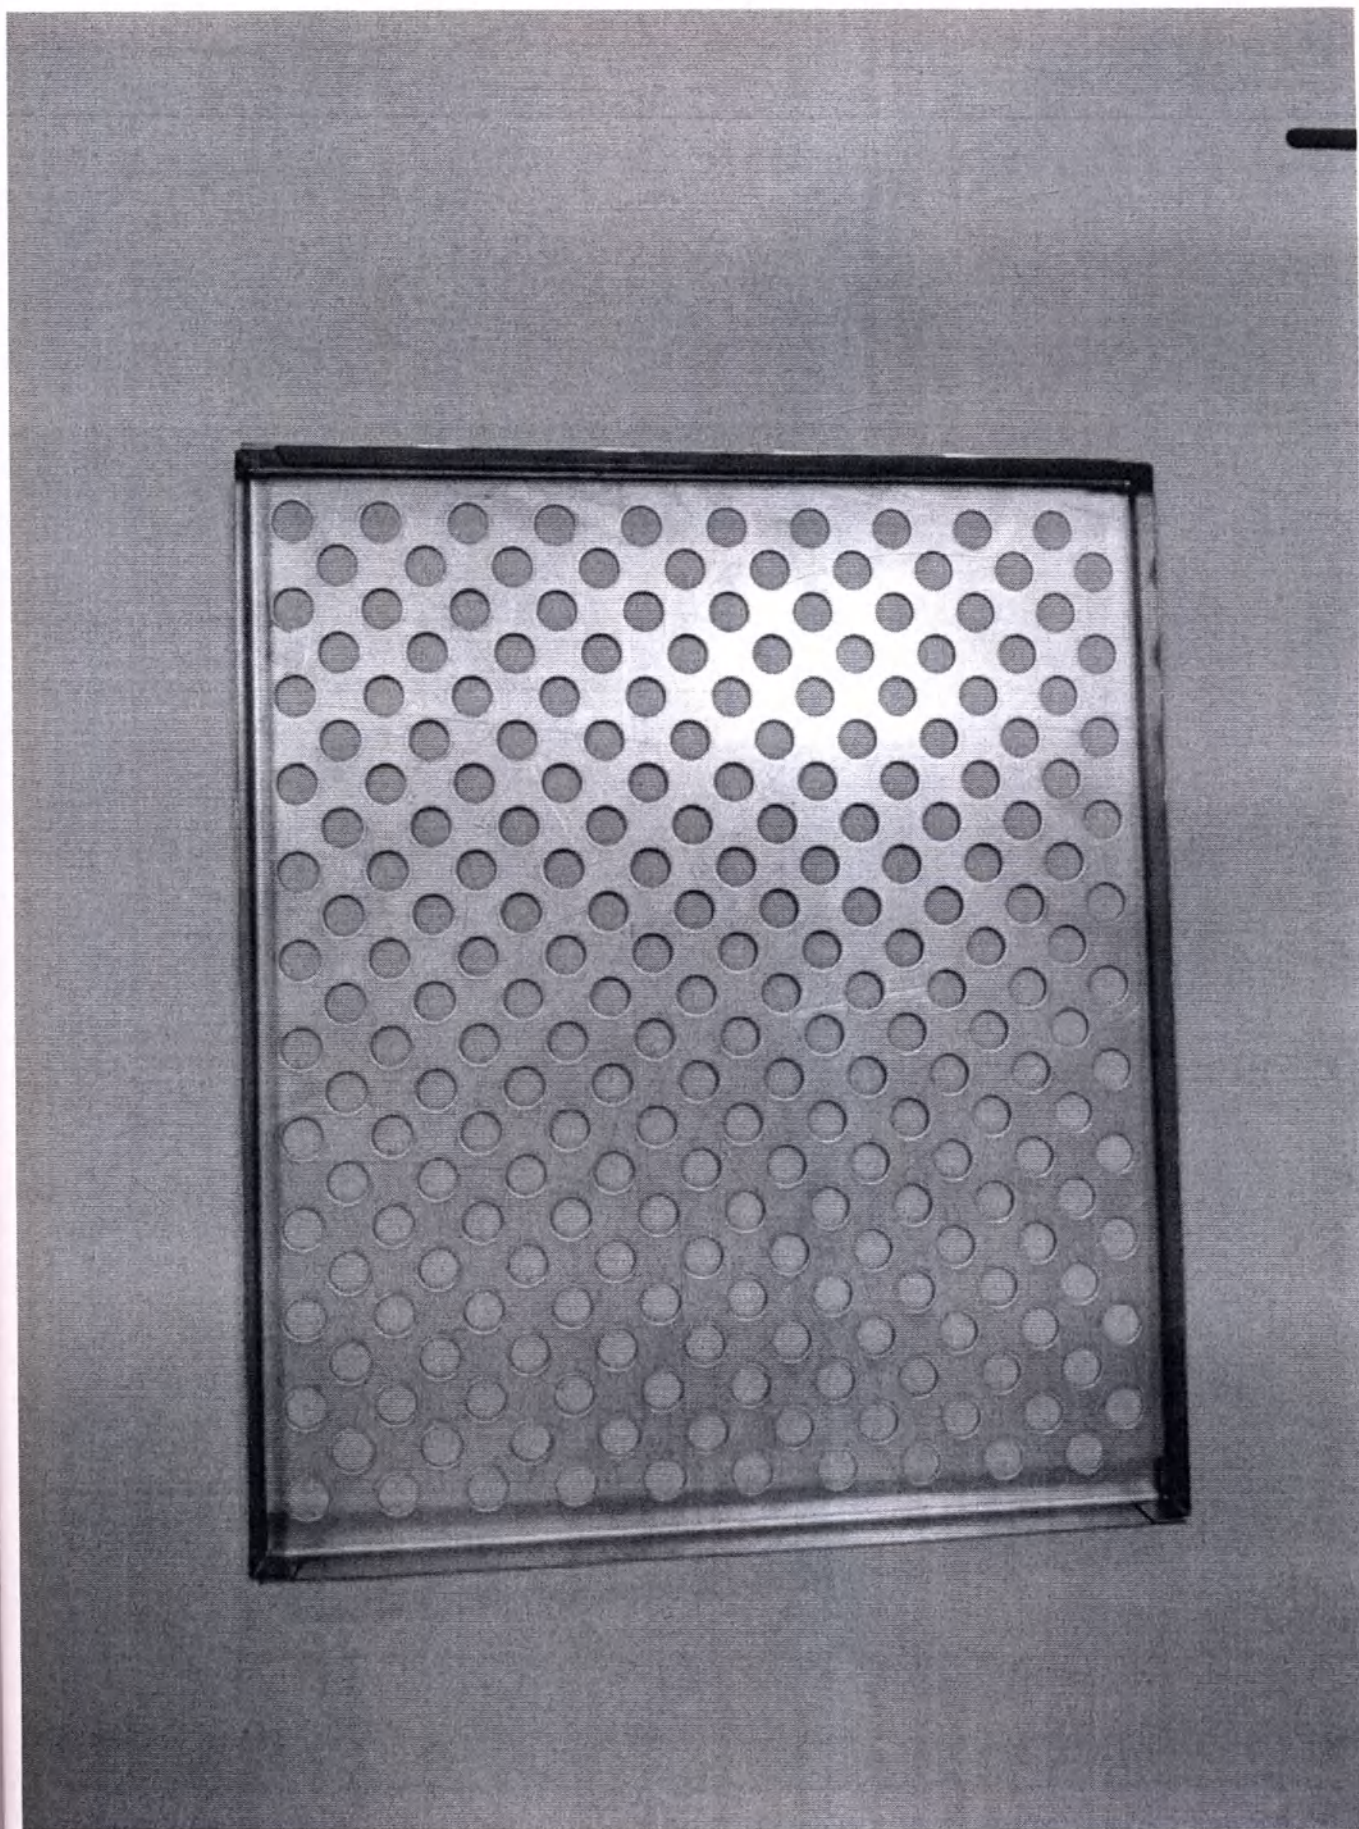

Фотографическое изображение 23. Поддон КИУС.745216.077-01

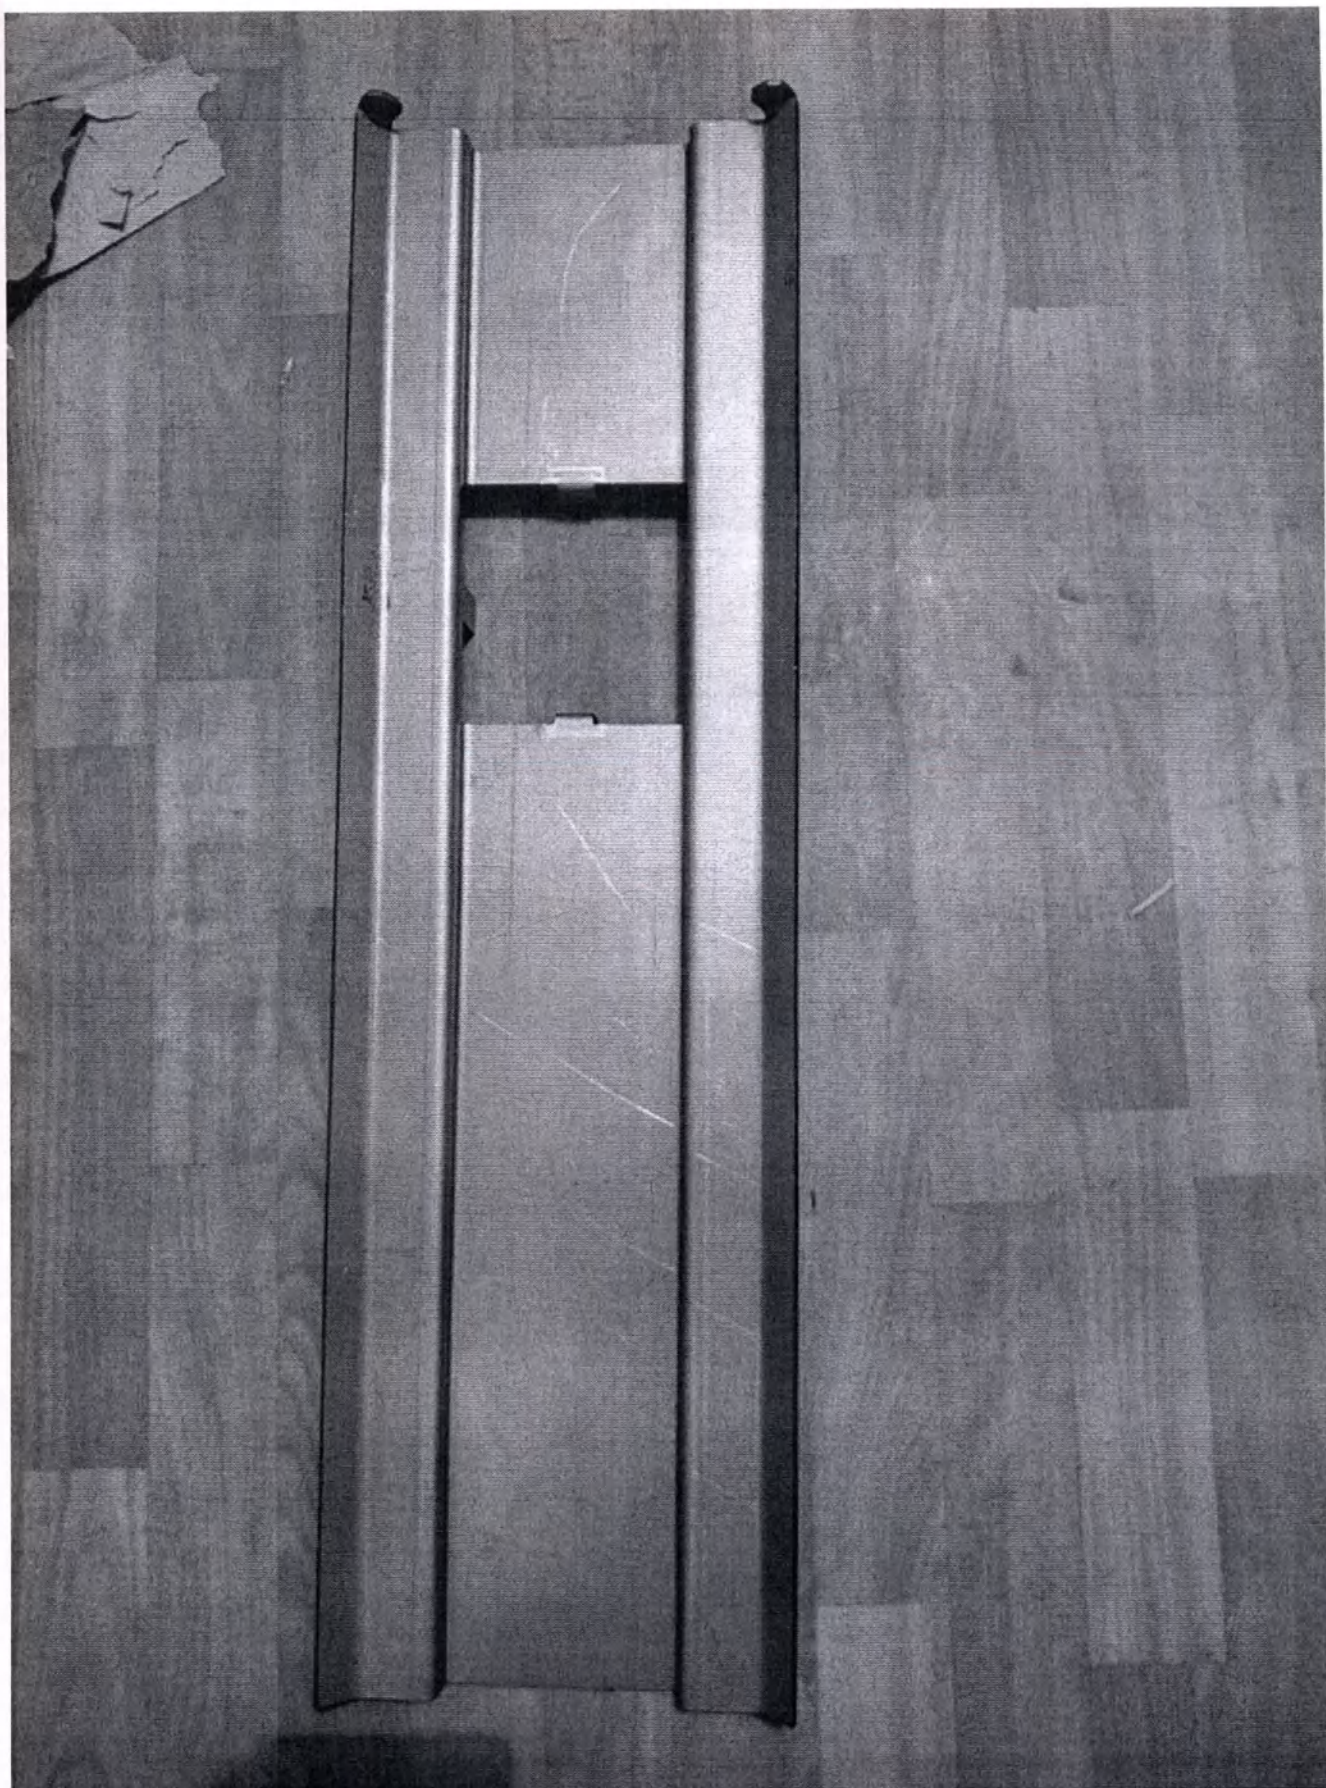


Фотографическое изображение 24. Подставка КИУС.745422.142-01



Фотографическое изображение 25. Кабель интерфейсный



Фотографическое изображение 26. Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО¹

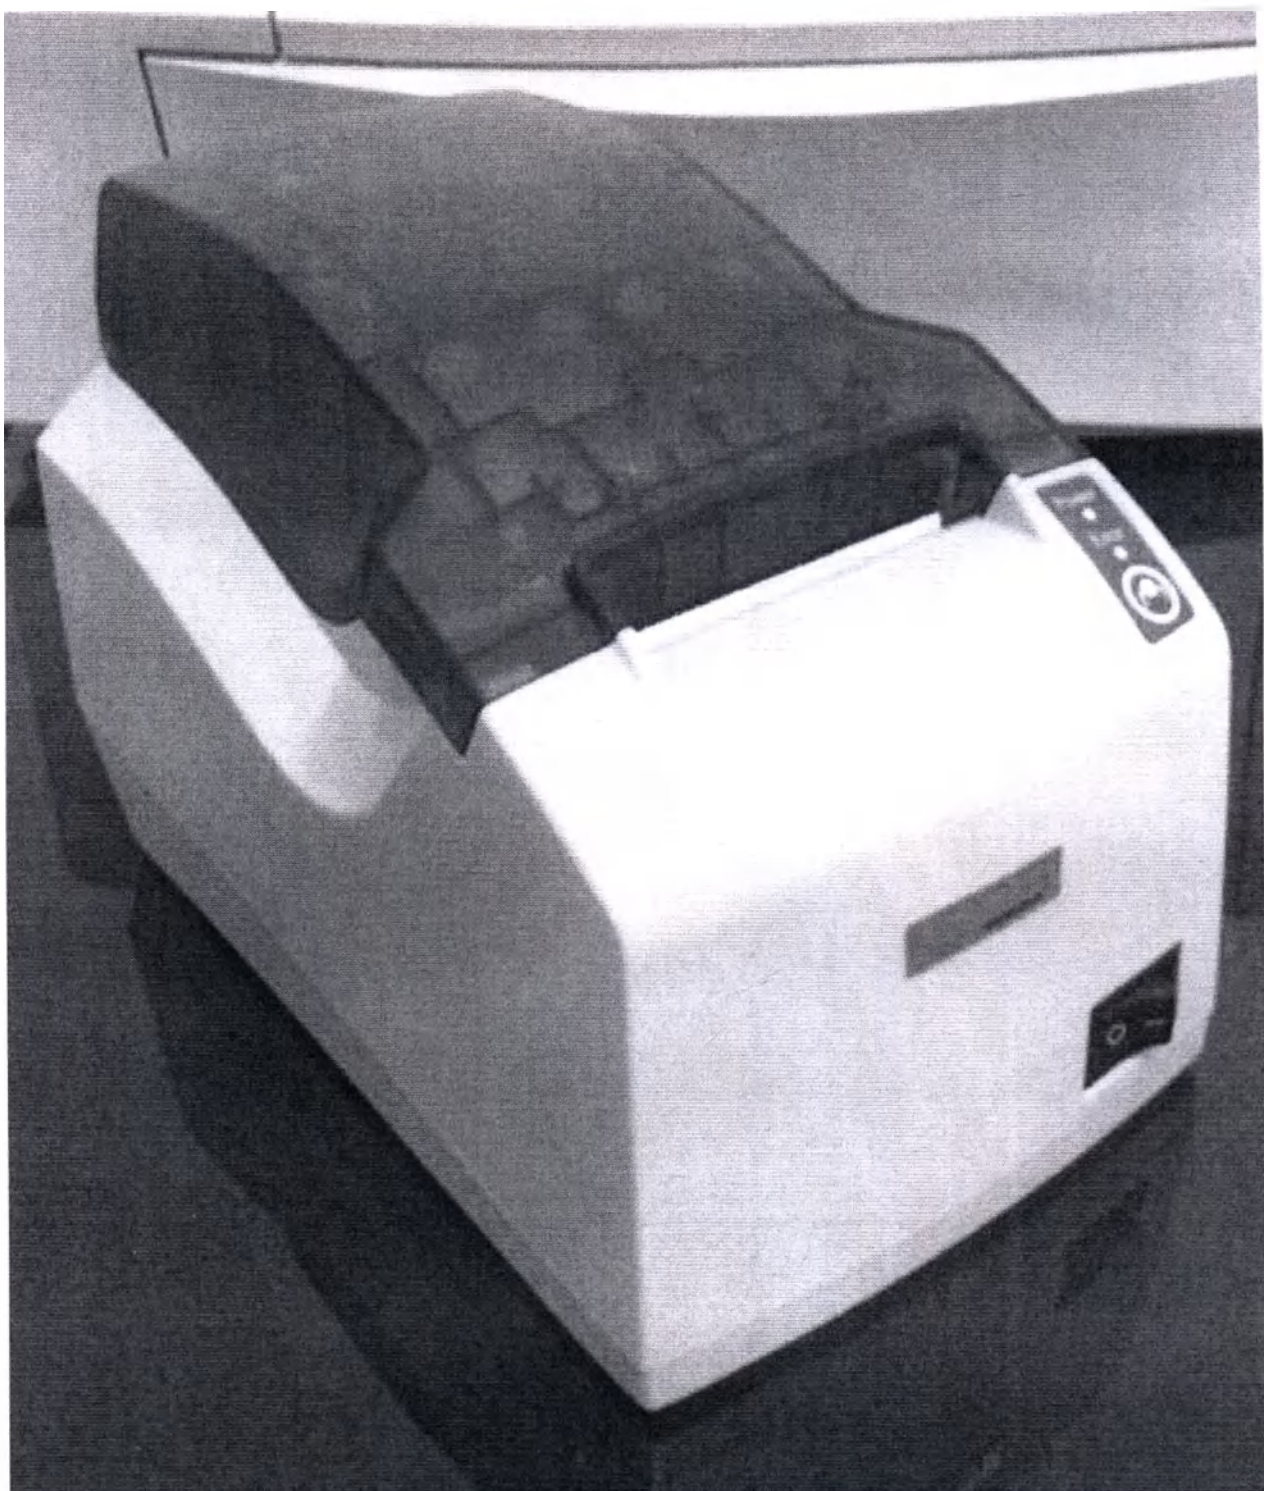

Фотографическое изображение 27. Принтер'



Фотографическое изображение 28. Наконечник



Фотографическое изображение 29. Клемма

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

30 листов(а)

Тридцать листов

Директор АО «ГРПЗ» - филиал
«Касимовский приборный завод»

Каравачев В.М.

