

PHILIPS


Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система мониторинга пациента во время магнитно-
резонансной томографии Essential с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Директор по нормативно-правовому
регулированию и качеству
ООО «ФИЛИПС»

О.В.Бахвалова

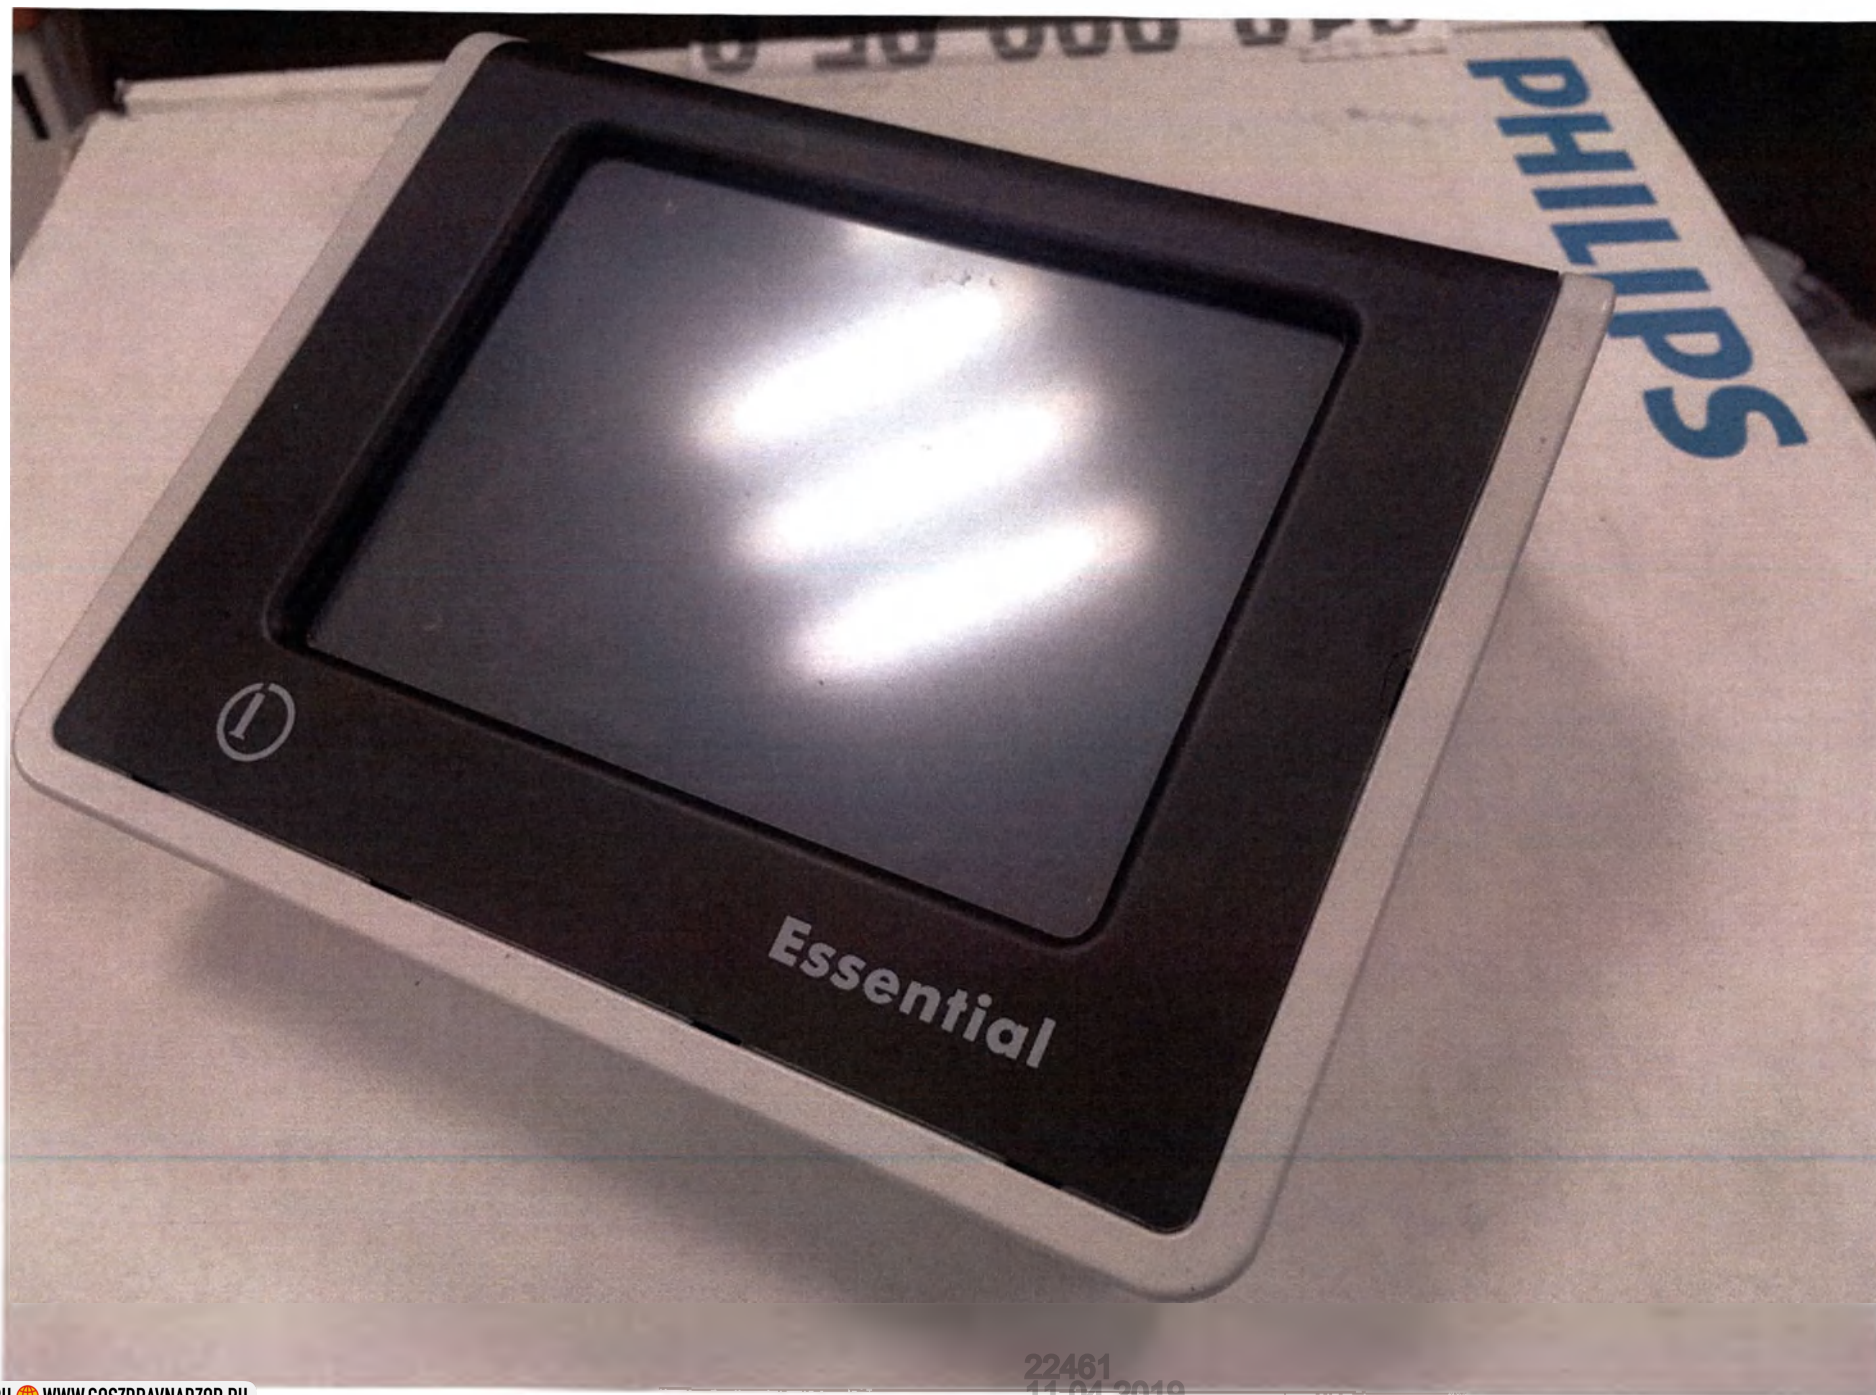

Система мониторинга пациента во время МРТ Essential

Собрано для «Инвиво, подразделение Филипс Меликал Системс»

12151 Ресерч Парквэй, Орландо, Флорида 32826, США

Изготовлено в Сингапуре

Модель: 865353

Размеры: 

Масса: 1 кг

Дата производства, серийный номер: см. маркировку изделия

Номинальная мощность: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

ERC

Блок аппарата базовый.



II. Принадлежности:

1. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).


5



II. Принадлежности:

1. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).


6

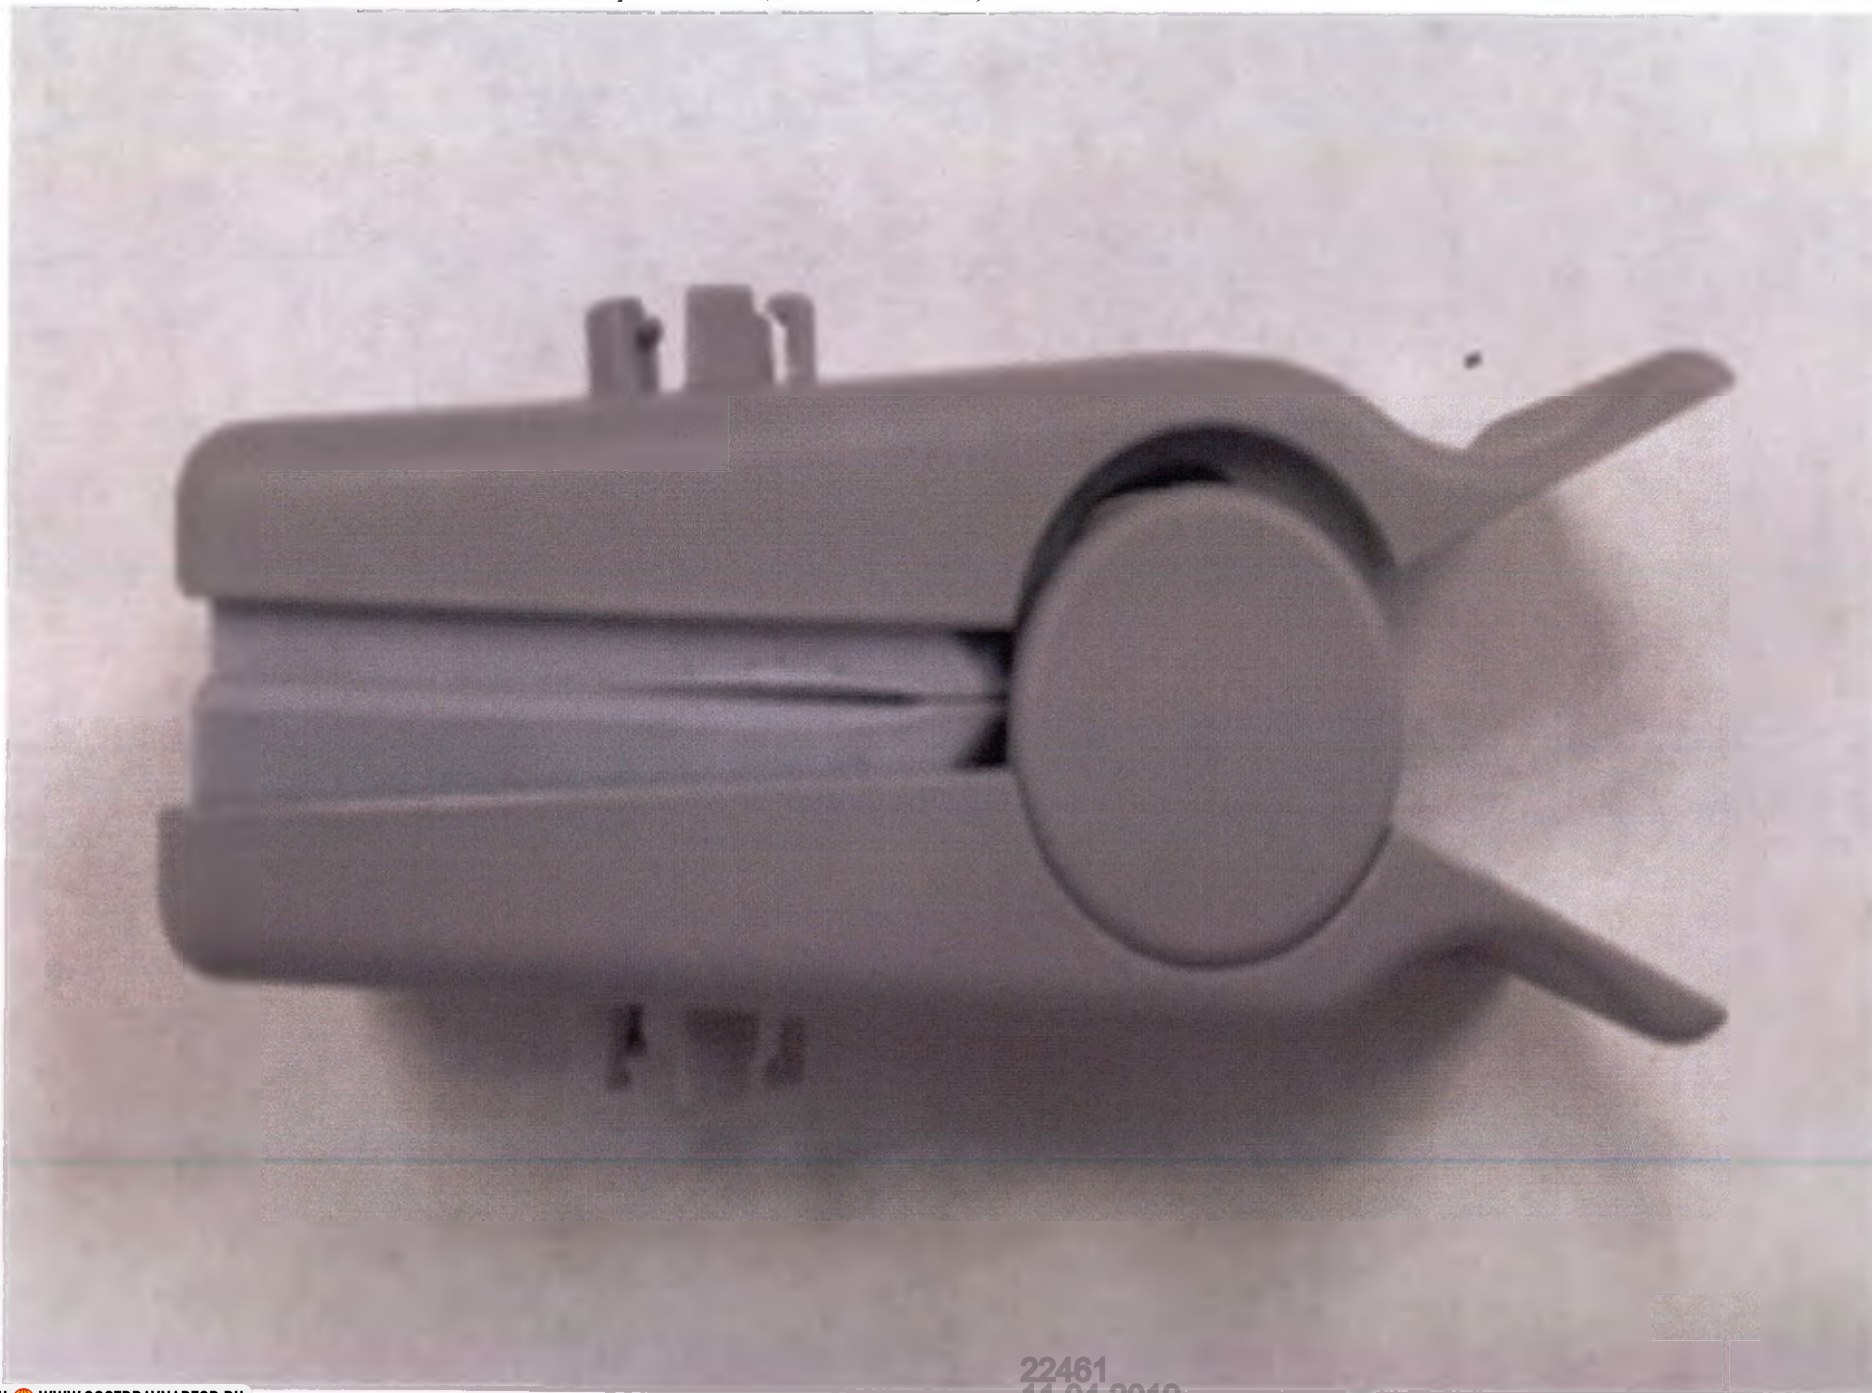

II. Принадлежности:


1. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).

7

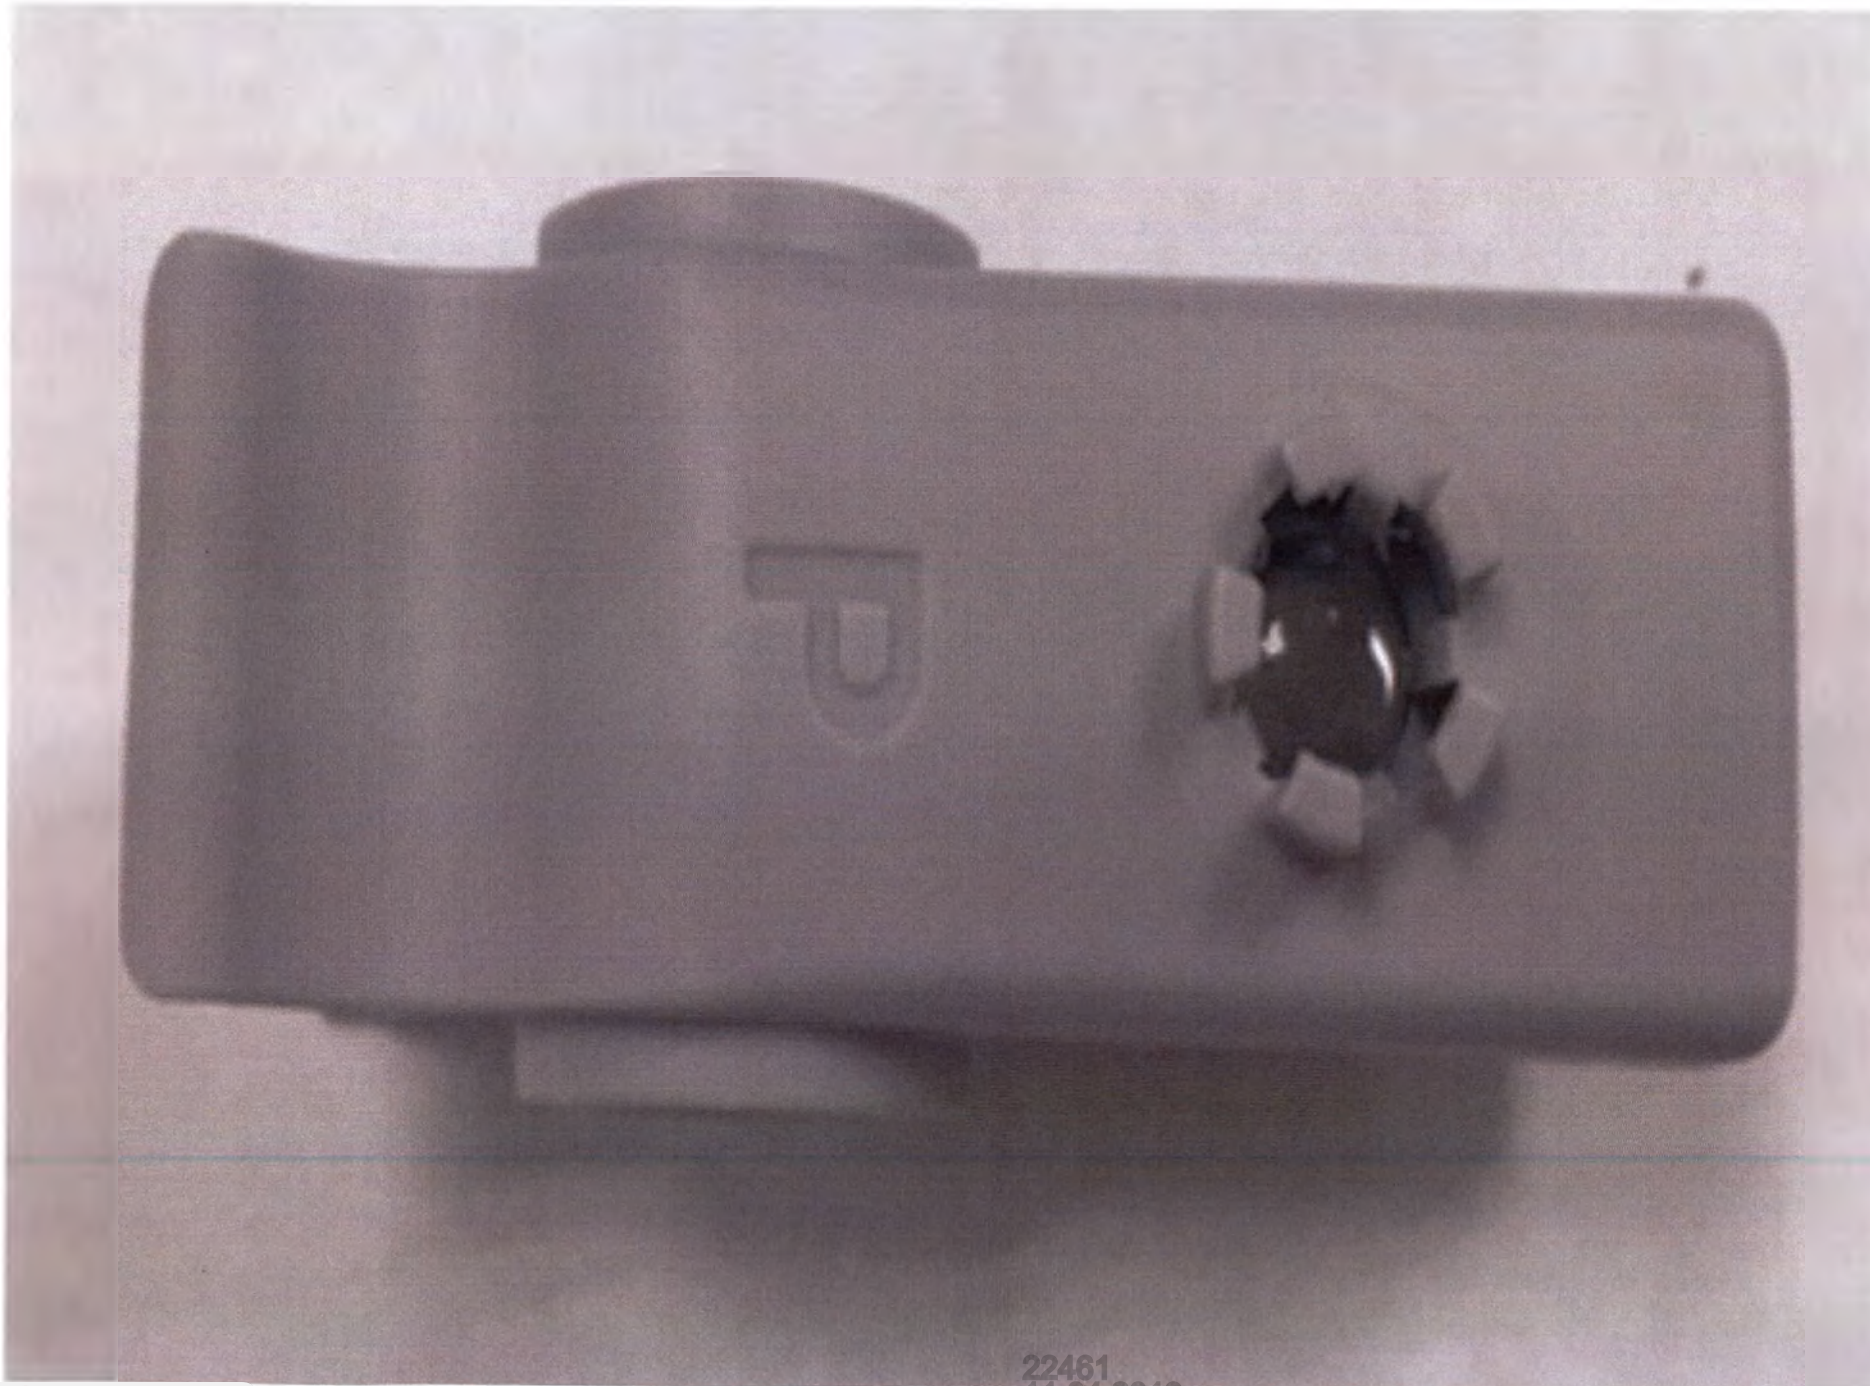

II. Принадлежности:

1. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).

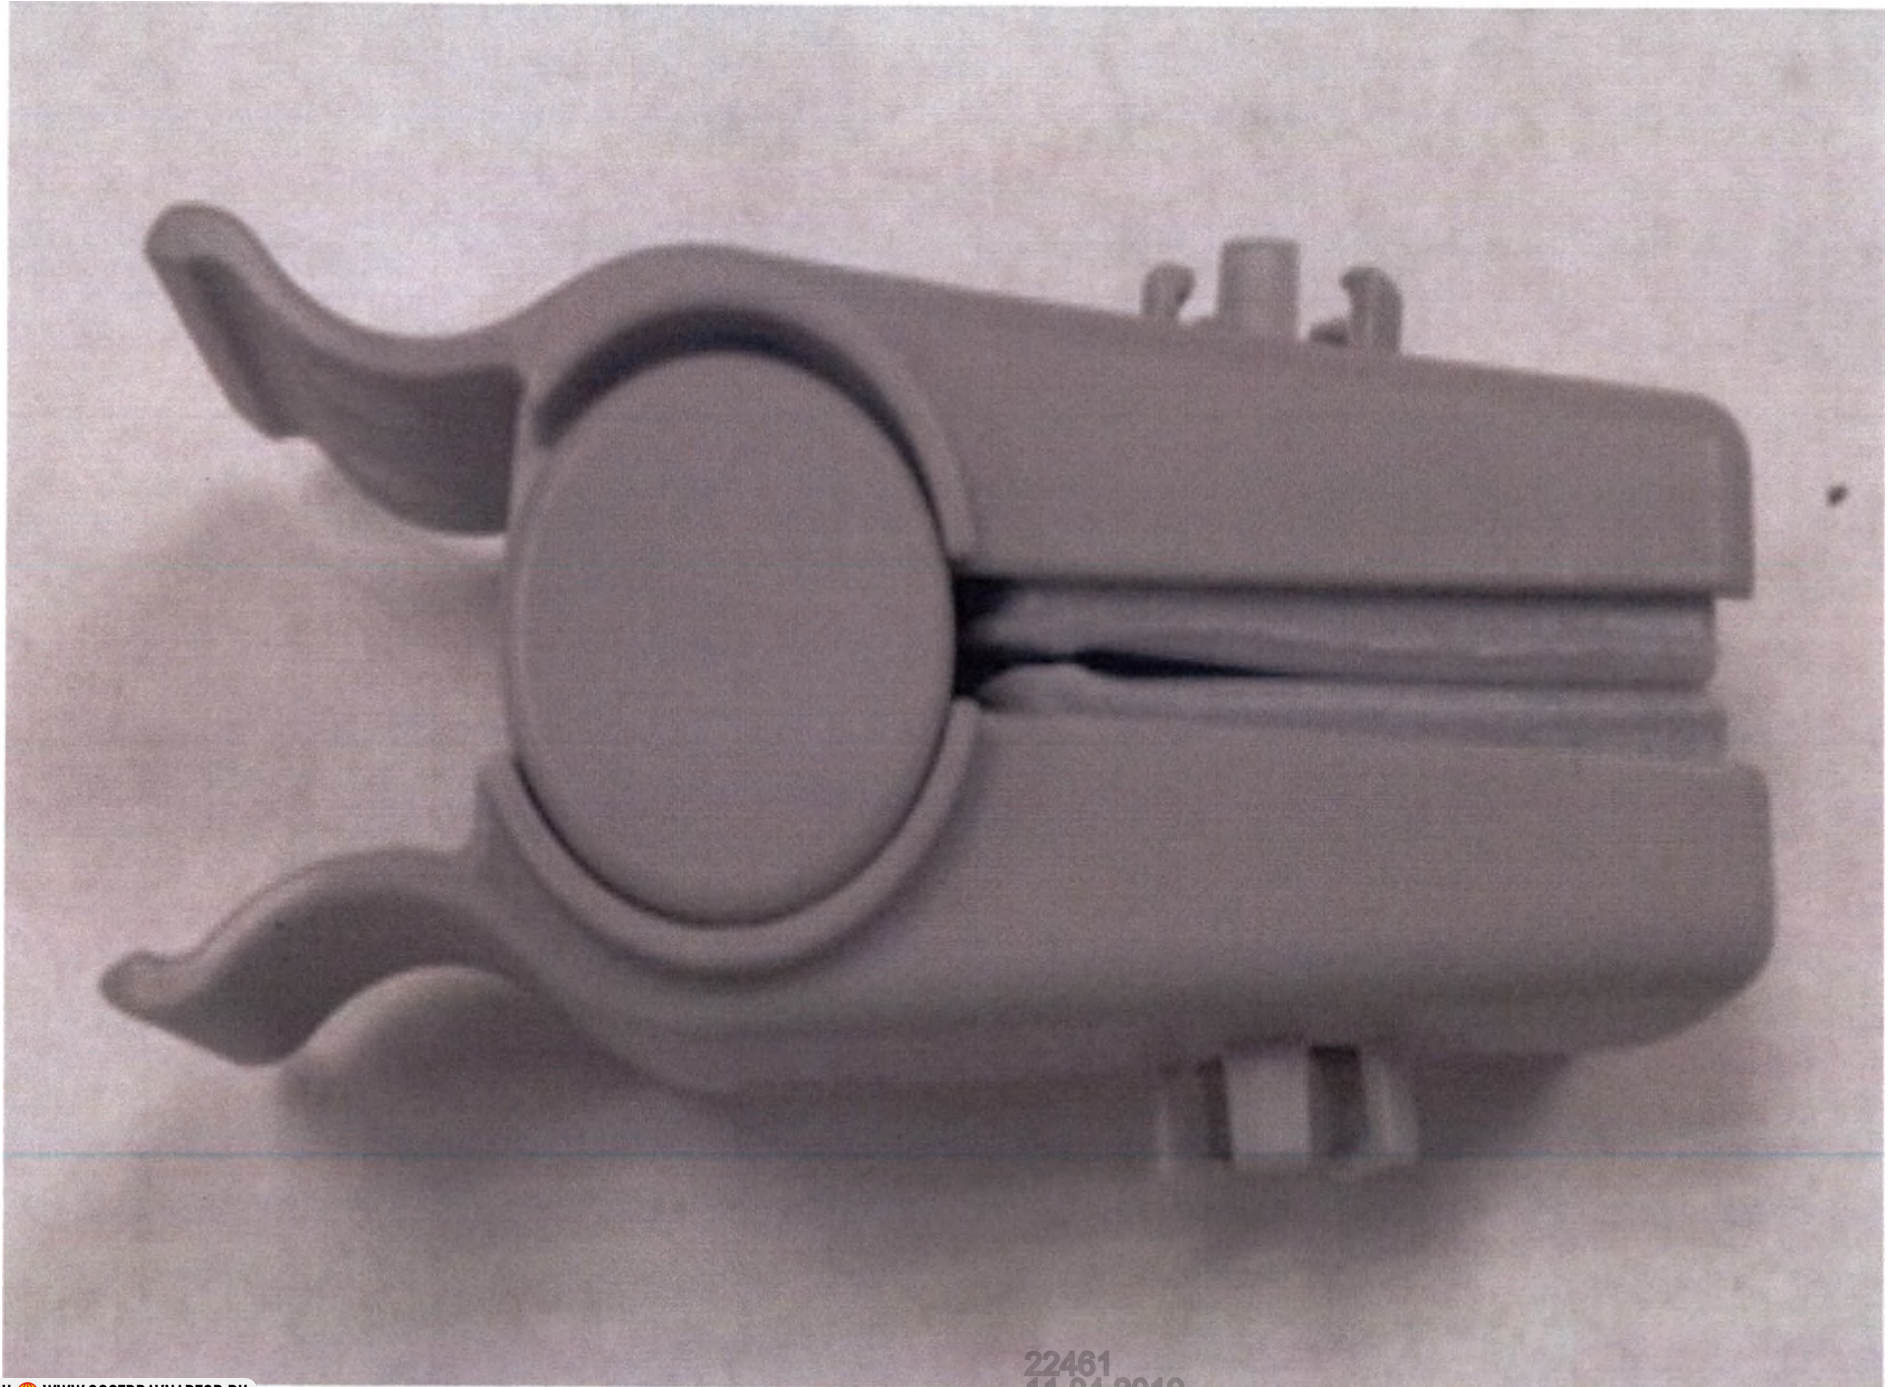

2. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).




2. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).




2. Зажимы-клипса для датчика пульсоксиметрического (не более 10 шт.).



3. Датчики пульсоксиметрические (не более 10 шт.).

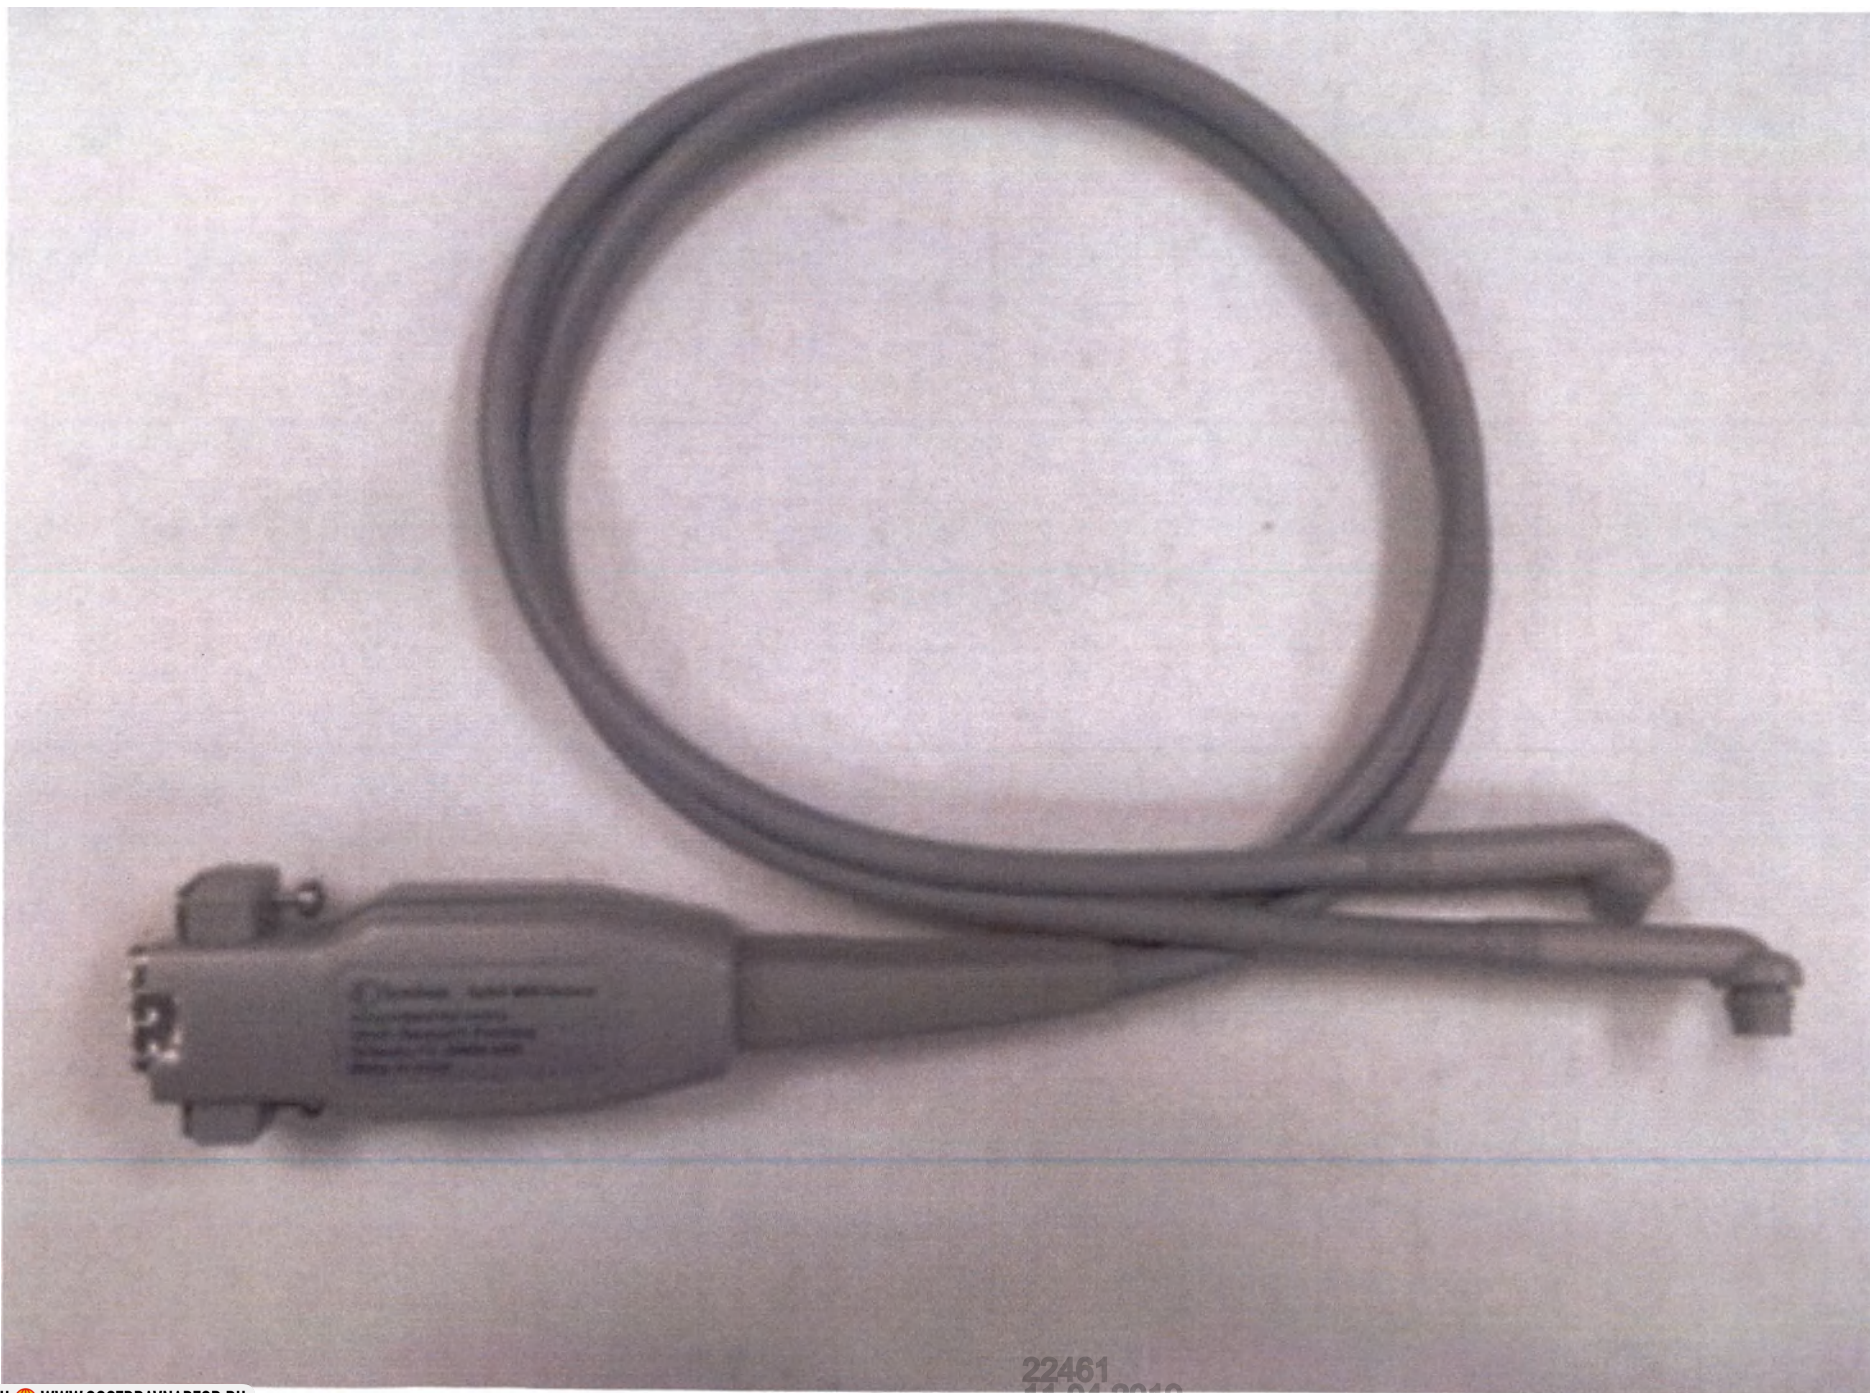

3. Датчики пульсоксиметрические (не более 10 шт.).

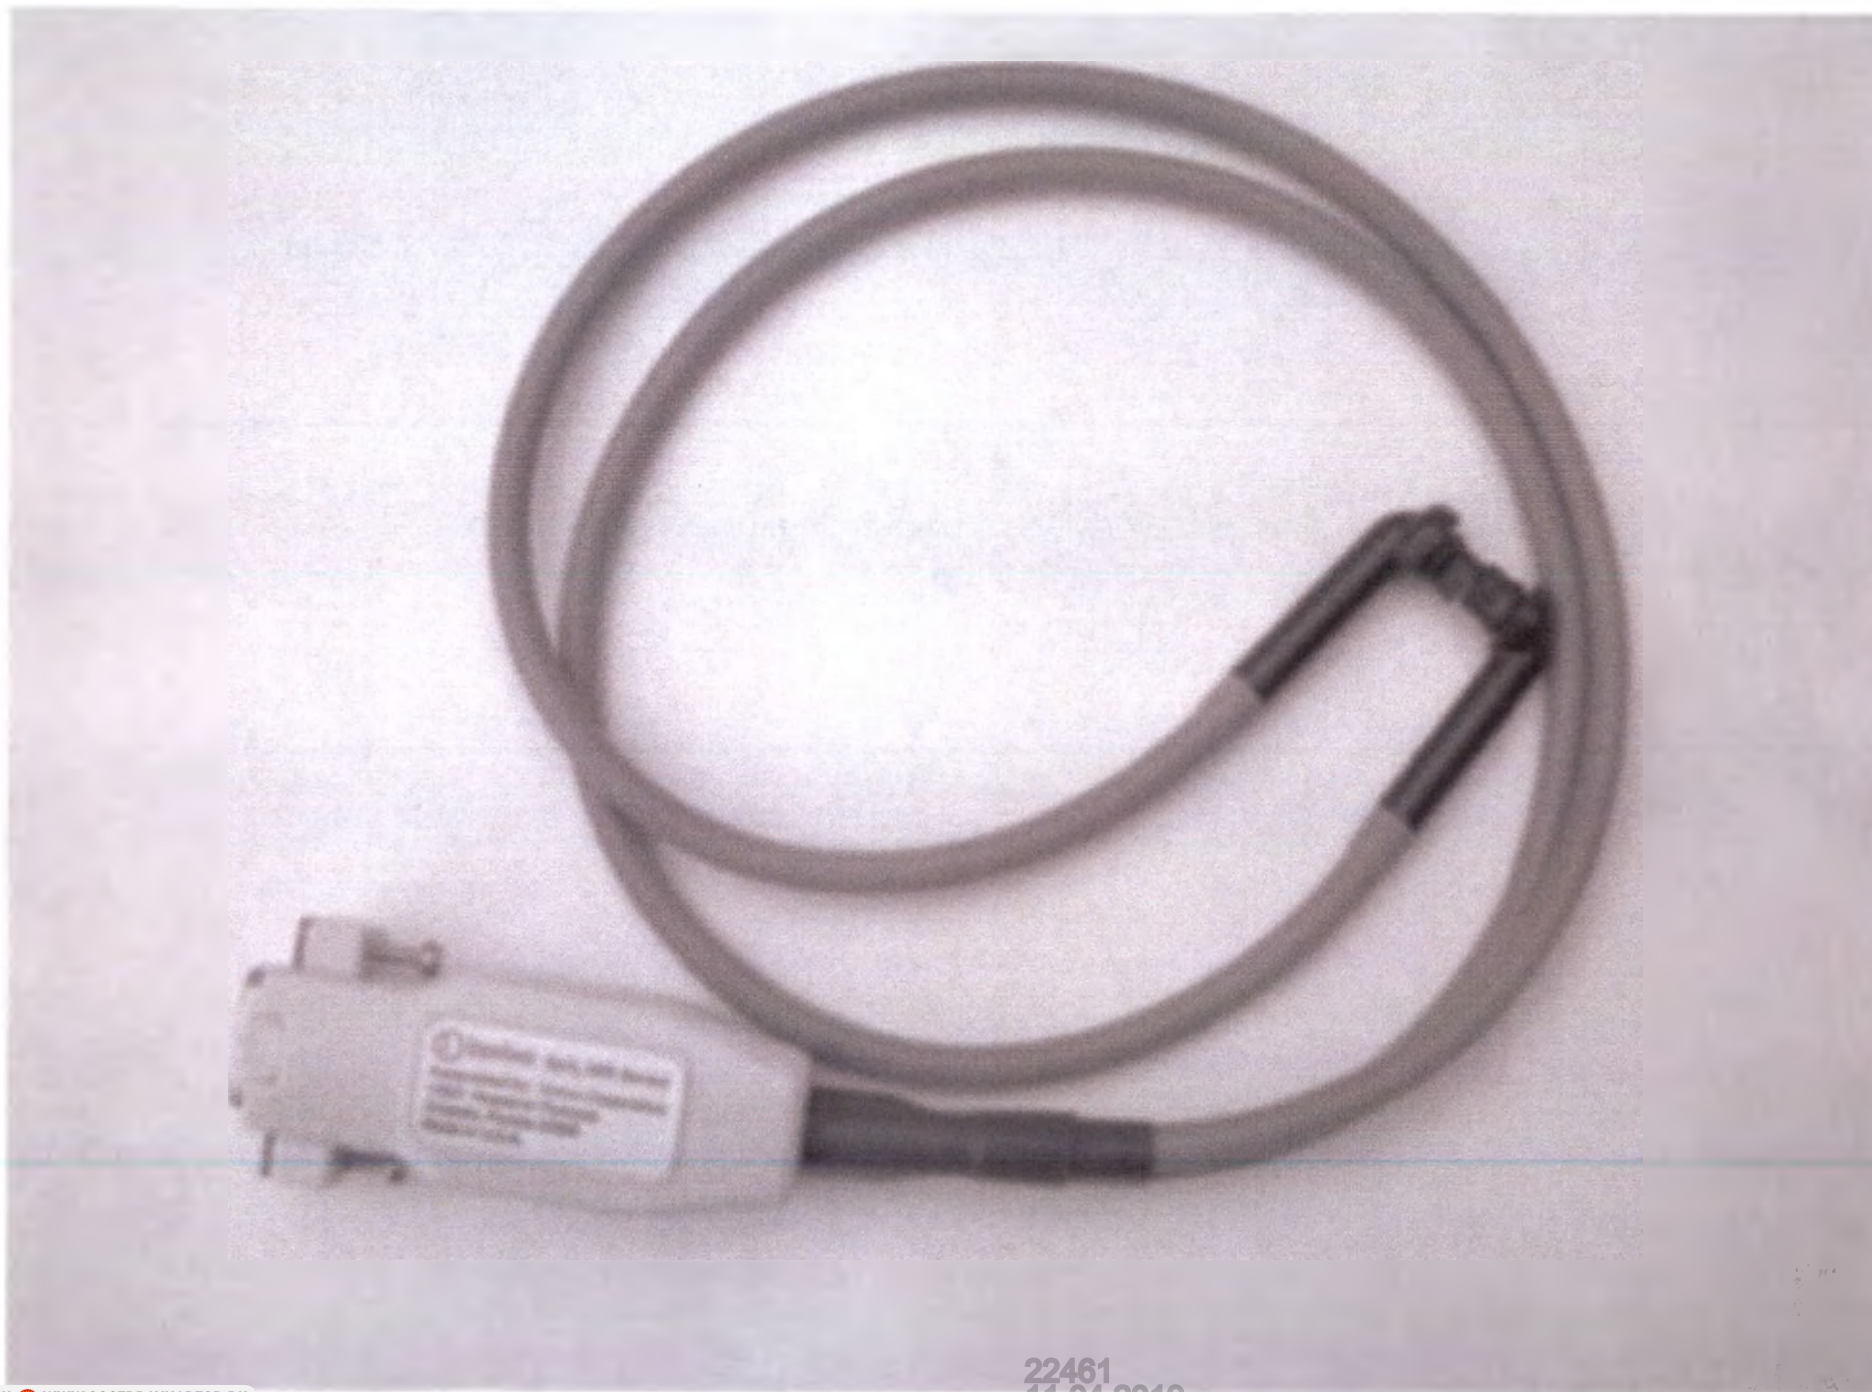

4. Модули беспроводные пульсоксиметрические (не более 2 шт.).




4. Модули беспроводные пульсоксиметрические (не более 2 шт.).



5. Аккумуляторы основные (не более 2 шт.).



6. Аккумуляторы модулей (не более 4 шт.).

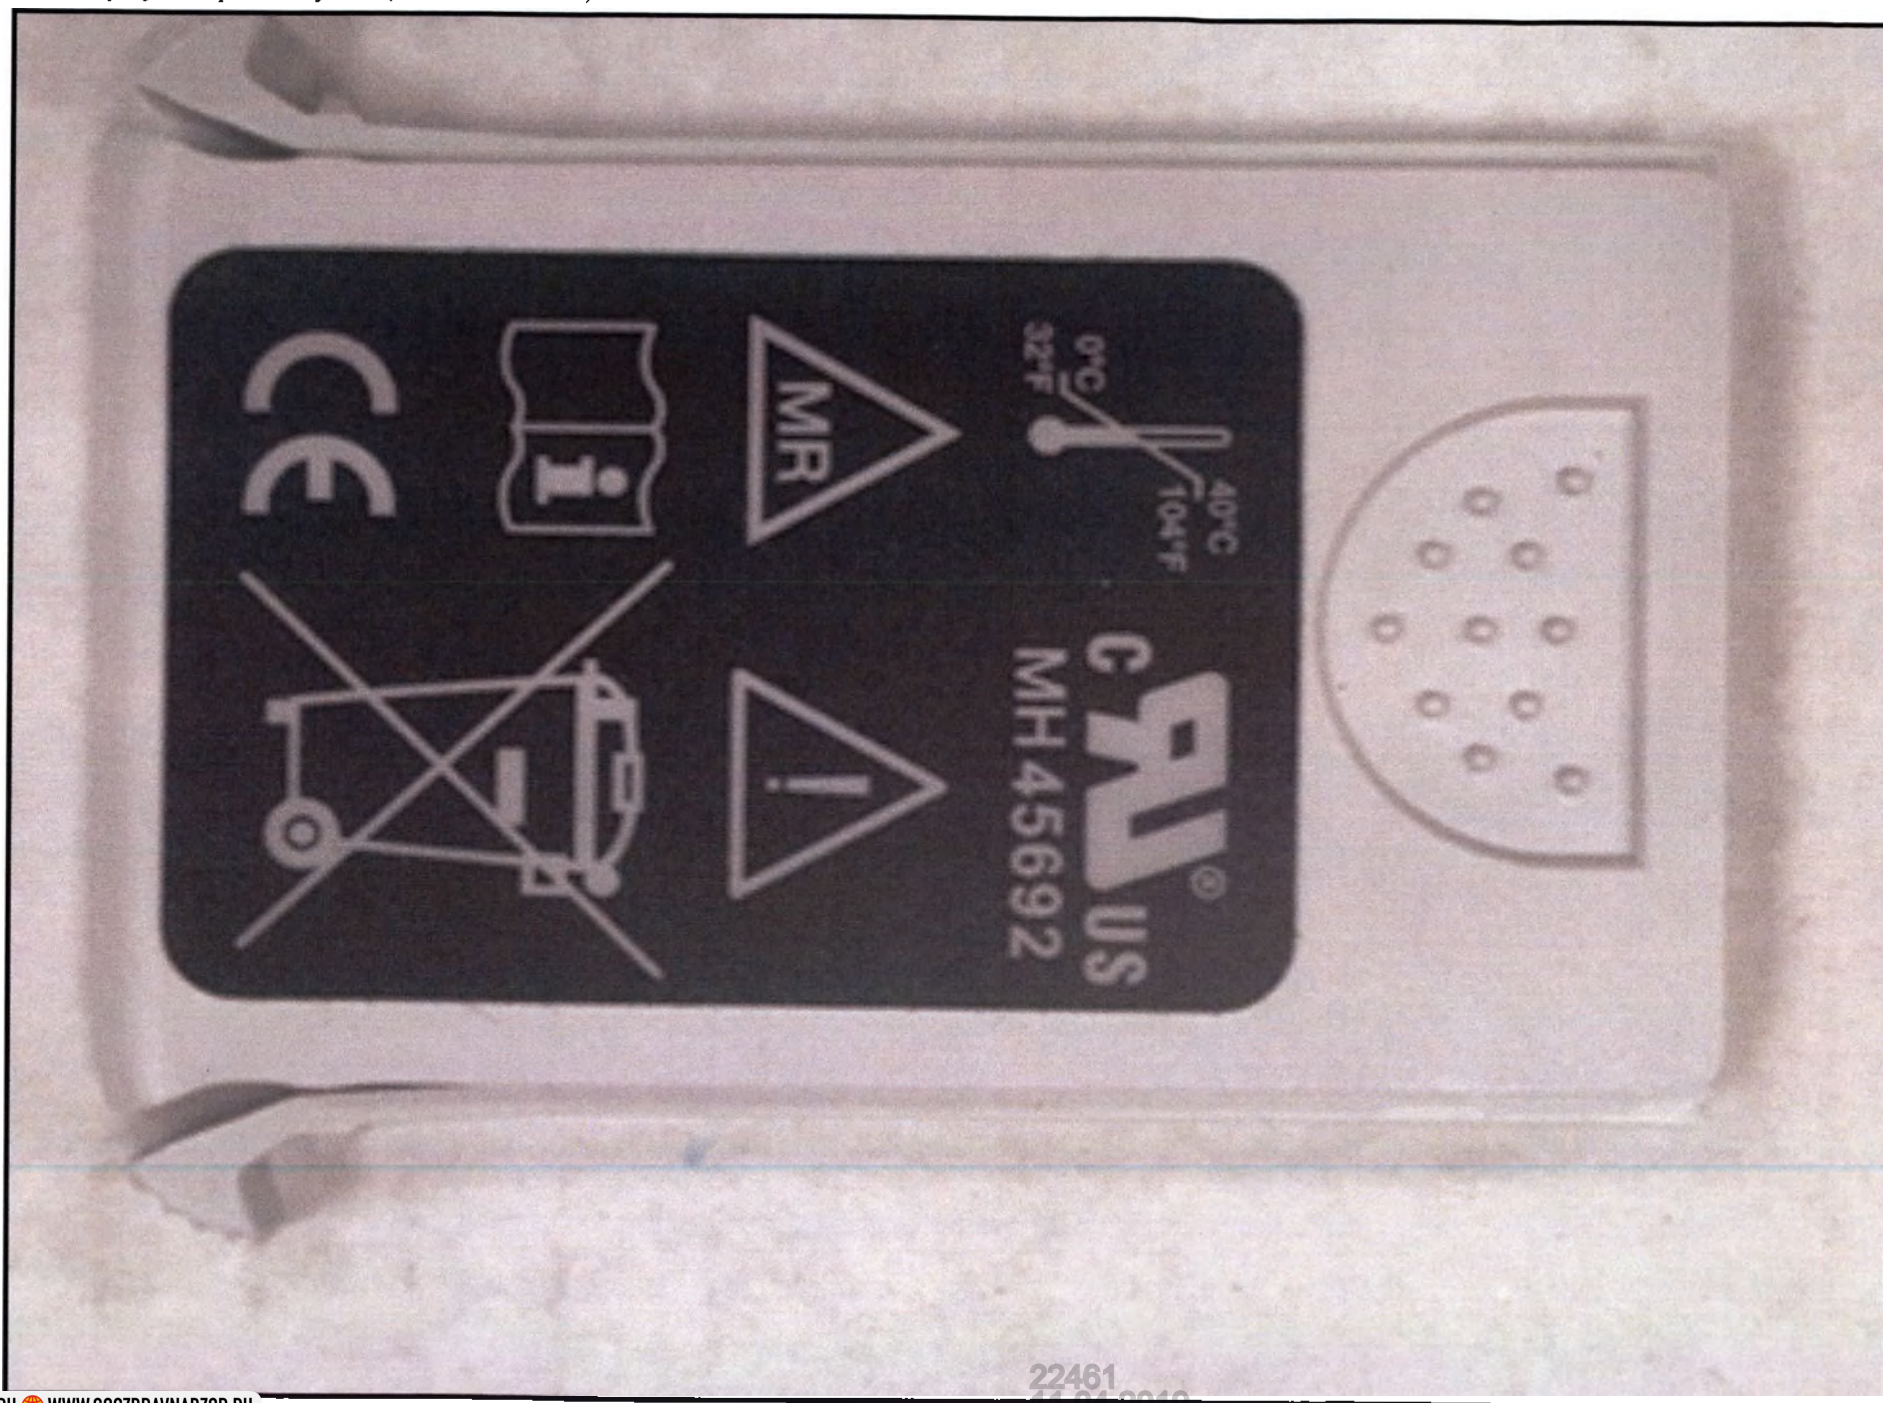

7. Адаптеры питания (не более 5 шт.).




8. Шнуры питания (не более 5 шт.).



9. Футляр для переноски.




10. Стойка подвижная.

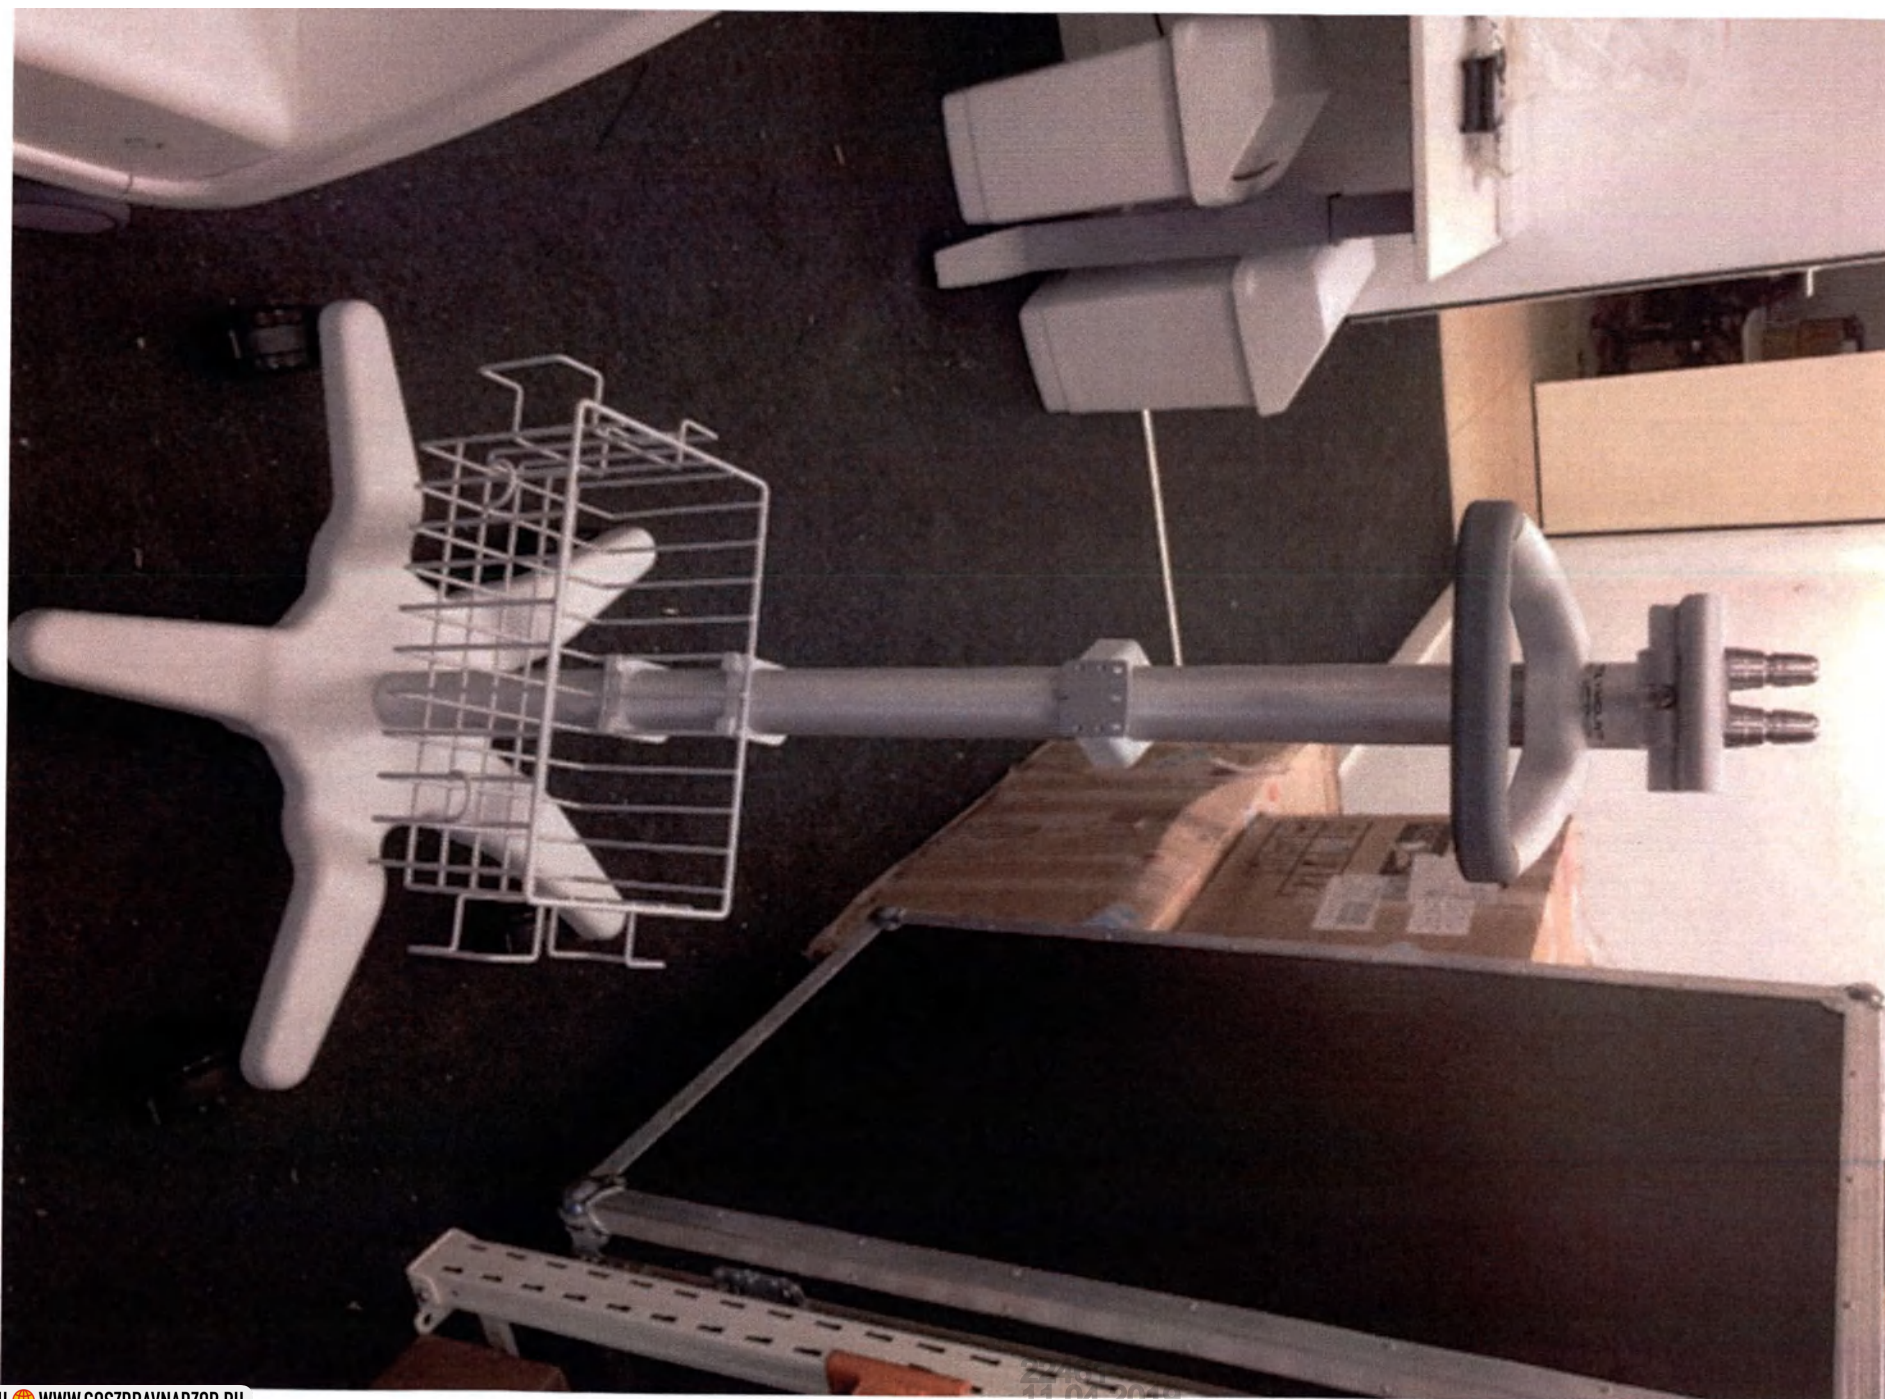

11. Универсальное крепление:

- Штырьки (2шт.); - Зажим; - Ручка; - Винт с накатанной головкой

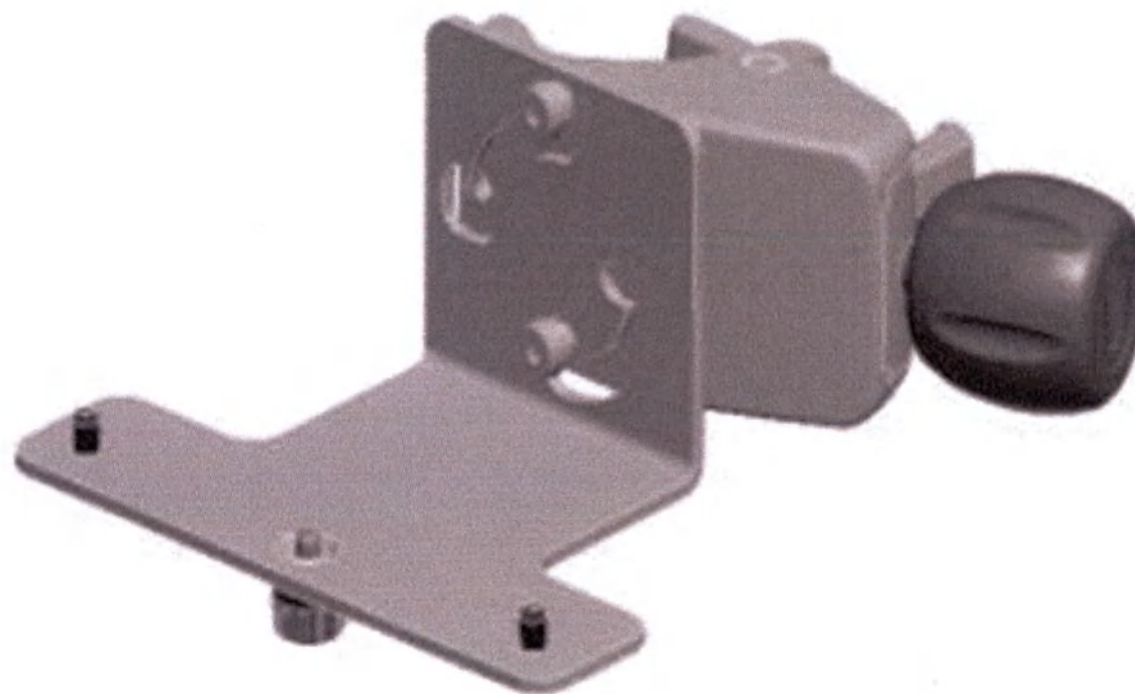

12. Инструкция по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителях.

PHILIPS

Монитор пациента

Essential для МРТ

(модель 865353)



Инструкция по
эксплуатации
Версия E
На русском языке



9690001234021




Essential MRI Patient Monitor

(Model 865553)



SERVICE MANUAL

Revision C



13. Руководство сервисное на бумажном и/или электронном носителях.

14. Программное обеспечение на электронных носителях.



14. Программное обеспечение на электронных носителях.





ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (СВ)

27

10.04.19г.

Handwritten signature

