


Руководитель отдела регистрации

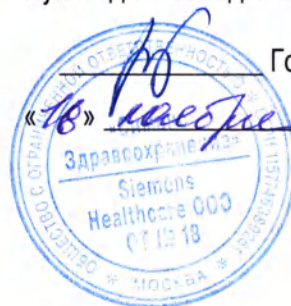

Горшкова Н.А.

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Анализатор автоматический осадка мочи Atellica UAS 800

«Сименс Хэлскеа Диагностика Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

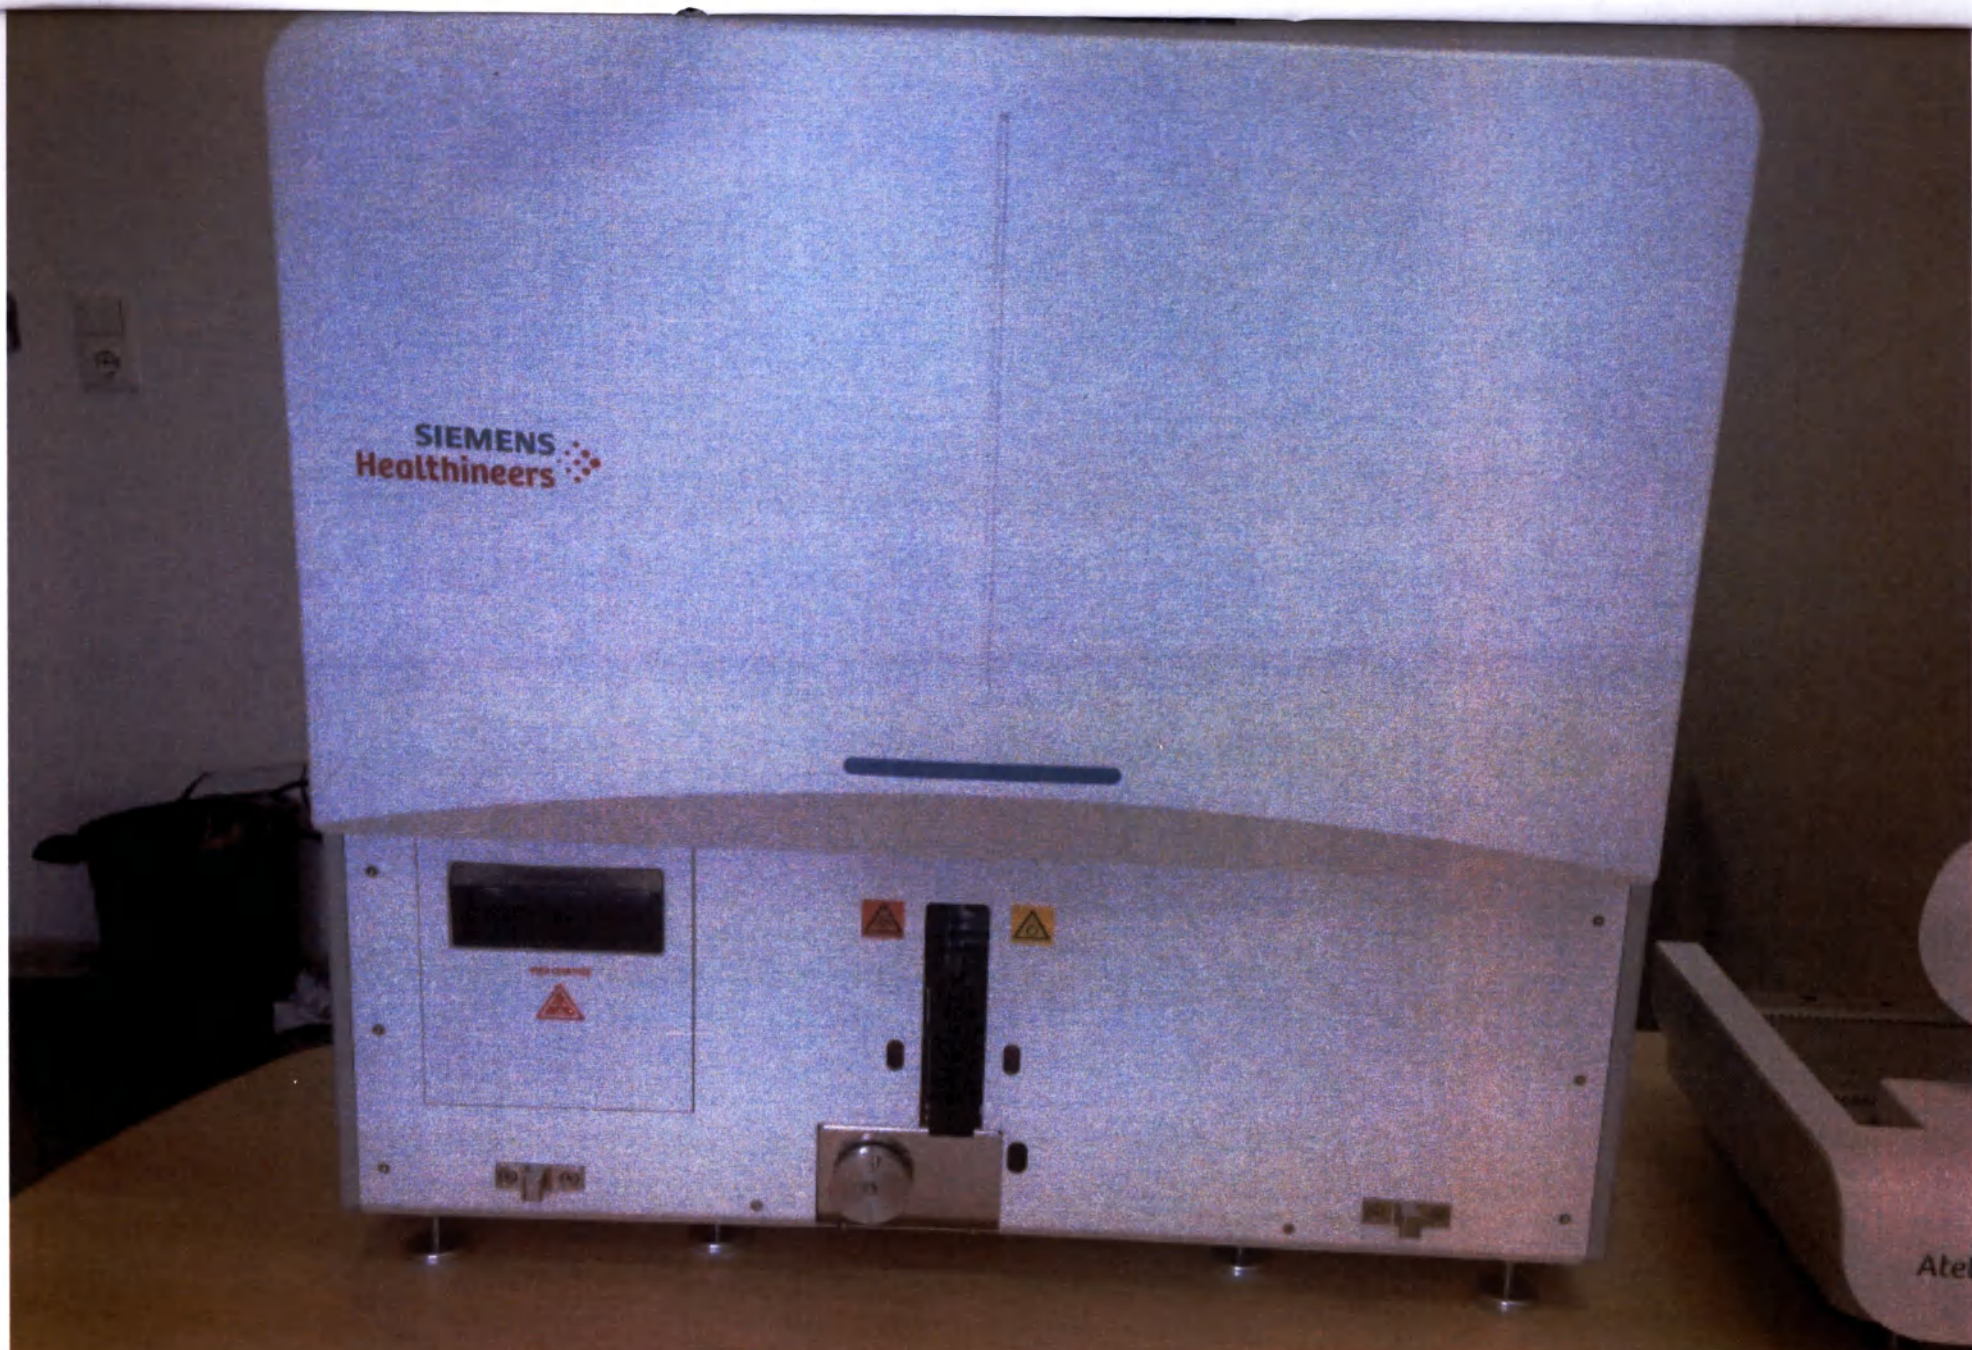
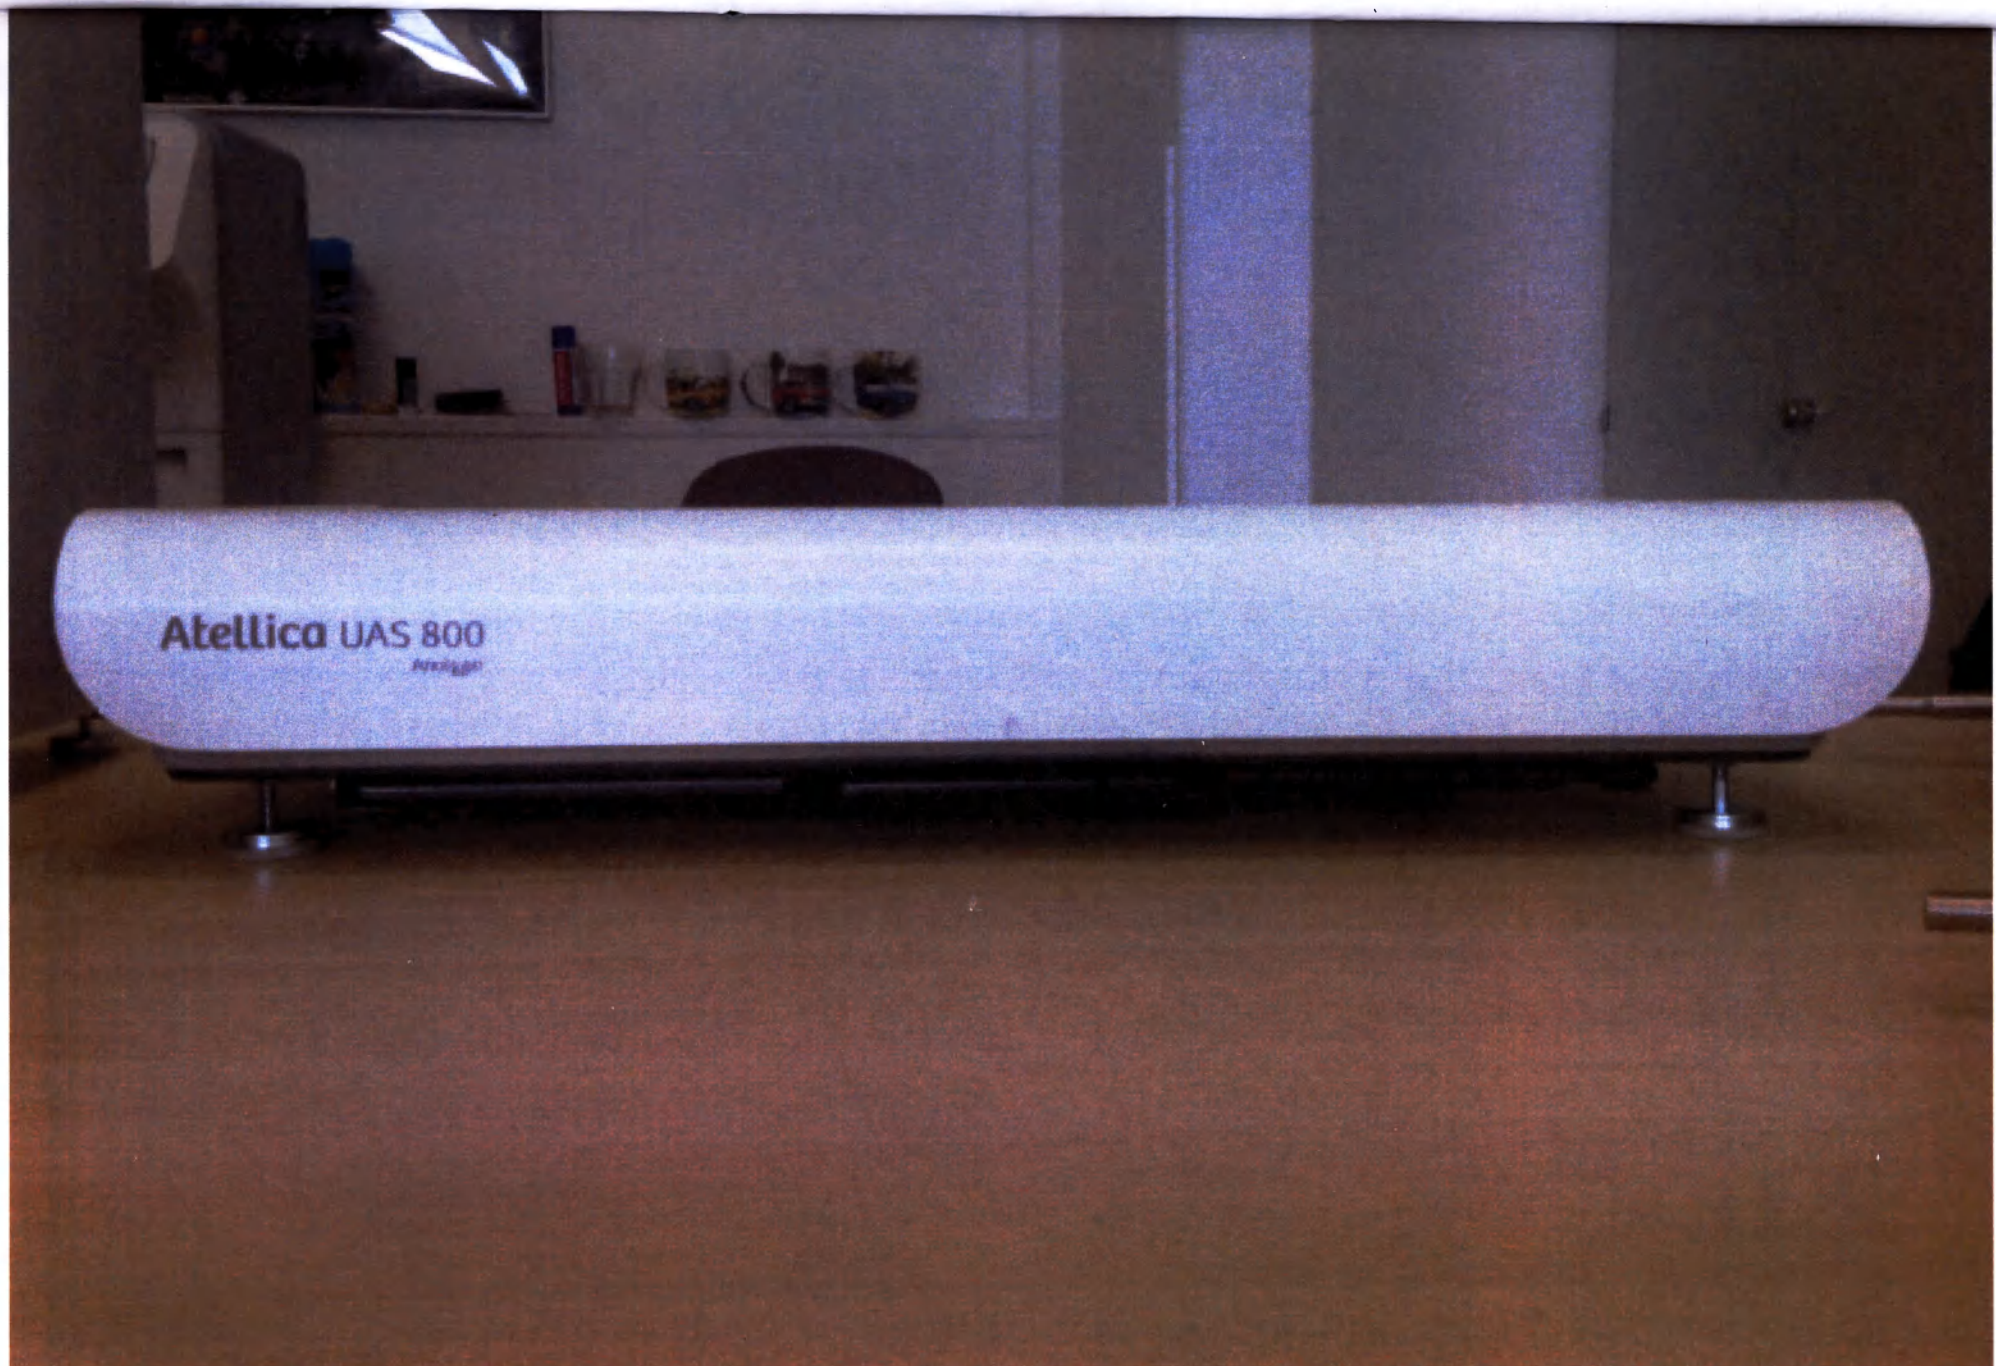
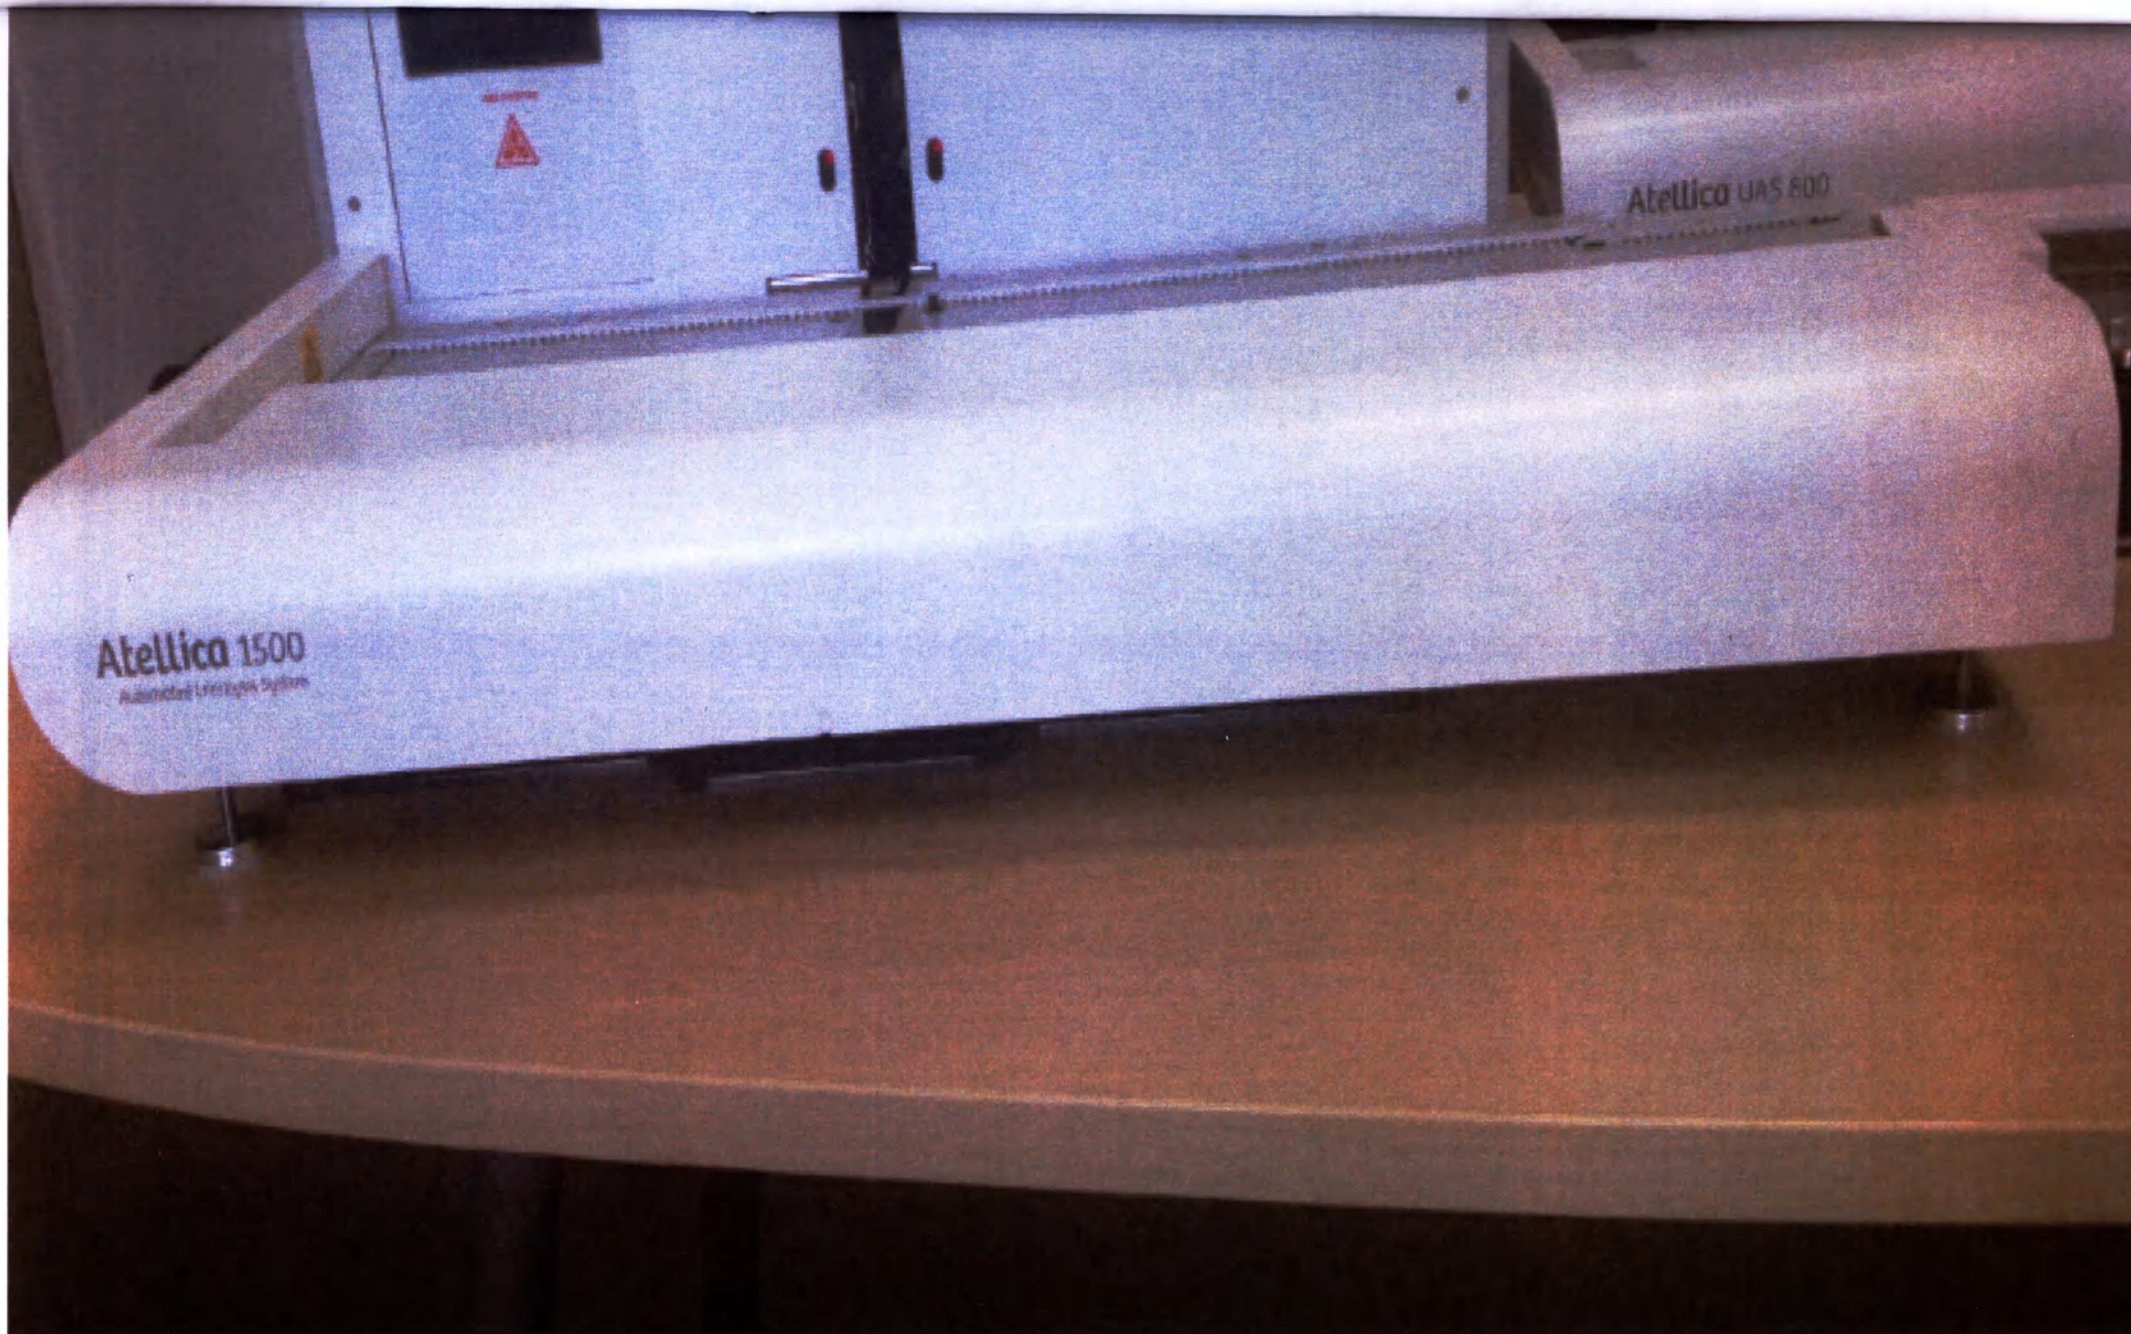


Рисунок 1. Анализатор автоматический осадка мочи Atellica UAS 800






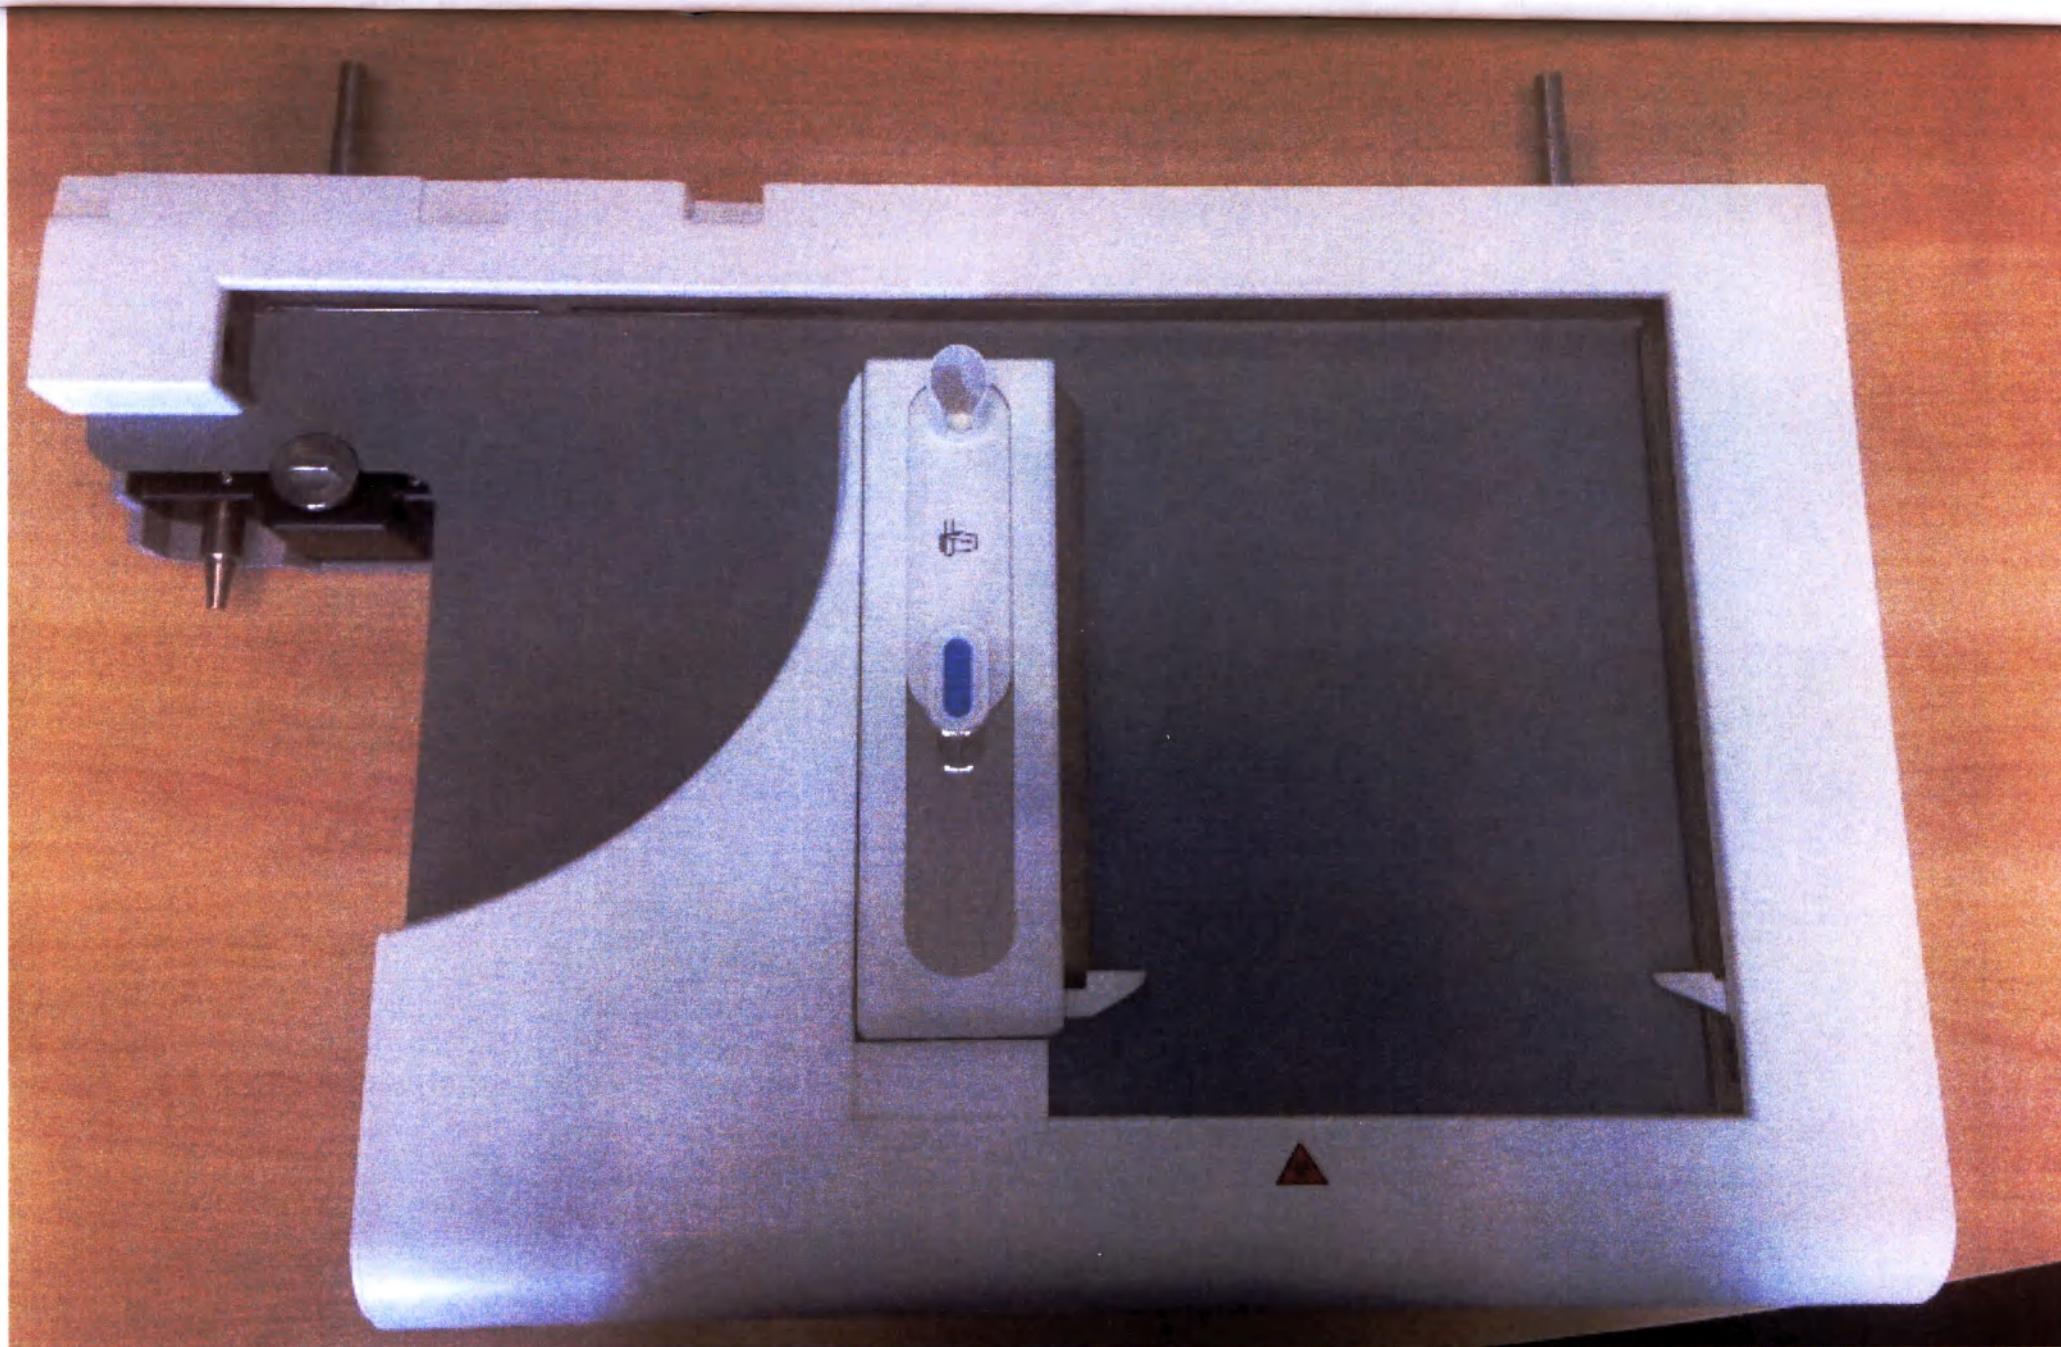


Рисунок 4. Соединительная штативная система Atellica 1500: Штативное устройство Novus - UAS 800

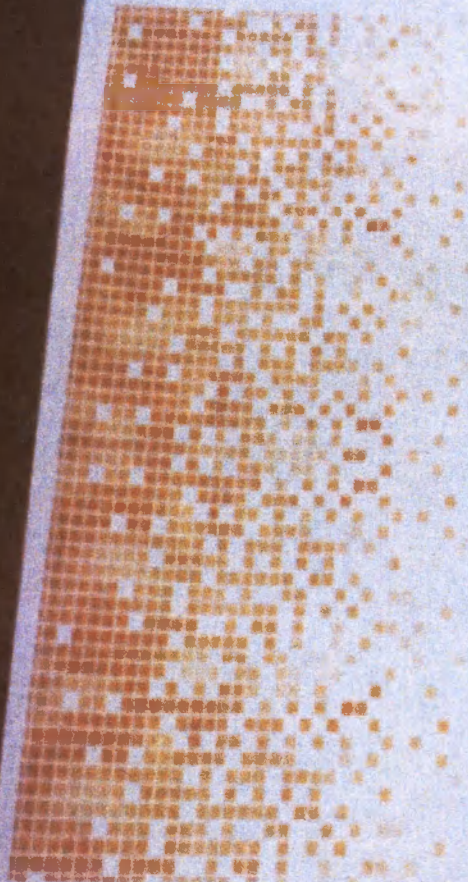

SIEMENS
Healthineers


Atellica™ UAS 800
Анализатор

Руководство
пользователя



Рисунок 5. Эксплуатационная документация пользователя

SIEMENS
Healthineers

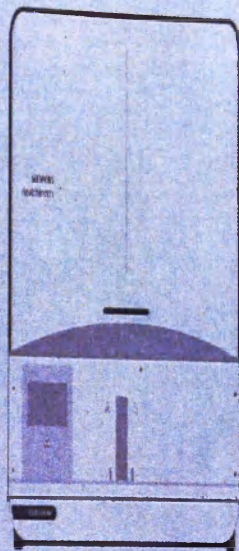

Анализатор
 **Atellica® UAS 800**

Руководство пользователя

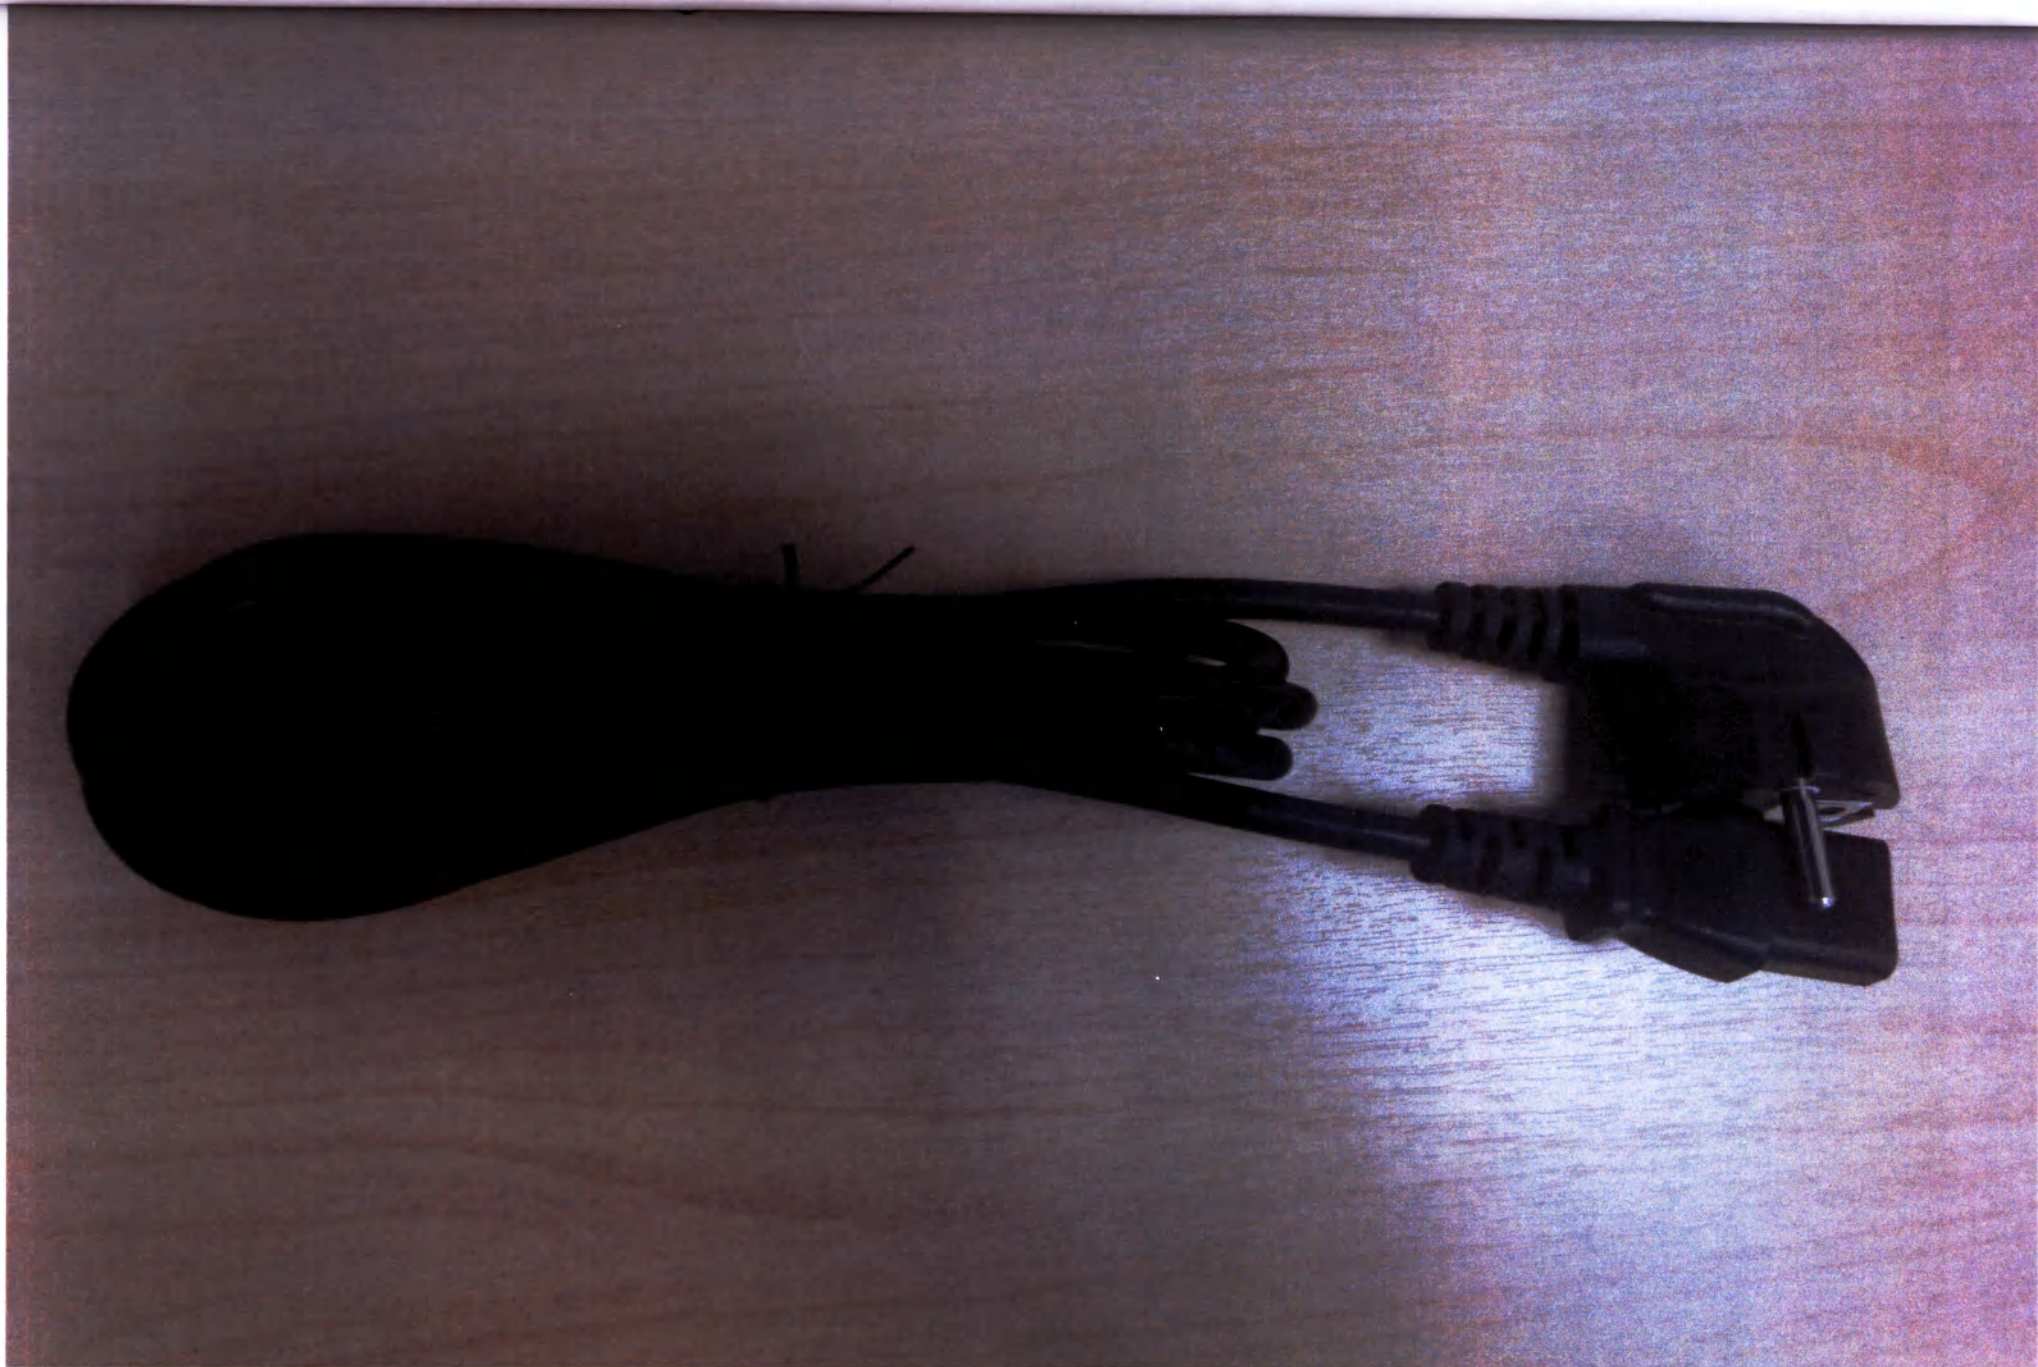




Рисунок 6. Кюветы (1 уп./600 шт.), не более 100 шт.

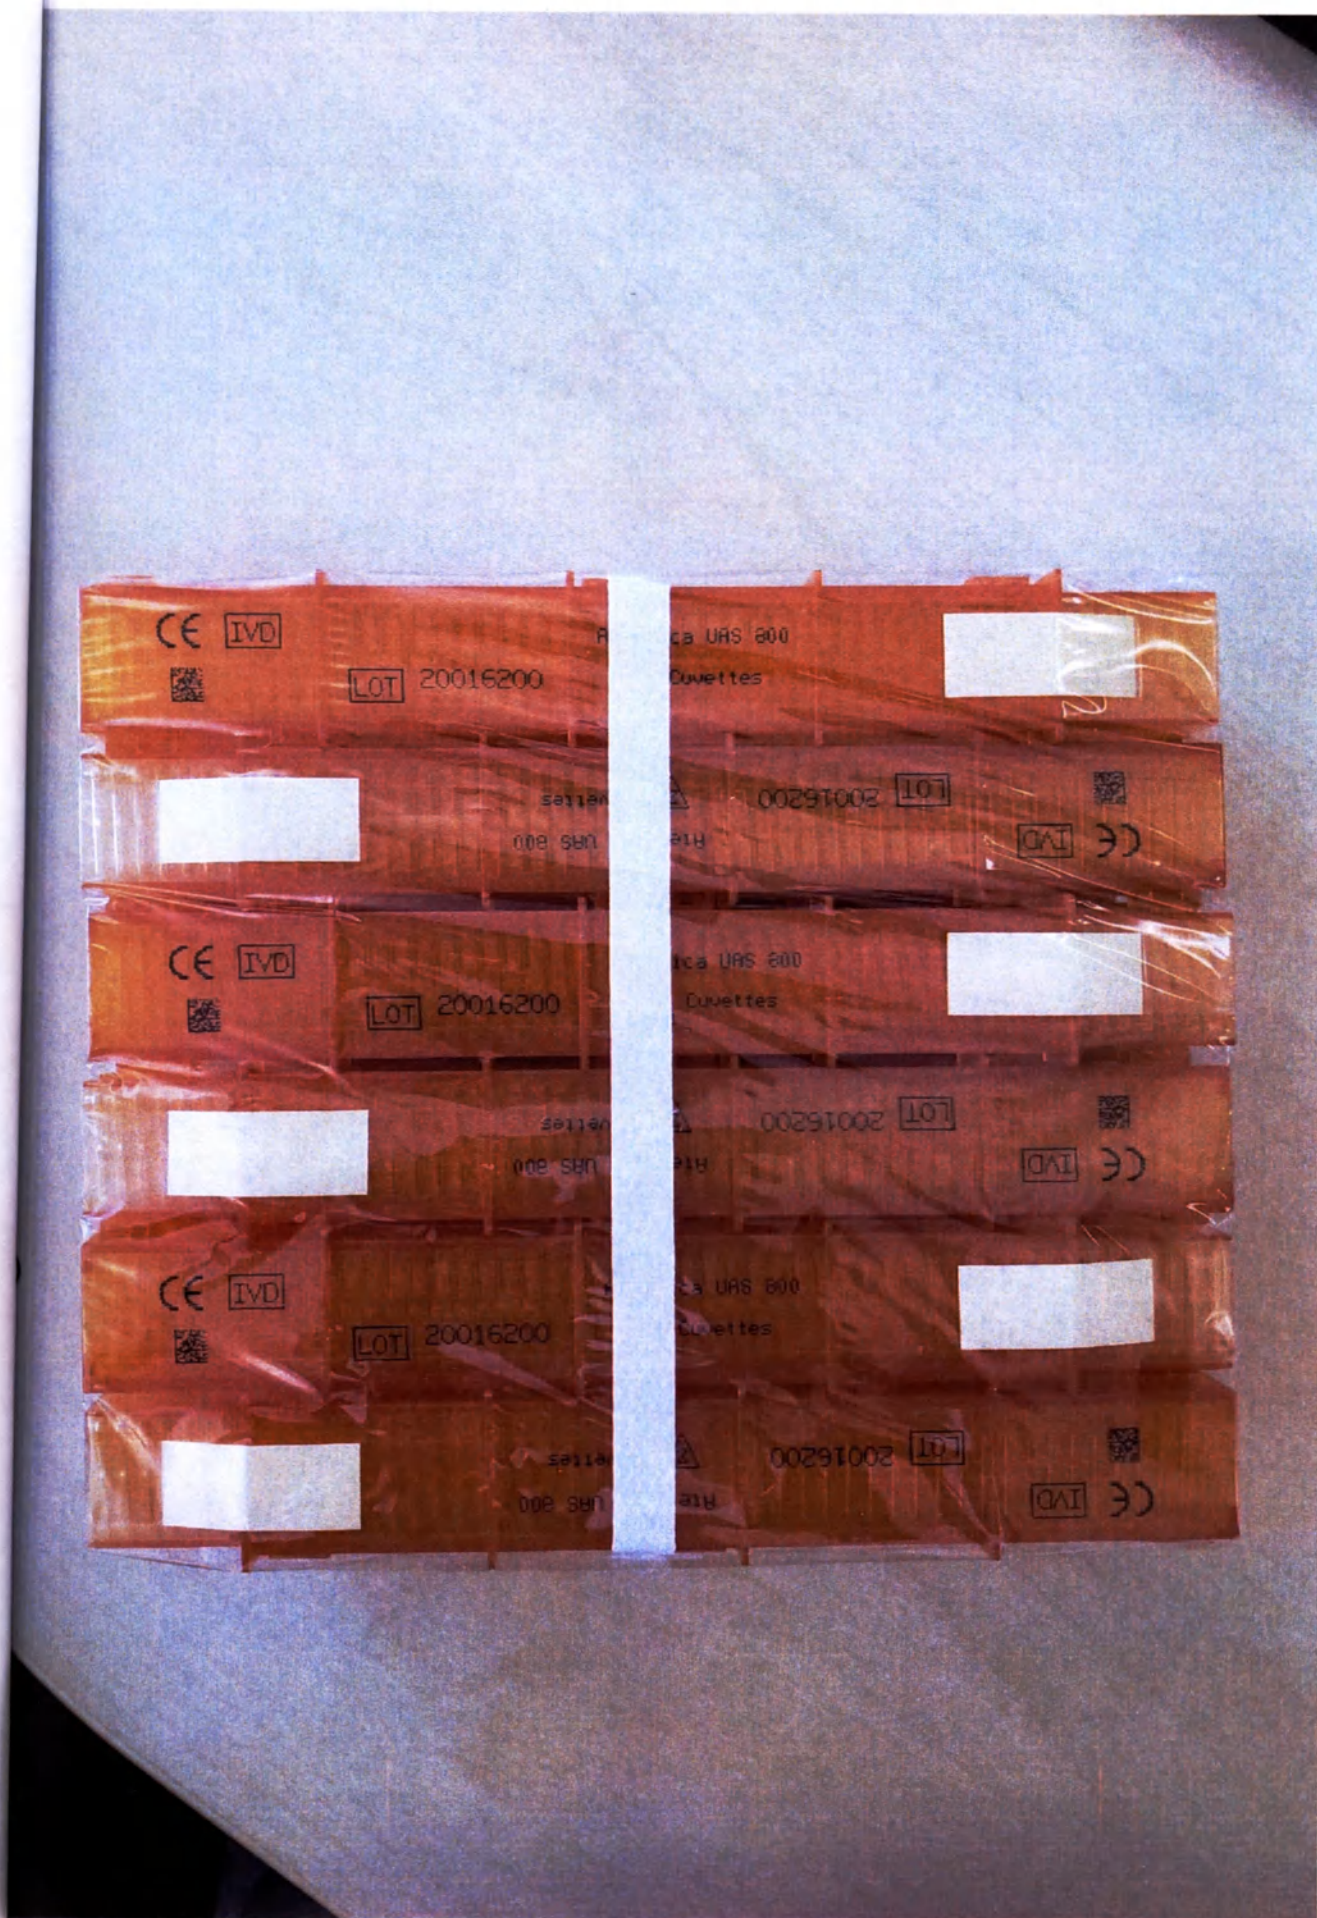


Рисунок 8. Кюветы (1 уп./600 шт.), не более 100 шт.





Рисунок 10. Сетевой кабель UTP, не более 3 шт.



Рисунок 11. Блок управления и обработки данных (опционально)





Рисунок 13. Клавиатура



Рисунок 14. Мышь



Рисунок 15. Коврик

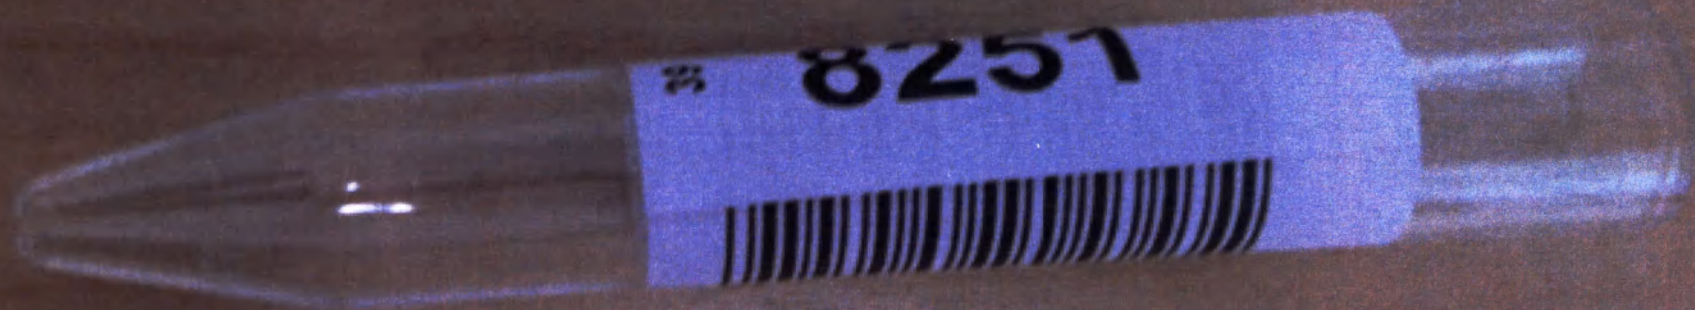


Рисунок 16. Тестовая пробирка, не более 3 шт.

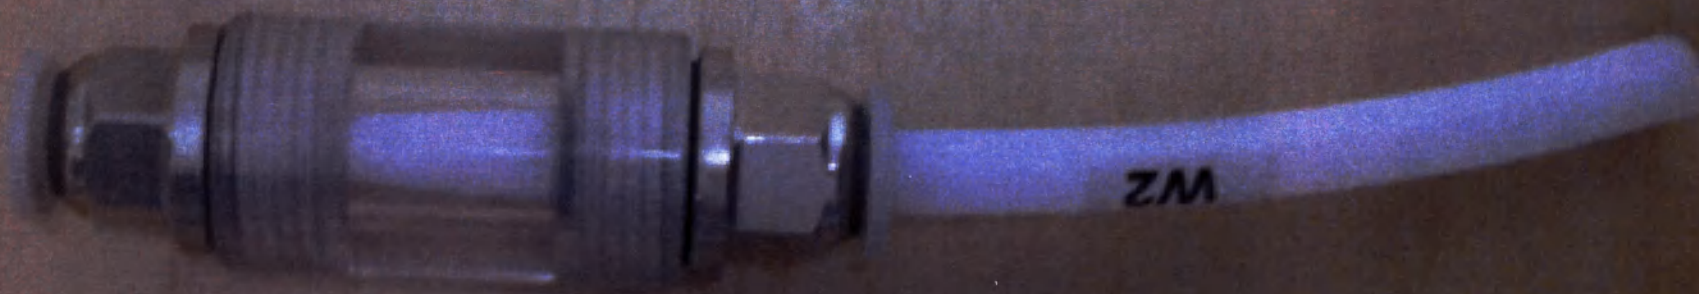


Рисунок 17. Фильтр воды, не более 5 шт.

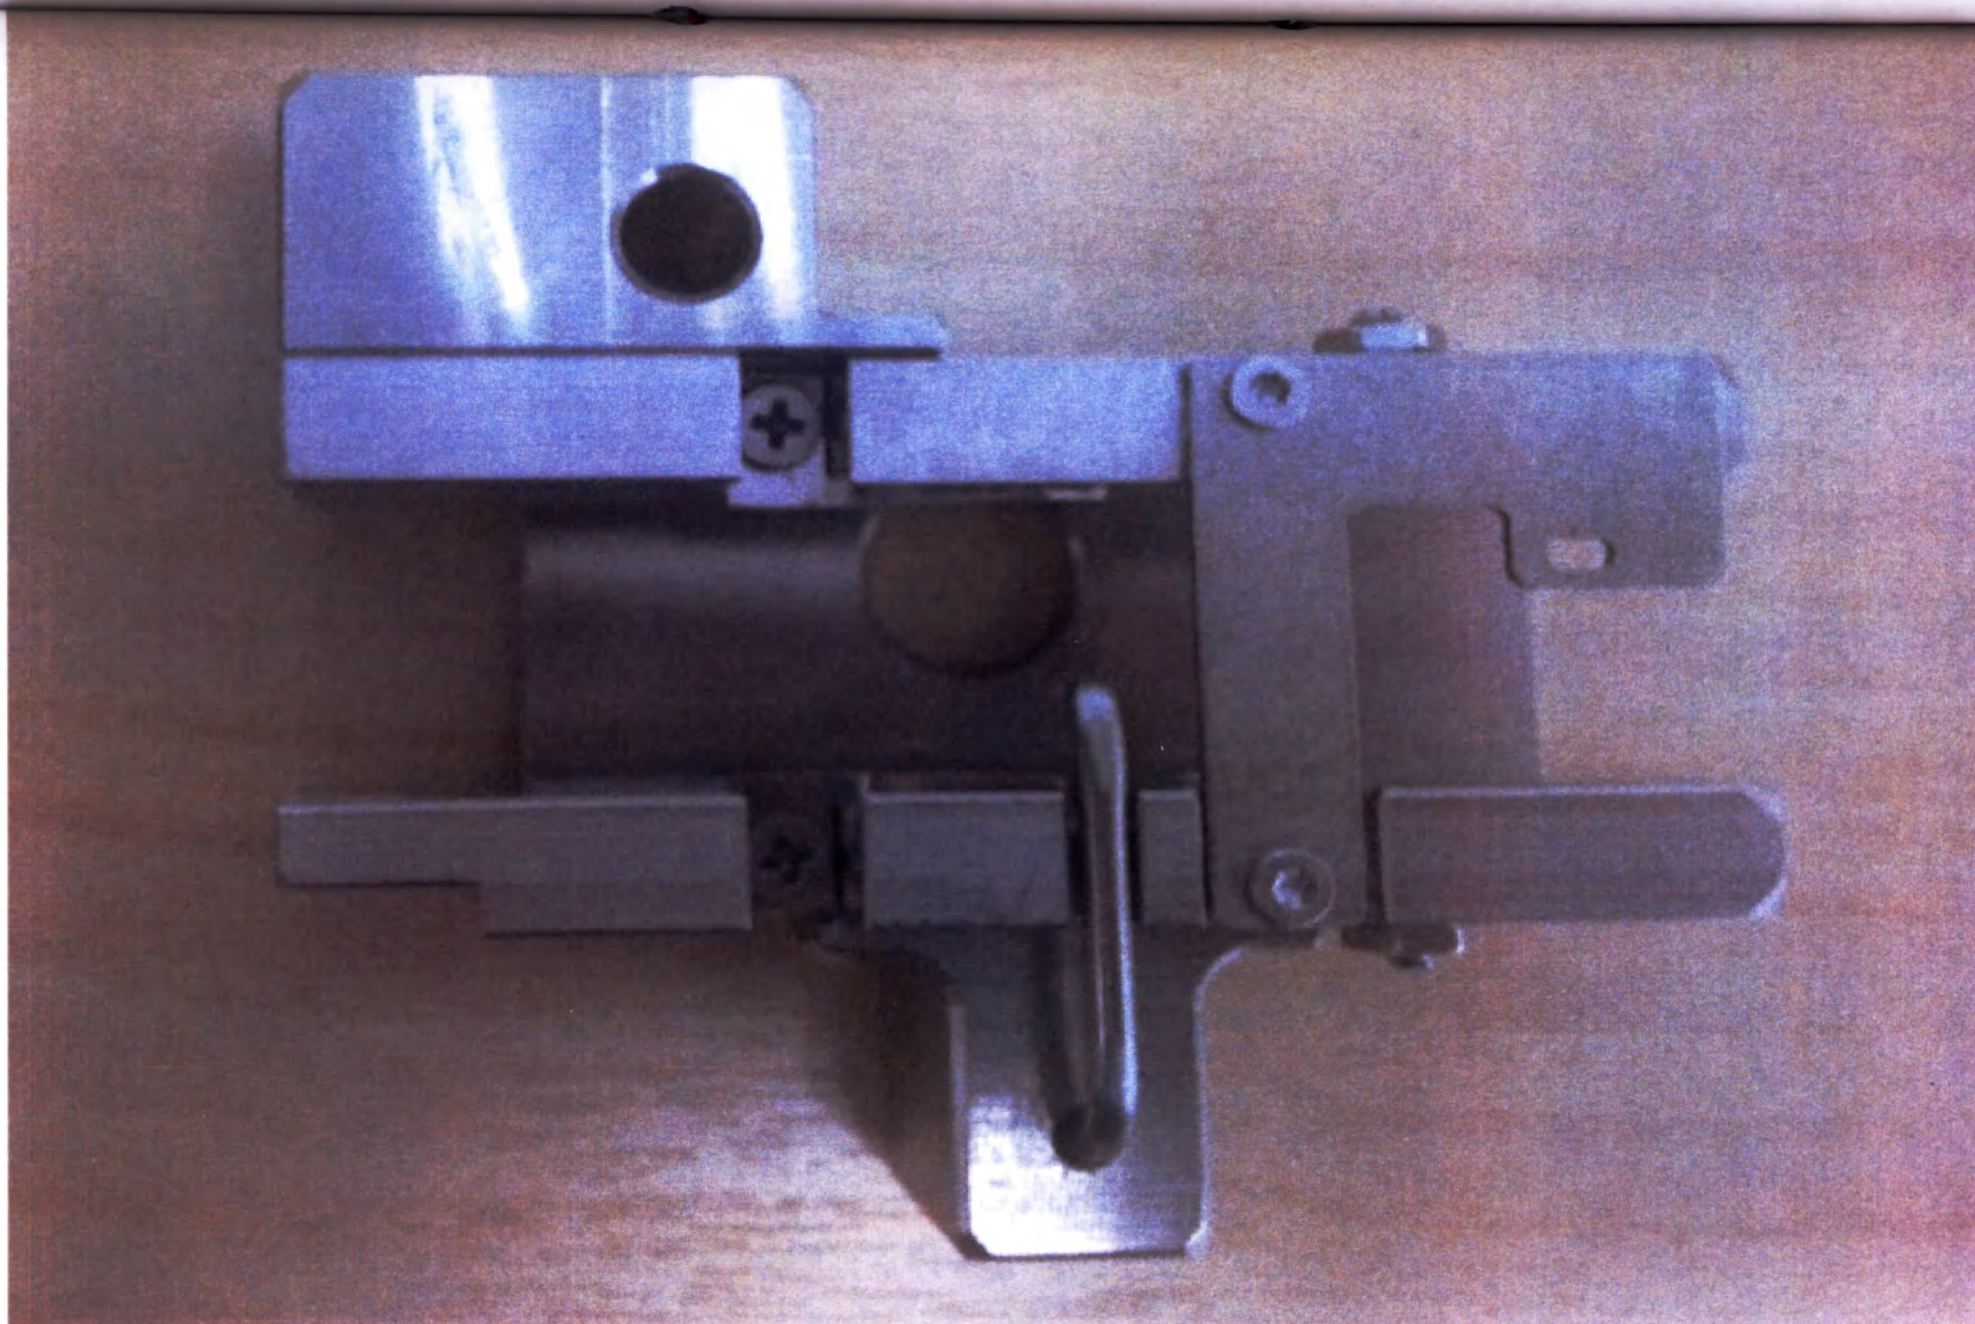


Рисунок 18. Передняя кюветная направляющая, не более 3 шт.

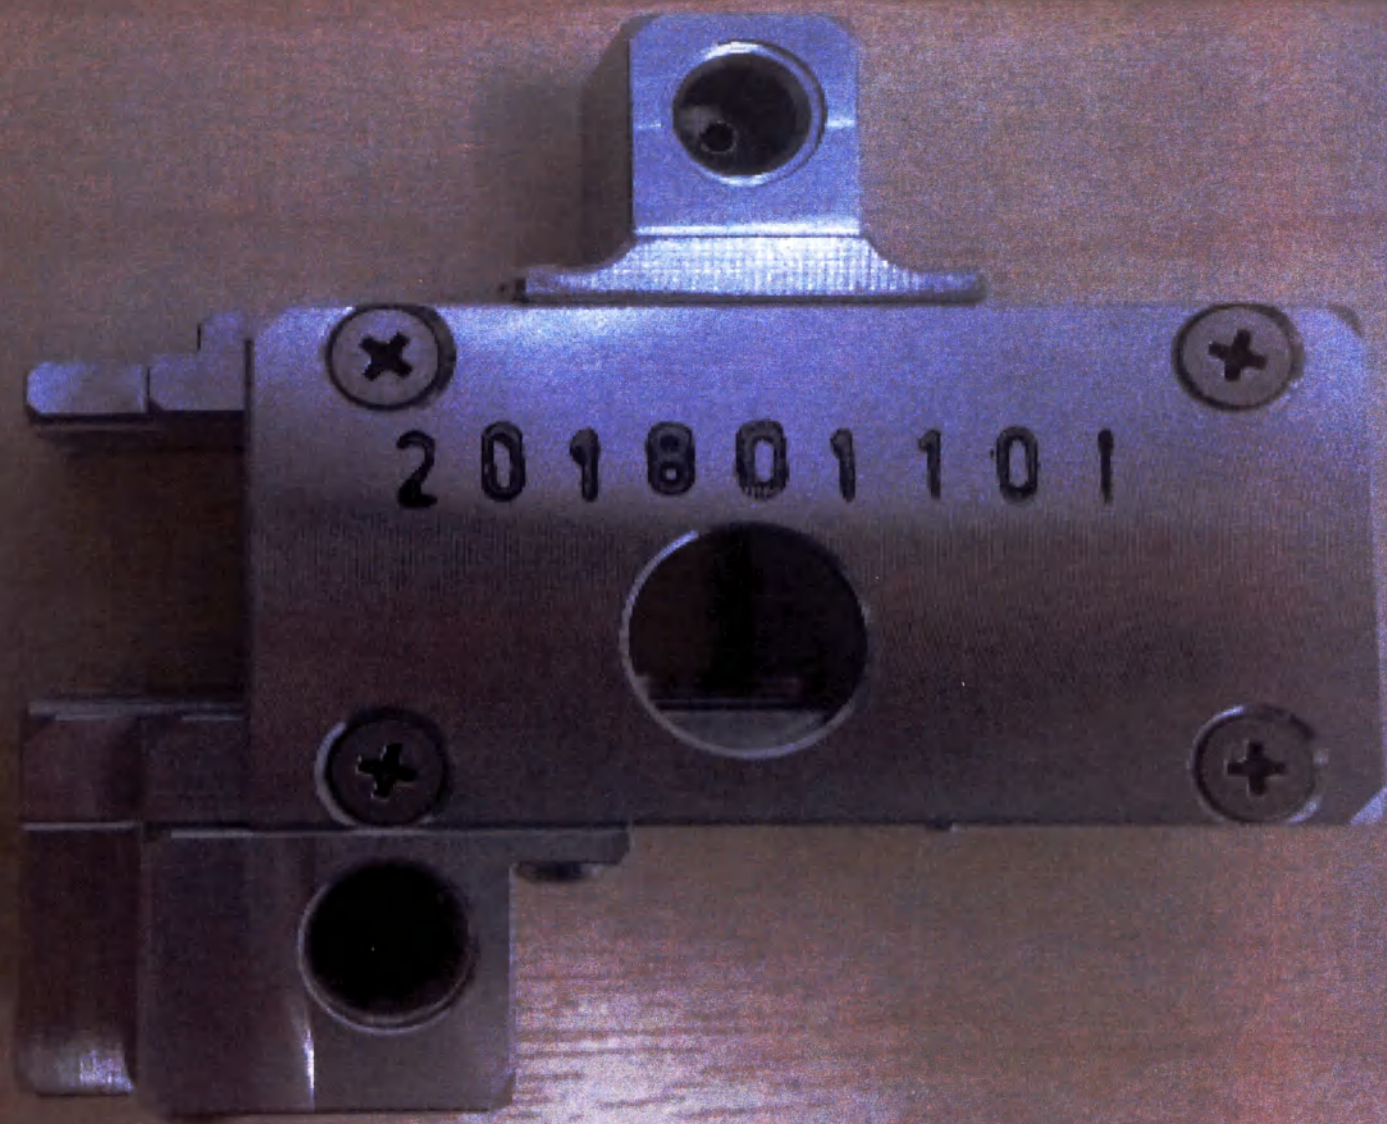


Рисунок 19. Задняя кюветная направляющая, не более 3 шт.

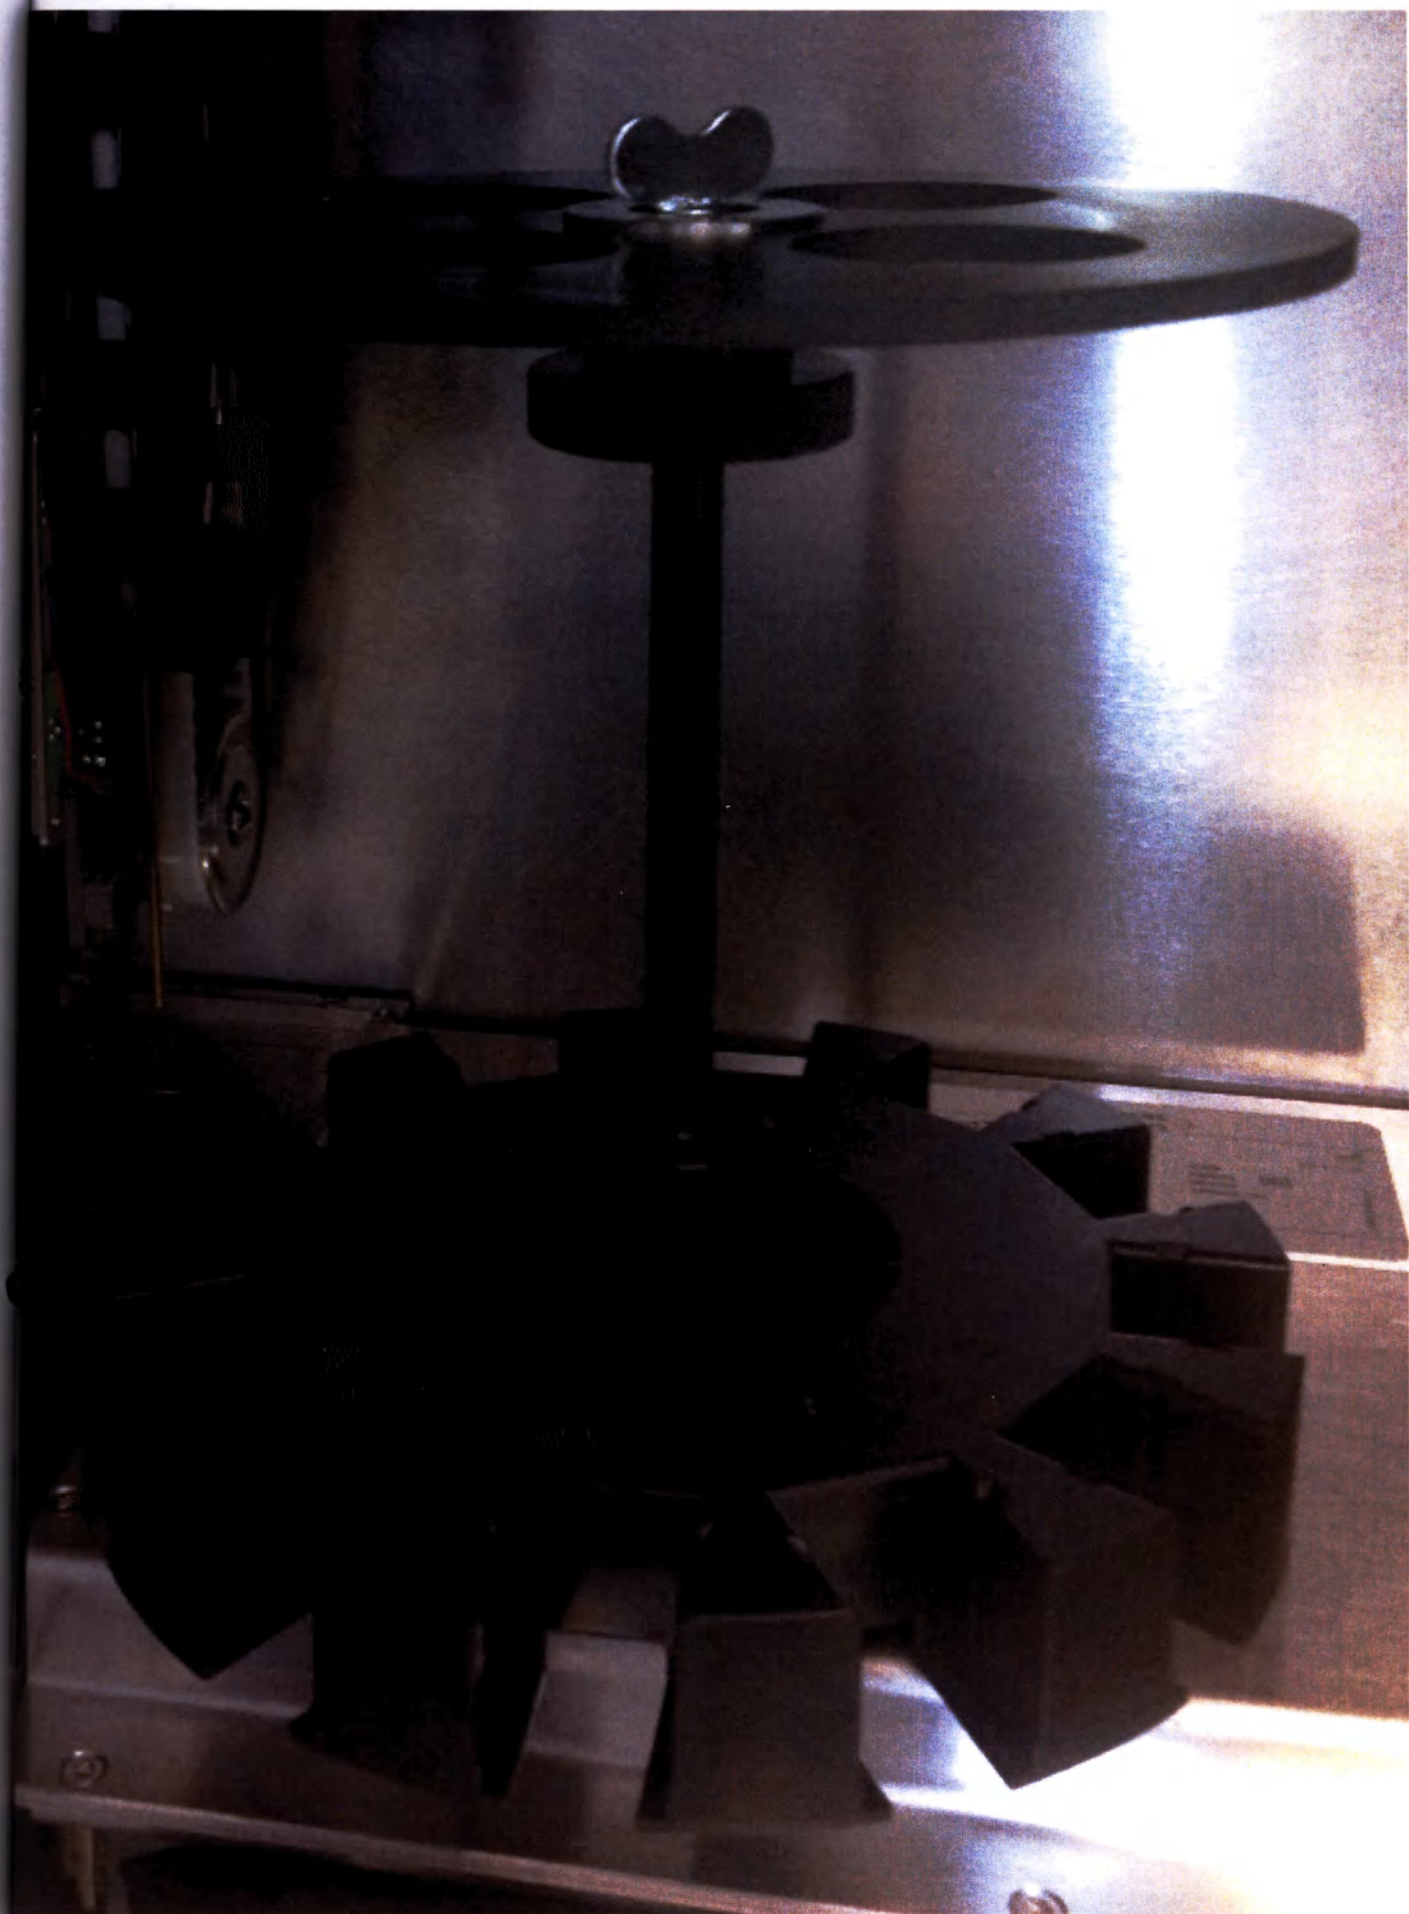


Рисунок 20. Ротор кюветной карусели

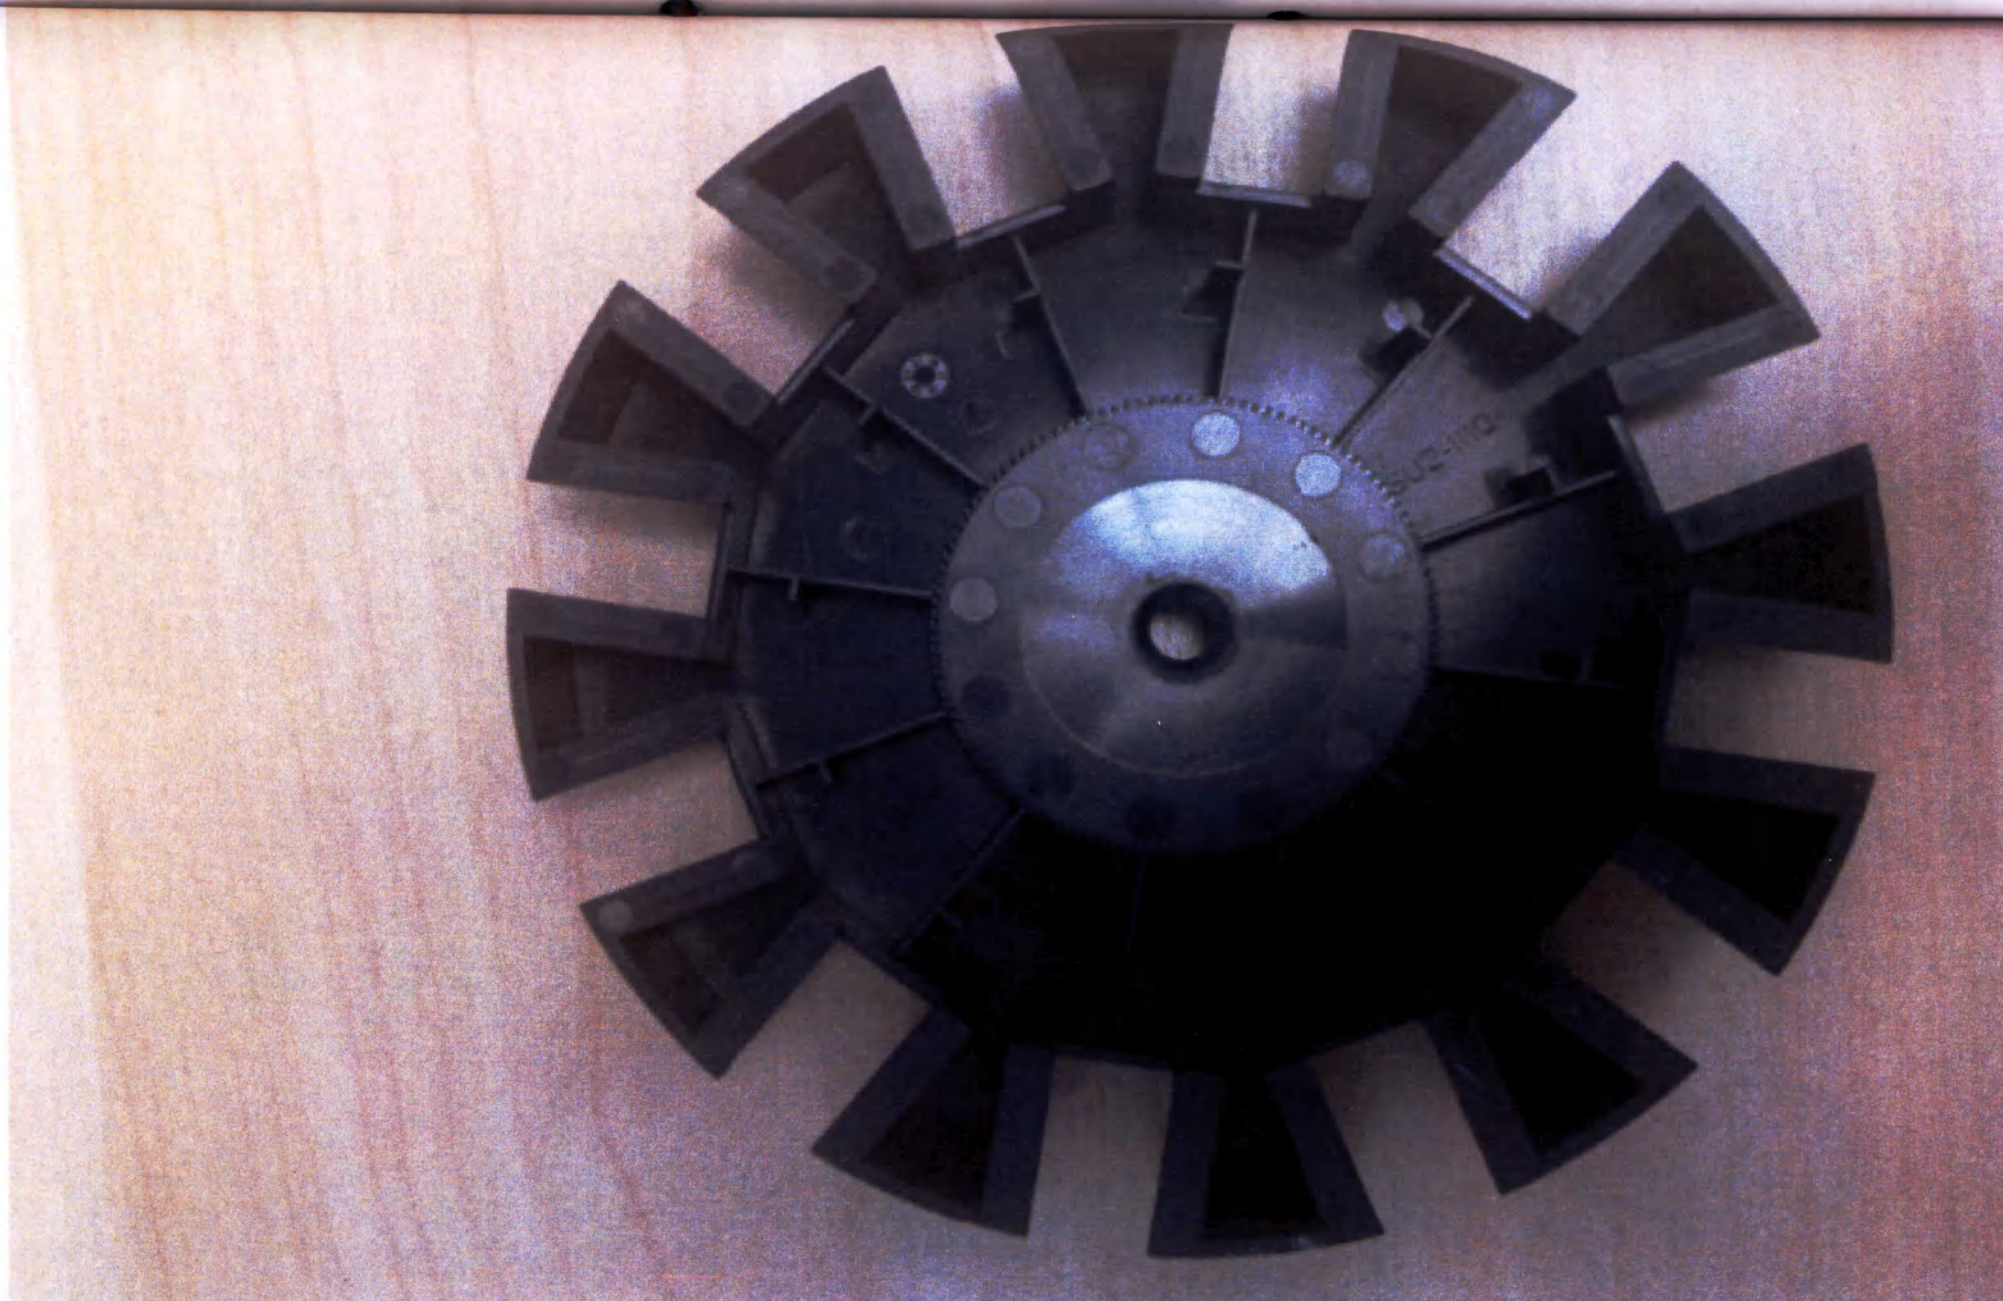
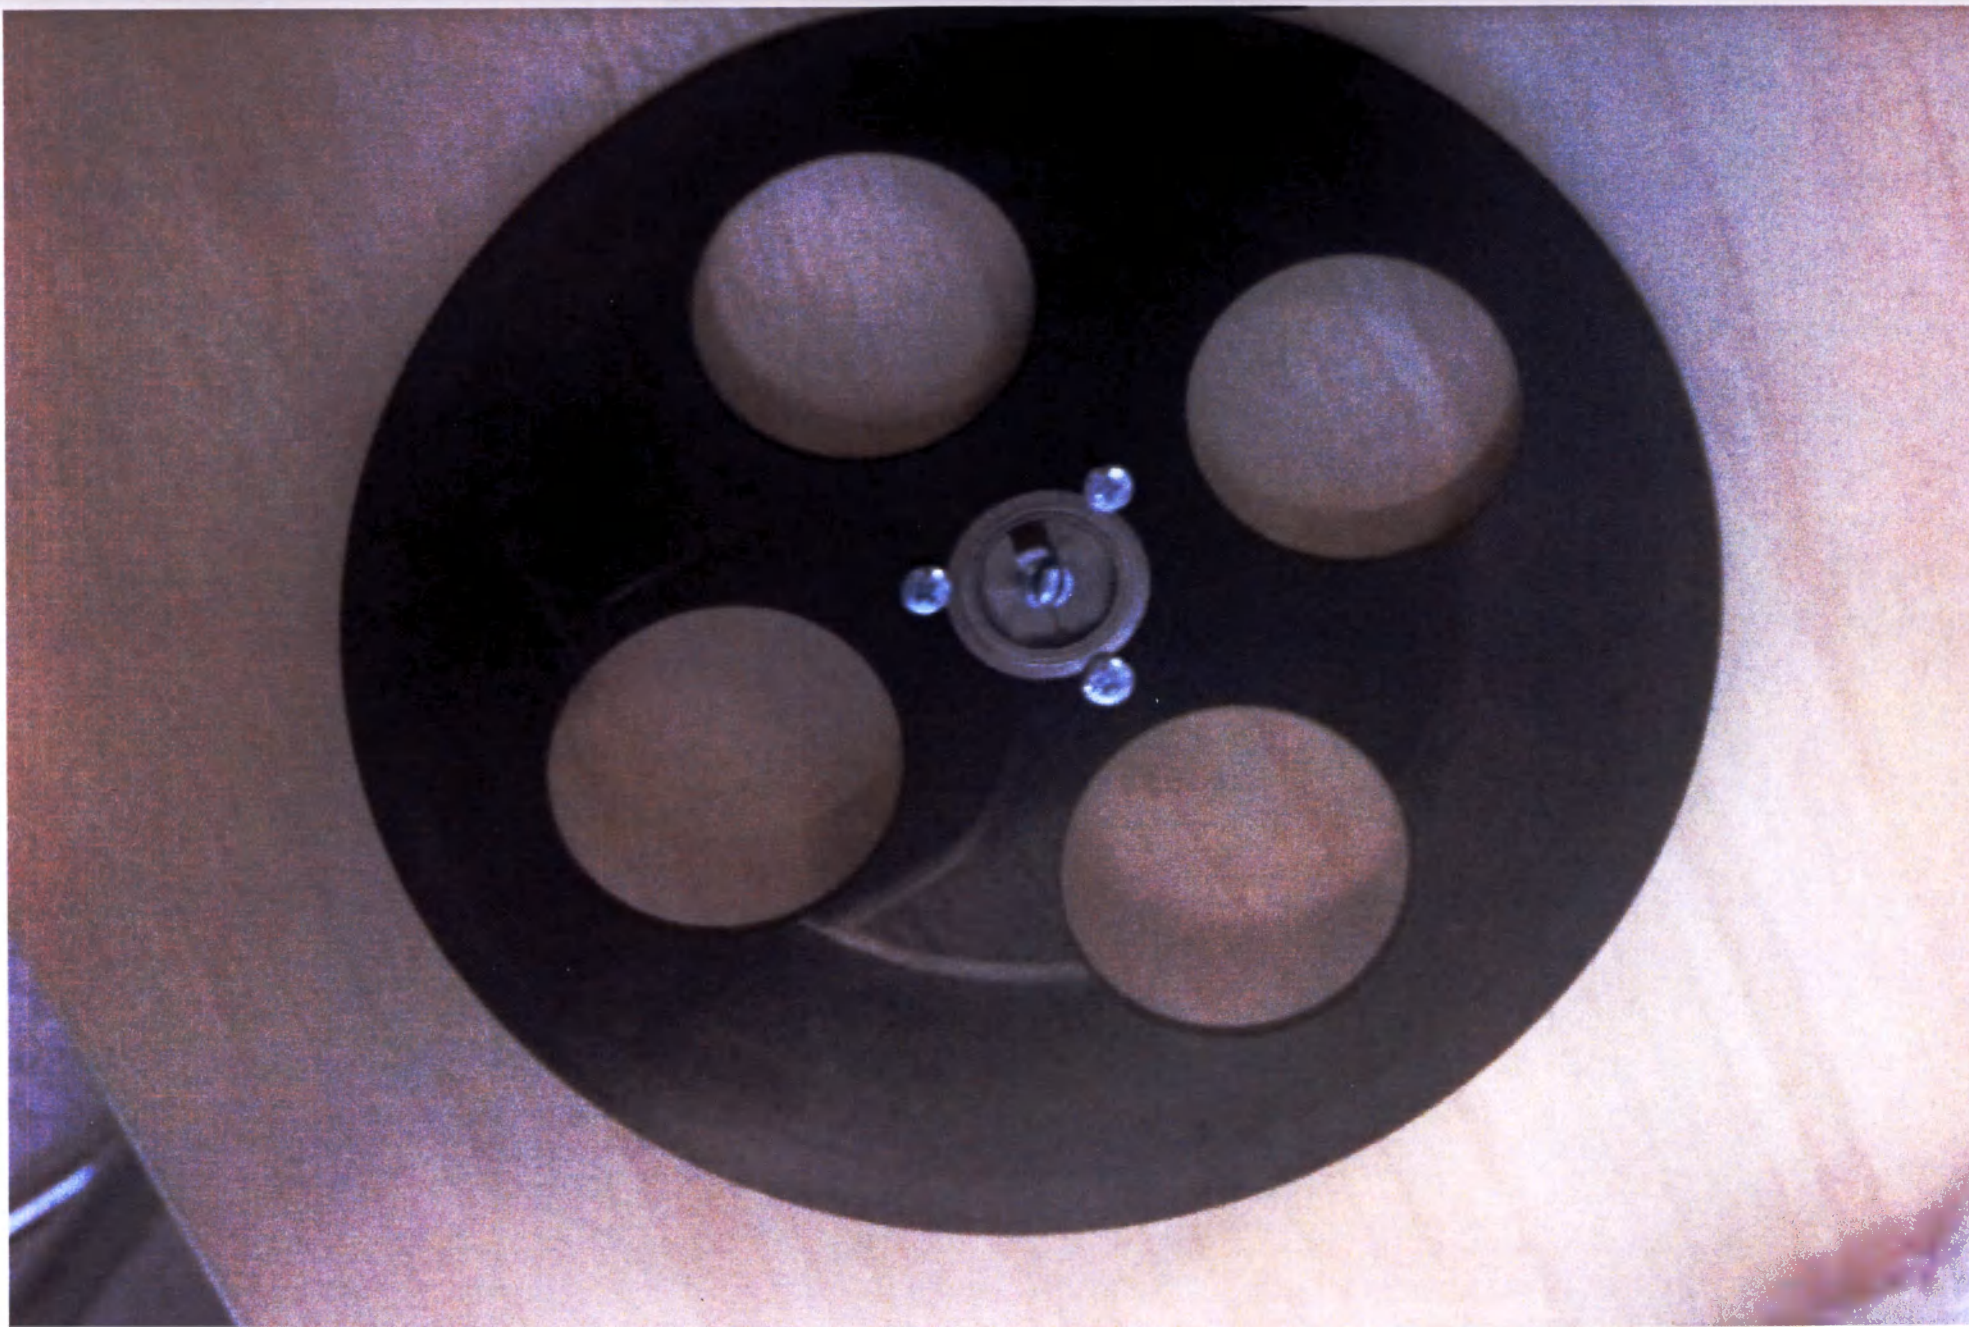


Рисунок 21. Нижний диск кюветной карусели





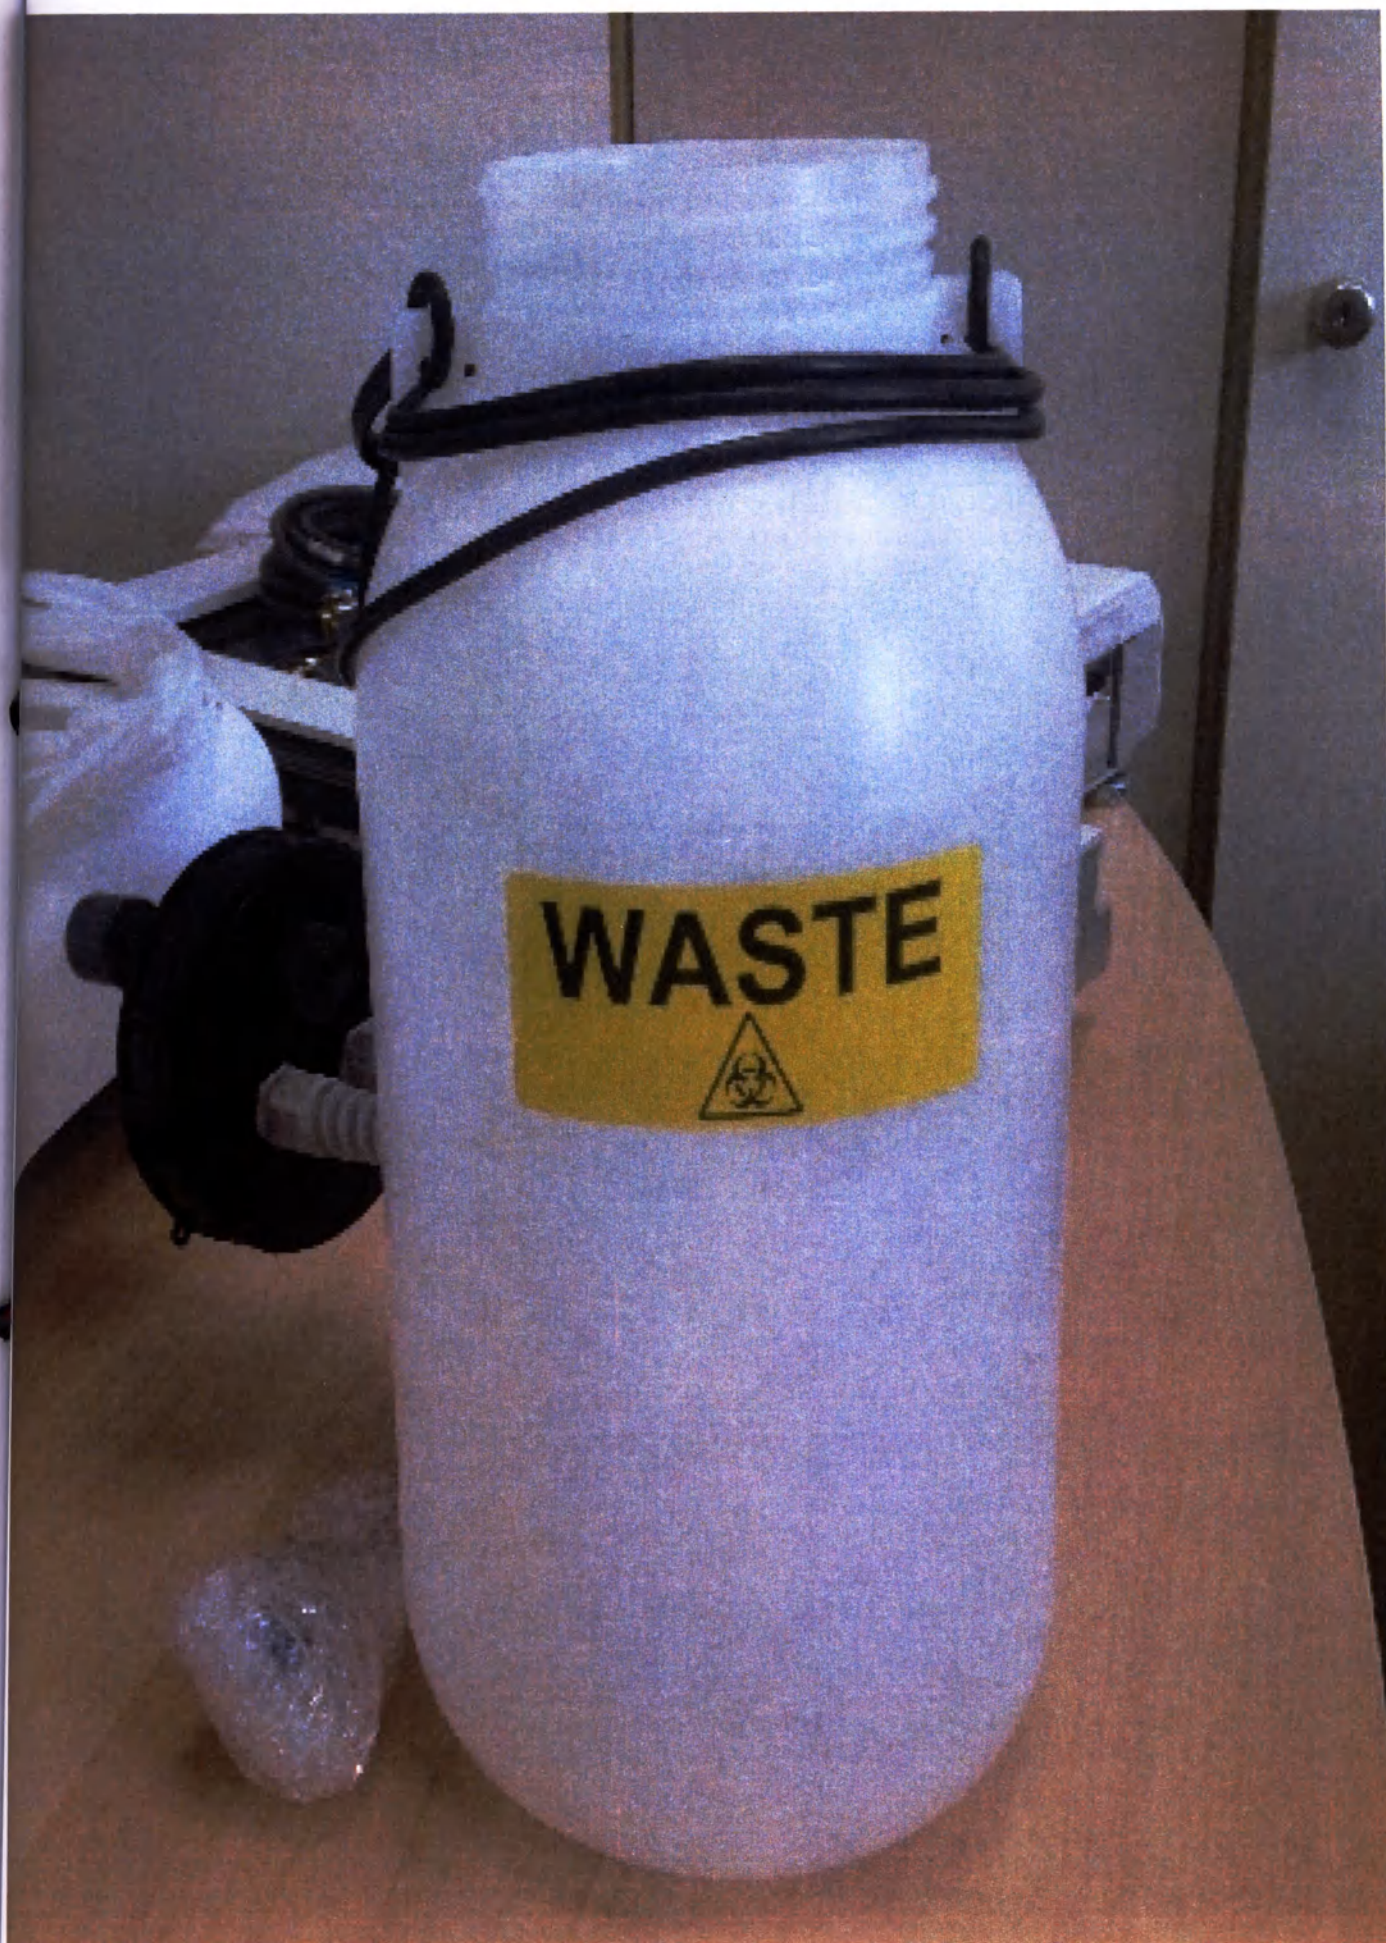


Рисунок 24. Контейнер для отходов 5 л, не более 5 шт.

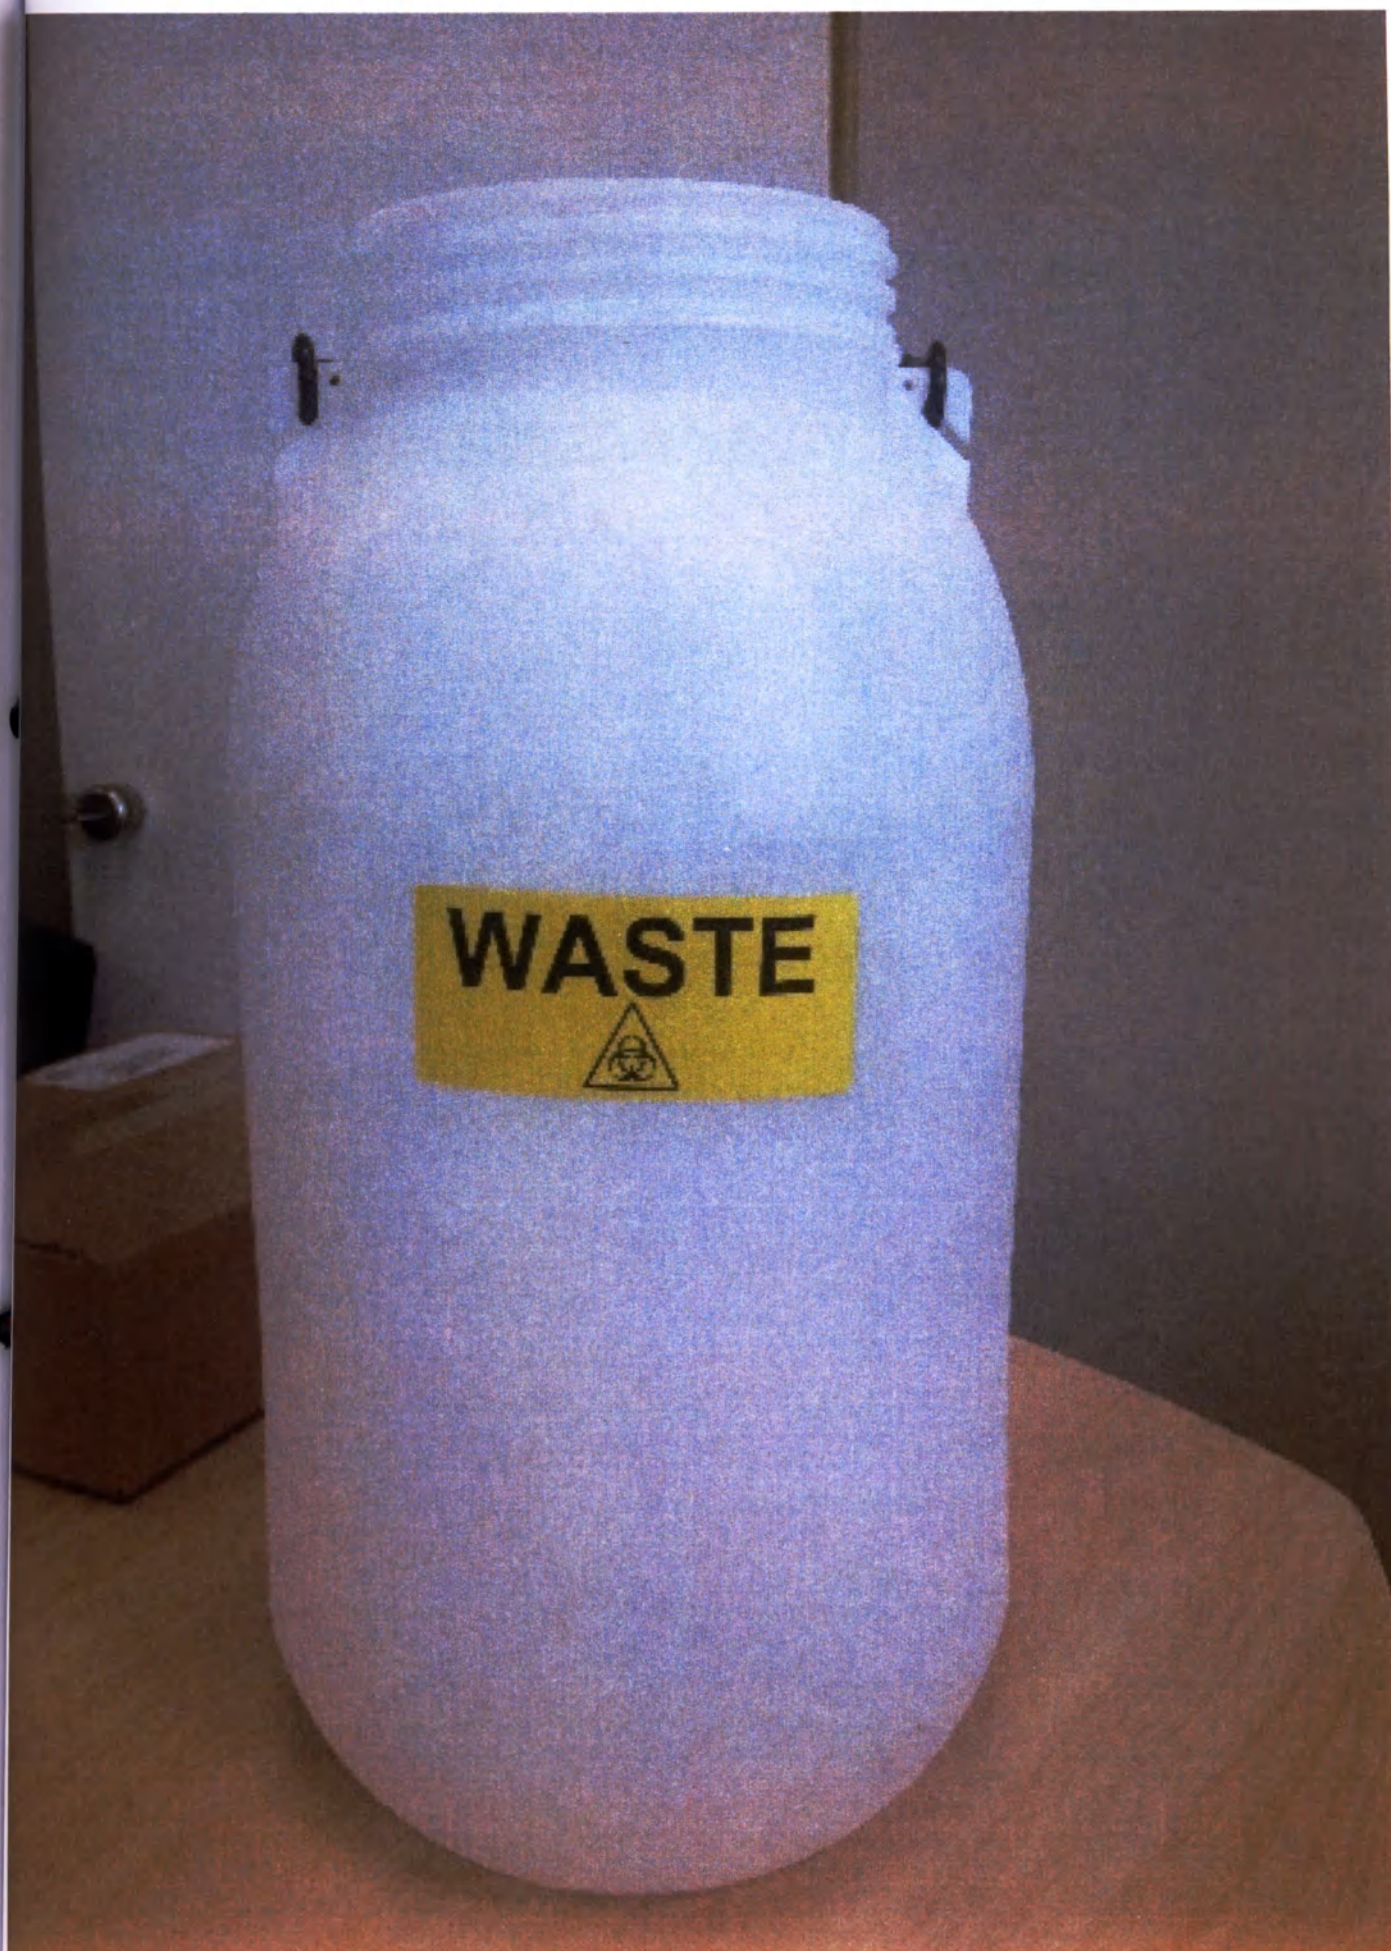


Рисунок 25. Контейнер для отходов 10 л, не более 5 шт.

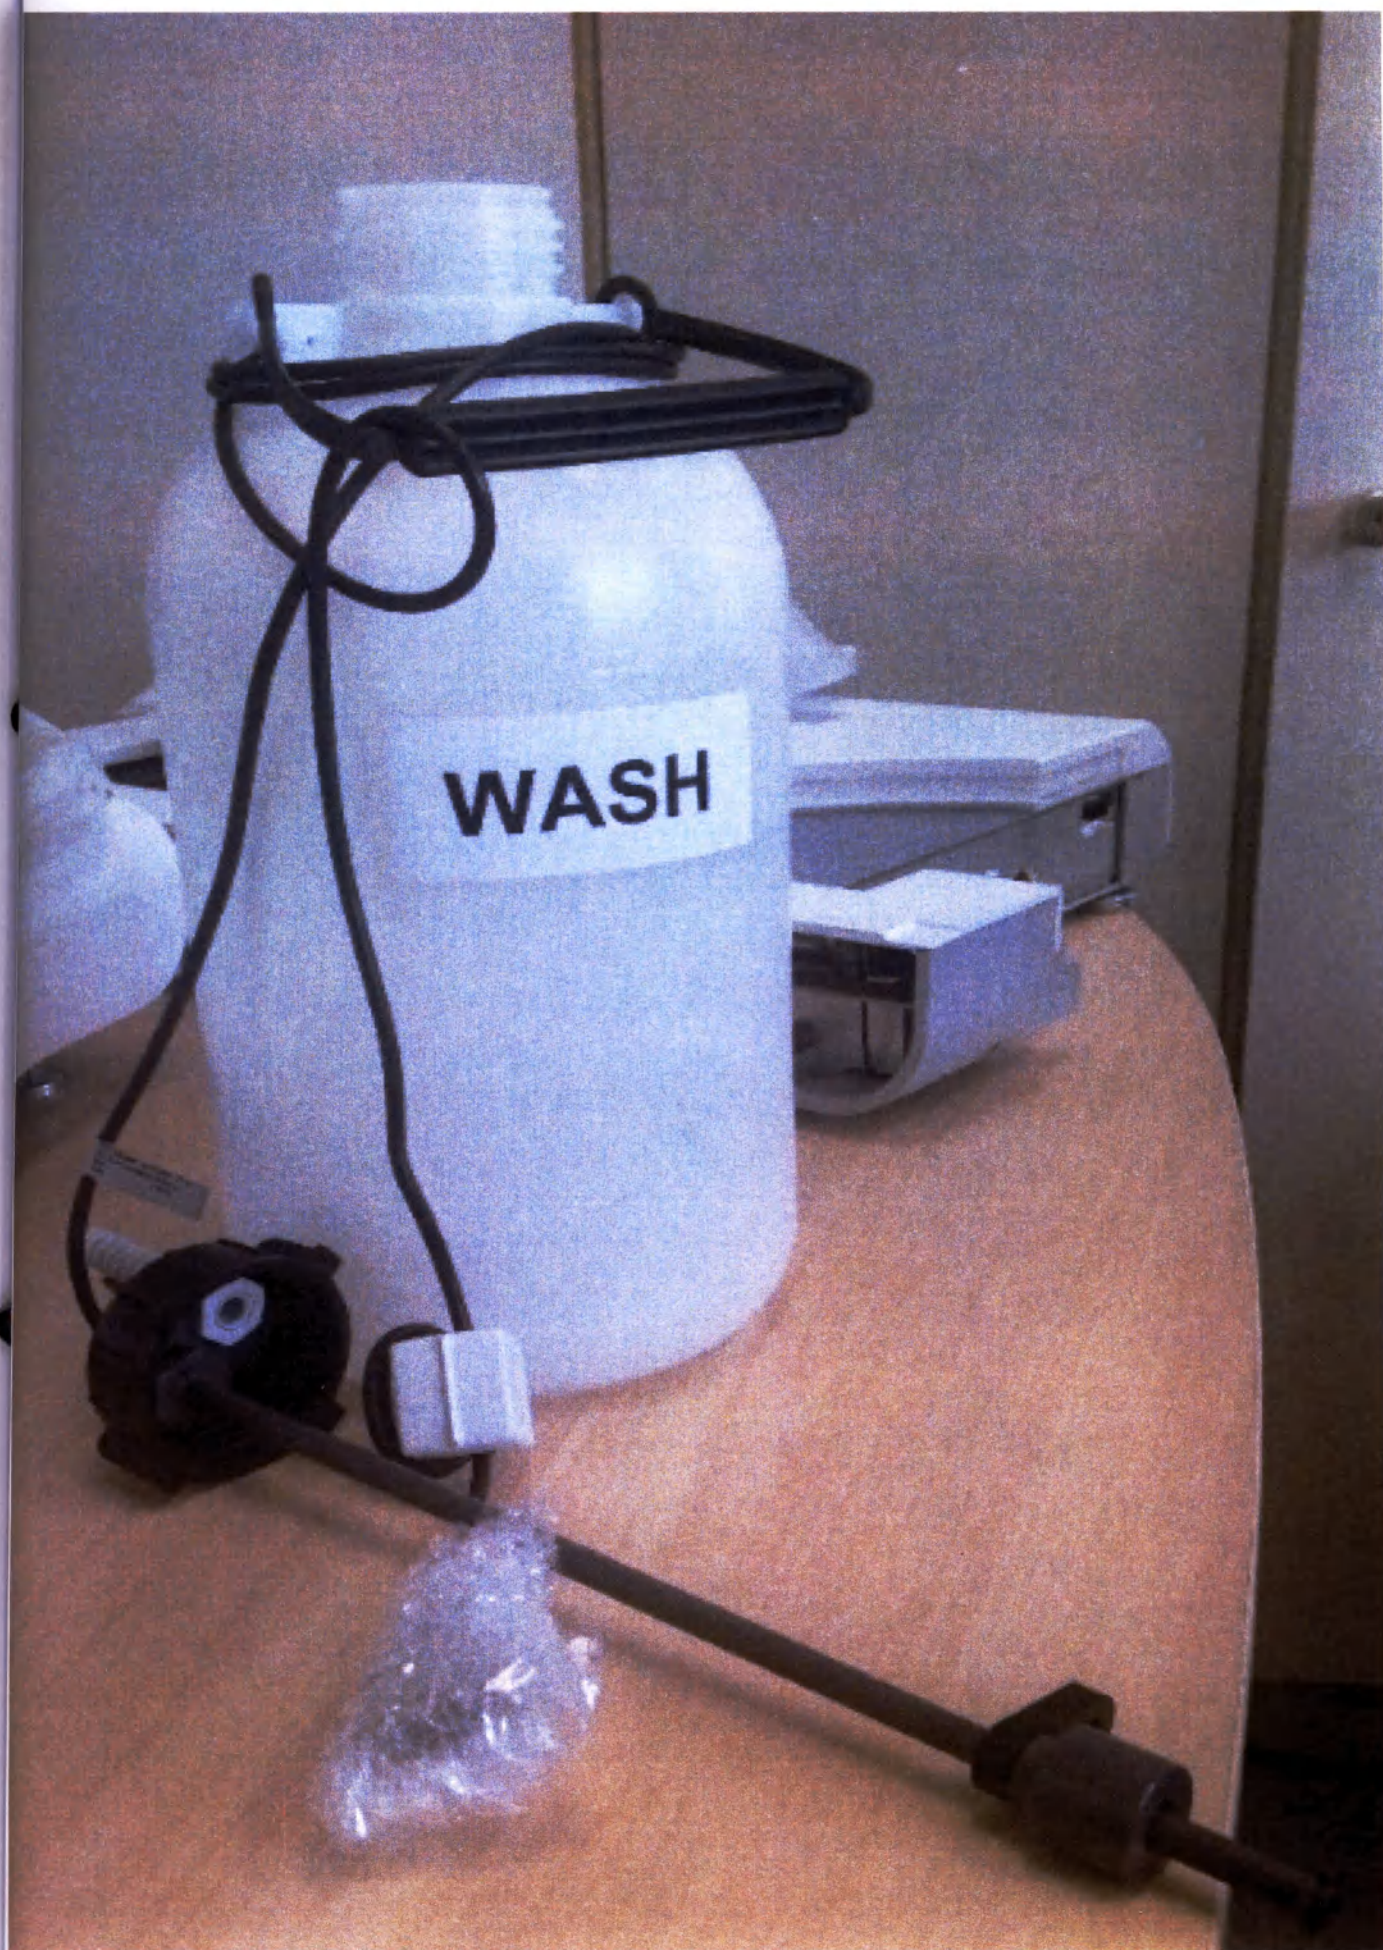


Рисунок 26. Контейнер для промывки 5 л, не более 5 шт.

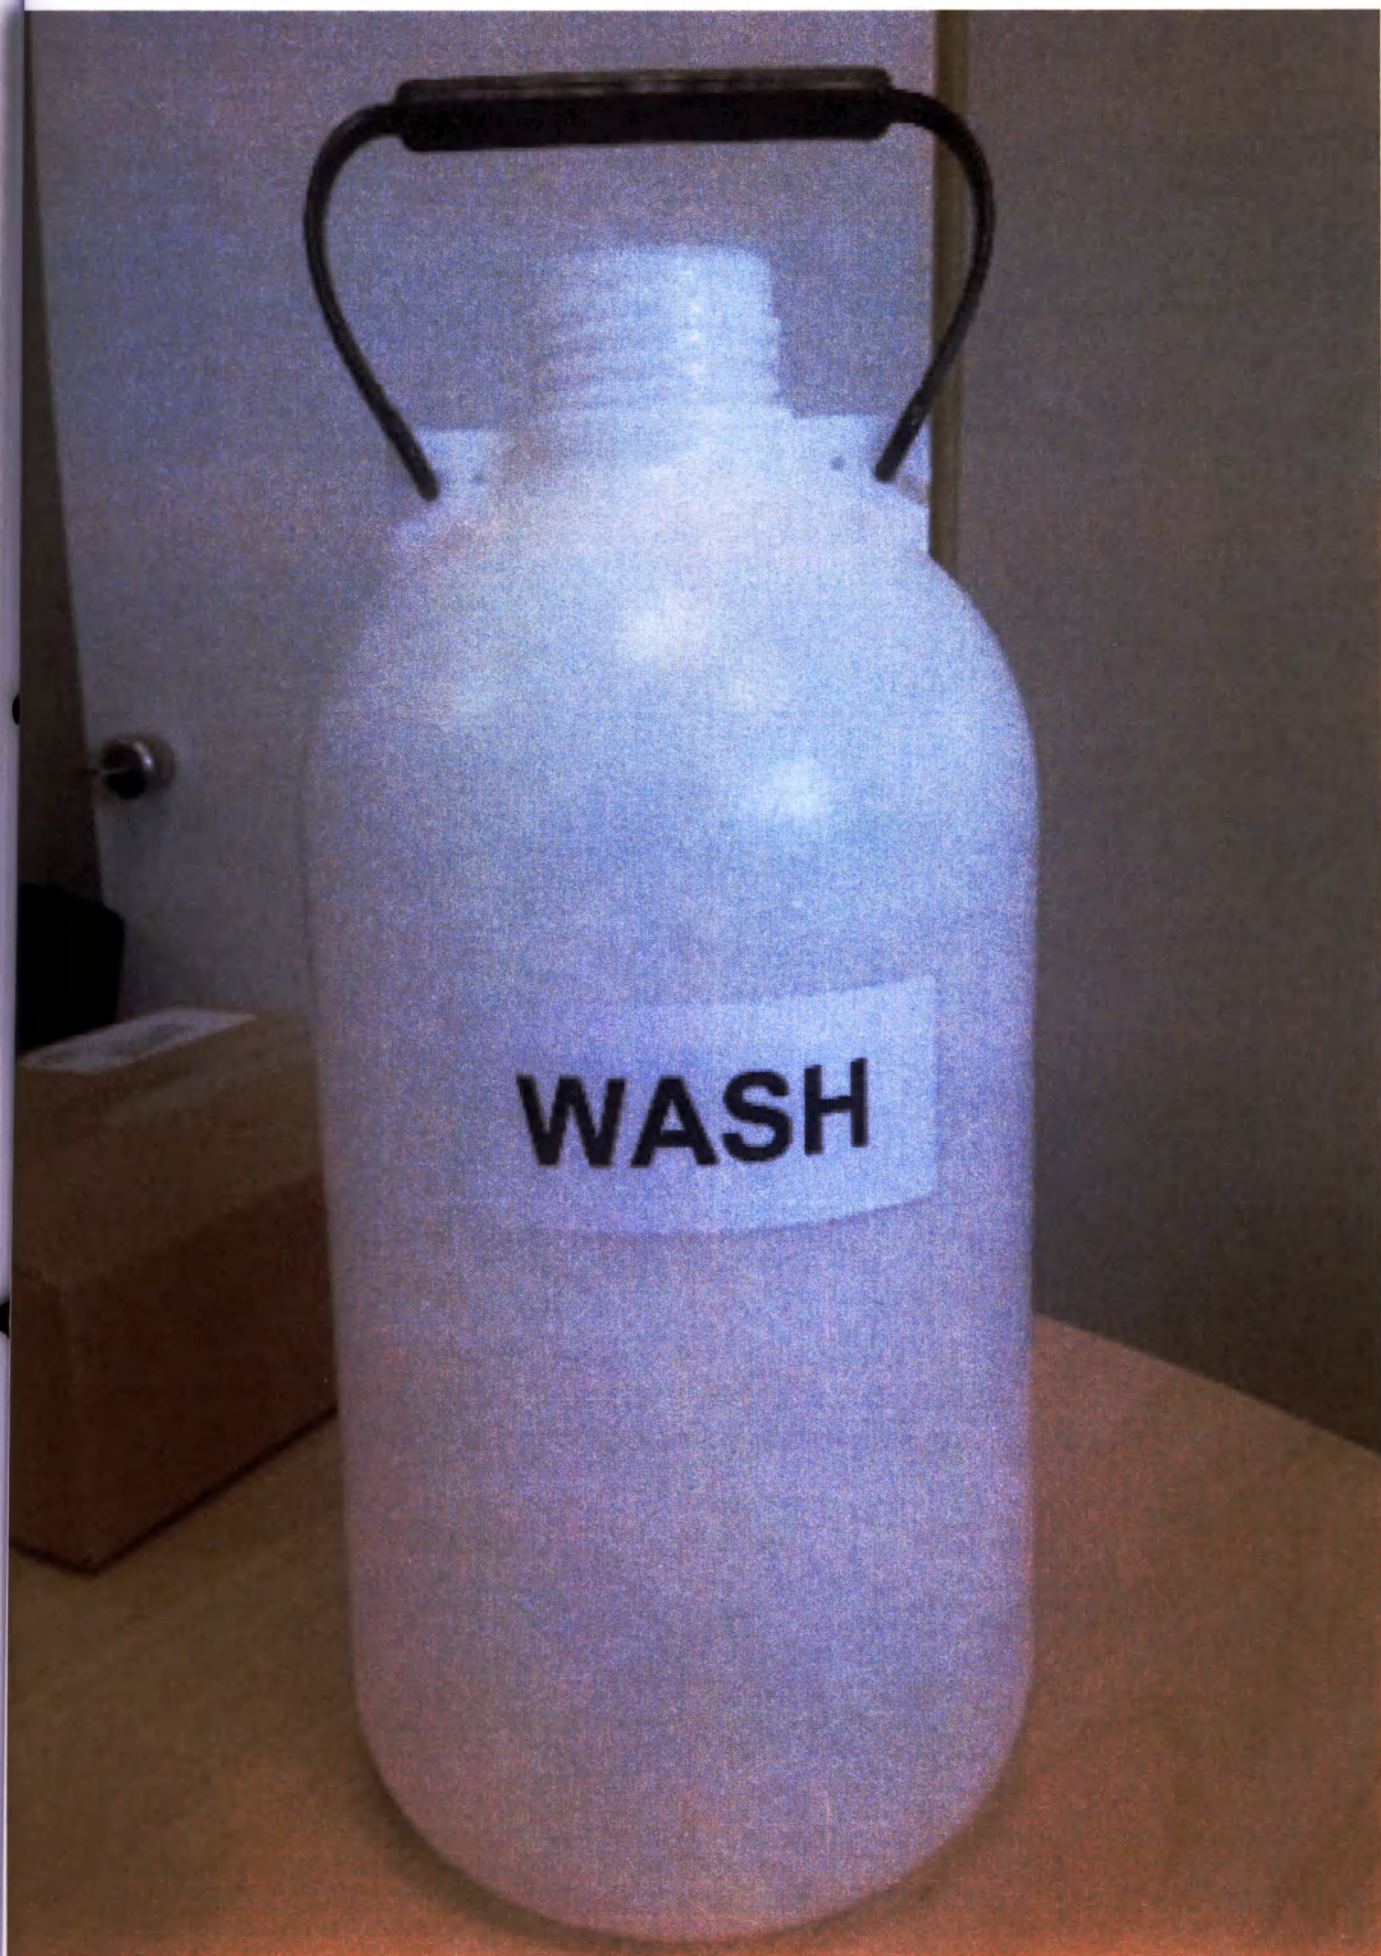


Рисунок 27. Контейнер для промывки 10 л, не более 5 шт.



Рисунок 28. Контейнер для использованных кювет

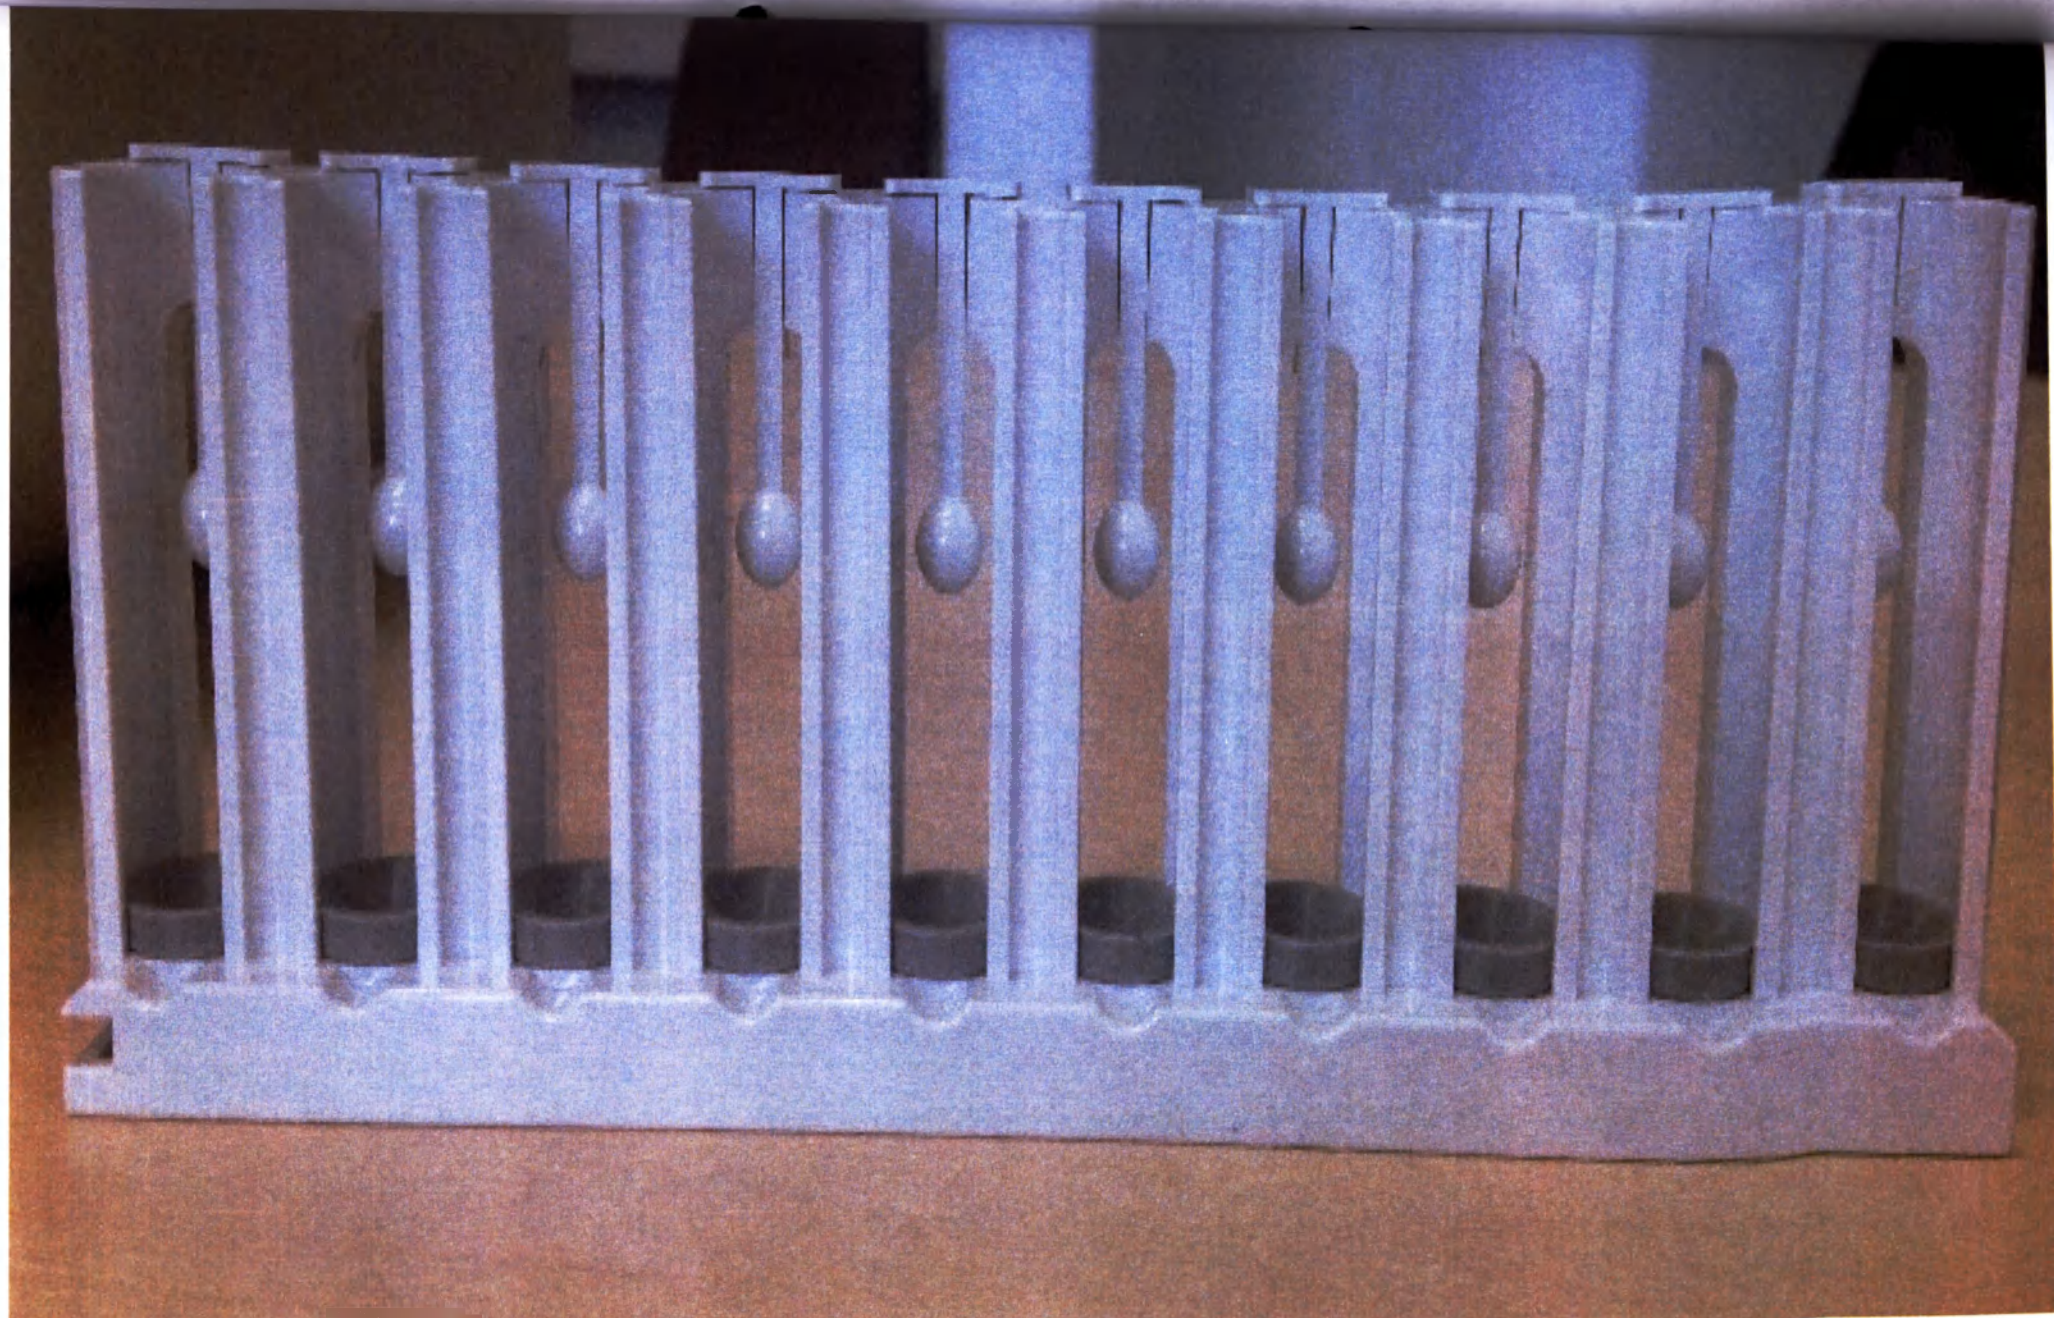


Рисунок 29. Штатив для пробирок для образцов, не более 15 шт.



Рисунок 30. Датчик уровня отходов;



Рисунок 31. Датчик уровня воды

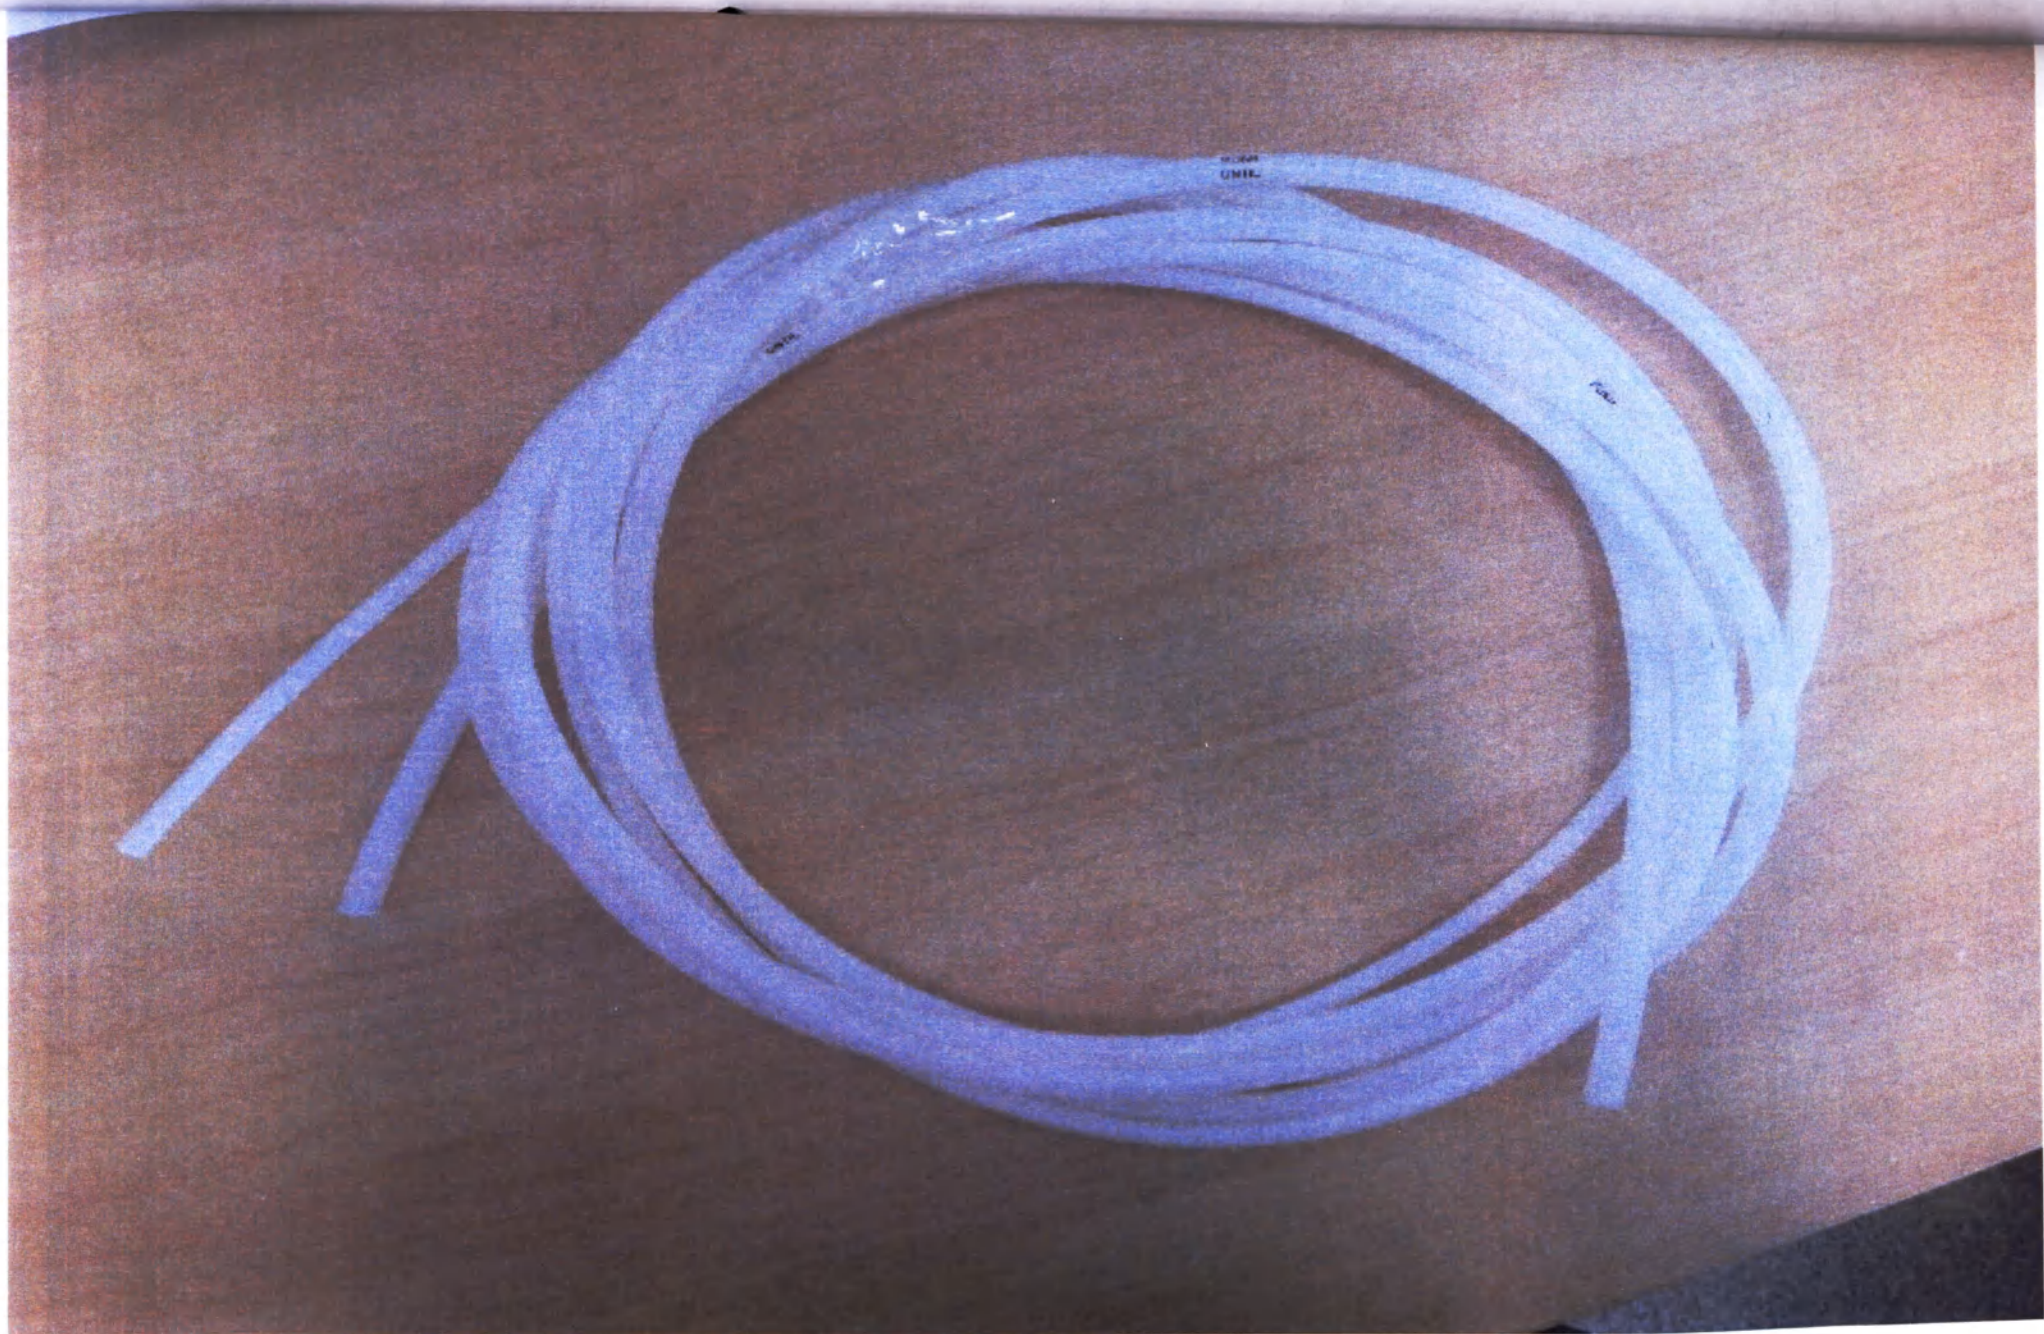


Рисунок 32. Трубка для отходов. не более 5 шт.
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


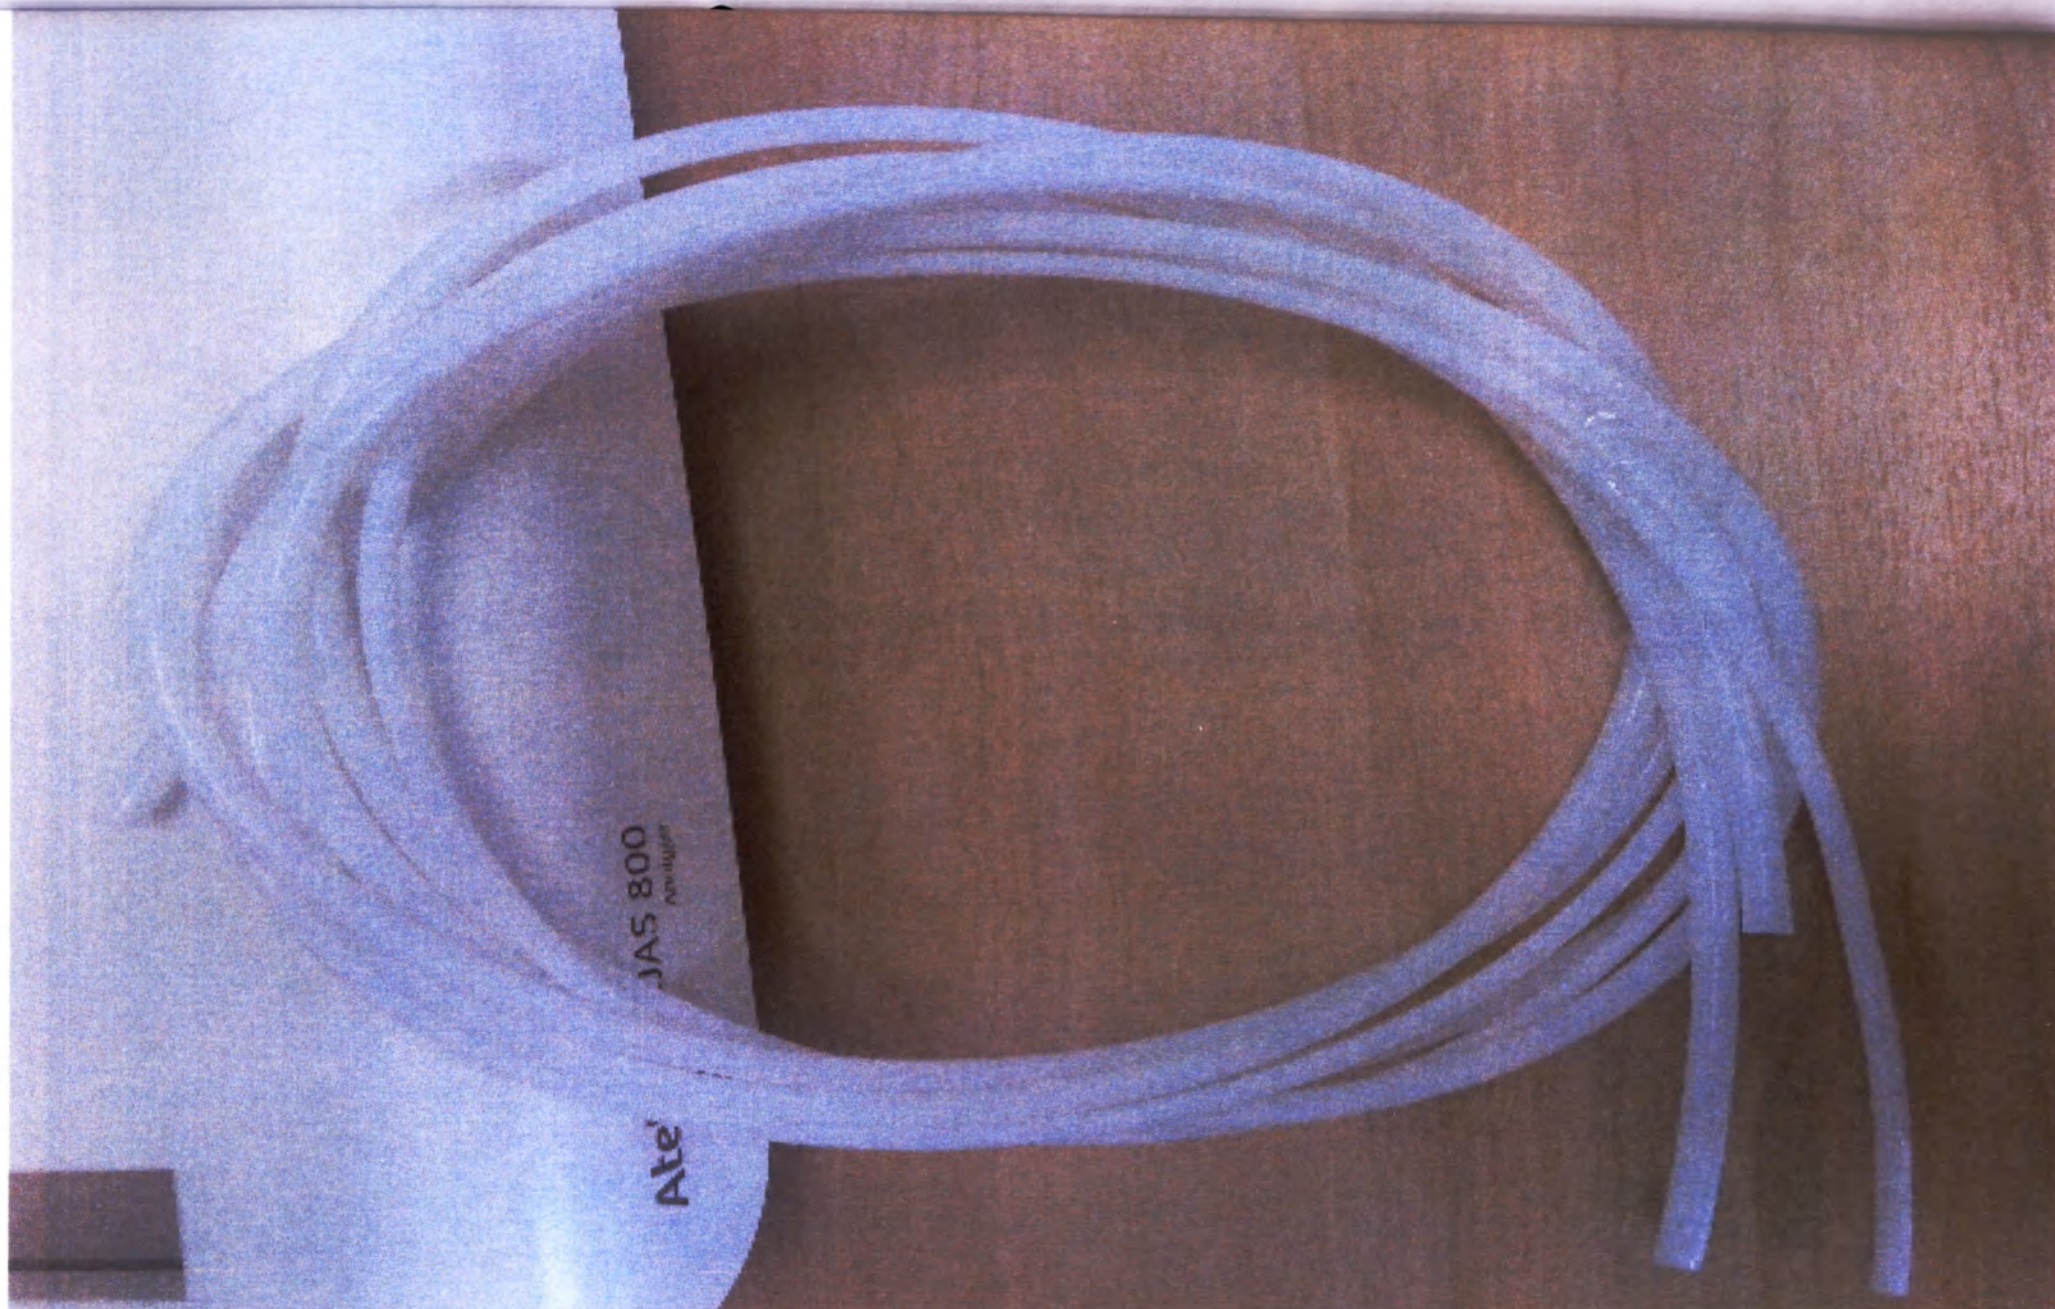


Рисунок 33. Трубка гравитационная, не более 5 шт.





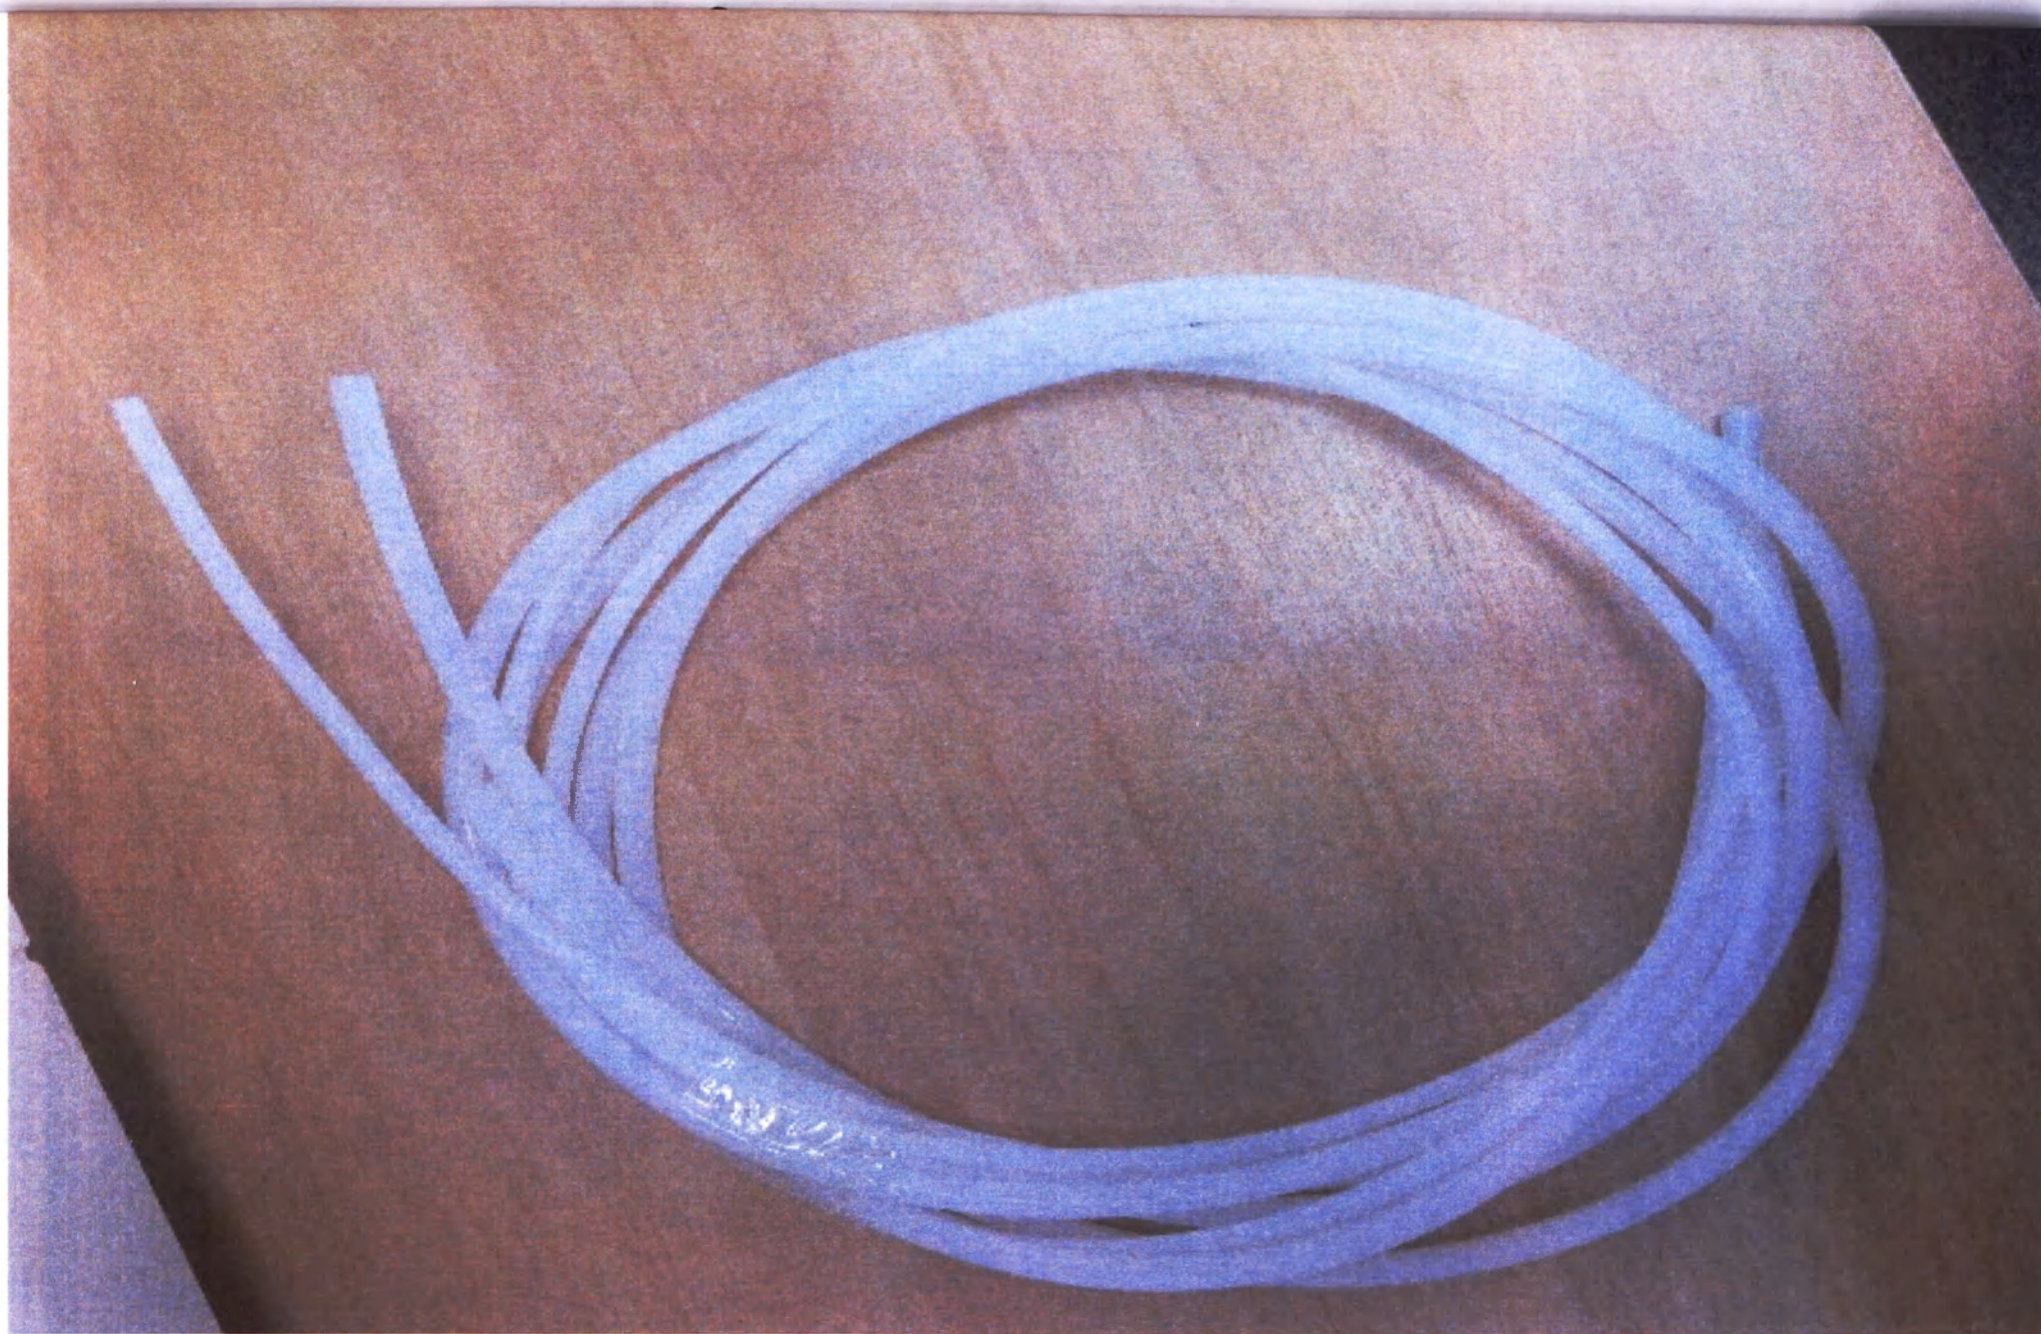

Всего прошито и пронумеровано 37 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

