



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: MPIS-402-10.0-SC-NT-U-SST; MPIS-502-10.0-SC-NT-U-SST

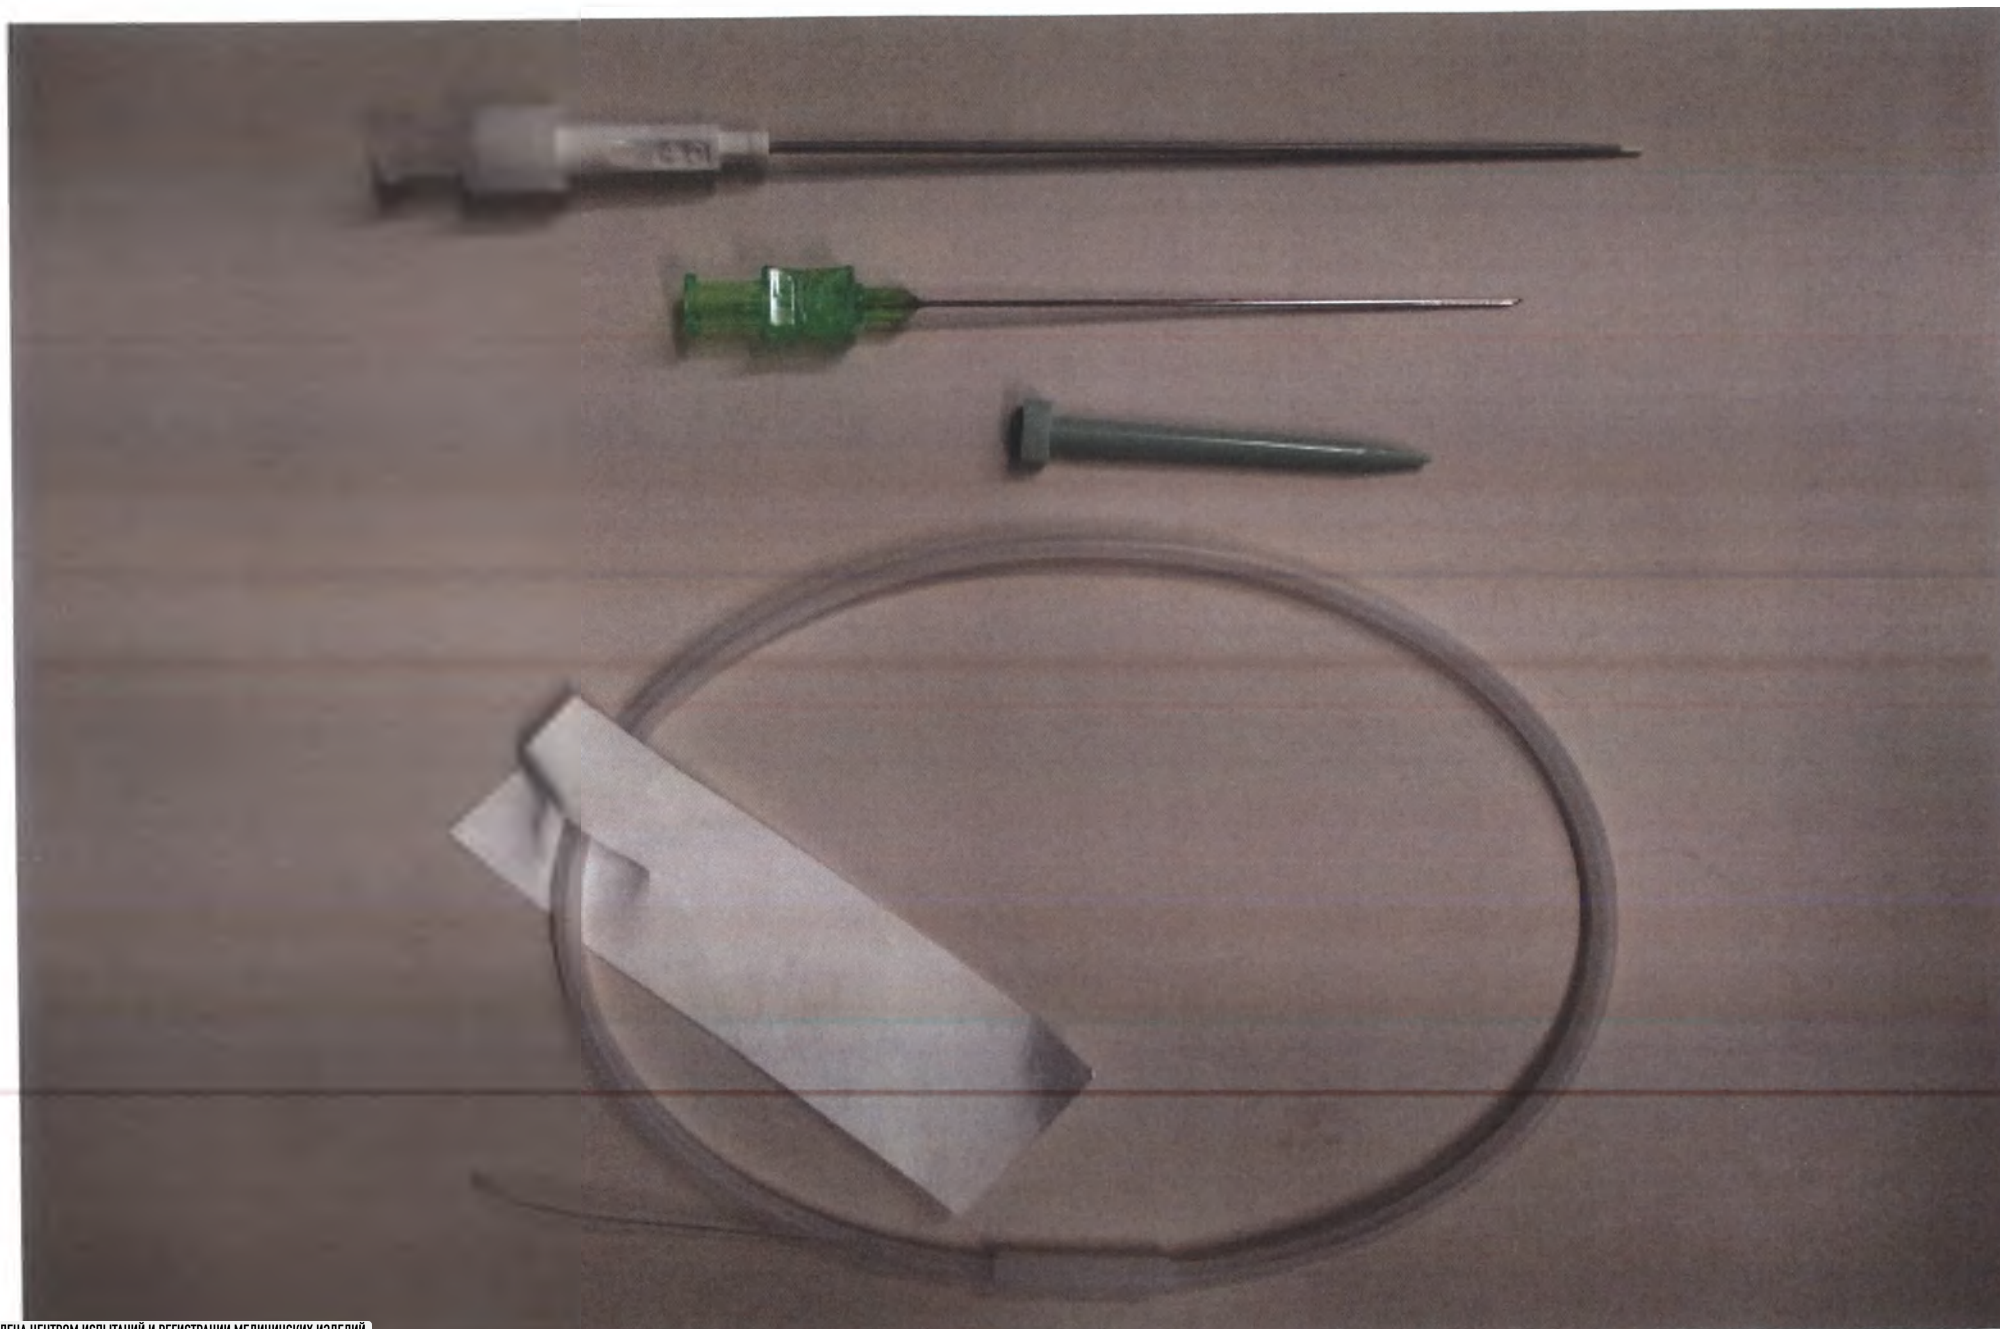

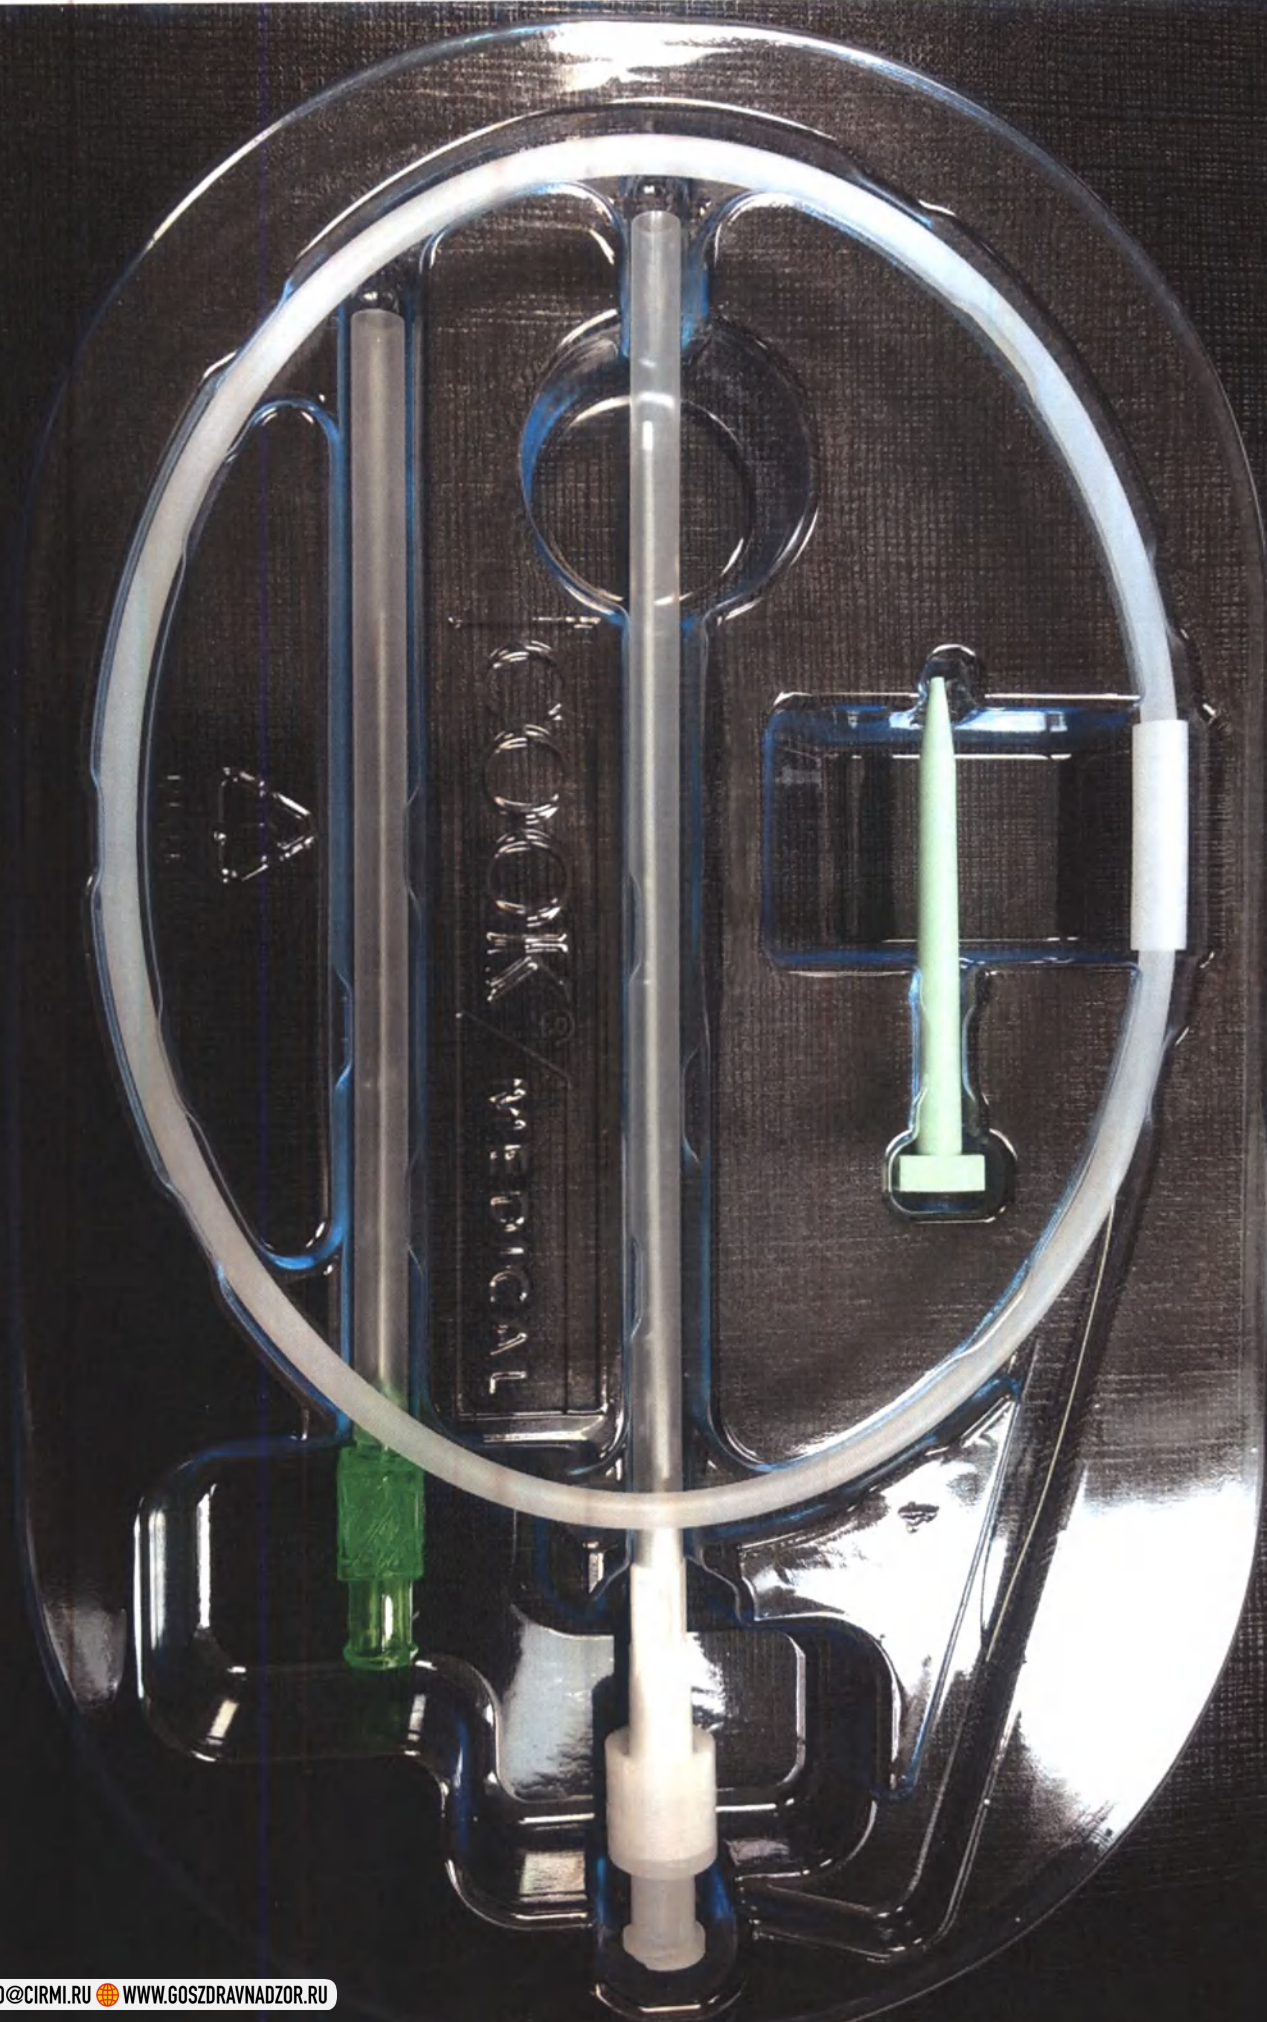

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

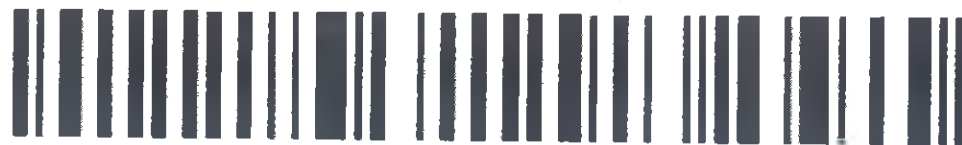

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах
Вариант исполнения: MPIS-401-PEDAL-NT-U-SST

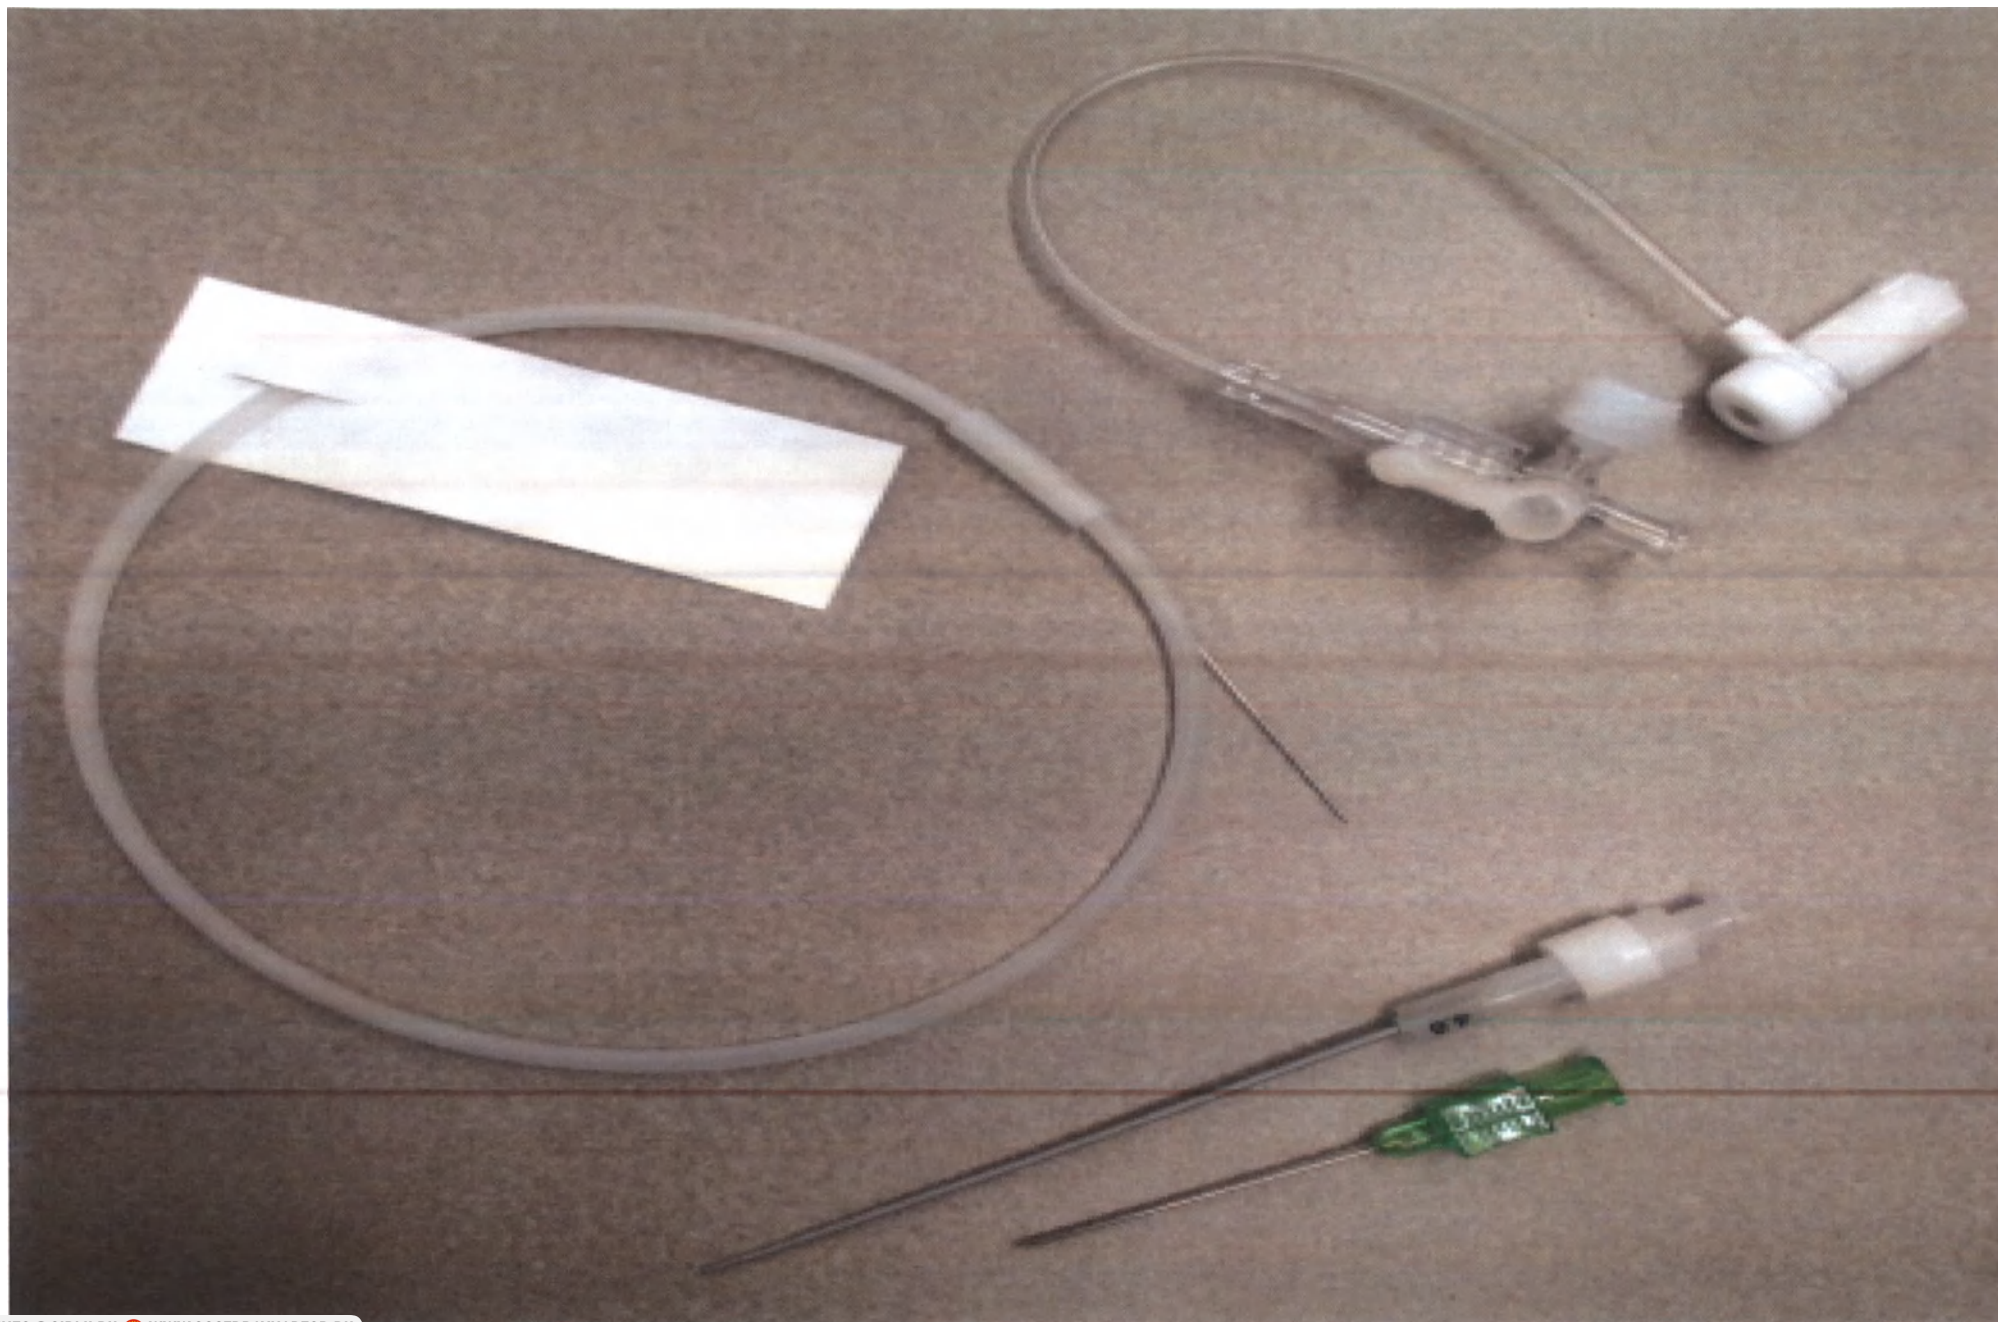

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

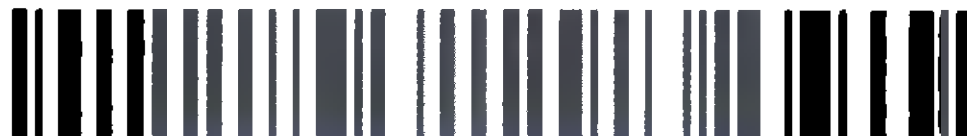

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: MPIS-401-U-SST; MPIS-401-NT-SST; MPIS-401-NT-U-SST; MPIS-401-PED-NT-SST; MPIS-401-PED-NT-U-SST; MPIS-402-NT-U-SST; MPIS-405-SST; MPIS-502-NT-U-SST; MPIS-505-SST; MPIS-501-U-SST; MPIS-501-PED-NT-SST; MPIS-501-NT-U-SST; MPIS-501-NT-SST

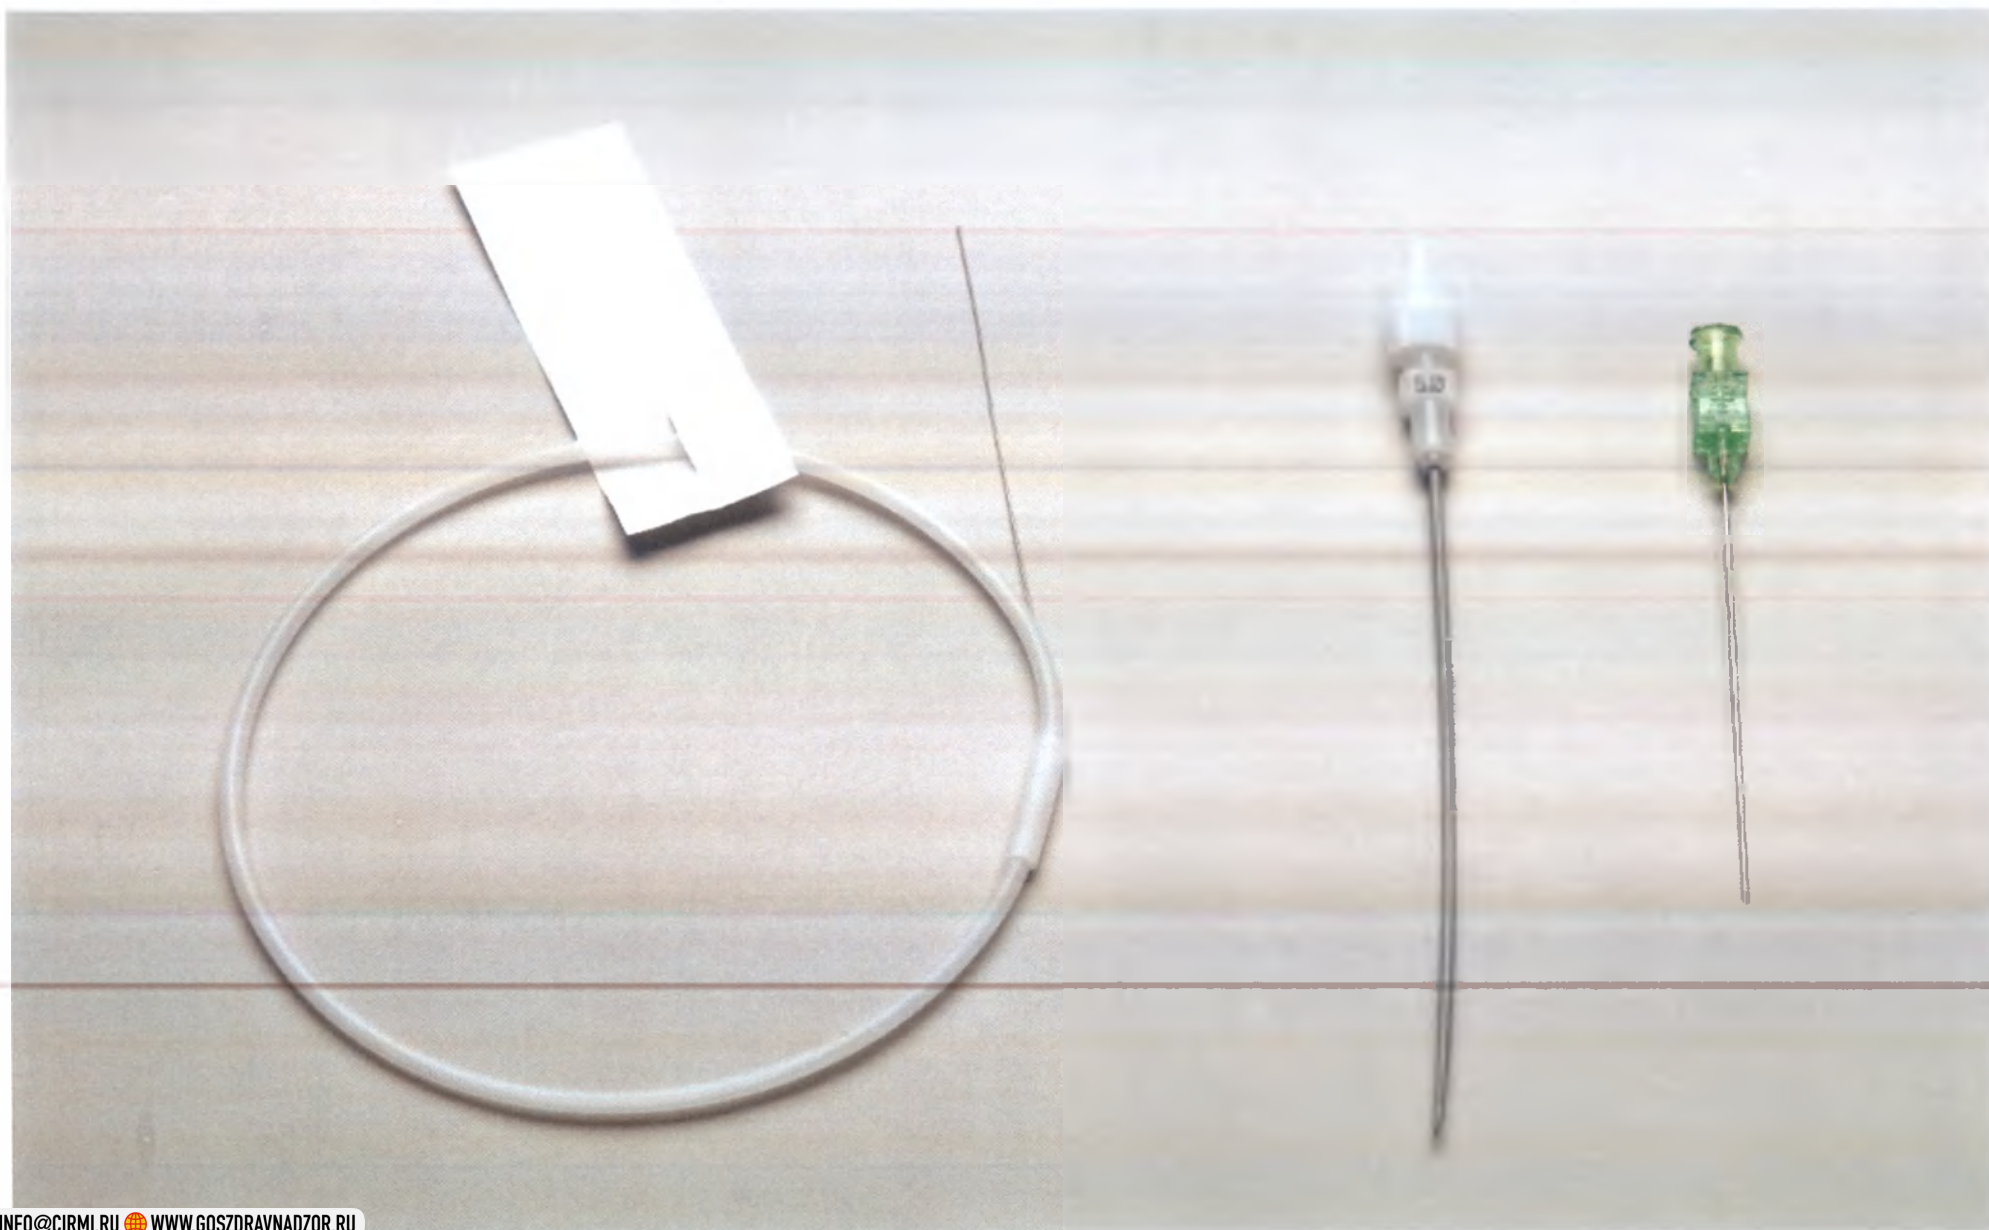

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

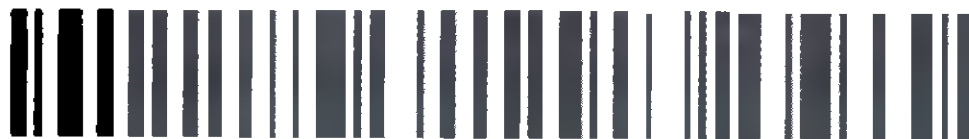

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: MPIS-401-10.0-SC-NT-SST; MPIS-401-10.0-SC-NT-U-SST; MPIS-501-10.0-SC-NT-SST; MPIS-501-10.0-SC-NT-U-SST; MPIS-501-15.0-SC-NT-SST

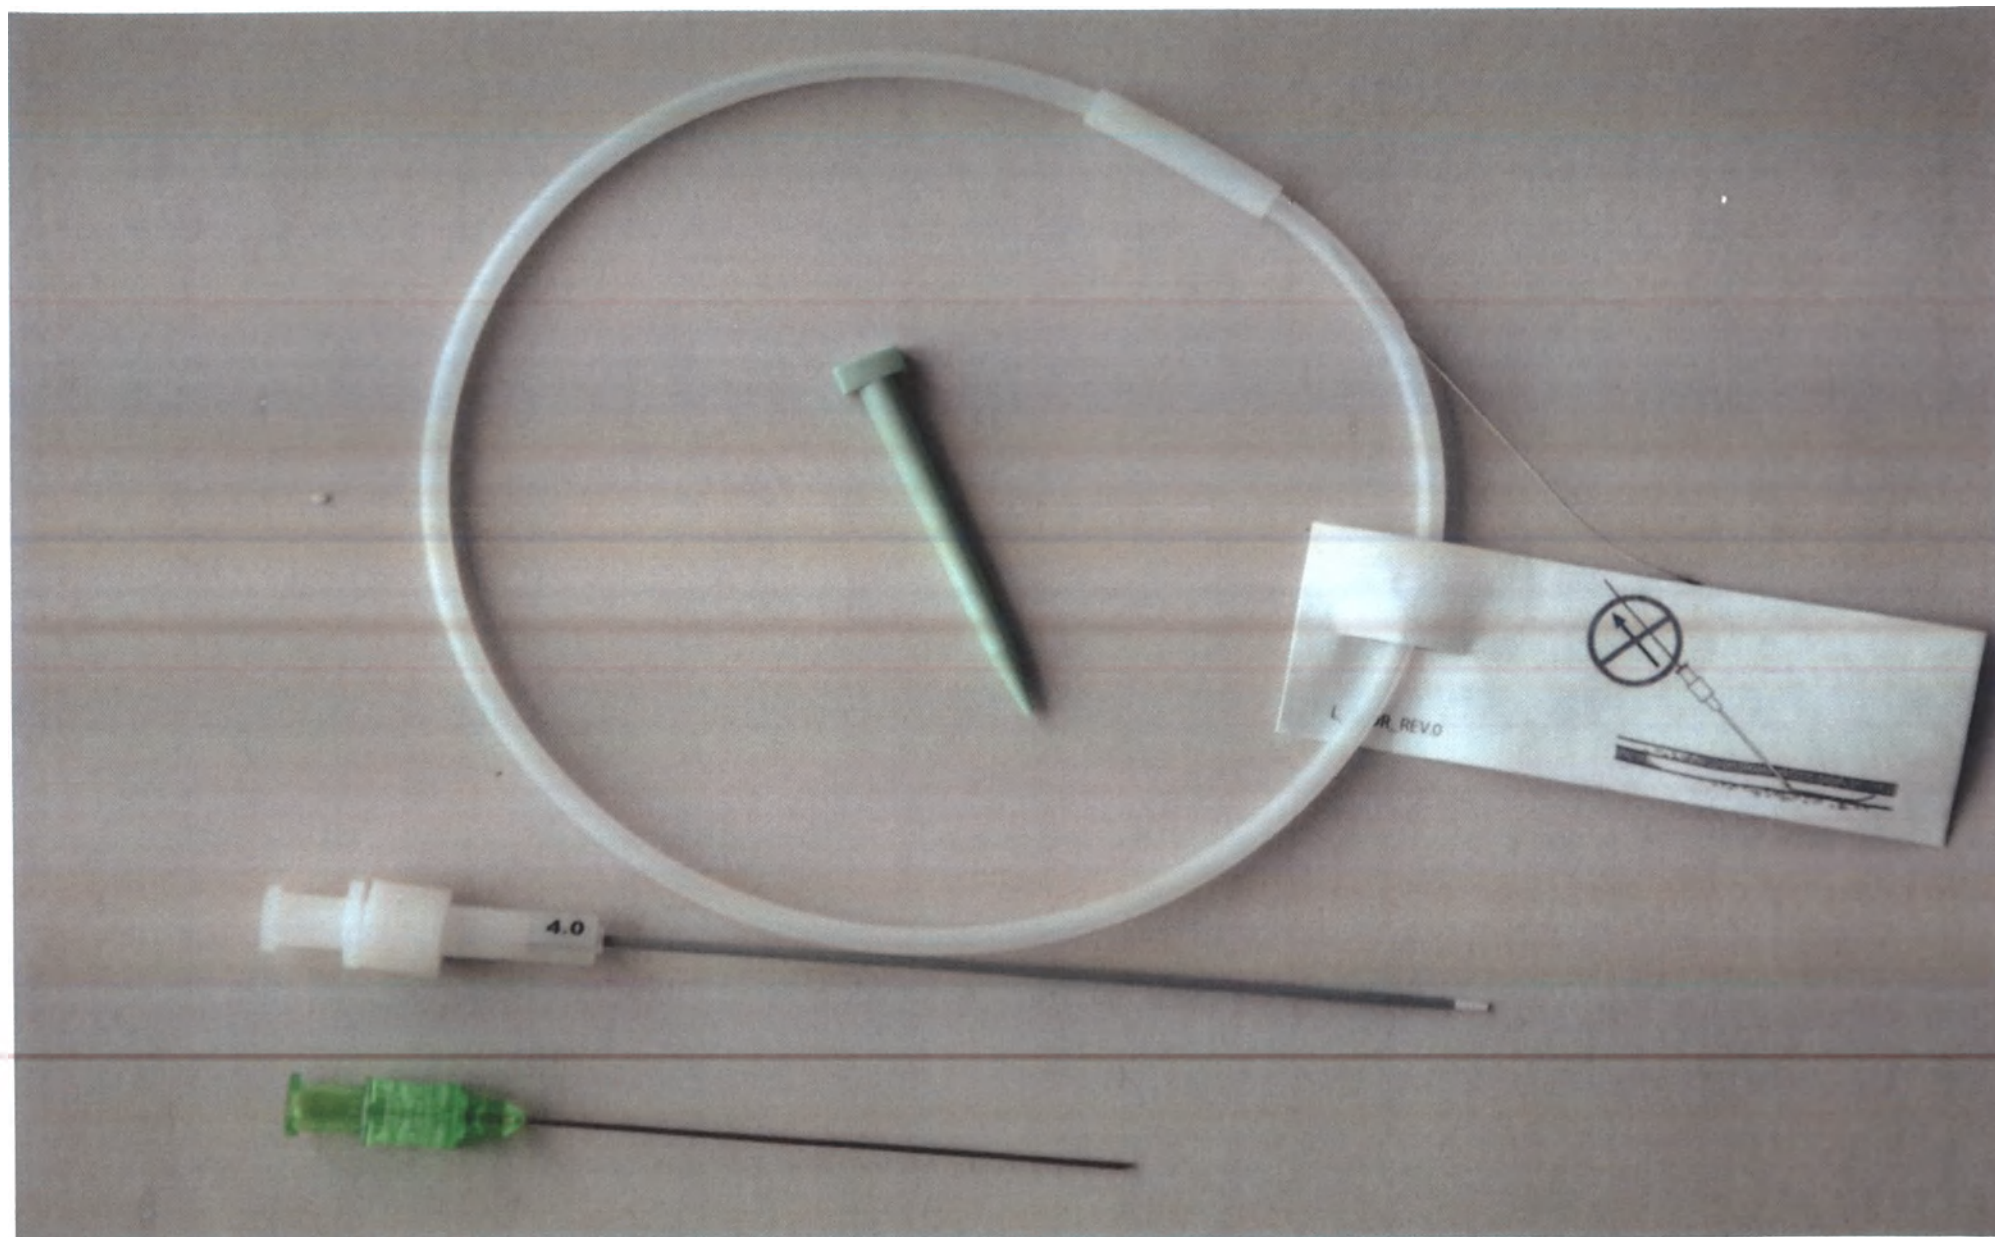

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCFN-4.0-18-MPIS-NT; RCFN-5.0-18-MPIS-NT; RCFN-6.0-18-MPIS-NT

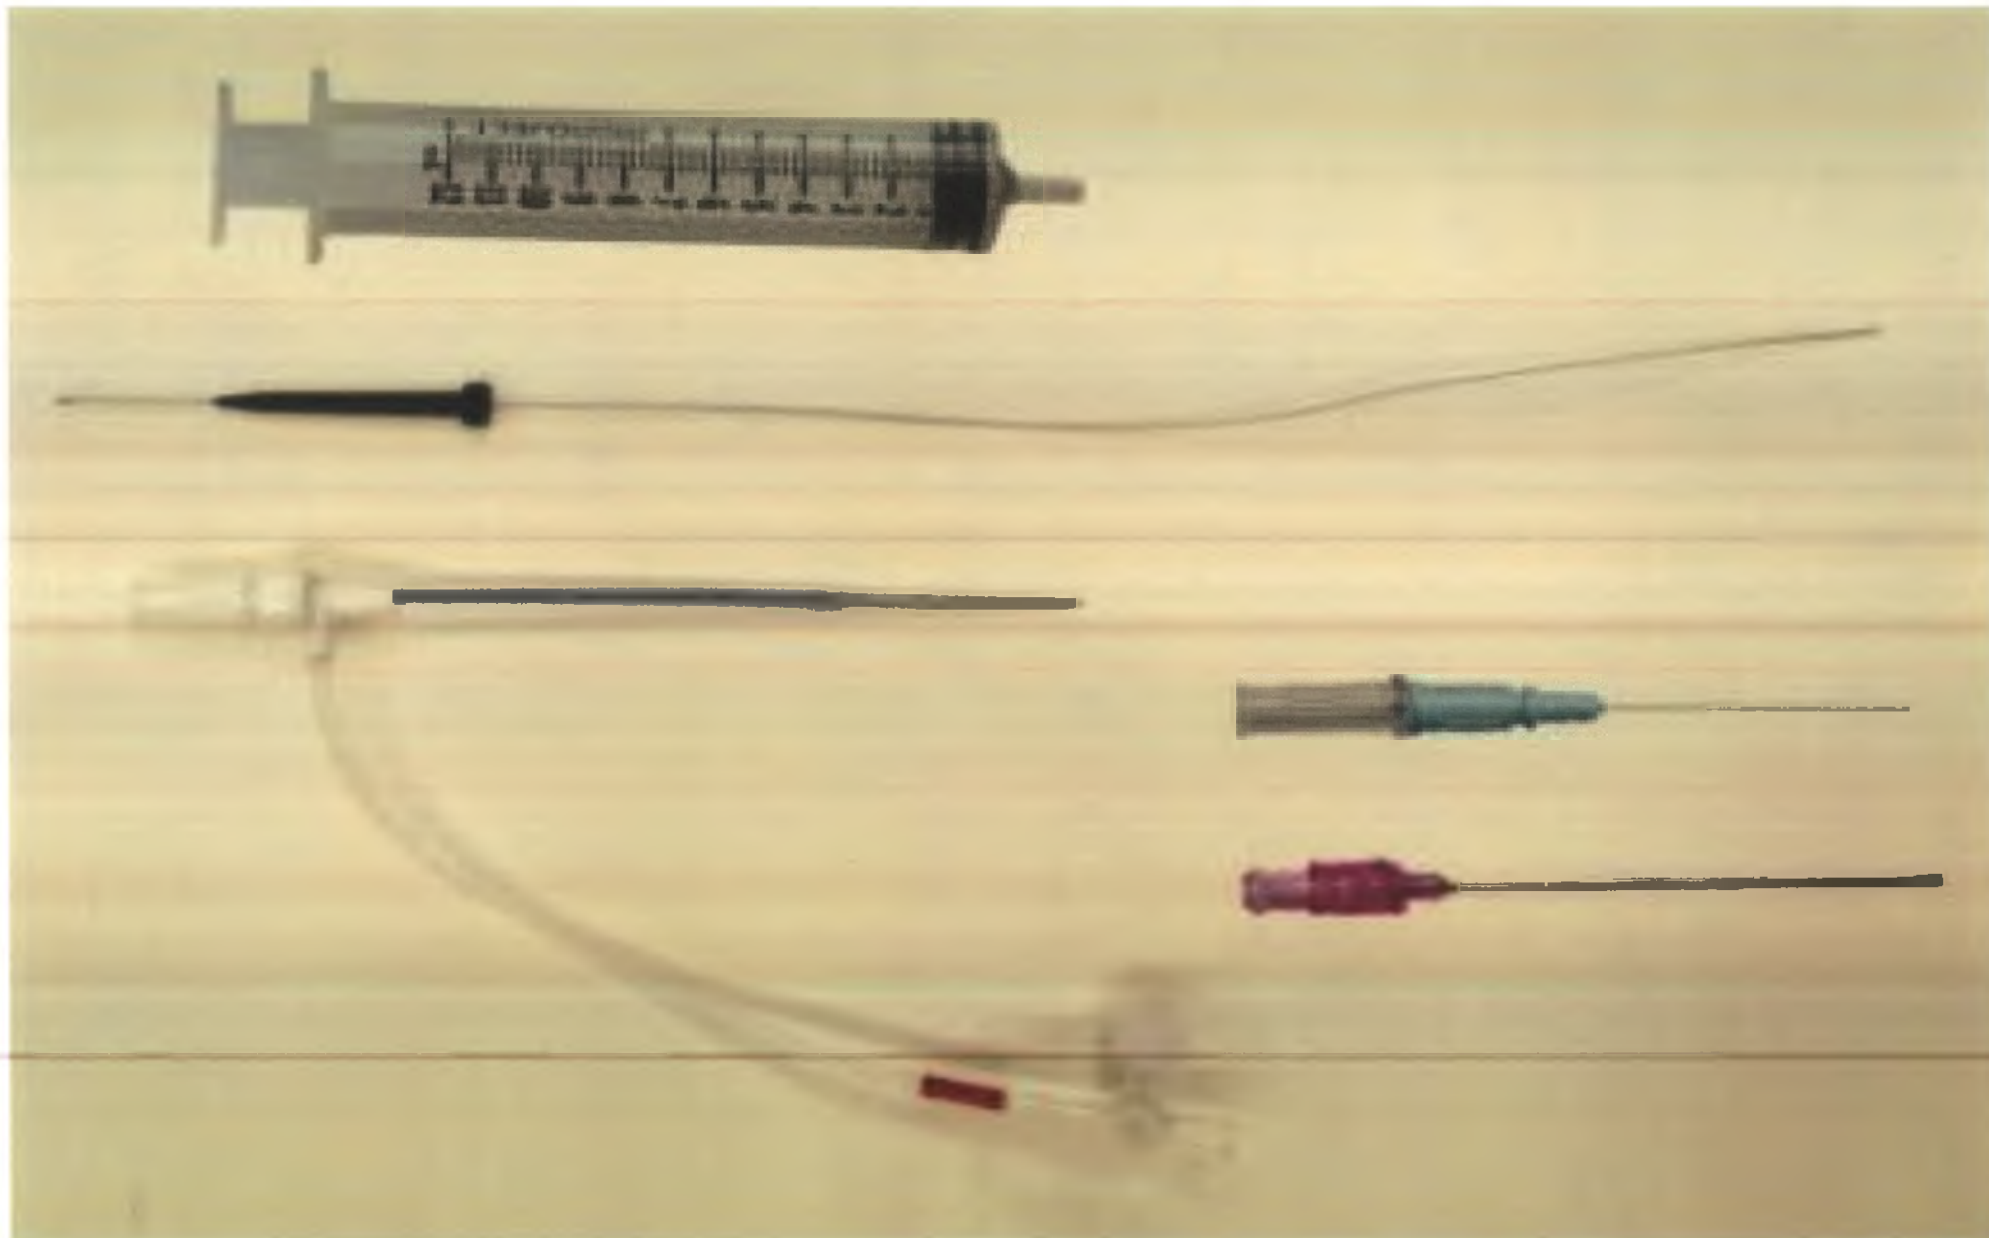

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCFN-4.0-18-13-RA2.5; RCFN-4.0-18-23-RA1.5; RCFN-4.0-18-5.5-RA1.5; RCFN-5.0-18-13-RA2.5; RCFN-5.0-18-23-RA2.5; RCFN-5.0-18-5.5-RA1.5; RCFN-5.0-18-7-RA2.5; RCFN-6.0-18-13-RA2.5; RCFN-6.0-18-19-RA2.5; RCFN-6.0-18-23-RA2.5; RCFN-6.0-18-5.5-RA1.5; RCFN-6.0-18-7-RA2.5; RCFW-6.0-18-7-RA2.5; RCFW-5.0-18-13-RA2.5; RCFW-4.0-18-13-RA1.5

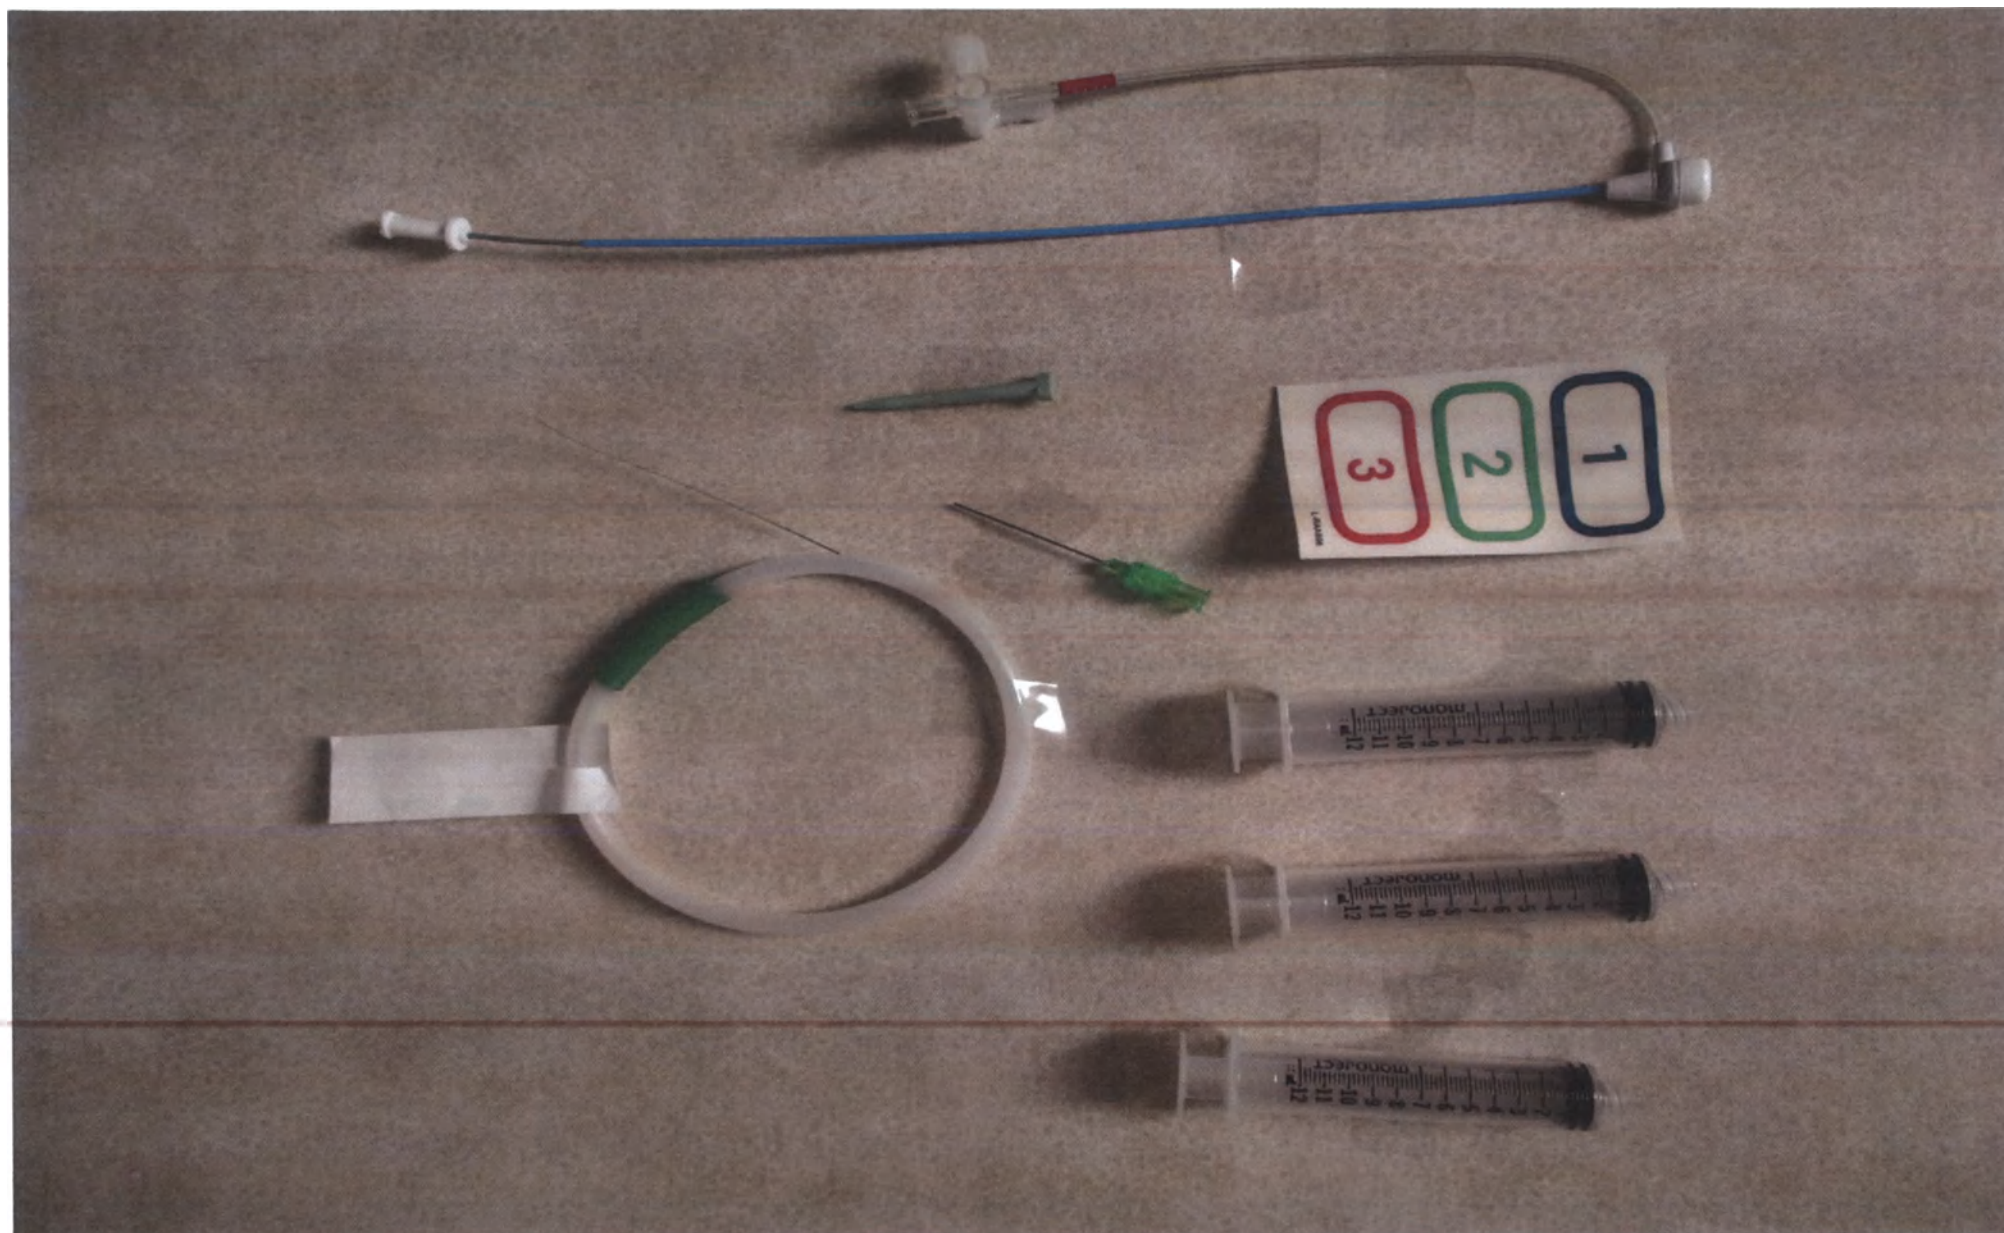

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCFW-10.0-38-30-RB; RCFW-10.0-38-45-RB; RCFW-10.0-38-80-RB; RCFW-11.0-38-30-RB; RCFW-11.0-38-70-RB; RCFW-12.0-38-45-RB; RCFW-12.0-38-30-RB; RCFW-12.0-38-80-RB; RCFW-12.0-38-RB; RCFW-14.0-38-30-RB; RCFW-14.0-38-45-RB; RCFW-14.0-38-80-RB; RCFW-16.0P-38-30-RB; RCFW-16.0P-38-35-RB; RCFW-16.0P-38-45-RB; RCFW-16.0P-38-70-RB; RCFW-16.0P-38-RB; RCFW-18.0P-38-30-RB; RCFW-18.0P-38-40-RB; RCFW-18.0P-38-85-RB; RCFW-16.0P-38-80-RB; RCFW-4.0-35-45-RB; RCFW-6.0-35-30-RB; RCFW-6.0-38-30-RB; RCFW-6.0-35-80-RB; RCFW-6.0-35-RB; RCFW-6.0-38-RB; RCFW-7.0-38-30-RB; RCFW-7.0-38-80-RB; RCFW-8.0-38-30-RB; RCFW-8.0-38-80-RB; RCFW-9.0-38-30-RB; RCFW-12.0-38; RCFW-5.0-35; RCFW-10.0-38



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: XVCFW-20.0-35-25; XVCFW-20.0-35-40; XVCFW-20.0-35-65; XVCFW-22.0-35-25; XVCFW-22.0-35-65; XVCFW-24.0-35-25; XVCFW-24.0-35-65

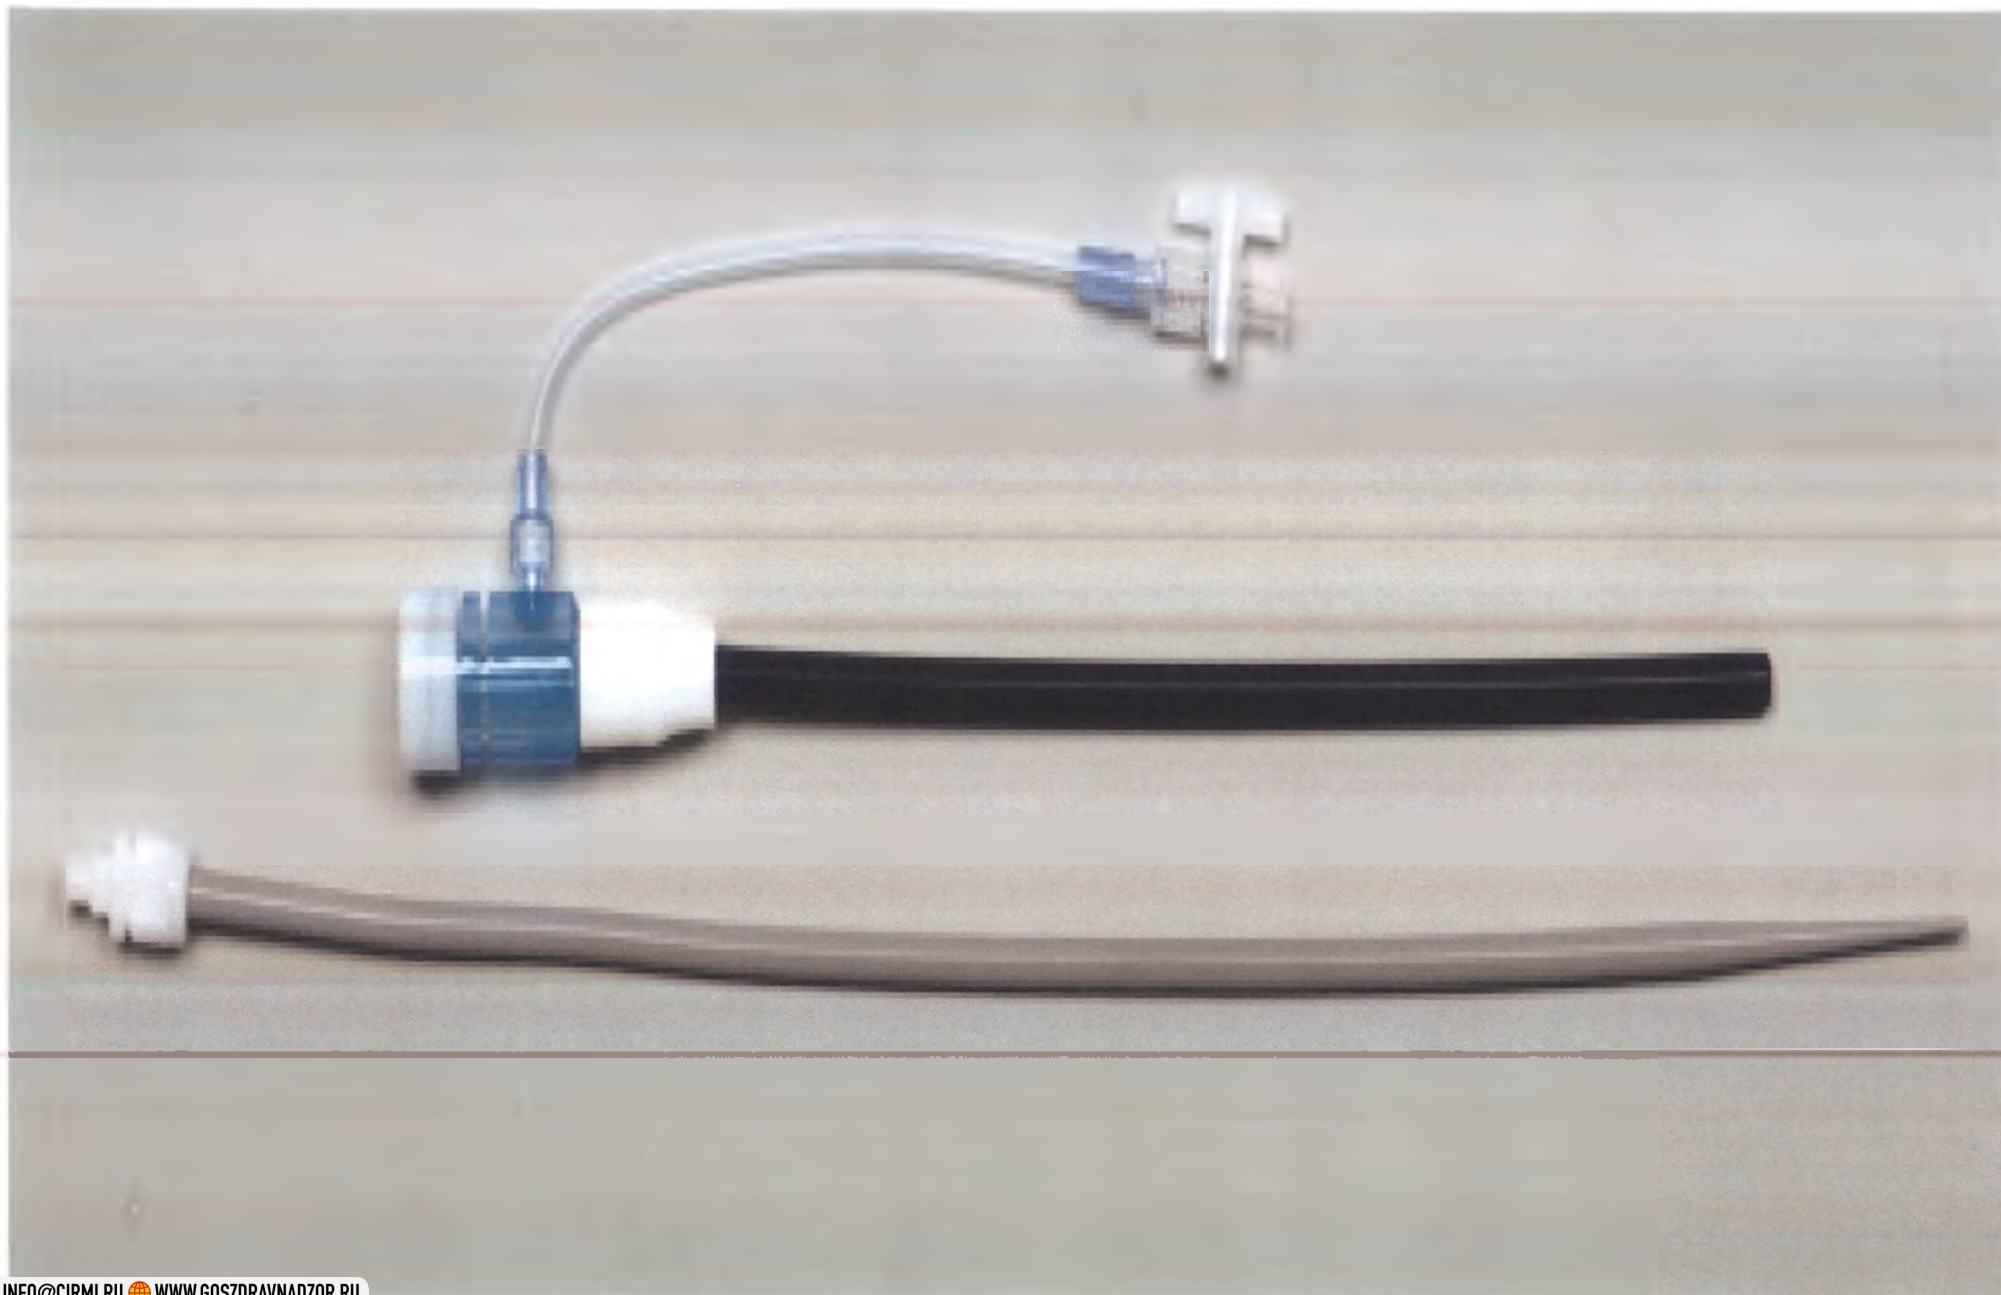

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KCFW-10.0-38-30-RB; KCFW-10.0-38-40-RB; KCFW-10.0-38-80-RB; KCFW-12.0-38-40-RB; KCFW-12.0-38-80-RB; KCFW-5.0-38-30-RB; KCFW-5.0-38-45-RB; KCFW-5.0-38-RB; KCFW-6.0-35-45-RB; KCFW-6.0-38-30-RB; KCFW-6.0-38-45-RB; KCFW-6.0-38-90-RB; KCFW-7.0-38-30-RB; KCFW-7.0-38-45-RB; KCFW-7.0-38-90-RB; KCFW-8.0-38-30-RB; KCFW-8.0-38-45-RB; KCFW-8.0-38-90-RB

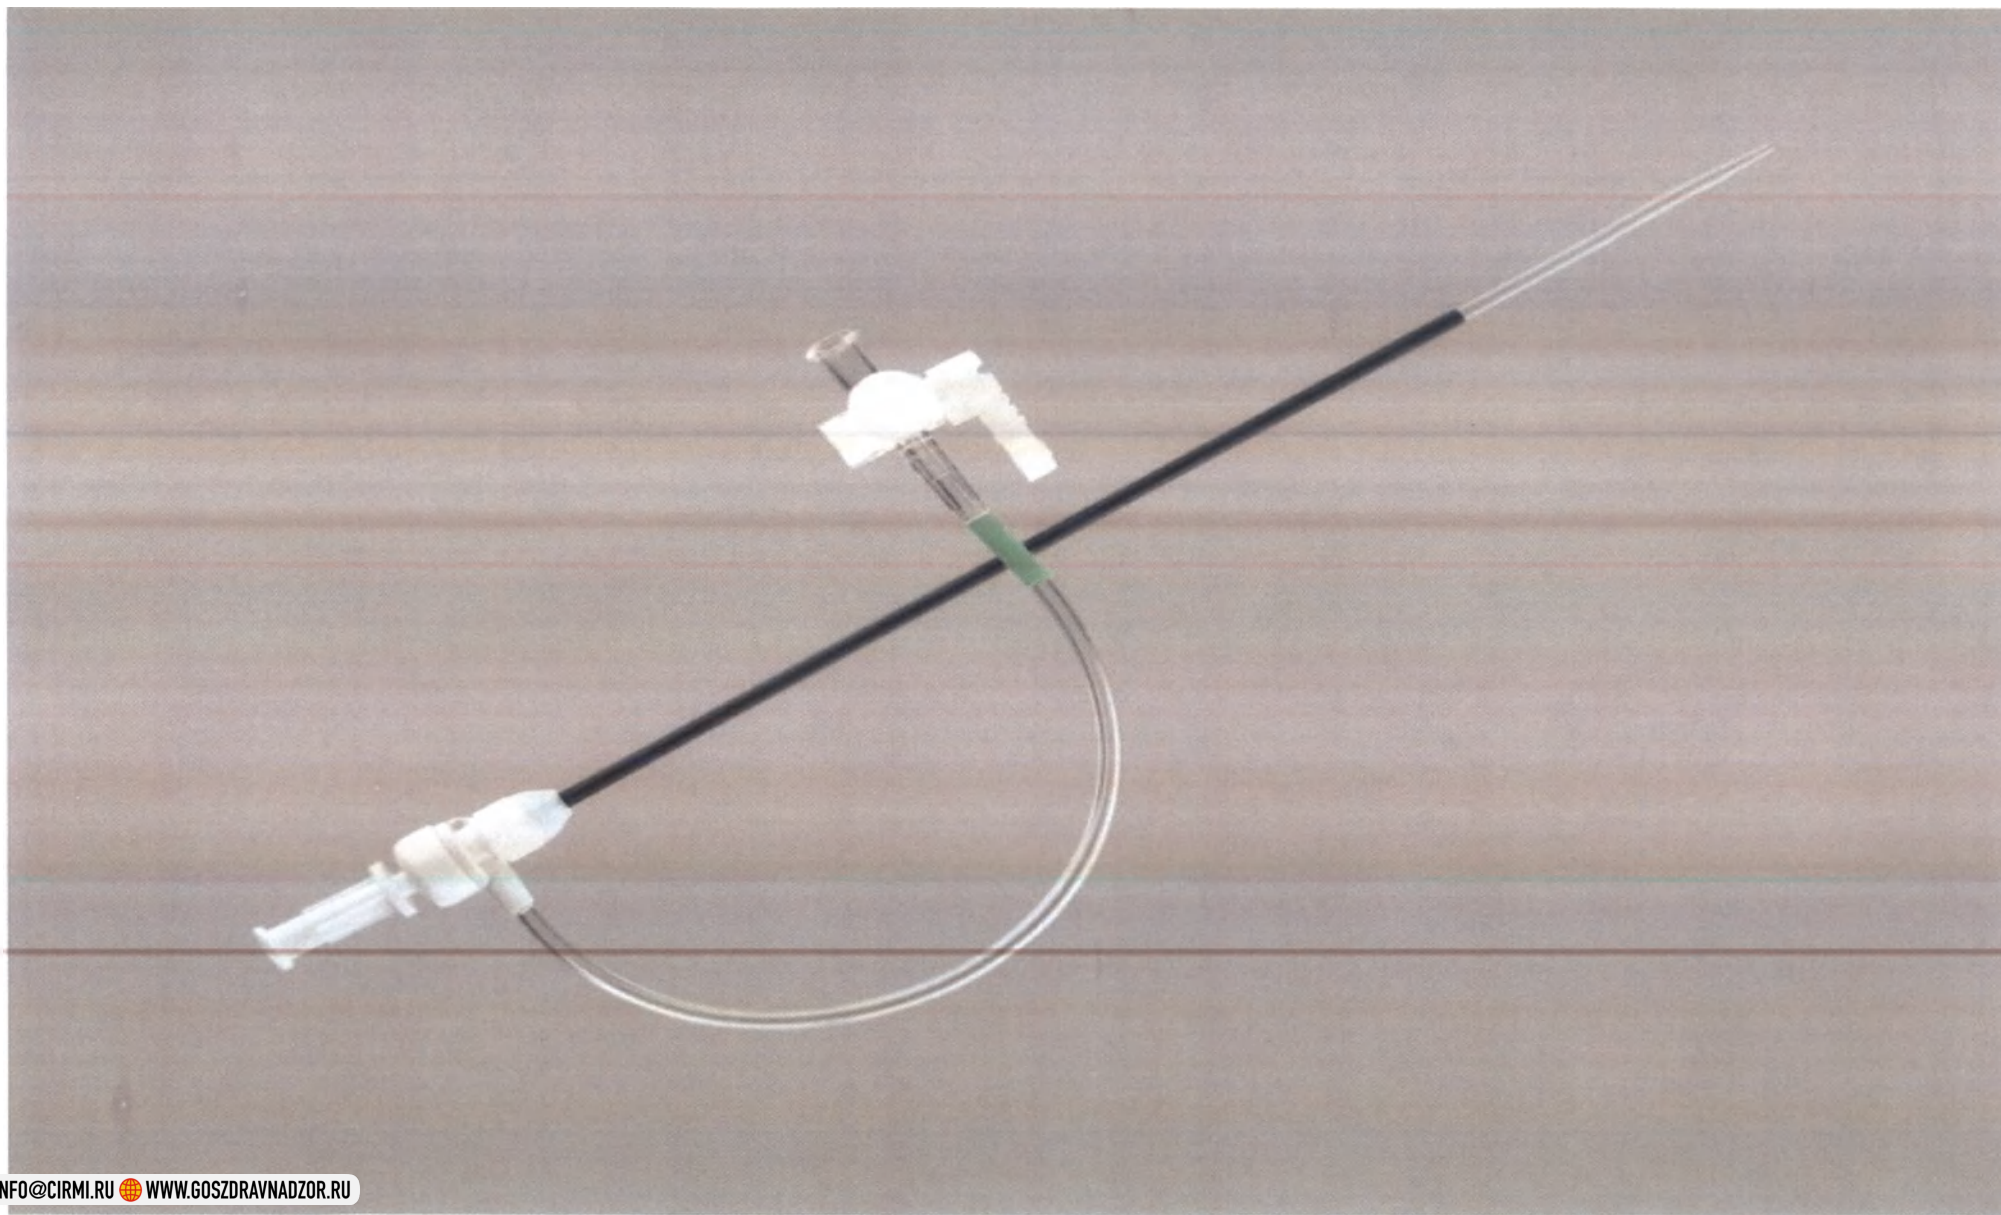

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL0-HC; KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC; KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL0-HC; KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC; KCFW-4.0-18/35-110-RB-ANL0-HC; KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANL0-HC; KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC; KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL1-HC; KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL0-HC; KCFW-4.0-35-70-RB-HFANL0-HC; KCFW-5.0-18/38-110-RB-ANL0-HC; KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL0-HC; KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL1-HC; KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL2-HC; KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL0-HC; KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL1-HC; KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL0-HC; KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL1-HC; KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL0-HC; KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC; KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL0-HC; KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL1-HC; KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC; KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL3-HC; KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC; KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL0-HC; KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC; KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC; KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL0-HC; KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL0-HC; KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL1-HC; KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL2-HC; KCFW-7.0-35-110-RB-HFANL1-HC; KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL0-HC; KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL1-HC; KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC; KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL0-HC; KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL0-HC; KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL1-HC; KCFW-8.0-35-110-RB-HFANL1-HC; KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL1-HC; KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL0-HC; KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC; KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL0-HC; KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL0-HC; KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL1-HC

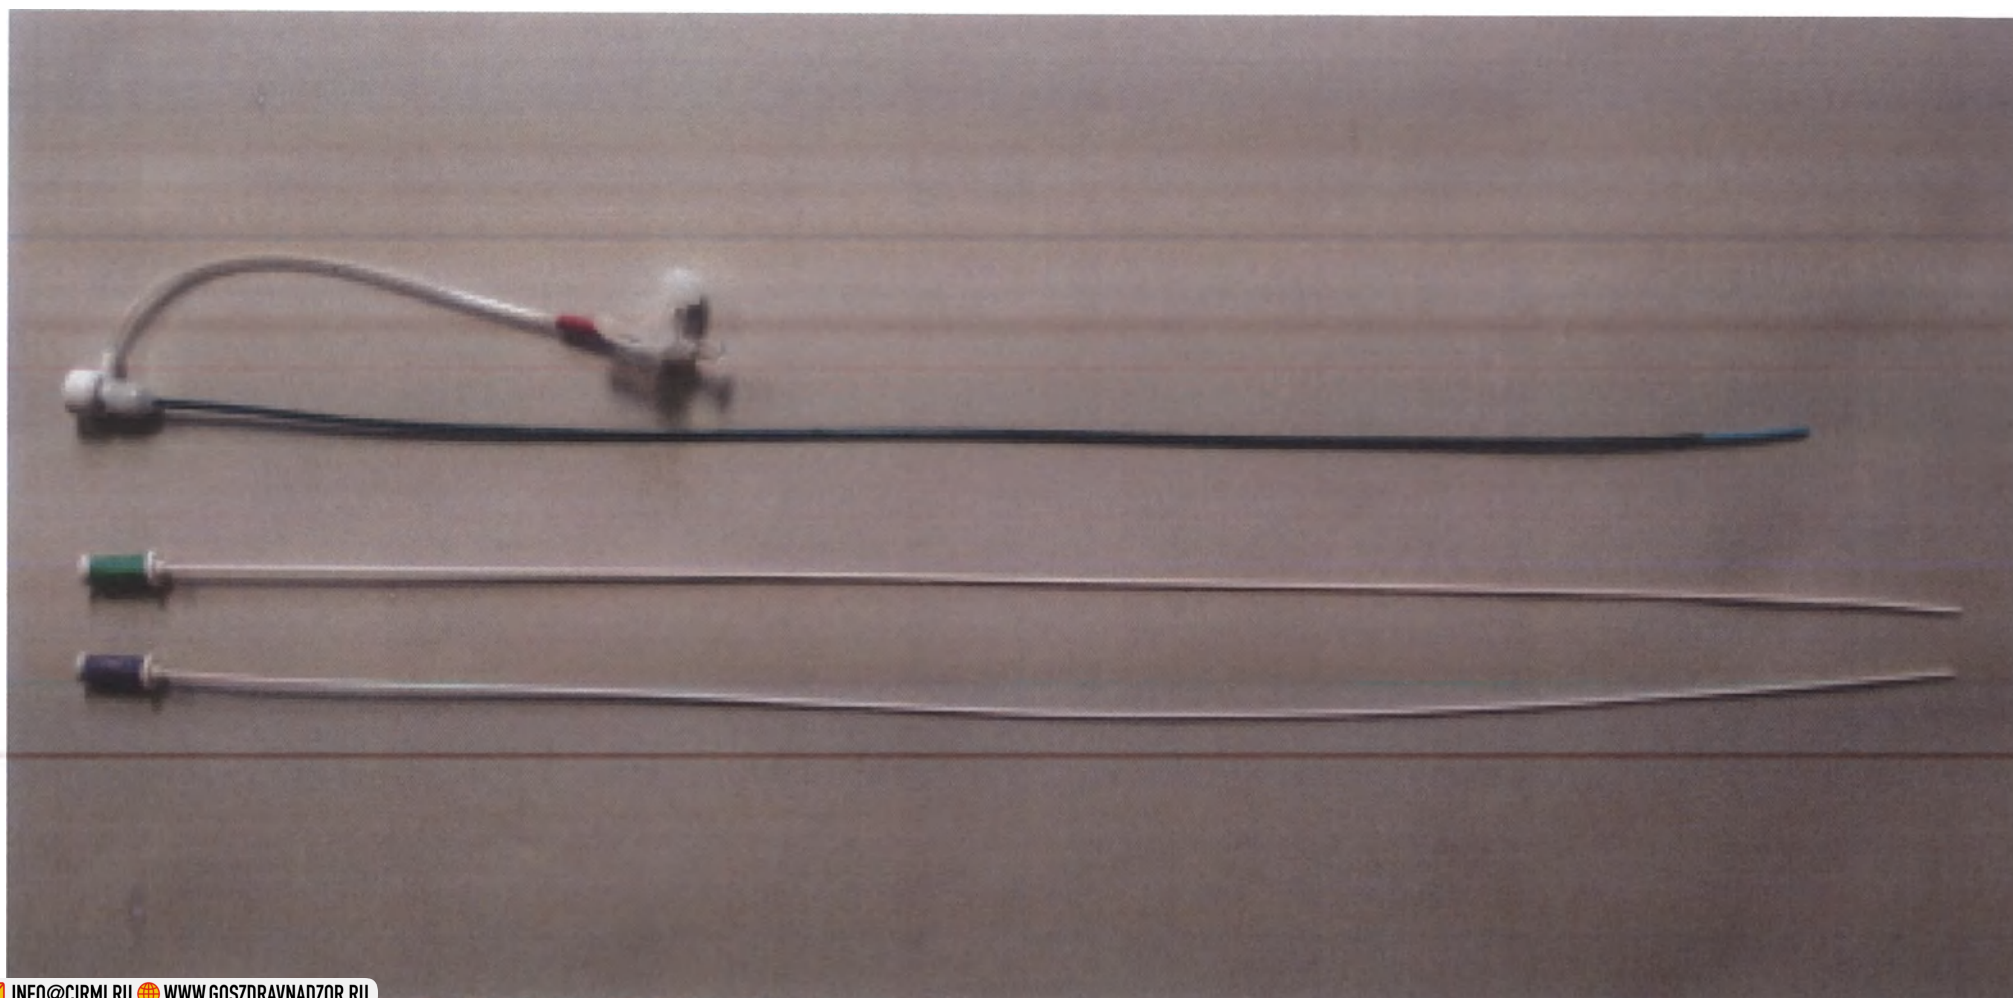

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN; KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC; KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN; KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC; KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN; KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN-HC; KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN-HC

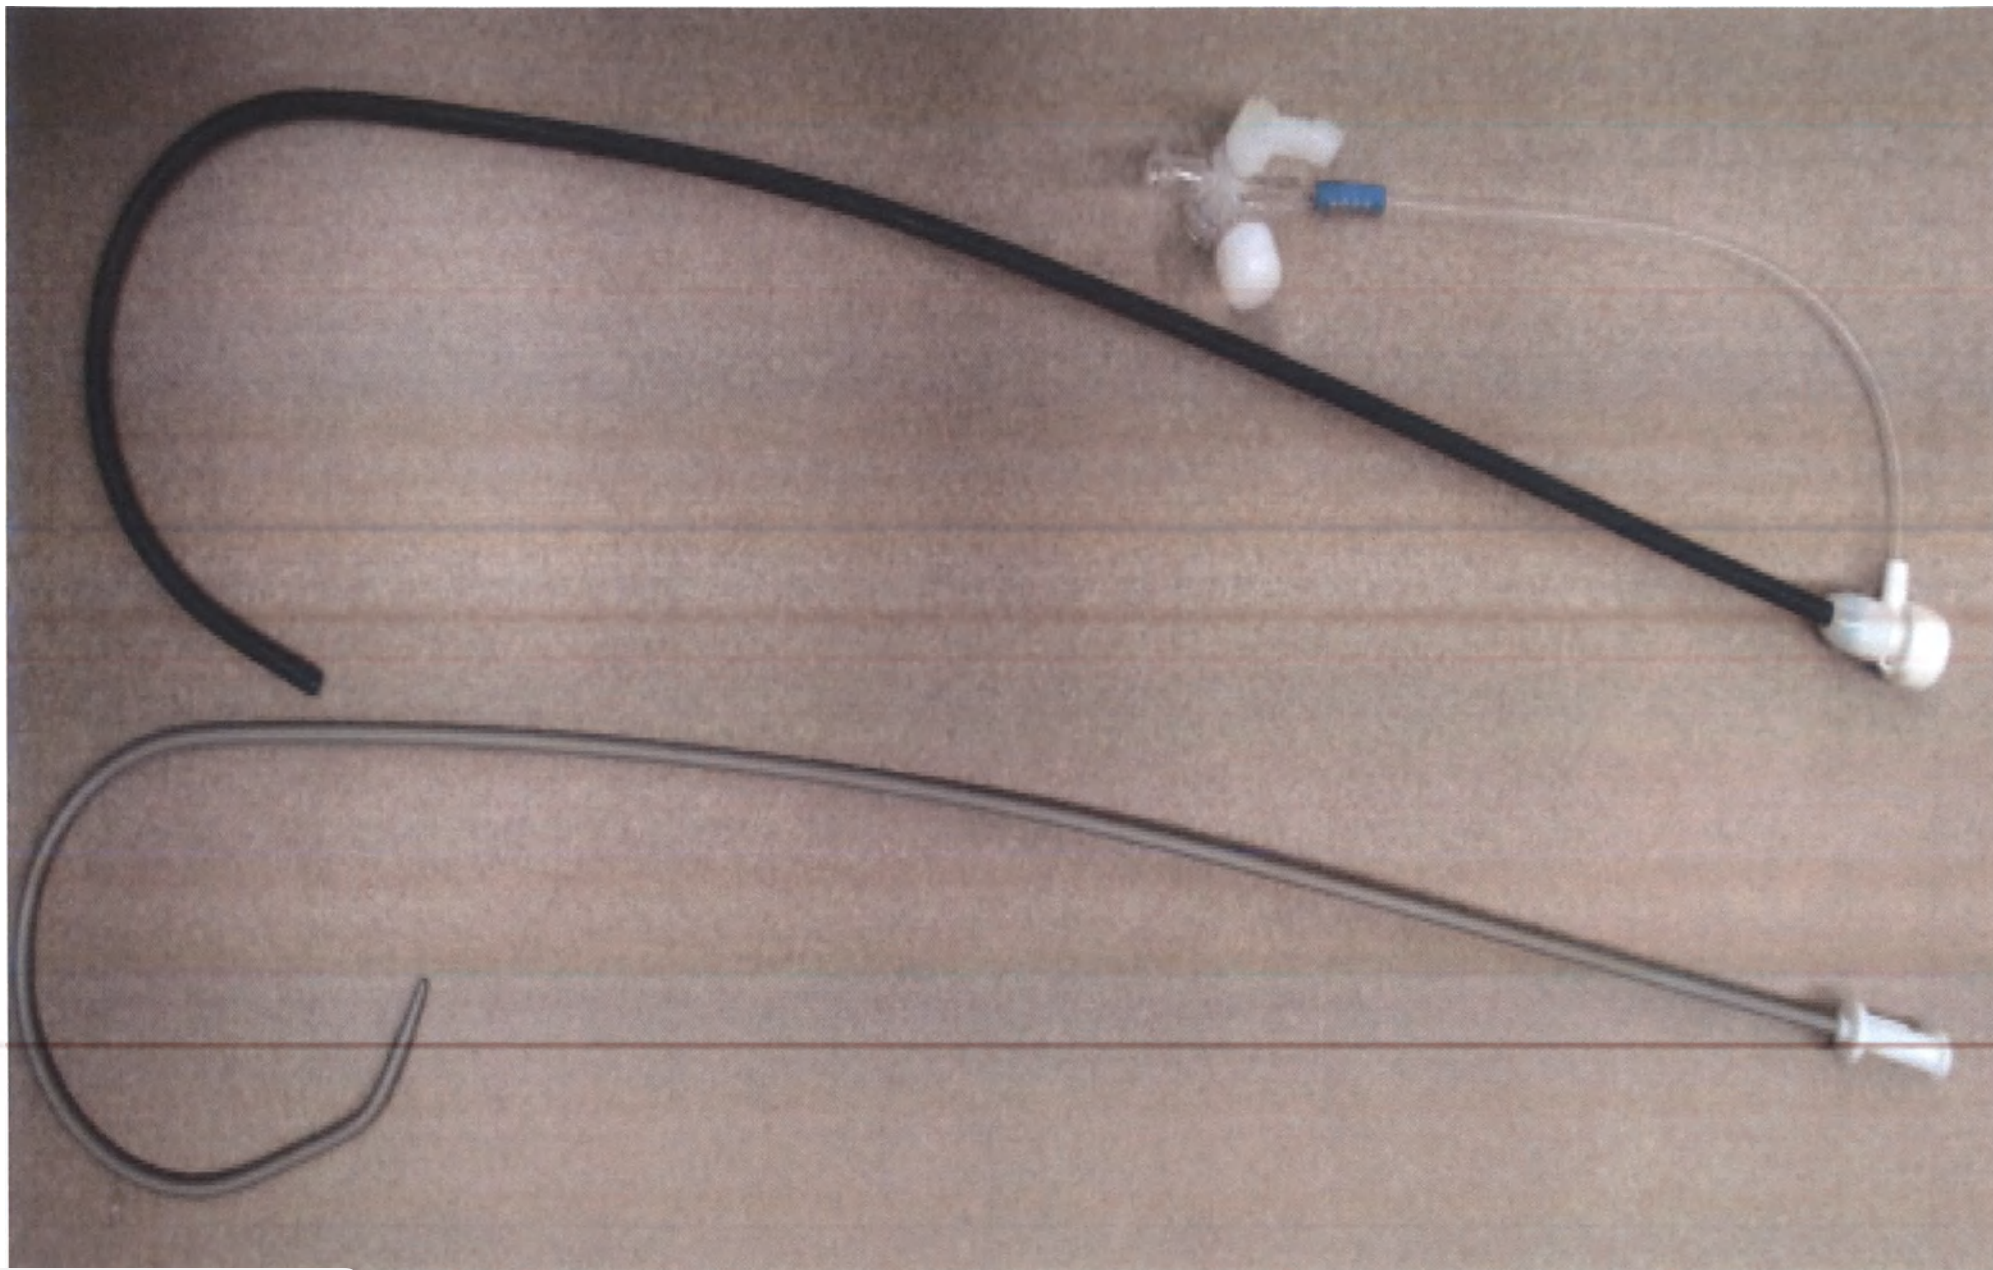

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KCFW-4.0-35-55-RB-RAABE; KCFW-5.0-38-55-RB-RAABE; KCFW-5.0-38-70-RB-RAABE; KCFW-5.0-38-90-RB-RAABE; KCFW-6.0-38-55-RB-RAABE; KCFW-6.0-38-70-RB-RAABE; KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE; KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE; KCFW-7.0-38-70-RB-RAABE; KCFW-7.0-38-90-RB-RAABE; KCFW-8.0-38-55-RB-RAABE; KCFW-8.0-38-70-RB-RAABE; KCFW-8.0-38-90-RB-RAABE; KCFW-9.0-38-55-RB-RAABE; KCFW-9.0-38-70-RB-RAABE

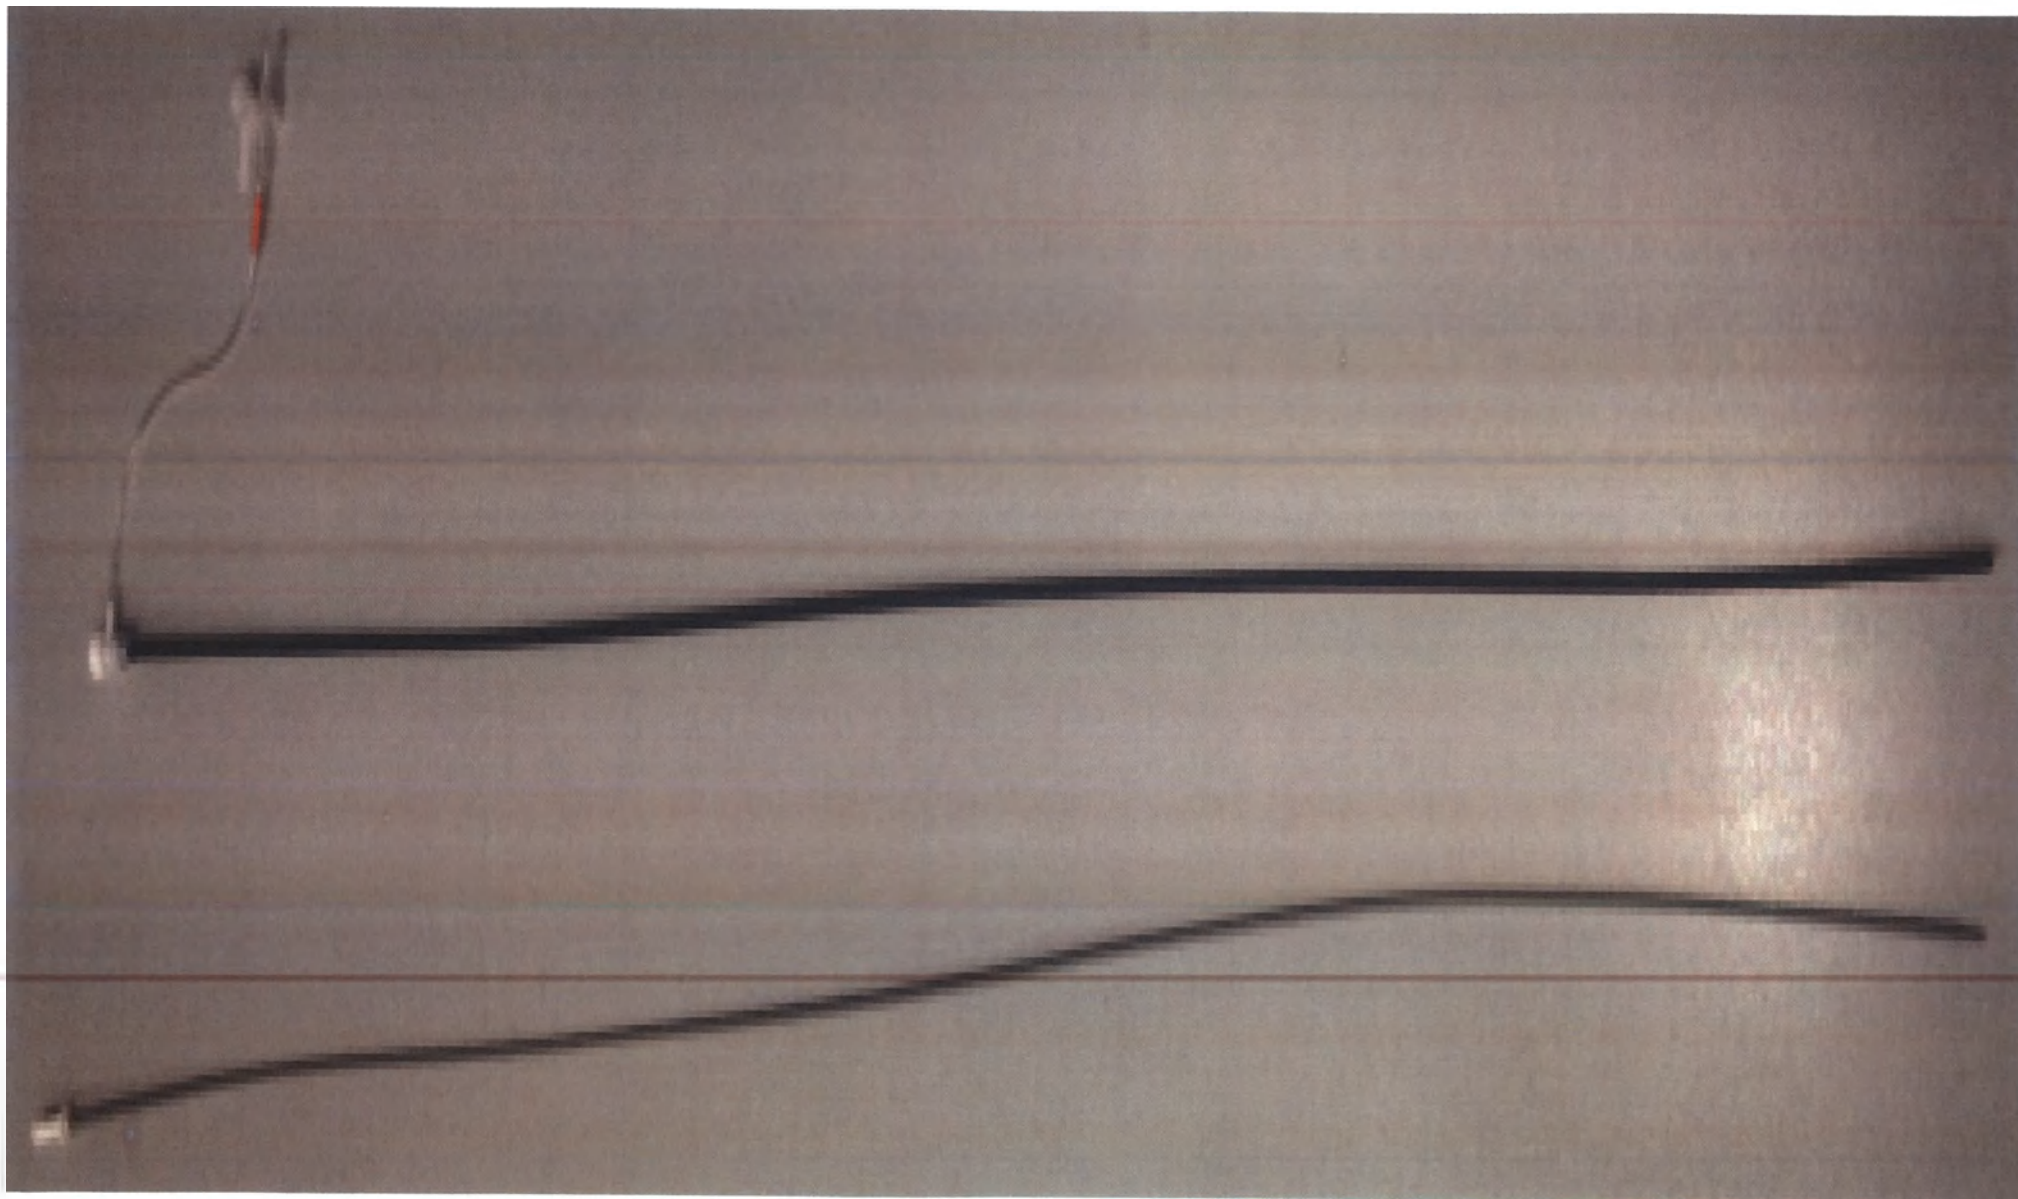

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC; KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC; KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC; KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC; KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC; KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC; KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC

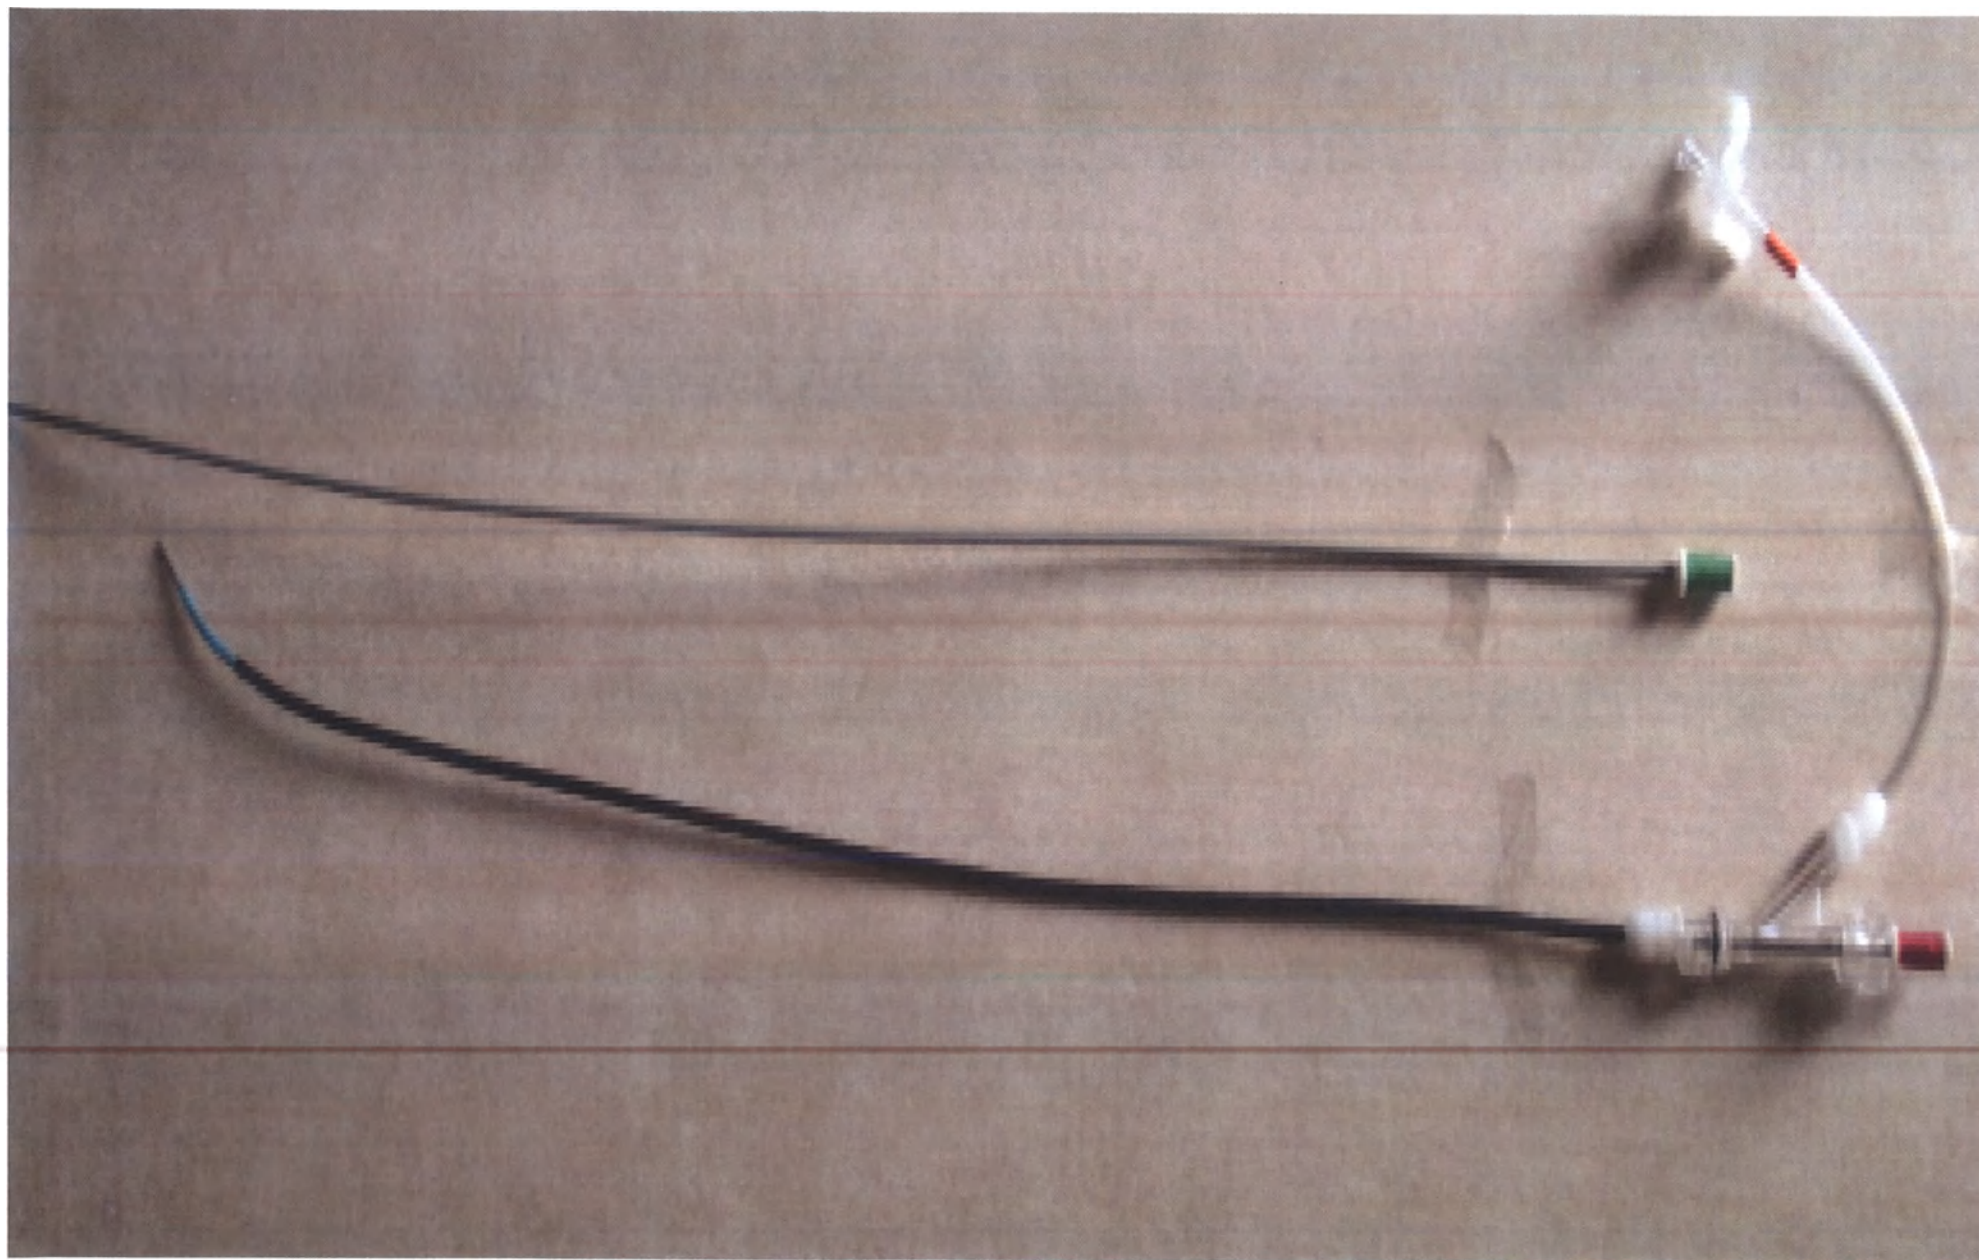

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах
Вариант исполнения: VSSW-22.0-38-25-0-KTI

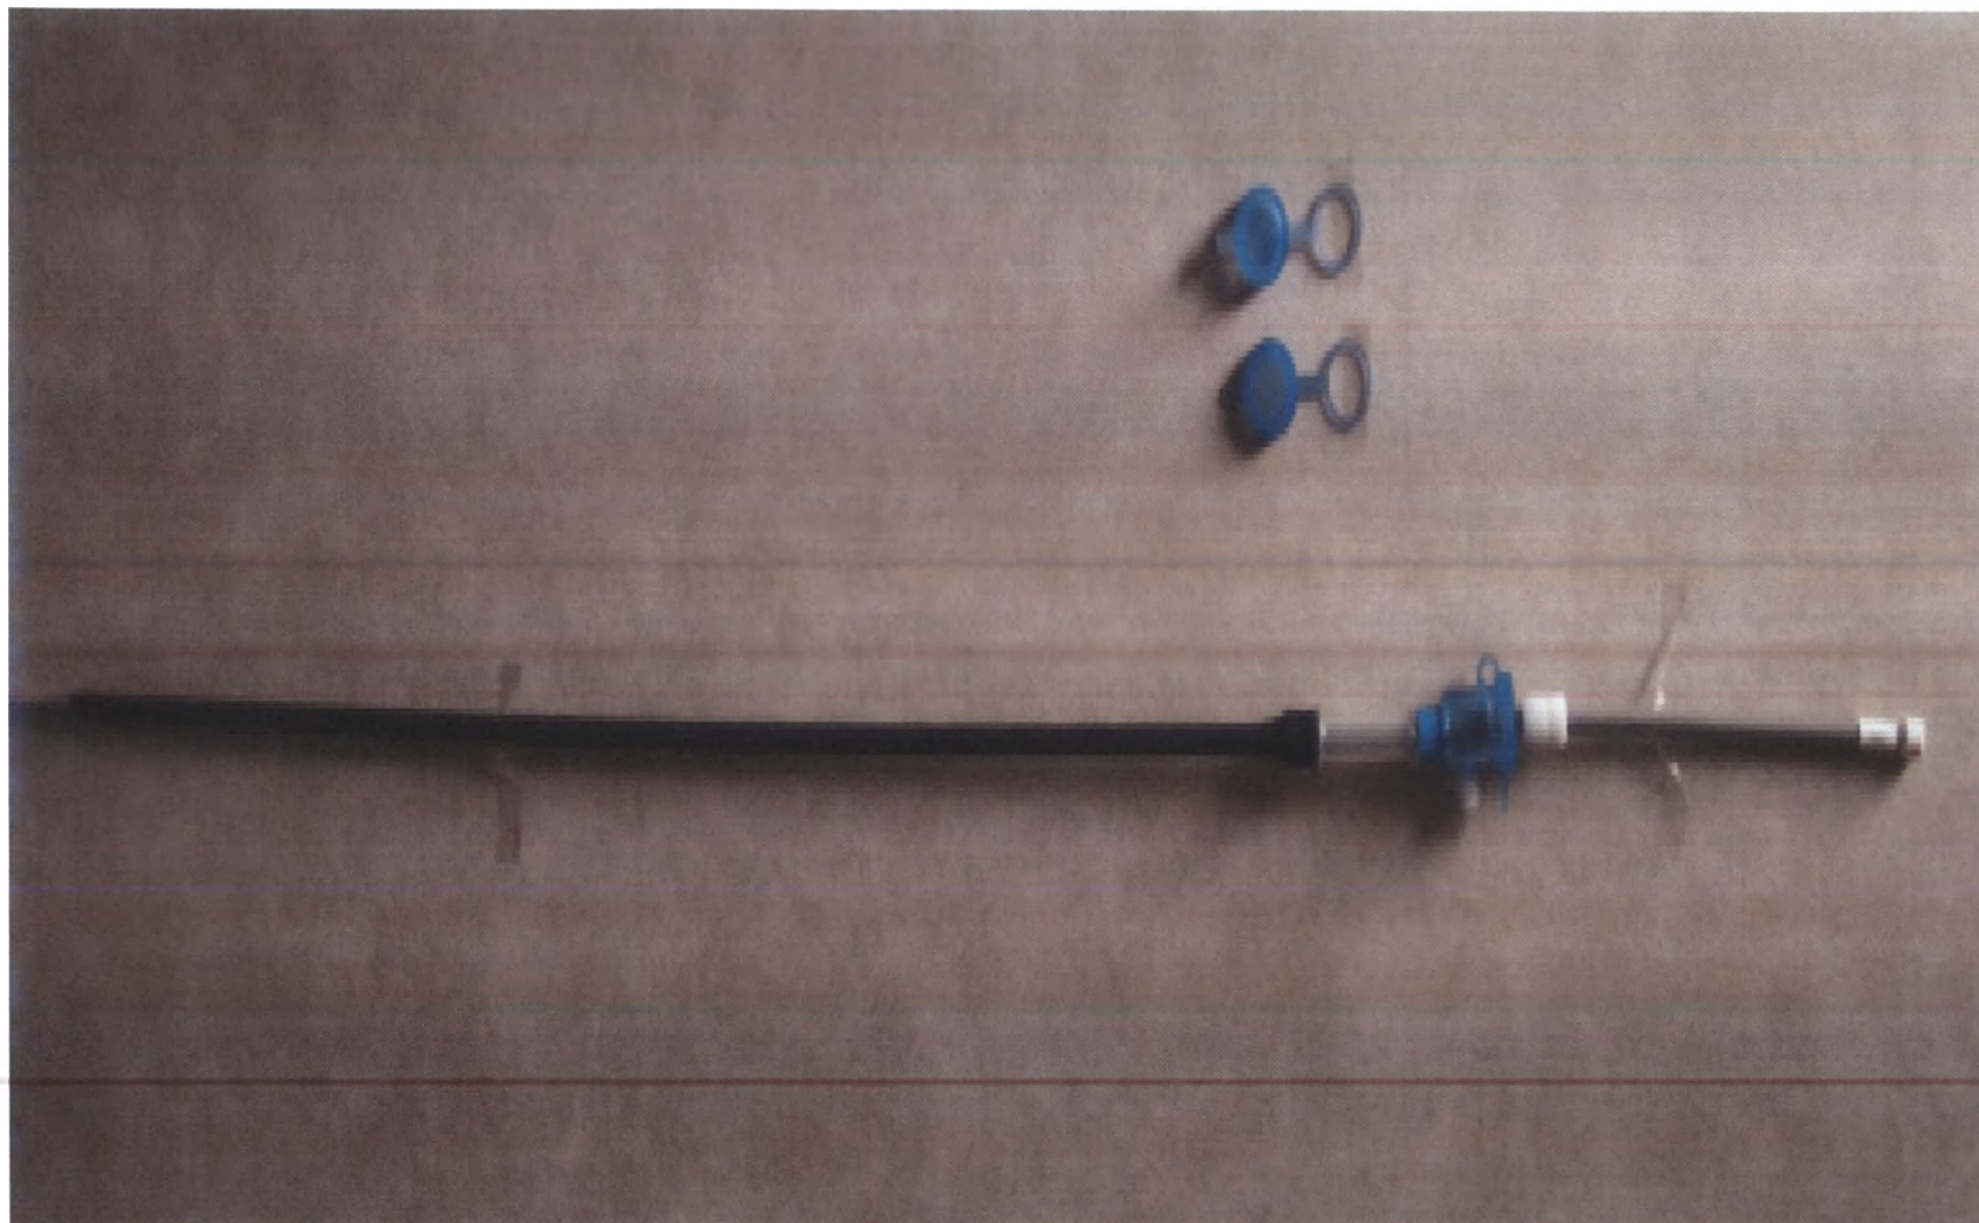

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC; KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC; KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC; KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL; KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC; KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC; KSAW-6.0-38-110-RB-SHTL-HC; KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL; KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC; KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC; KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC; KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL; KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL; KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC; KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC; KSAW-8.0-38-80-RB-SHTL-HC; KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC

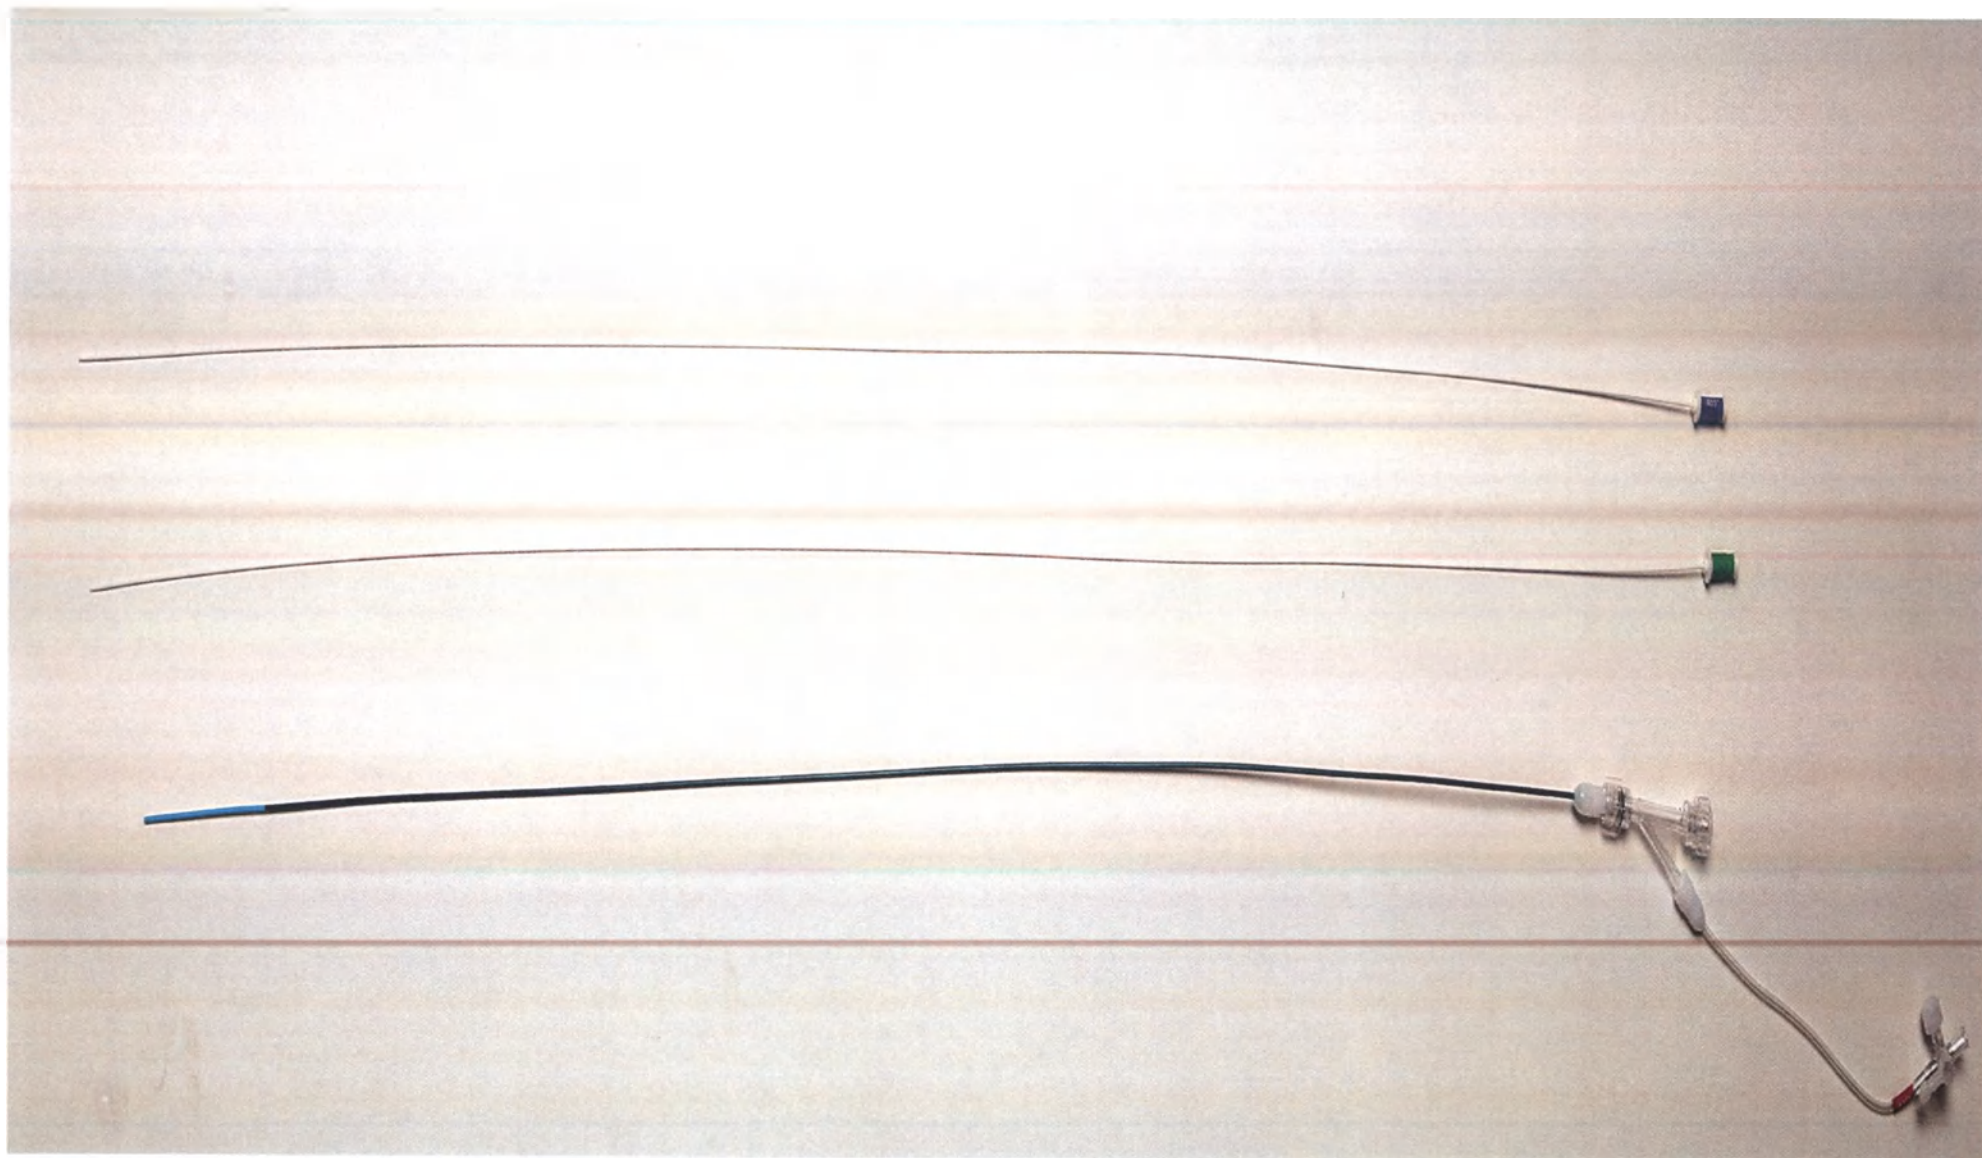

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCFW-10.0-38-63-RB-MTS; RCFW-10.0-38-75-RB-MTS; RCFW-10.0-38-85-RB-MTS; RCFW-11.0-38-63-RB-MTS; RCFW-11.0-38-75-RB-MTS; RCFW-11.0-38-85-RB-MTS; RCFW-12.0-38-63-RB-MTS; RCFW-12.0-38-75-RB-MTS; RCFW-12.0-38-85-RB-MTS; RCFW-13.0-38-63-RB-MTS; RCFW-13.0-38-75-RB-MTS; RCFW-13.0-38-85-RB-MTS; RCFW-14.0-38-63-RB-MTS; RCFW-14.0-38-75-RB-MTS; RCFW-14.0-38-85-RB-MTS; RCFW-4.0-35-63-RB-MTS; RCFW-5.0-32-48-RB-MTS; RCFW-5.0-35-63-RB-MTS; RCFW-5.0-35-75-RB-MTS; RCFW-6.0-32-48-RB-MTS; RCFW-6.0-35-75-RB-MTS; RCFW-6.0-38-48-RB-MTS; RCFW-6.0-38-63-RB-MTS; RCFW-6.0-38-75-RB-MTS; RCFW-6.0-38-85-RB-MTS; RCFW-7.0-38-48-RB-MTS; RCFW-7.0-38-63-RB-MTS; RCFW-7.0-38-75-RB-MTS; RCFW-7.0-38-85-RB-MTS; RCFW-8.0-38-63-RB-MTS; RCFW-8.0-38-75-RB-MTS; RCFW-8.0-38-85-RB-MTS; RCFW-9.0-38-63-RB-MTS; RCFW-9.0-38-75-RB-MTS; RCFW-9.0-38-85-RB-MTS; RCFW-16.0P-38-75-RB-MTS; RCFW-16.0P-38-85-RB-MTS

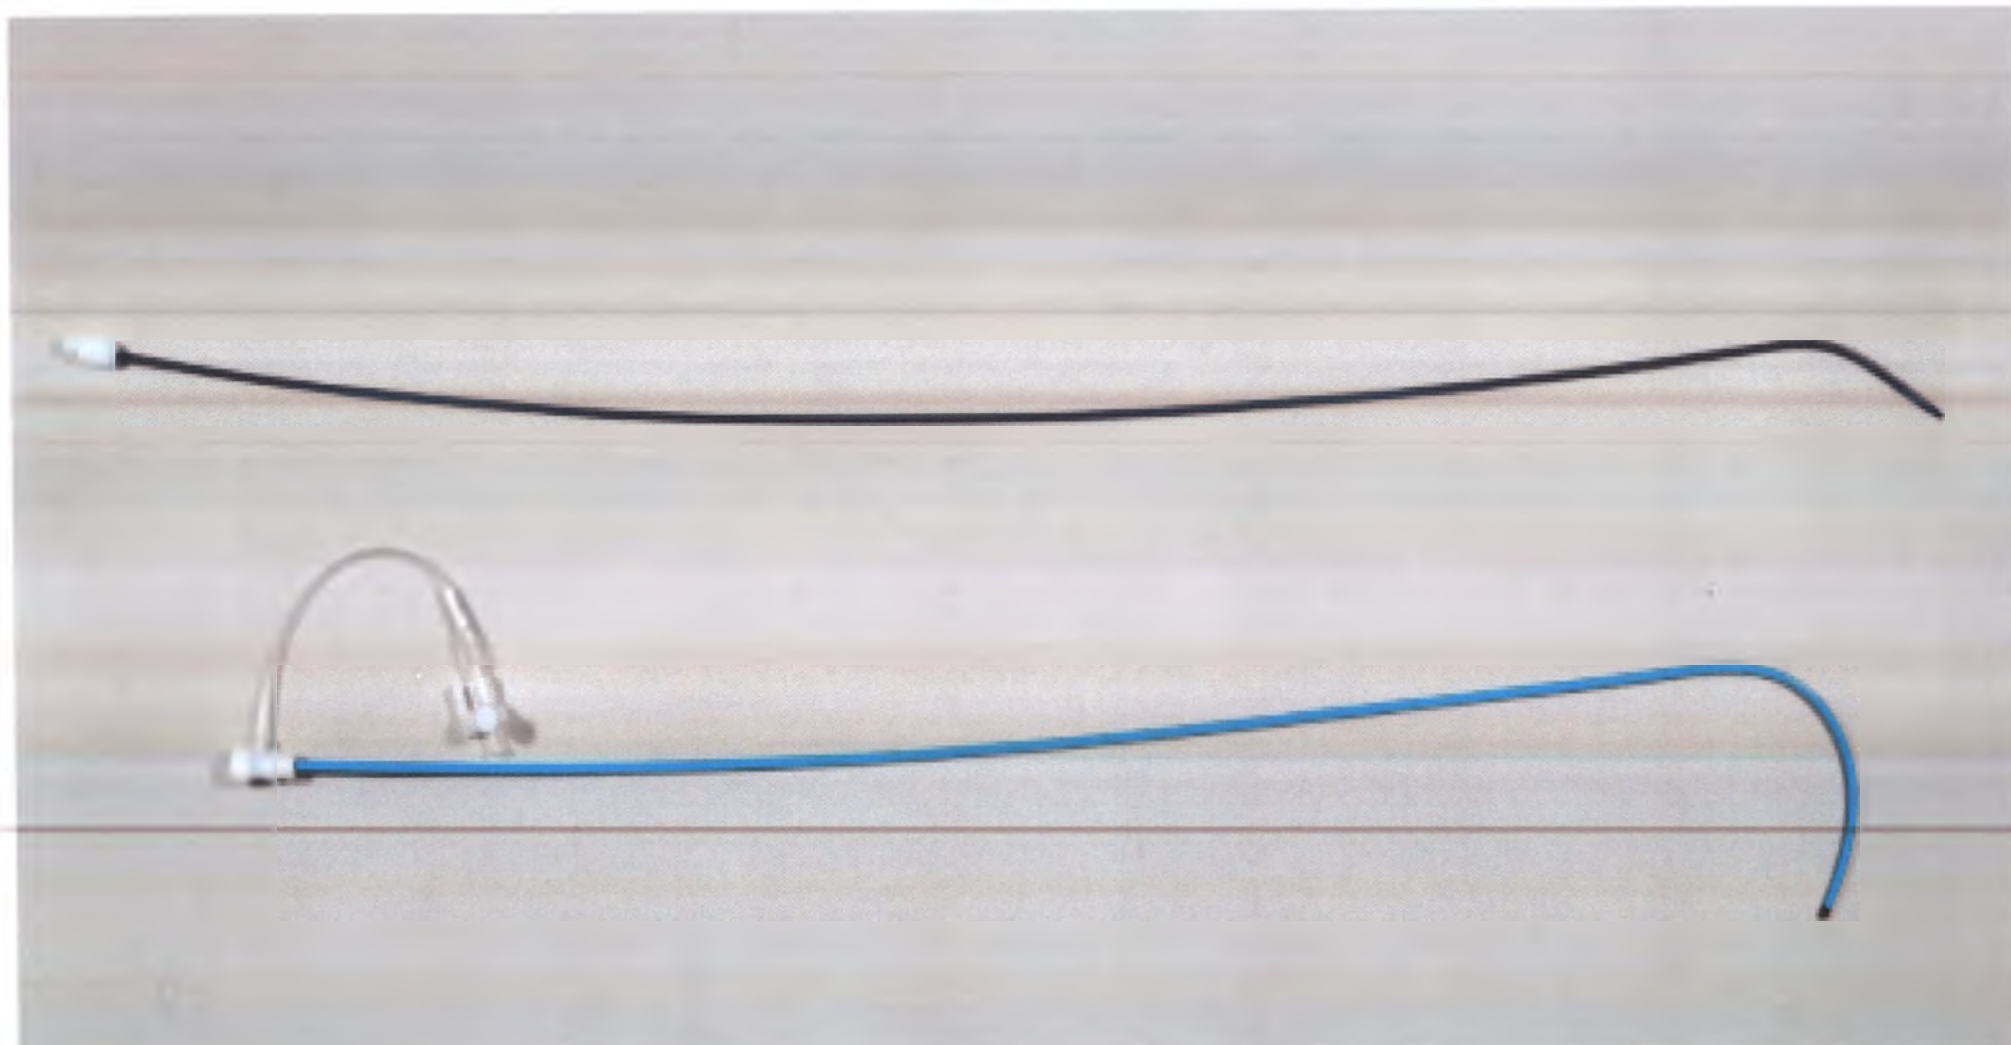

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCFW-10.0-38-75-RB-HLA-091100; RCFW-11.0-38-75-RB-HLA-091100; RCFW-11.0-38-80-RB-HLA-091100; RCFW-12.0-38-75-RB-HLA-091100; RCFW-7.0-38-75-RB-HLA-091100-BV

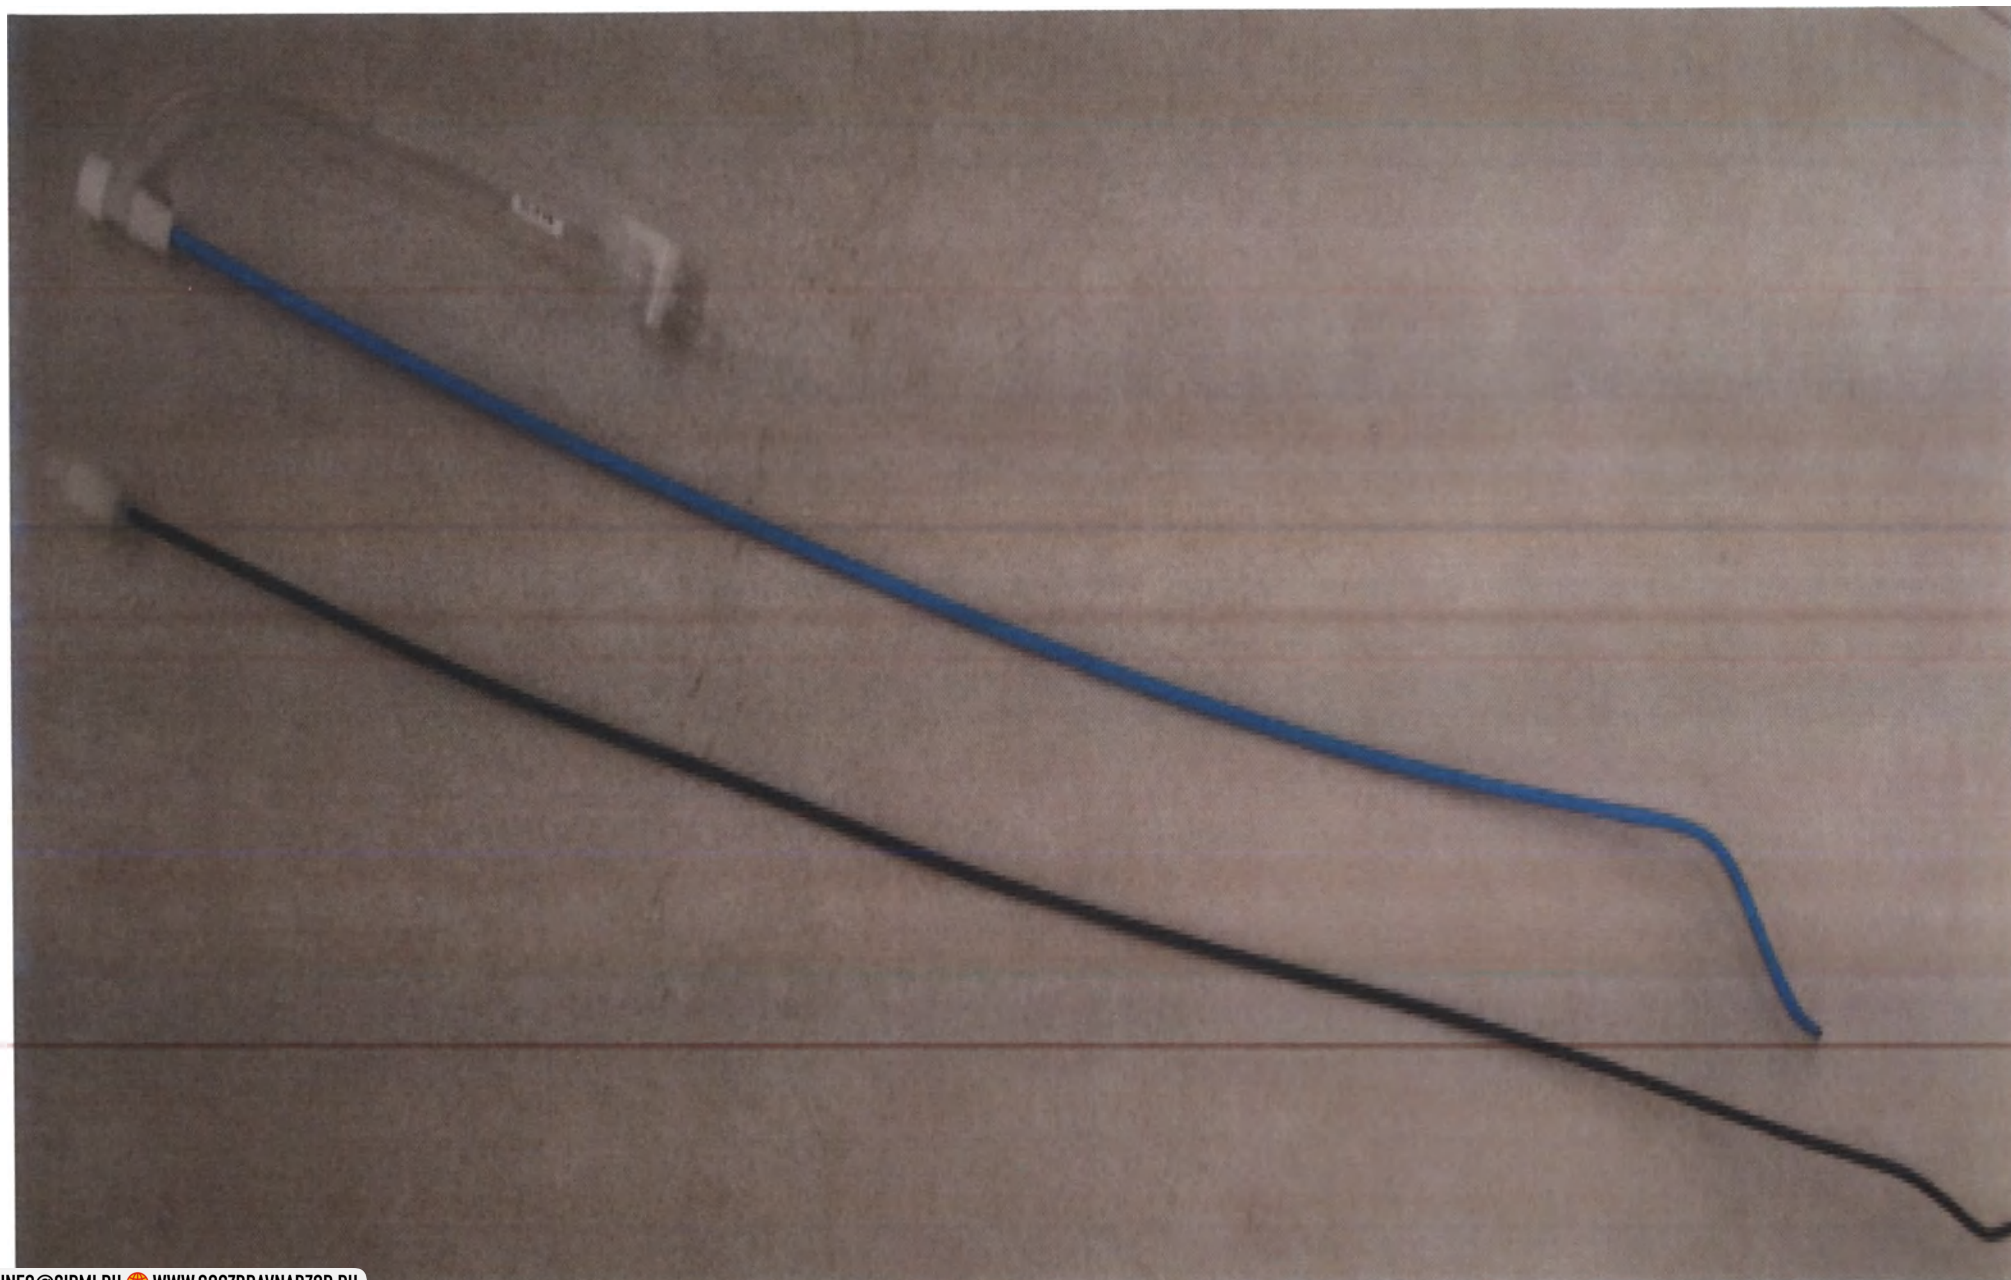

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах
Вариант исполнения: RCFN-5.0-35-J

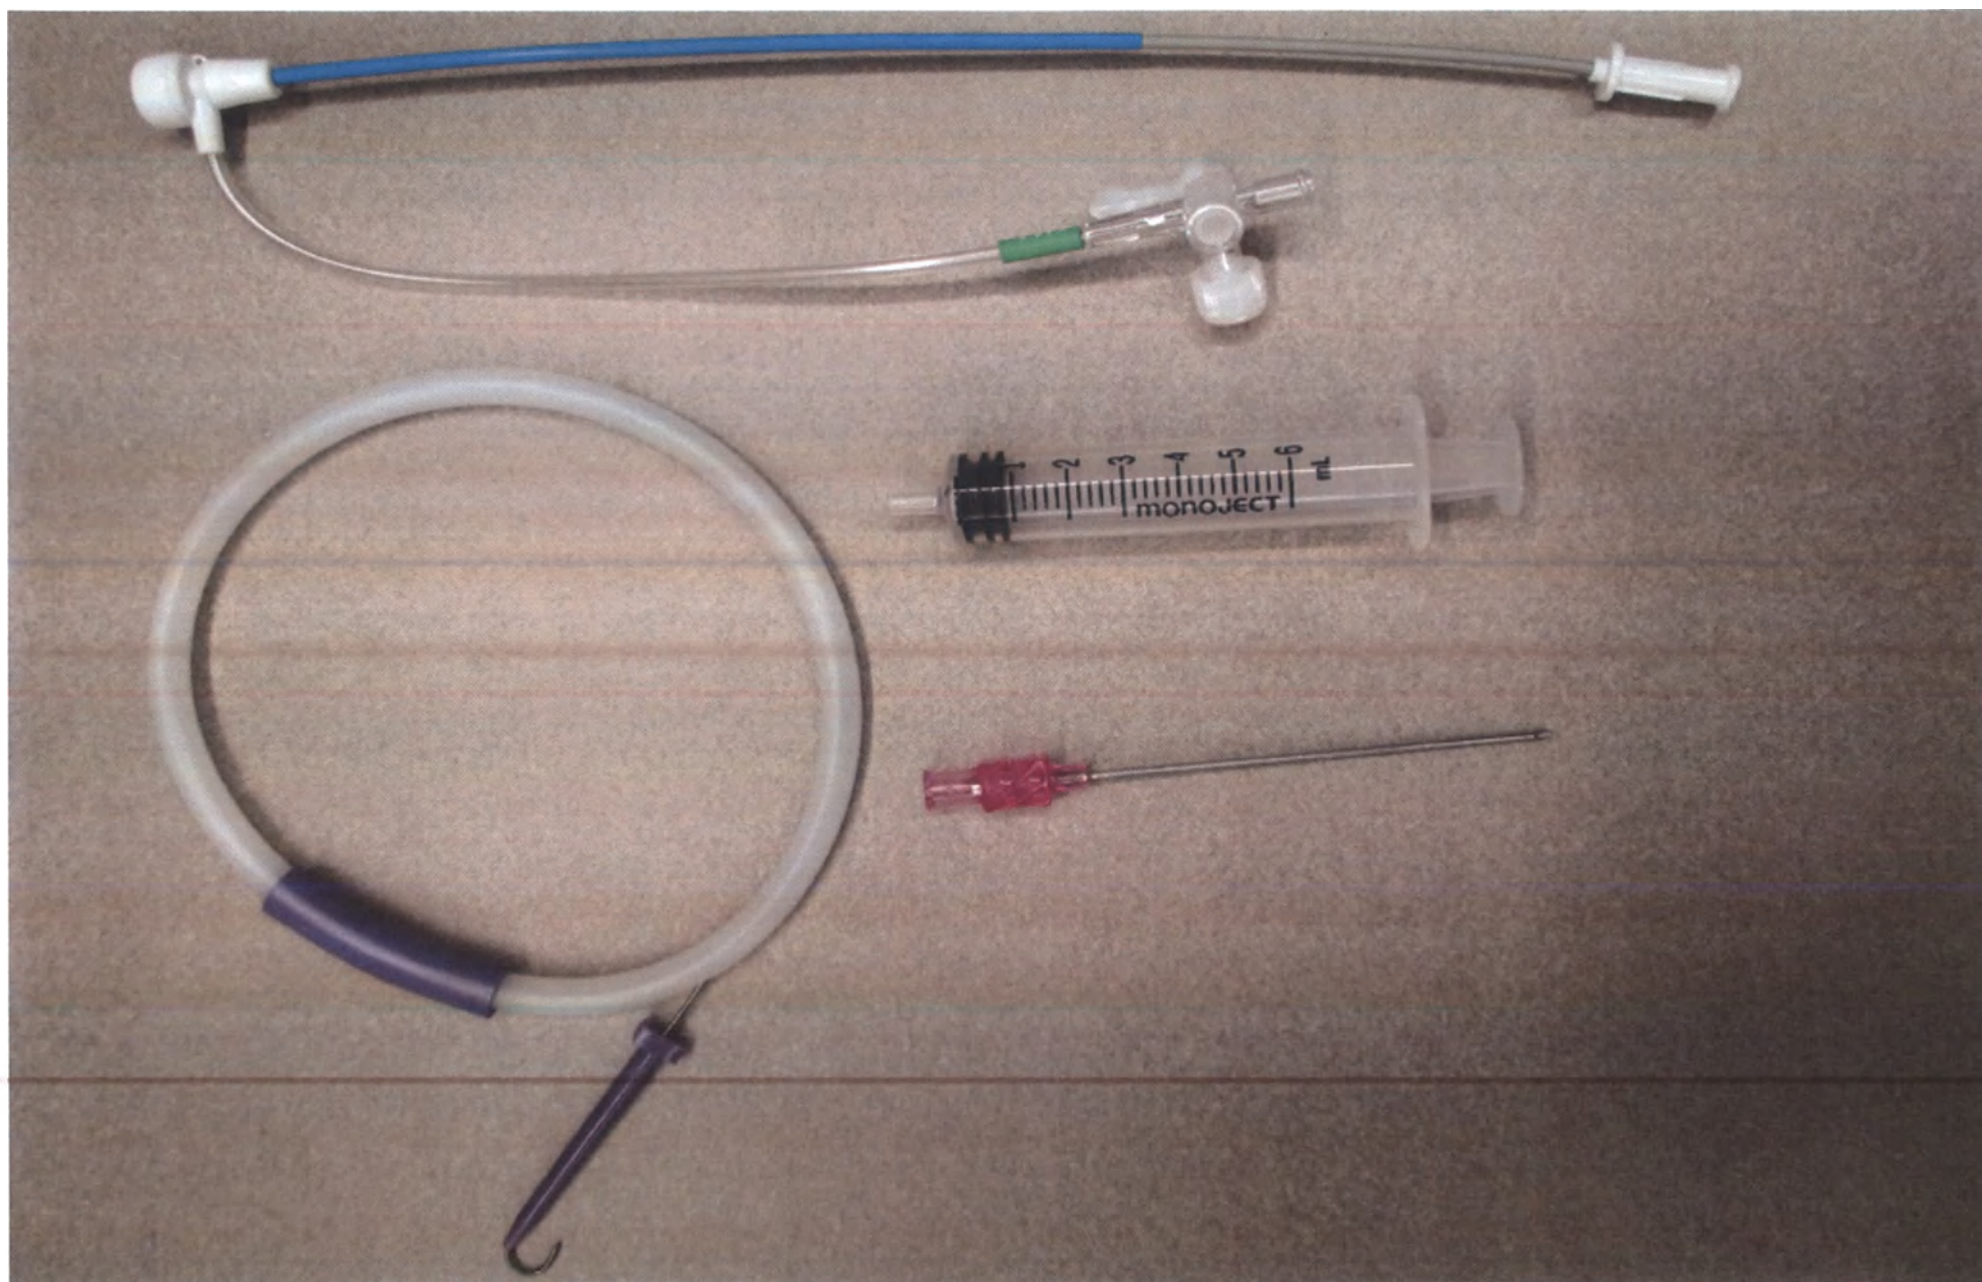

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах

Вариант исполнения: RCF-10.0-38-J; RCF-12.0-38-J; RCF-14.0-38-J; RCF-16.0-38-J; RCF-18.0P-38-J; RCF-5.0-35-45-J; RCF-5.0-35-J; RCF-5.0-38-J; RCF-6.0-35-J; RCF-6.0-38-J; RCF-7.0-38-J; RCF-8.0-38-J; RCF-9.0-38-J

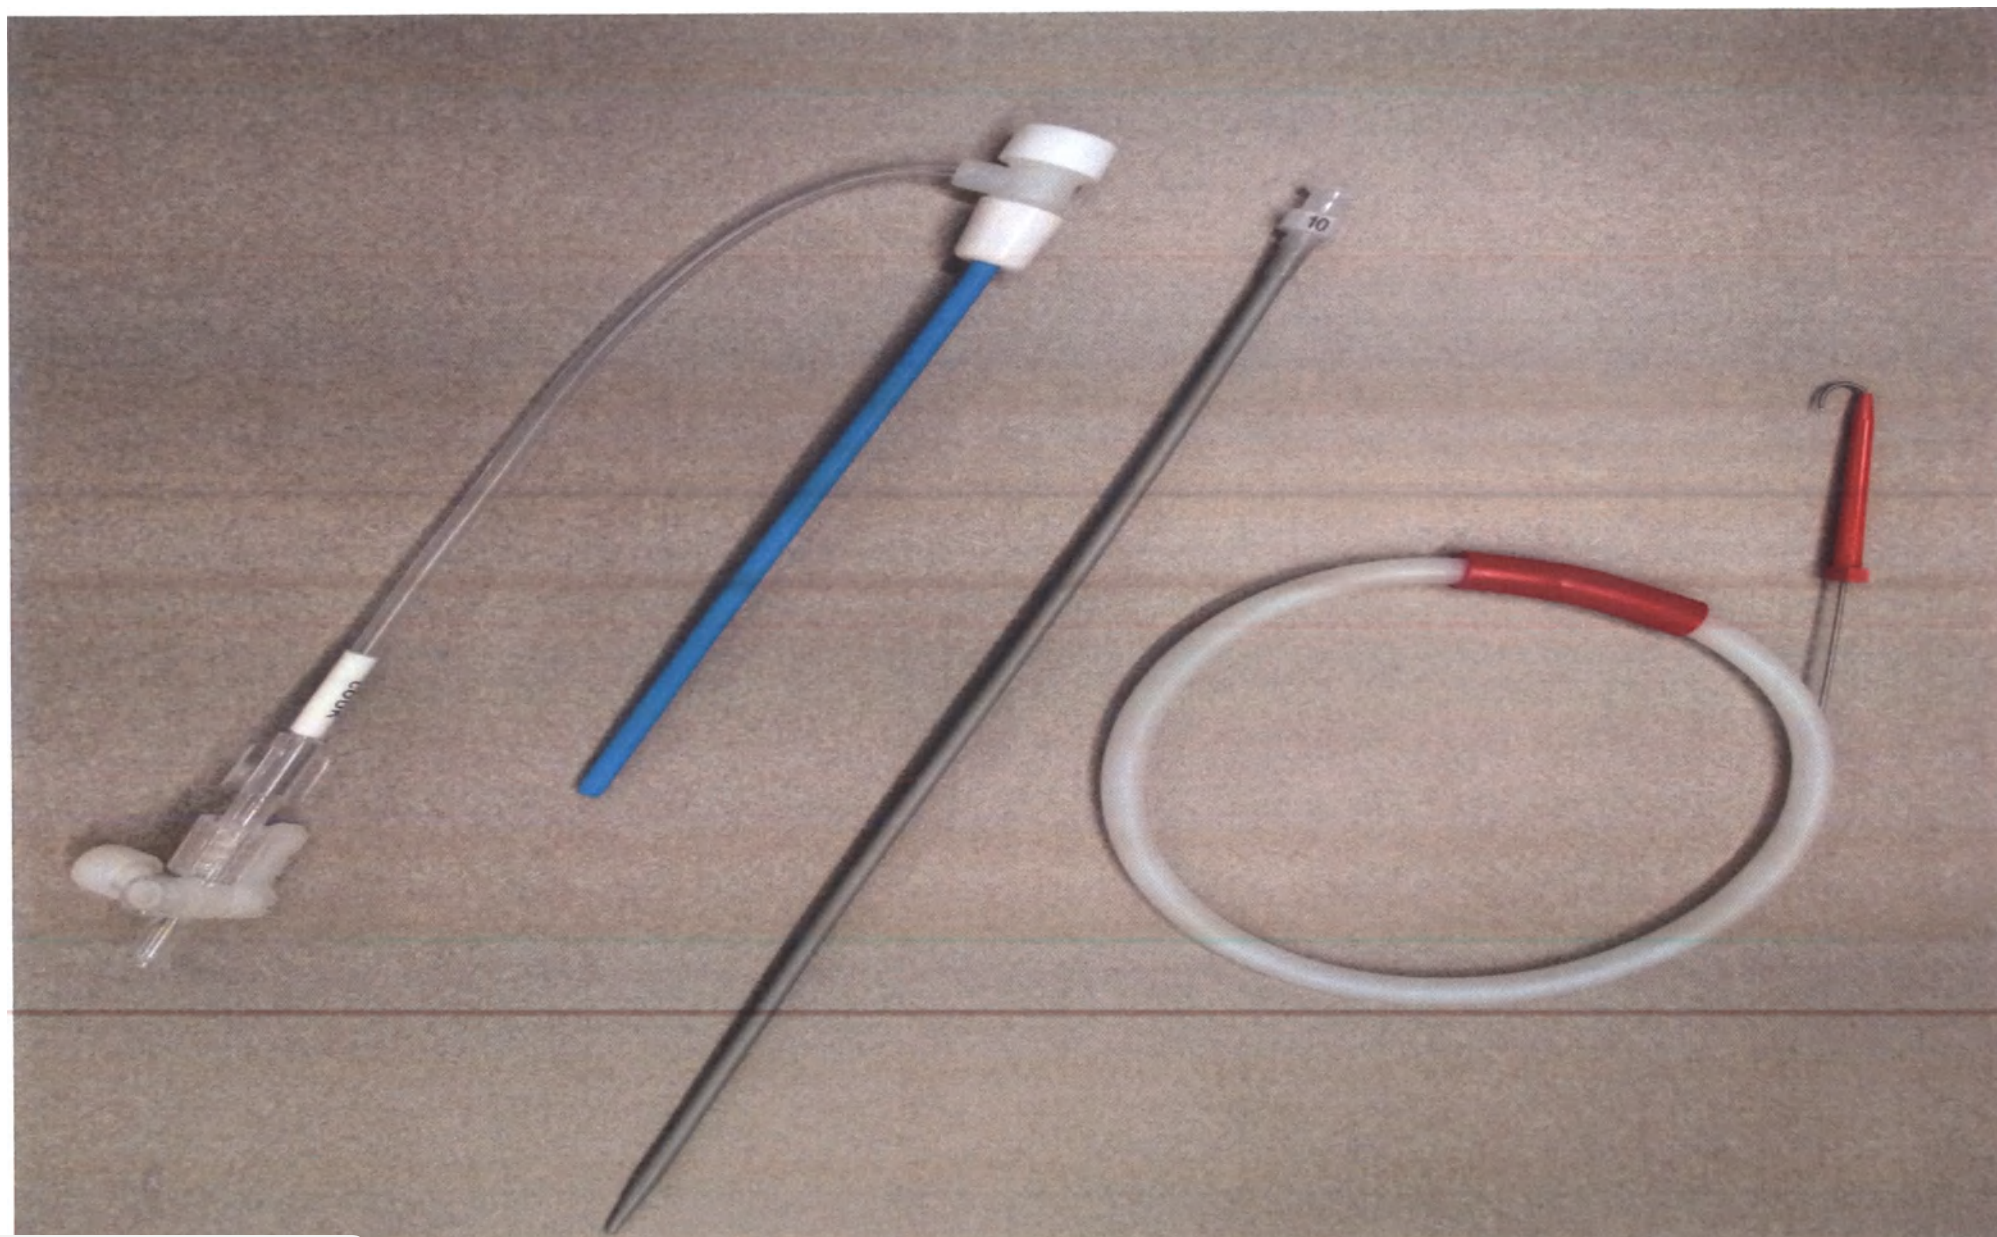

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Интродьюсеры эндоваскулярные в наборах


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

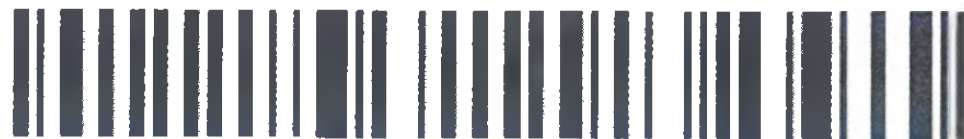



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3.9 листов
Генеральный директор

С.Н.Курин