



Фотографическое изображение на медицинское изделие «САЛГОН Диагностикумы
сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА, суспензия для диагностических целей
по ТУ 9388-020-01895016-07»





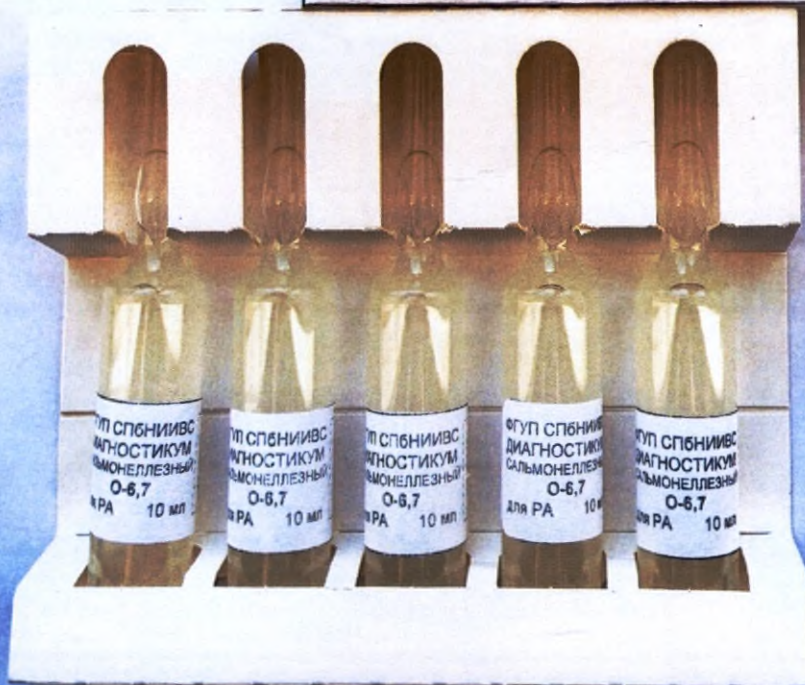

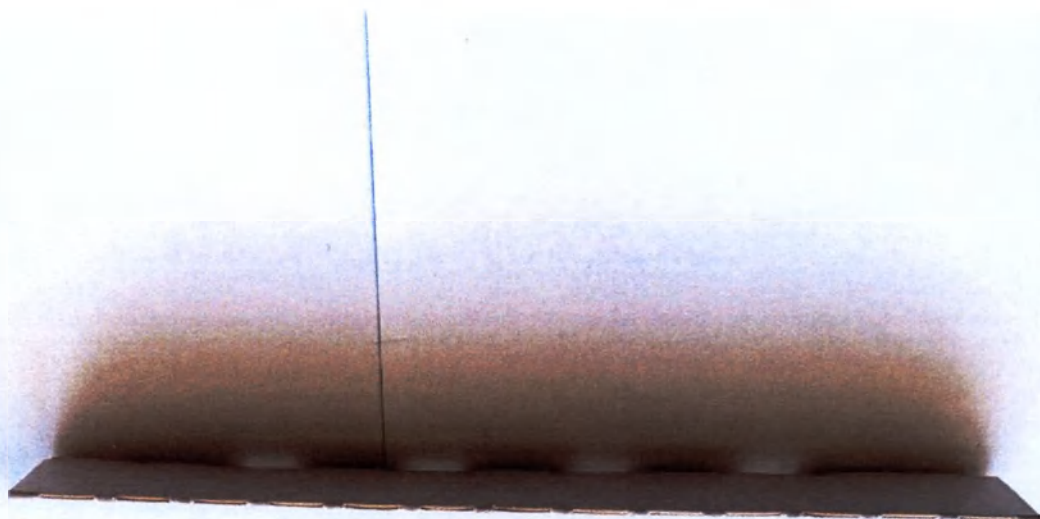



Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцины и сыворотки и предприятие по производству бактериальных препаратов»

Федерального медико-биологического агентства

198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52,

тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivs.ru



ТУ 9388-020-01895016-07

Рег. № ФСР 2007/00235

от

Хранить при температуре от 4 до 10°C

Штрих-код

САЛГОН


Диагностikum сальмонеллезный Vi
для РА, суспензия для диагностических целей





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
САЛГОН
диагностикумов сальмонеллезной
суспензии для диагностических целей



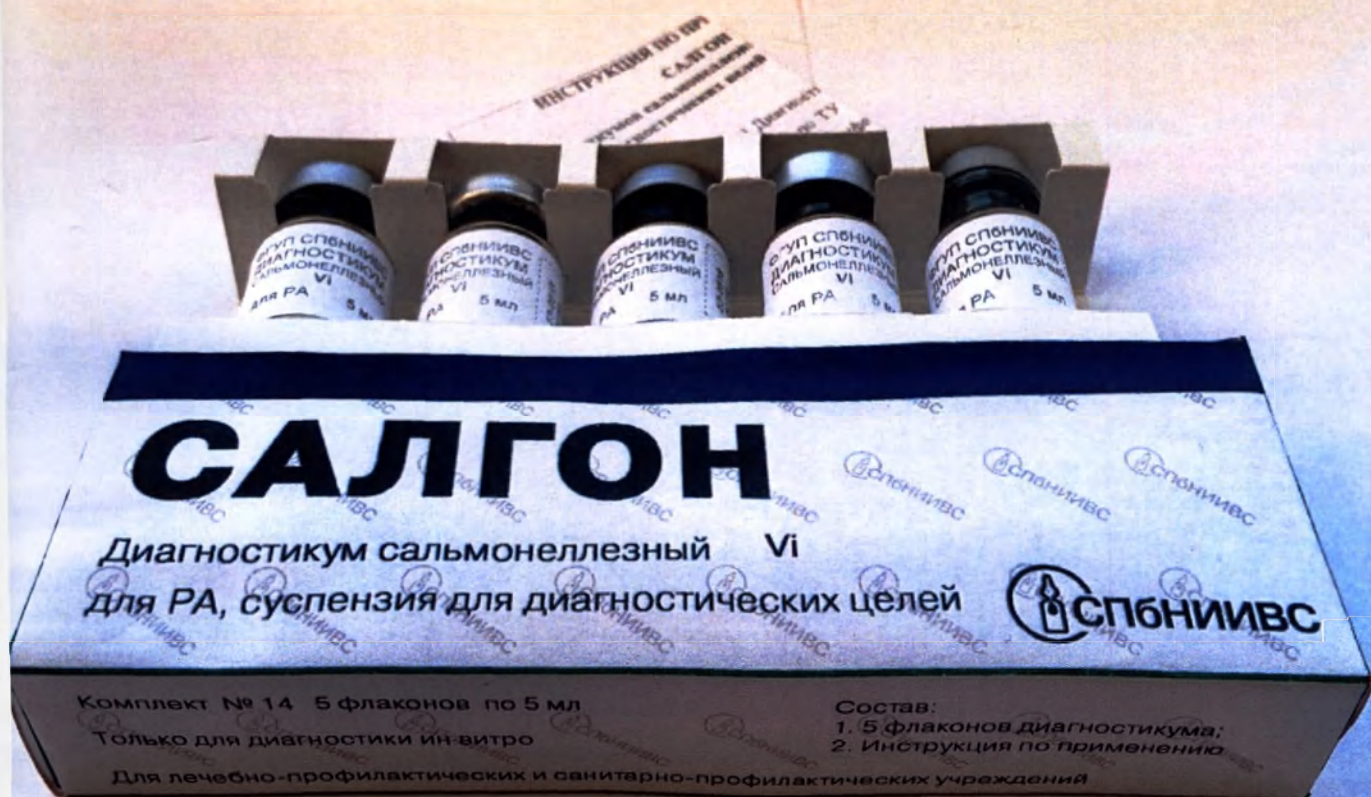

Директор

ФГУП СПБНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин

Стр. 8



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____
листа(-ов)

Должность, ФИО заведующий
сектором МИ ОРЛ ДИР
Ионинакова И.В.

МП 2022г.



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет первичной упаковки – клише или этикетка на ампулу или флакон

Клише на ампулу (флакон)



ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЙ

для РА ... мл
С** ДАТА ИЗГОТ.***
ГОДЕН ДО

ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЙ

для РА ... мл
С** ДАТА ИЗГОТ.***
ГОДЕН ДО

Этикетка



Место
нанесения
номера серии
(четыре
последние
цифры номера
серии -дата
изготовления)
и срока
годности

* - указывается рецептор

** - серия

*** ДАТА ИЗГОТ. – четыре последние цифры номера серии

Директор

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 1

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 2

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 3

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

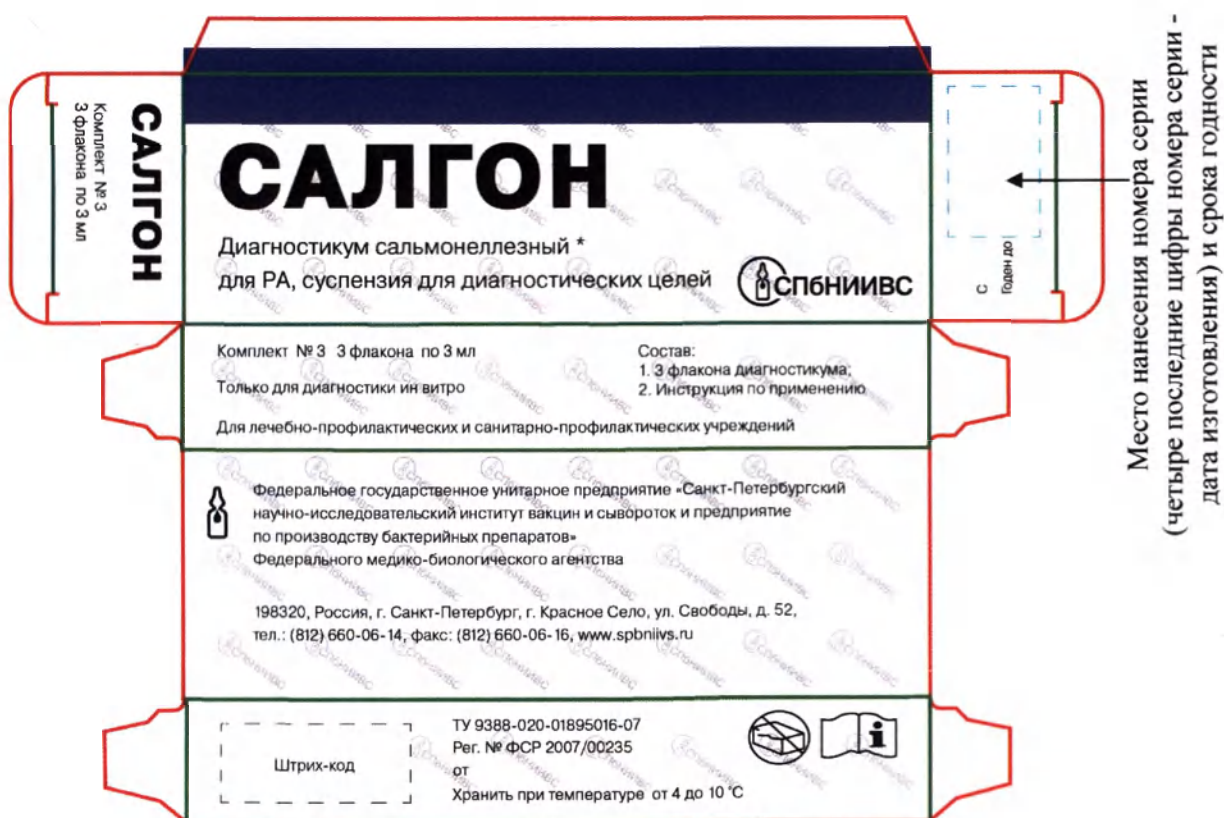

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 4

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячеистой упаковке.

Комплект № 5

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.


Комплект № 6

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

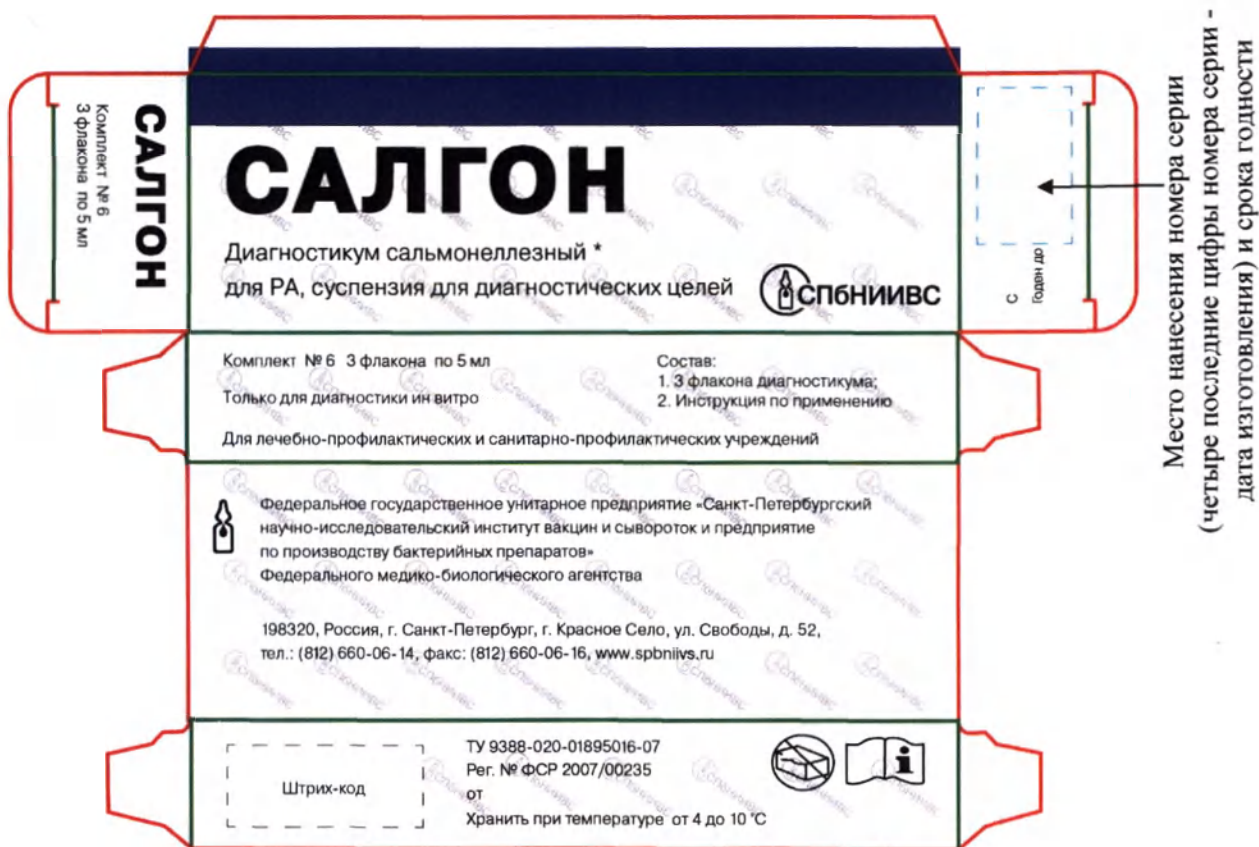

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

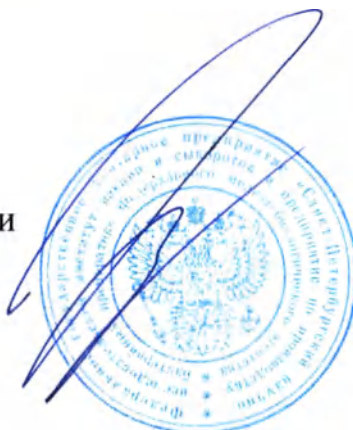

В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 7

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 8

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

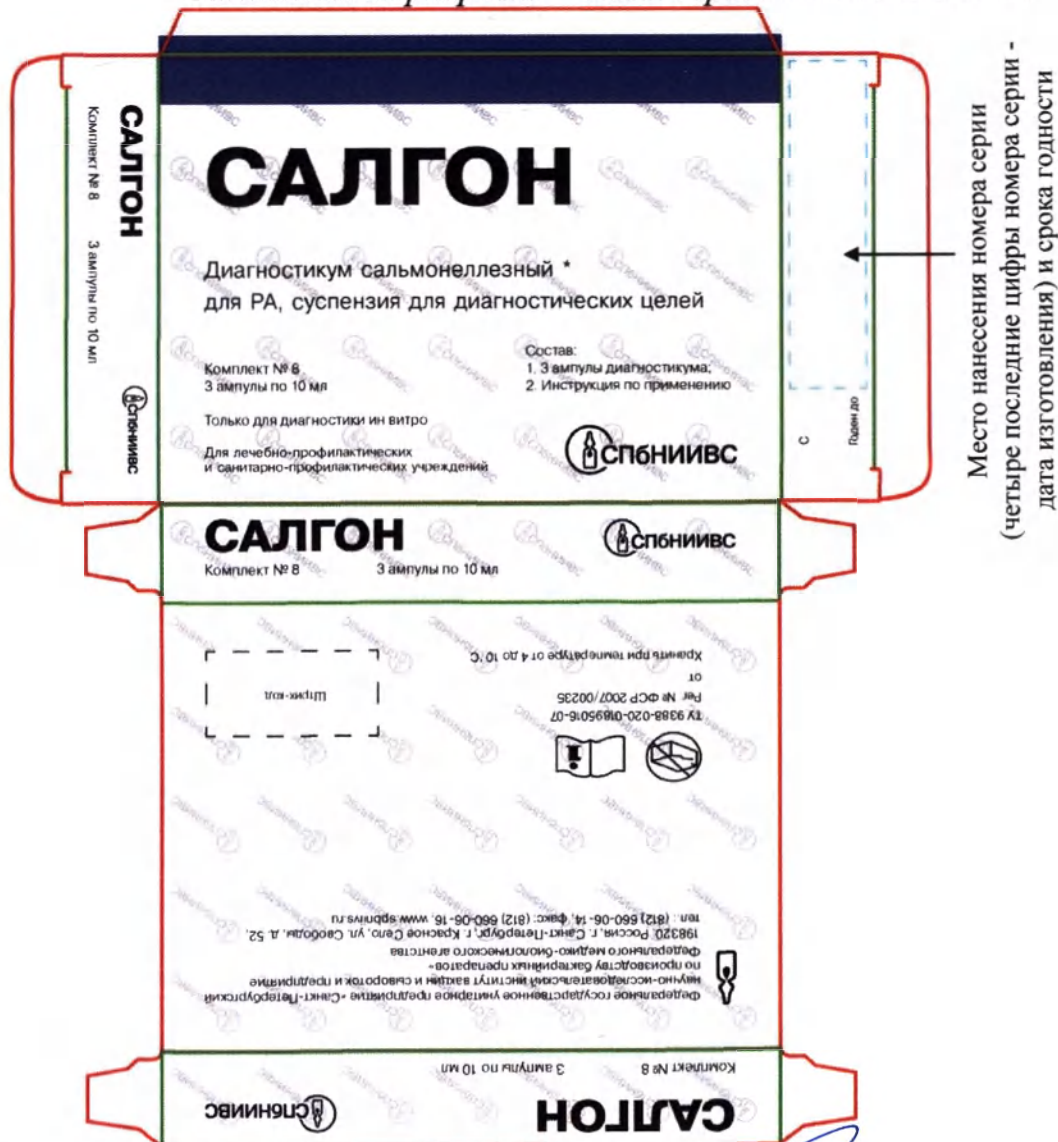

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 9

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

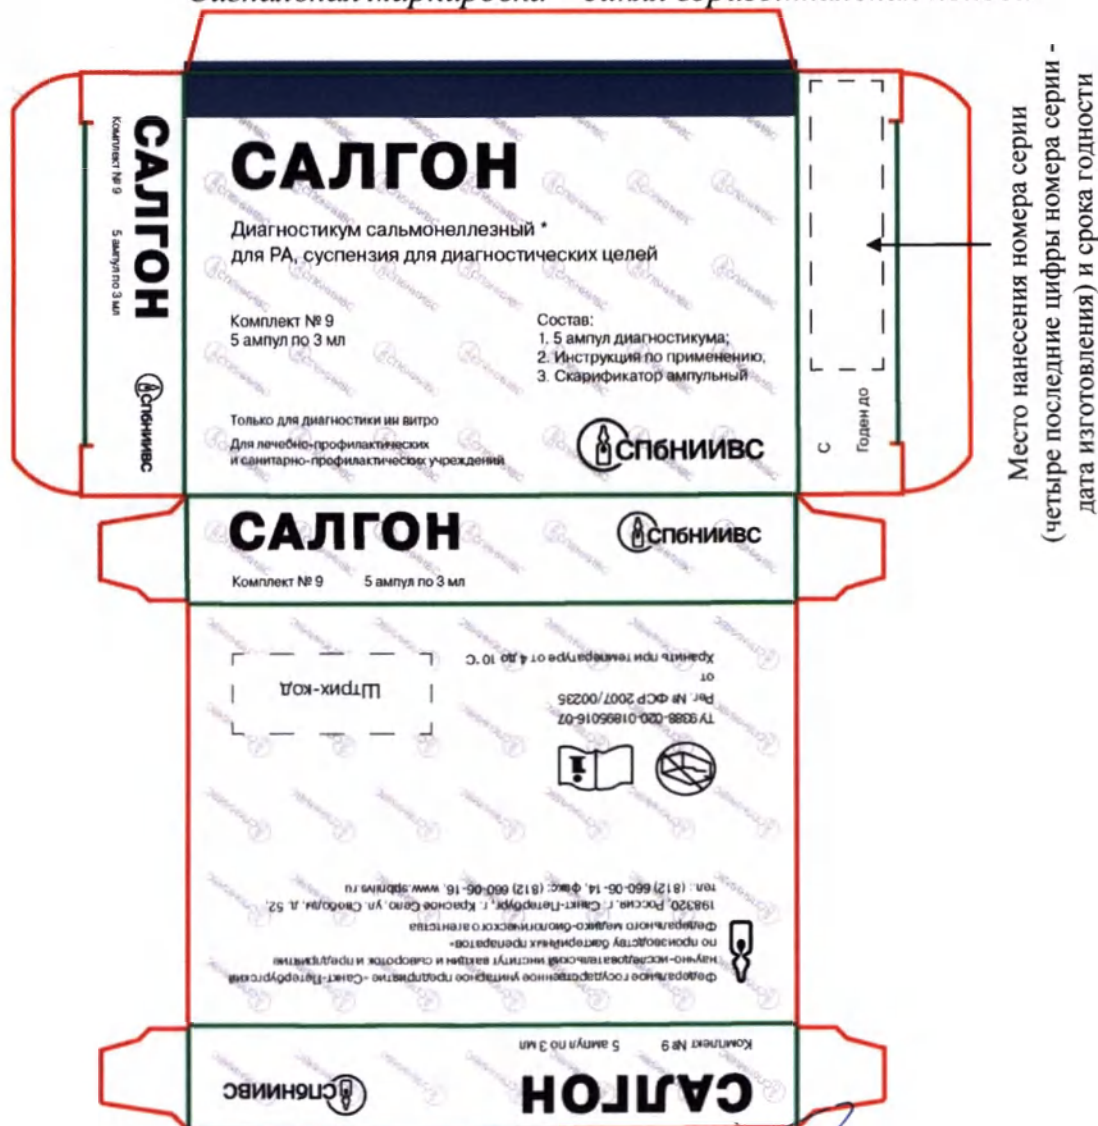

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 10

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

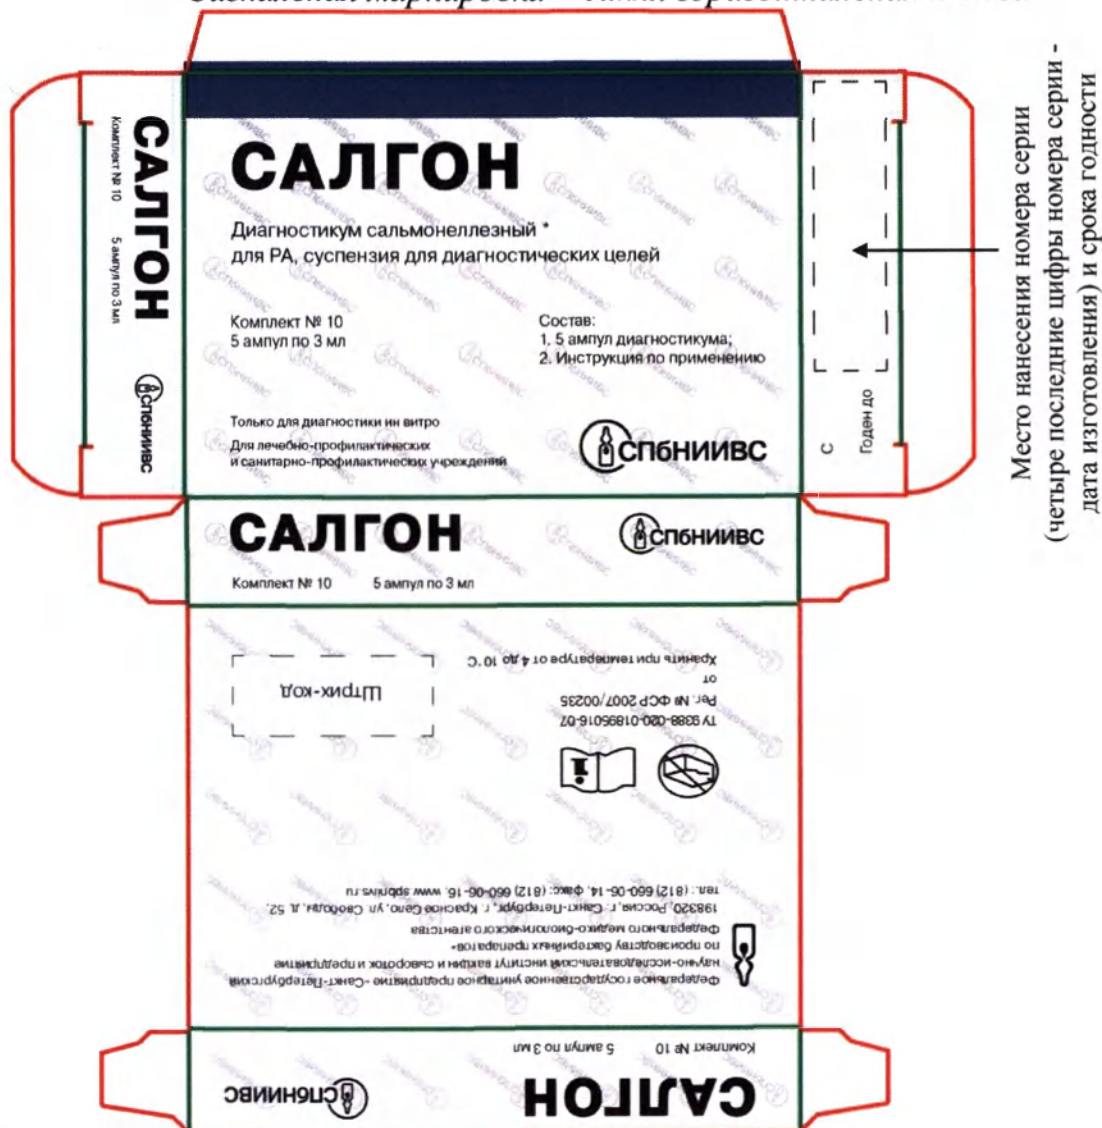

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 11

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

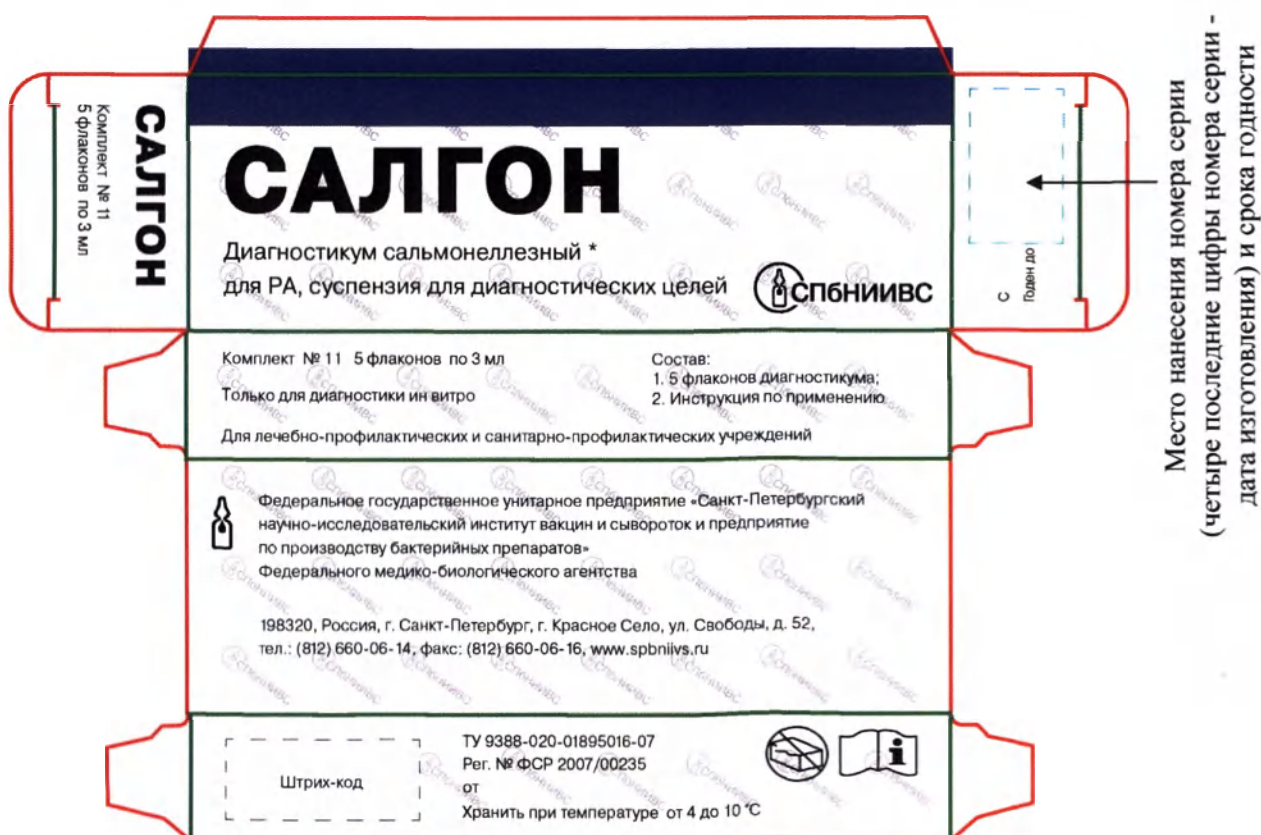

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 12

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 13

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

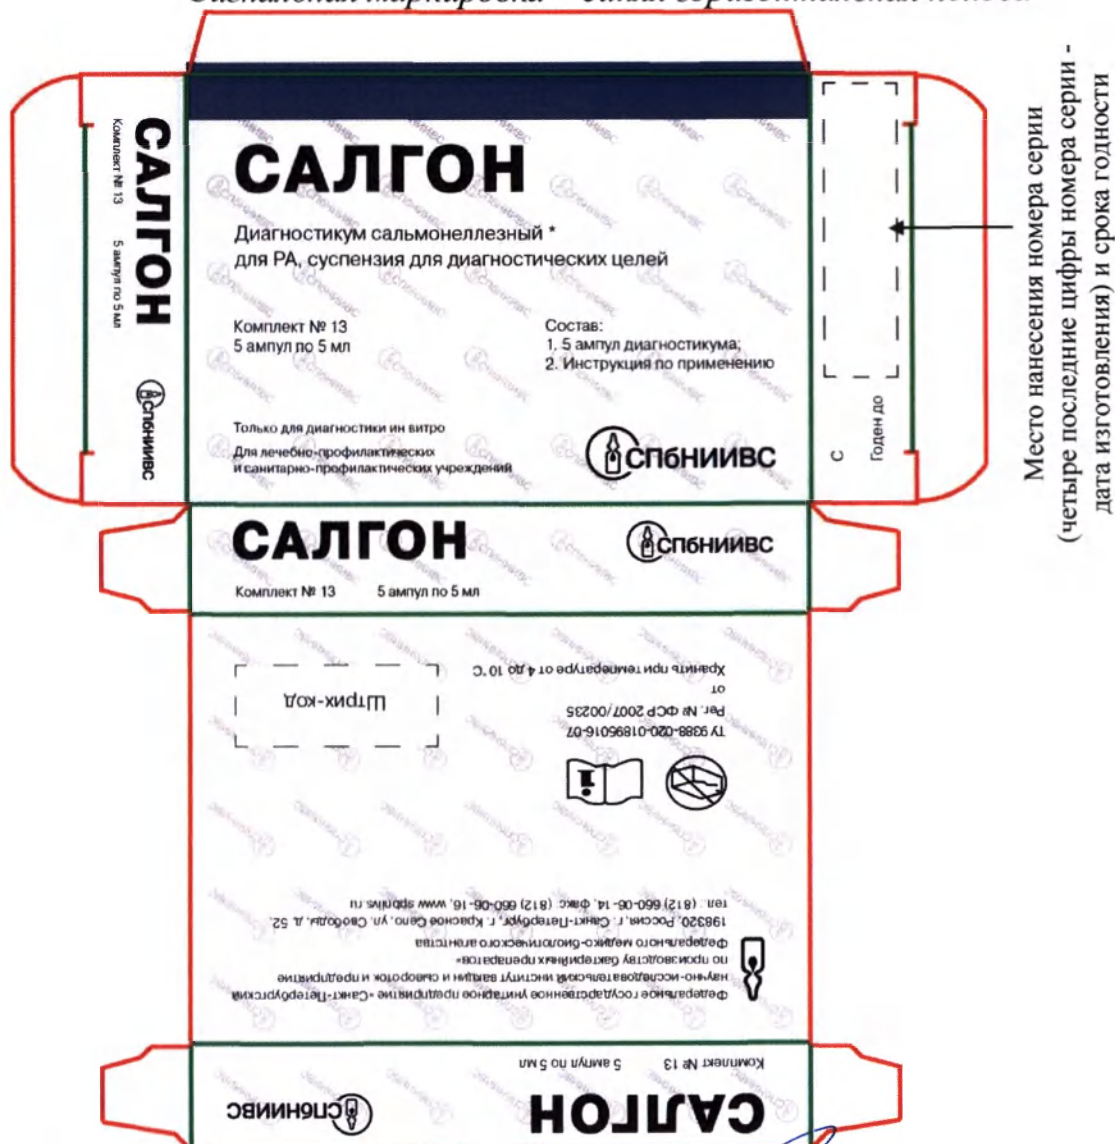

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 14

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

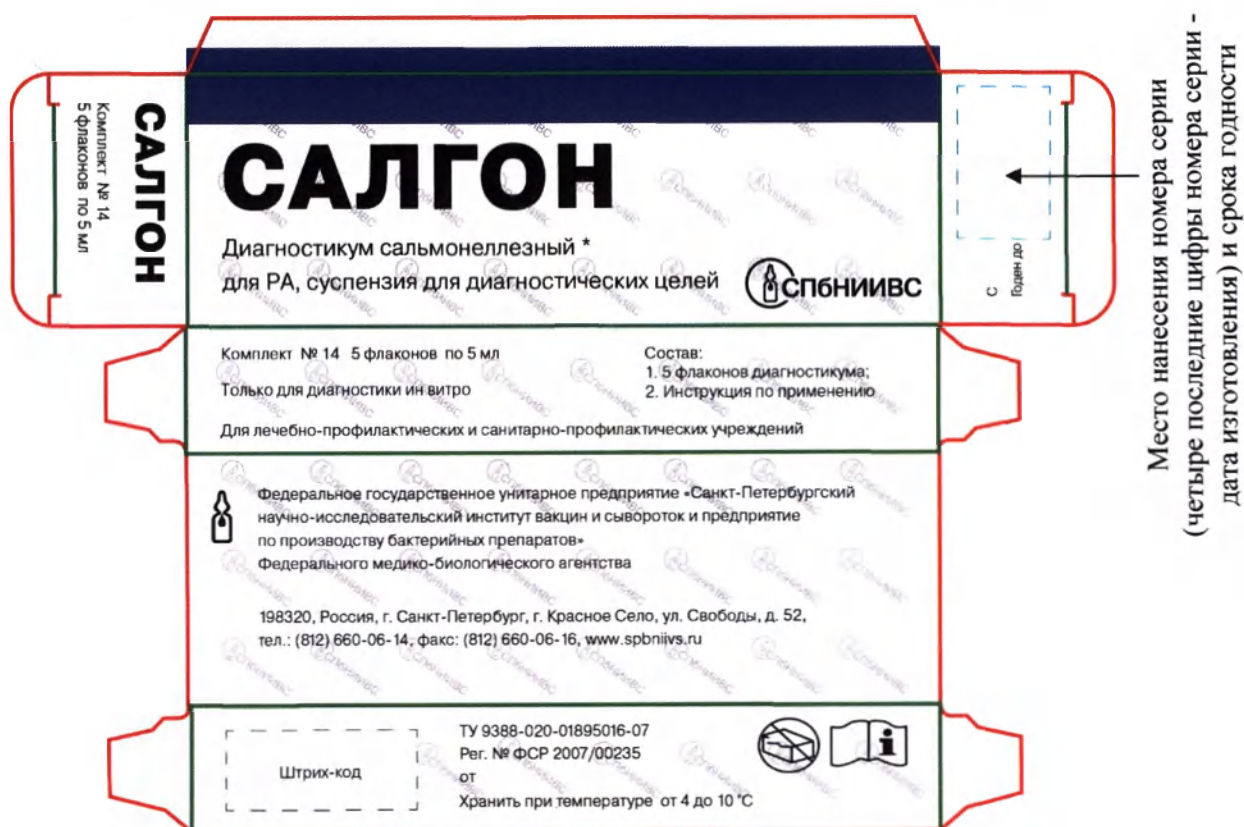

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 15


Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин

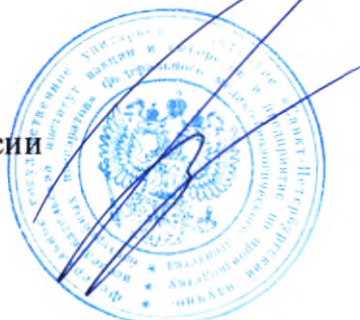


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 16

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

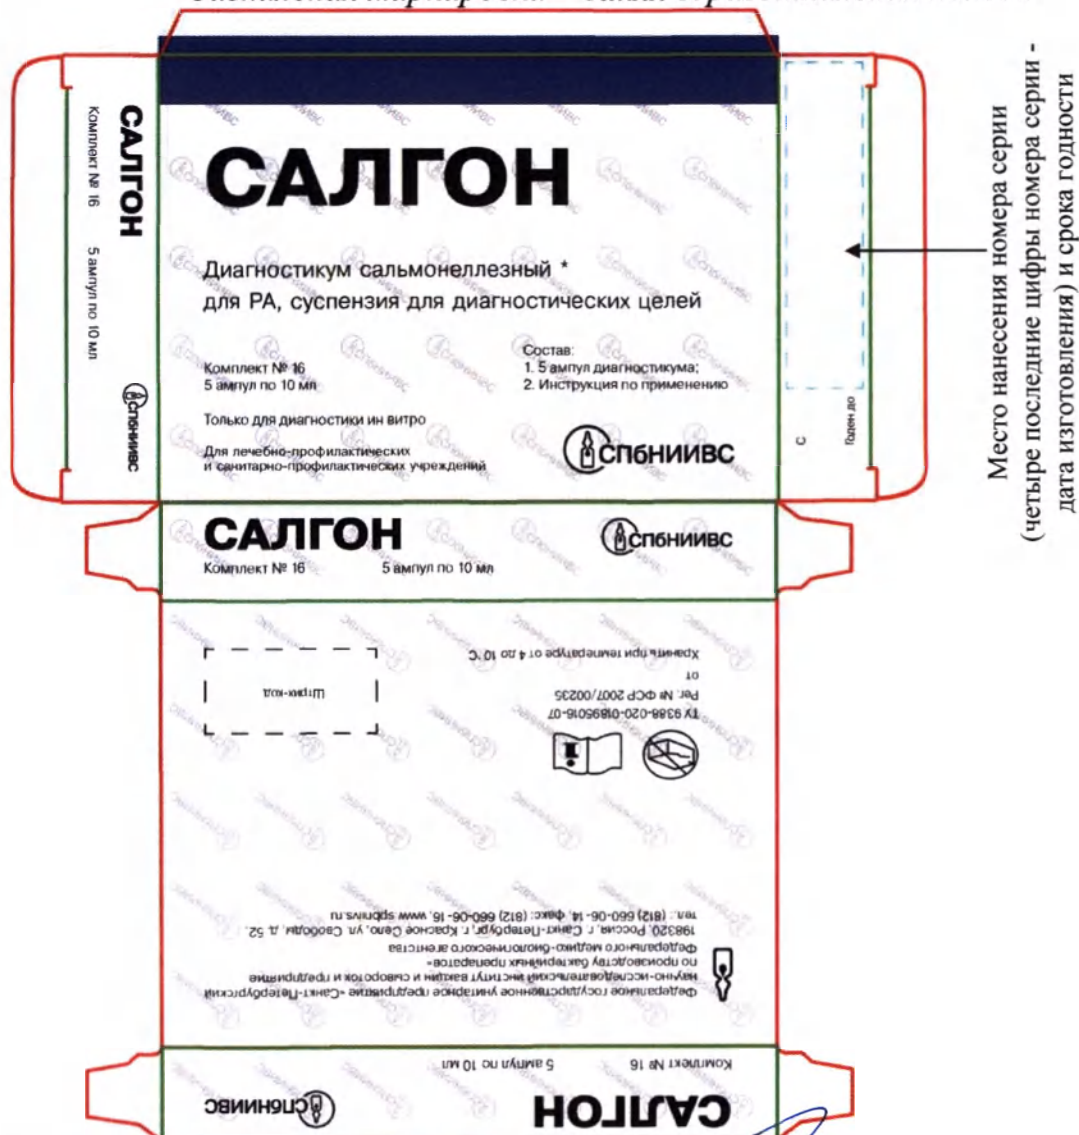

Место нанесения номера серии -
(четыре последние цифры номера серии -
дата изготовления) и срока годности

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 17

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

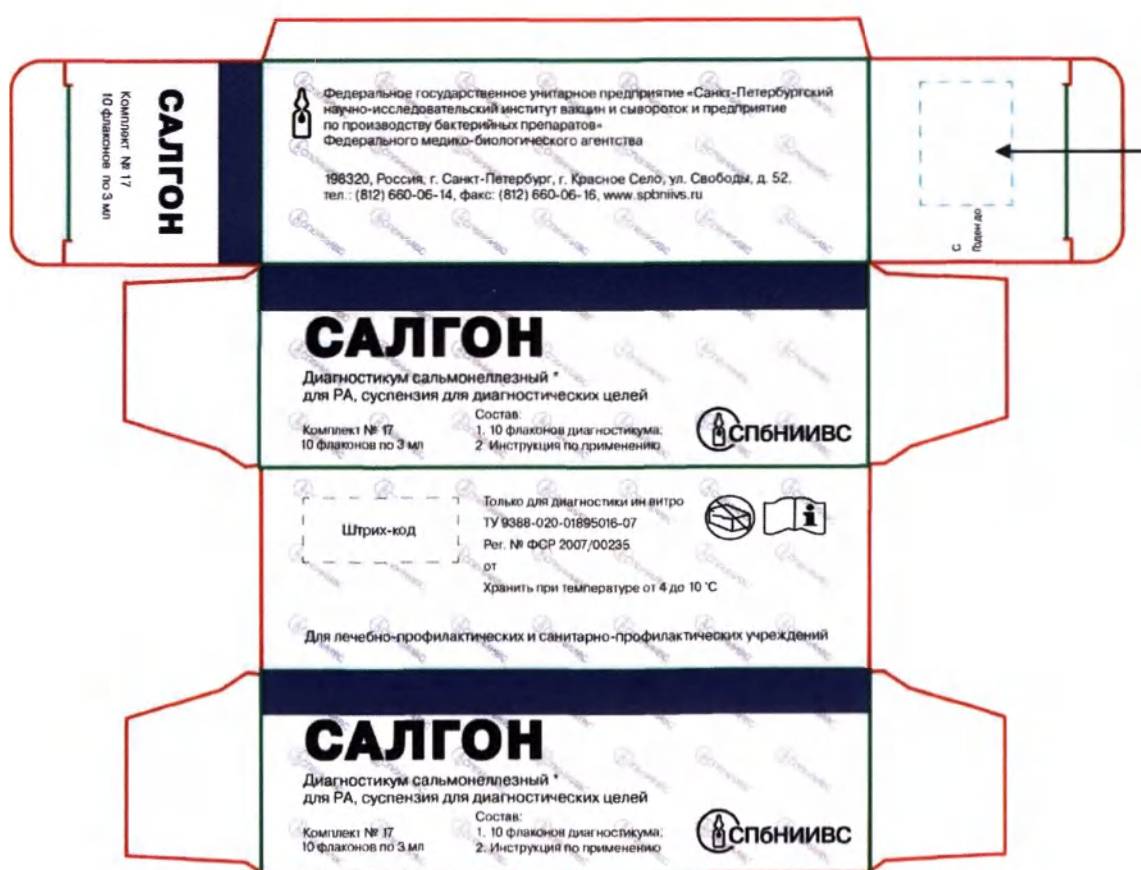

Место нанесения номера серии
(четыре последние цифры номера серии -
дата изготовления) и срока годности

* - указывается рецептор

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия**

**САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07**

**Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.**

Комплект № 18

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

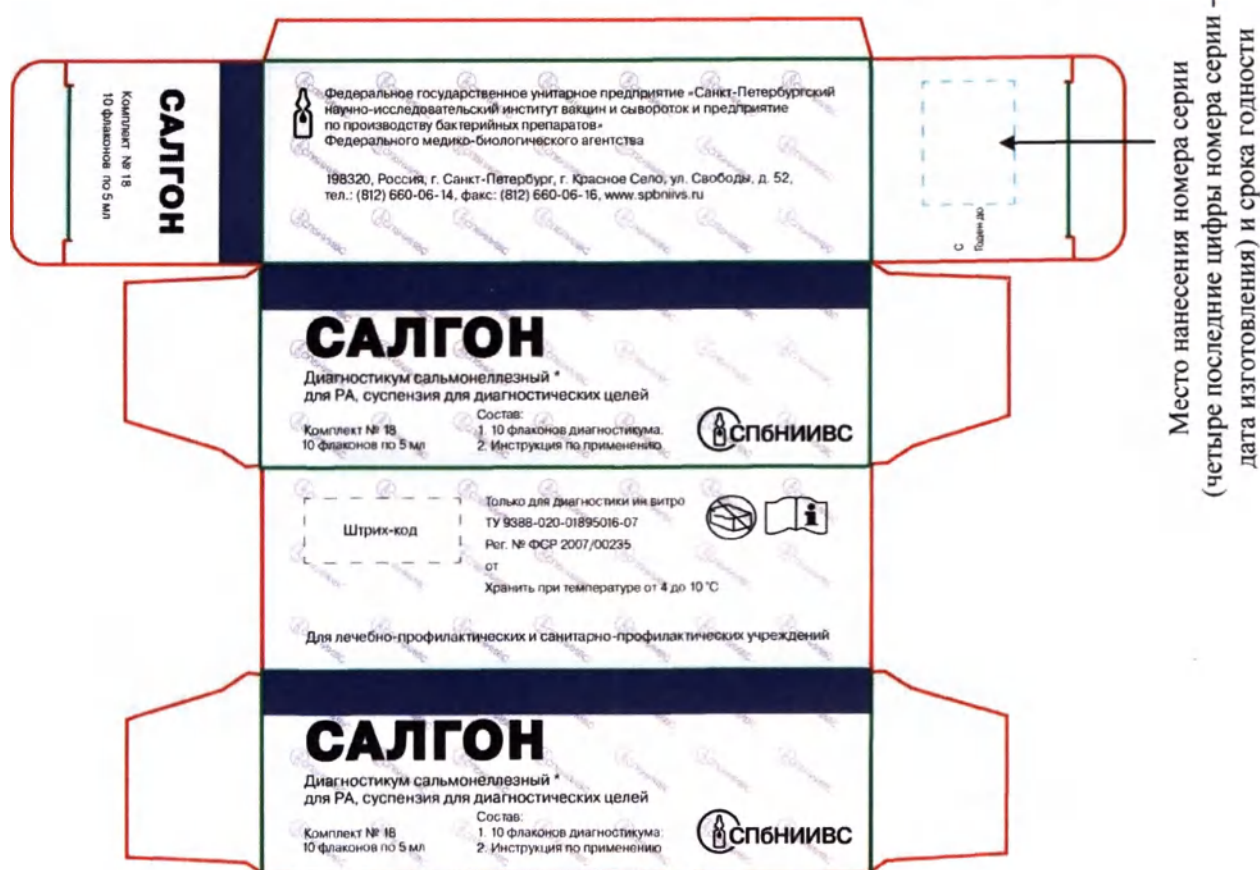

* - указывается рецептор

**Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России**



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки – этикетка на пачку/коробку
Комплект № 19

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» Федерального медико-биологического агентства 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivs.ru		
САЛГОН Диагностикум сальмонеллезный * для РА, суспензия для диагностических целей		
	Комплект № 19 10 ампул по 10 мл	Состав: 1. 10 ампул диагностикума; 2. Инструкция по применению; 3. Скарификатор ампульный
С**	Дата изготовления***	Годен до
Рег. № ФСР 2007/00235 от		
Только для диагностики in vitro ТУ 9388-020-01895016-07 Хранить при температуре от 4 до 10 °С Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений		
		Штрих-код

* - указывается рецептор

** - серия

*** - Дата изготовления – четыре последние цифры номера серии

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

САЛГОН Диагностикумы сальмонеллезные О-, Н- и Vi для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-020-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки – этикетка на пачку/коробку
Комплект № 20

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» Федерального медико-биологического агентства 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivc.ru		
САЛГОН Диагностикум сальмонеллезный * для РА, суспензия для диагностических целей		
	Комплект № 20 10 ампул по 10 мл	Состав: 1. 10 ампул диагностикума; 2. Инструкция по применению
С**	Дата изготовления***	Годен до
Рег. № ФСР 2007/00235 от		
Только для диагностики in vitro ТУ 9388-020-01895016-07 Хранить при температуре от 4 до 10 °С Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений		
		Штрих-код

* - указывается рецептор

** - серия

*** - Дата изготовления – четыре последние цифры номера серии

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2/1
листа(-ов)

Должность, ФИО заведующий
сектором МИ ОРЛ ДИР
Донцова И.В.

(подпись)

МП

2022г.

